



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Синерджи Консалтинг»




Фотографические изображения
«Устройства для системы ротационной атерэктомии»

Производитель: «Бостон Сайентифик Корпорейшн», США.

Boston Scientific Corporation, 300 Boston Scientific Way, Marlborough , MA 01752, USA

- Катетер с буром, предустановленный на рукоятку манипуляционную RotaPro, в составе:
- катетер с буром, предустановленный на рукоятку манипуляционную RotaPro, размер бура: 1.75мм;
 - зажим кабельный;
 - инструкция по применению.

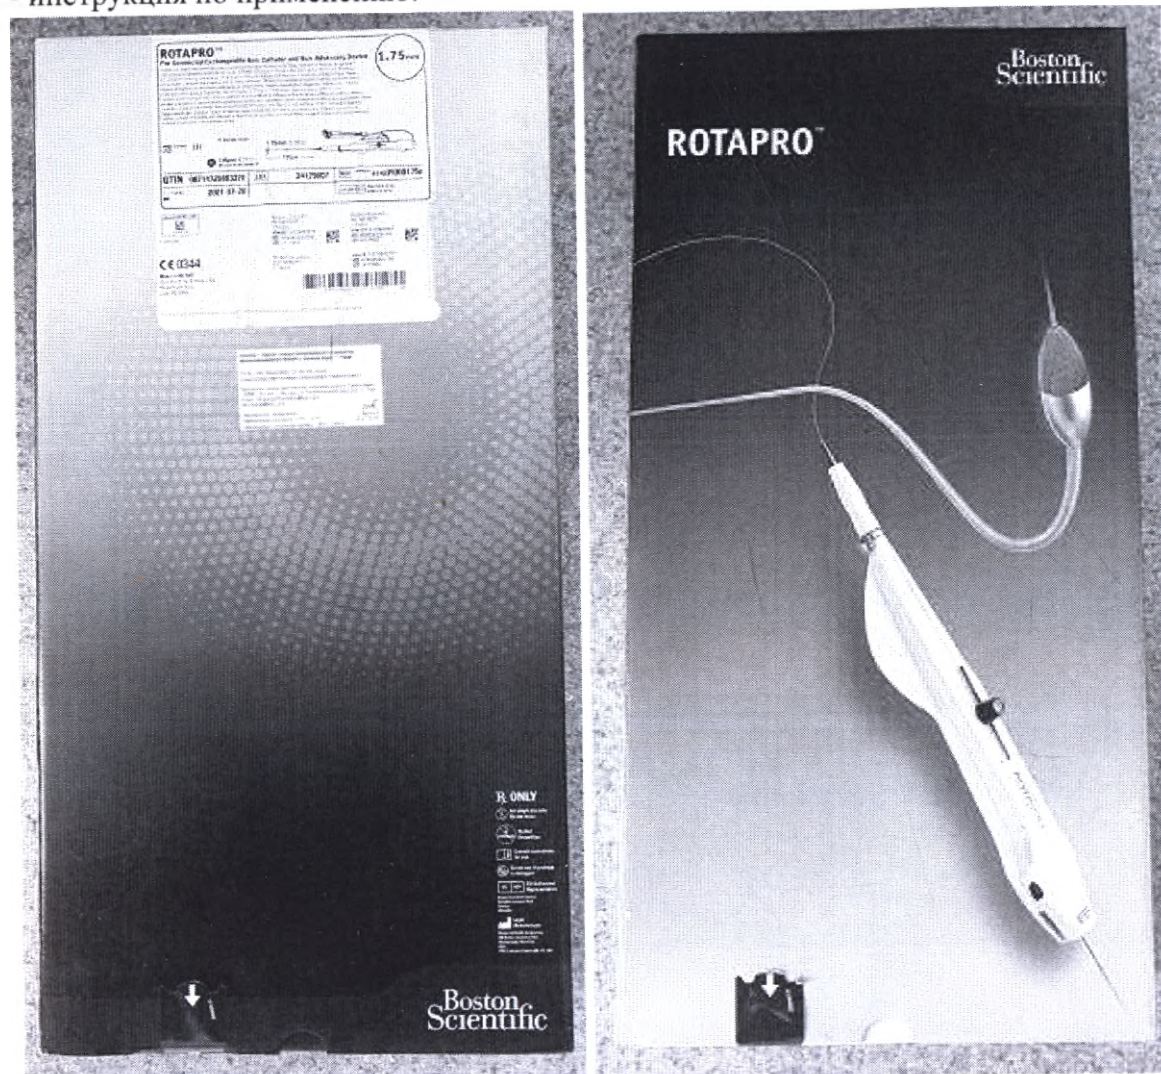

Общий вид упаковки

R_x ONLY

 For single use only.
Do not reuse.

 **2**
STERILIZE Do Not
Resterilize

 Consult instructions
for use.

 Do not use if package
is damaged.

EC	REP
----	-----

 EU Authorized
Representative


Boston Scientific Limited
Ballyhuni Business Park
Galway
IRELAND

 Legal
Manufacturer


Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 800-273-1901

**Boston
Scientific**

 ООО ЦПМИ INFO@CPMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

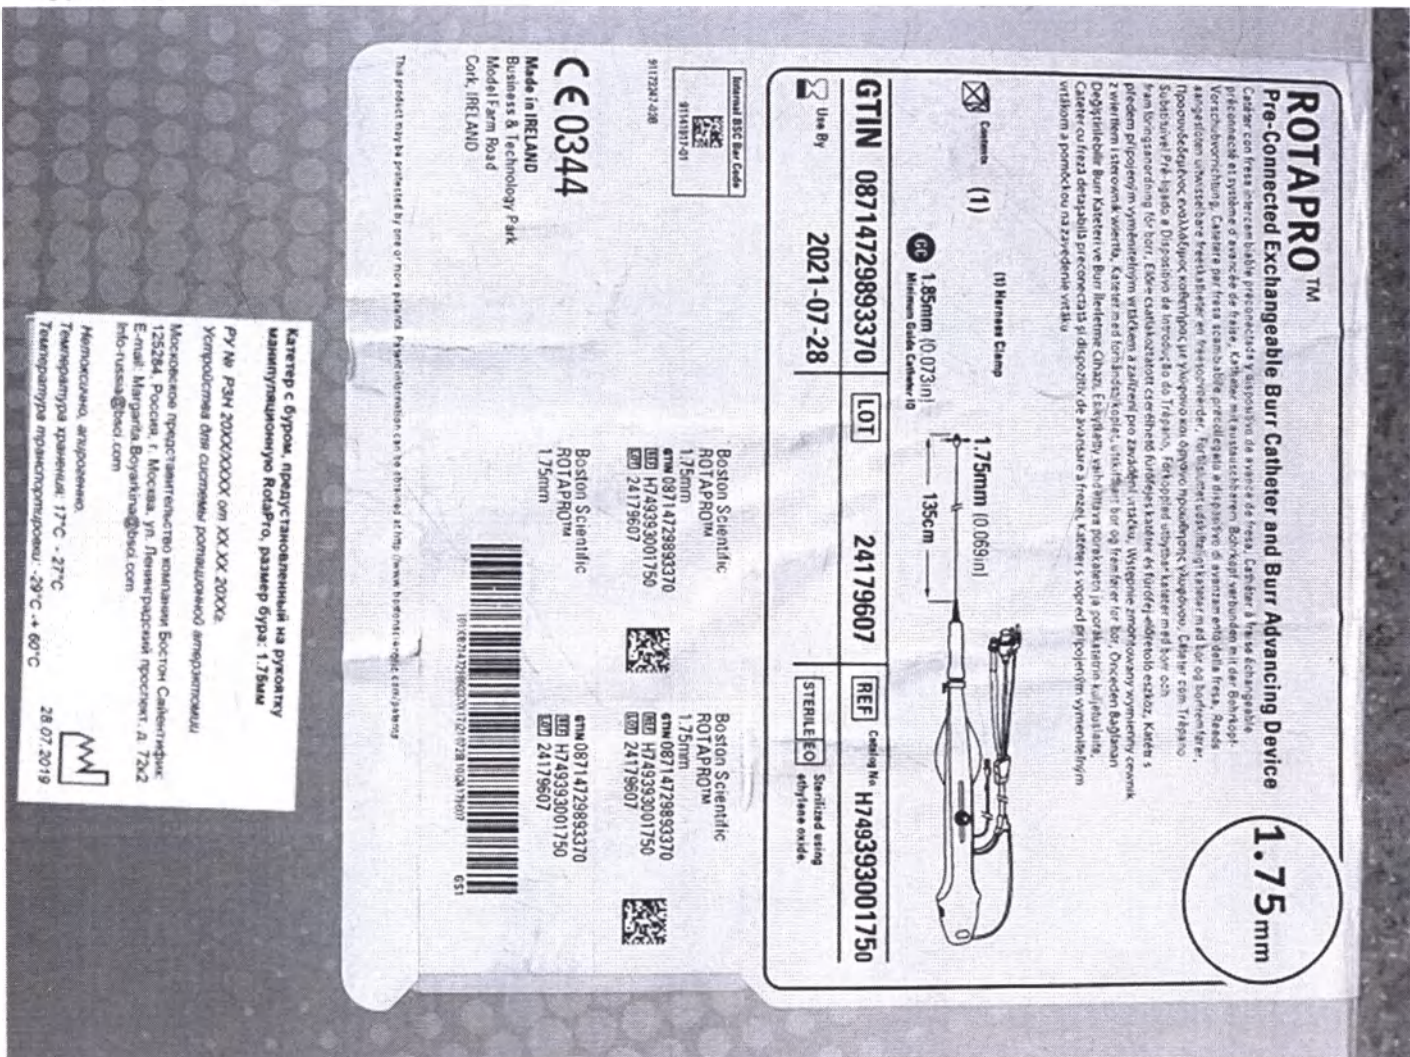

Катетер с буром, предустановленный на рукоятку манипуляционную RotaPro

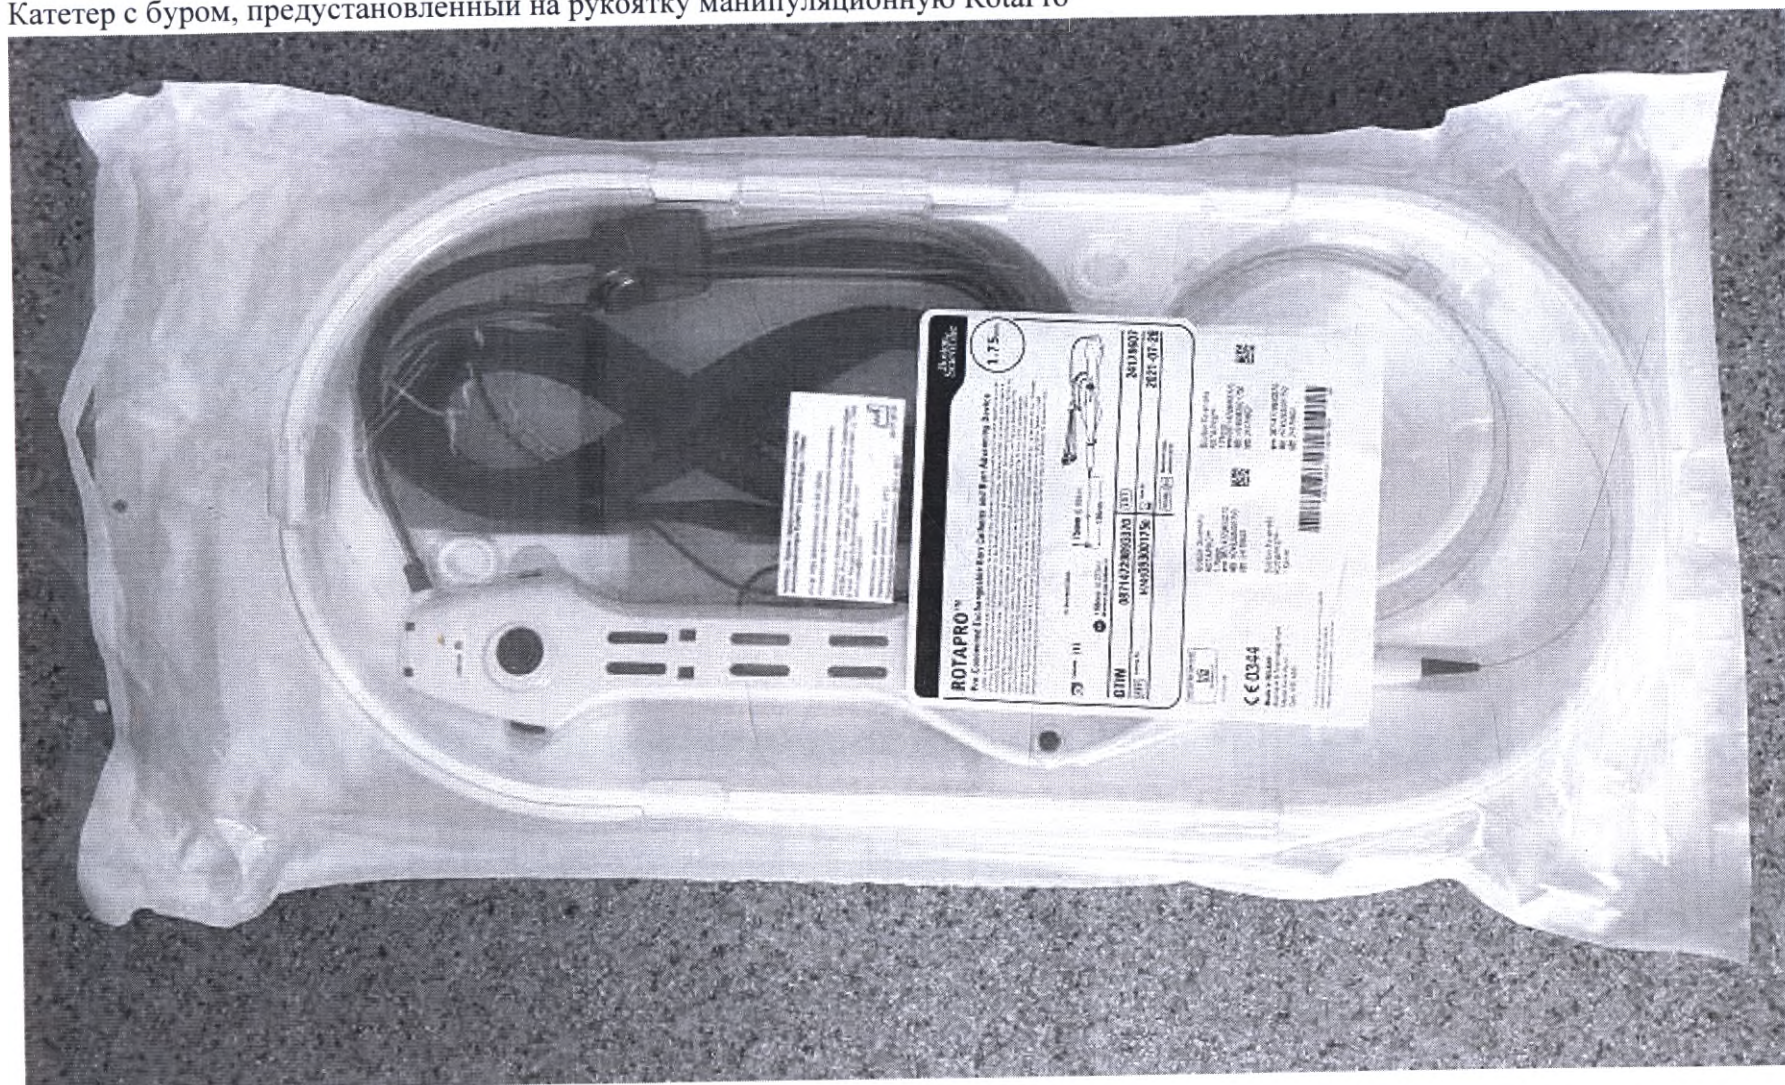

Изделие в стерильной упаковке

Катетер с буром, предустановленный на рукоятку манипуляционную RotaPro

Катетер с буром, предустановленный на рукоятку манипуляционную RotaPro, размер бура: 1.75мм

РУ № РЗН 20ХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.20ХХгг.

Устройства для системы ротационной атерэктомии

Московское представительство компании Бостон Сайентифик
125284, Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72к2
E-mail: Margarita.Boyarkina@bsci.com
Info-russia@bsci.com

Немоксено, апиогенно.

Температура хранения: 17°C - 27°C

Температура транспортировки: -29°C - + 60°C



28.07.2019


Boston Scientific

ROTAPRO™

Pre-Connected Exchangeable Burr Catheter and Burr Advancing Device

1.75mm

Catheter with interchangeable preconnected and disposable burr, Catheter à fraise échangeable préconnecté et jetable à avance de fraise, Katheter mit austauschbarem Bohrspindelvorlängen mit der Bohrspindel Vorstüßvorrichtung, Catetera per frese intercambiabile precollegate e dispositivo di avanzamento della frese, Rendszeresíthető váltakozóan csatlakoztatható és egyáramú vagy egyszeri használatú csatlakoztató, Cateter com Troceno Substituível Pré-ligado e Dispositivo de Introdução do Troceno, Férőcsatlósítható utóhajtós katóder med burr ach frőfőhőnggerőndőzörő für bor, Bőre csatlakoztatható csatlakoztató katóder és főrőfőhőnggerőndőzörő katóder, Káder s předem připojeným vyměnitelným vrátkem ažafreni pro zavádění vrátku, Wępieńie zmontowany wymienny cewnik a wiatlem i ste iowik iowik, Káder med förhållande káder, utstättart bor og fränter för bor, Önceden bağlanan değiştirilebilir Burr Kateterin ve Burr ilerleme Cihazı, Esiriyacı vahlattava parakaterin a parakaterin kalatistile ra, Cateter cu freză detaşabilă preconectată și dispozitiv de avansare a frezei, Káder a vopred připojeným vyměnitelným vrátkem a pomůckou na zavádění vrátku



GTIN	08714729893370	LOT	24179607
REF	Catalog No.	Use By	2021-07-28
	H749393001750		
		STERILE	EO Sterilized using ethylene oxide



91049905-01

CE 0344

Made in IRELAND
Business & Technology Park
Model Farm Road
Cork, IRELAND

Boston Scientific
ROTAPRO™
1.75mm
GTIN 08714729893370
REF H749393001750
LOT 24179607

Boston Scientific
ROTAPRO™
1.75mm
GTIN 08714729893370
REF H749393001750
LOT 24179607

Boston Scientific
ROTAPRO™
1.75mm

GTIN 08714729893370
REF H749393001750
LOT 24179607



This product may be protected by one or more patents.
Patent information can be viewed at
<http://www.boston-scientific.com/patents>

Rx ONLY

For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Sterilize
Resterilize

Consult instructions
for use.

Do not use if package
is damaged.

EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Bruff Park
Bruff, Ireland


Legal
Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA

USA Customer Service 888-272-1001


Маркировка на стерильной упаковке

Катетер с буром, предустановленный на рукоятку манипуляционную RotaPro

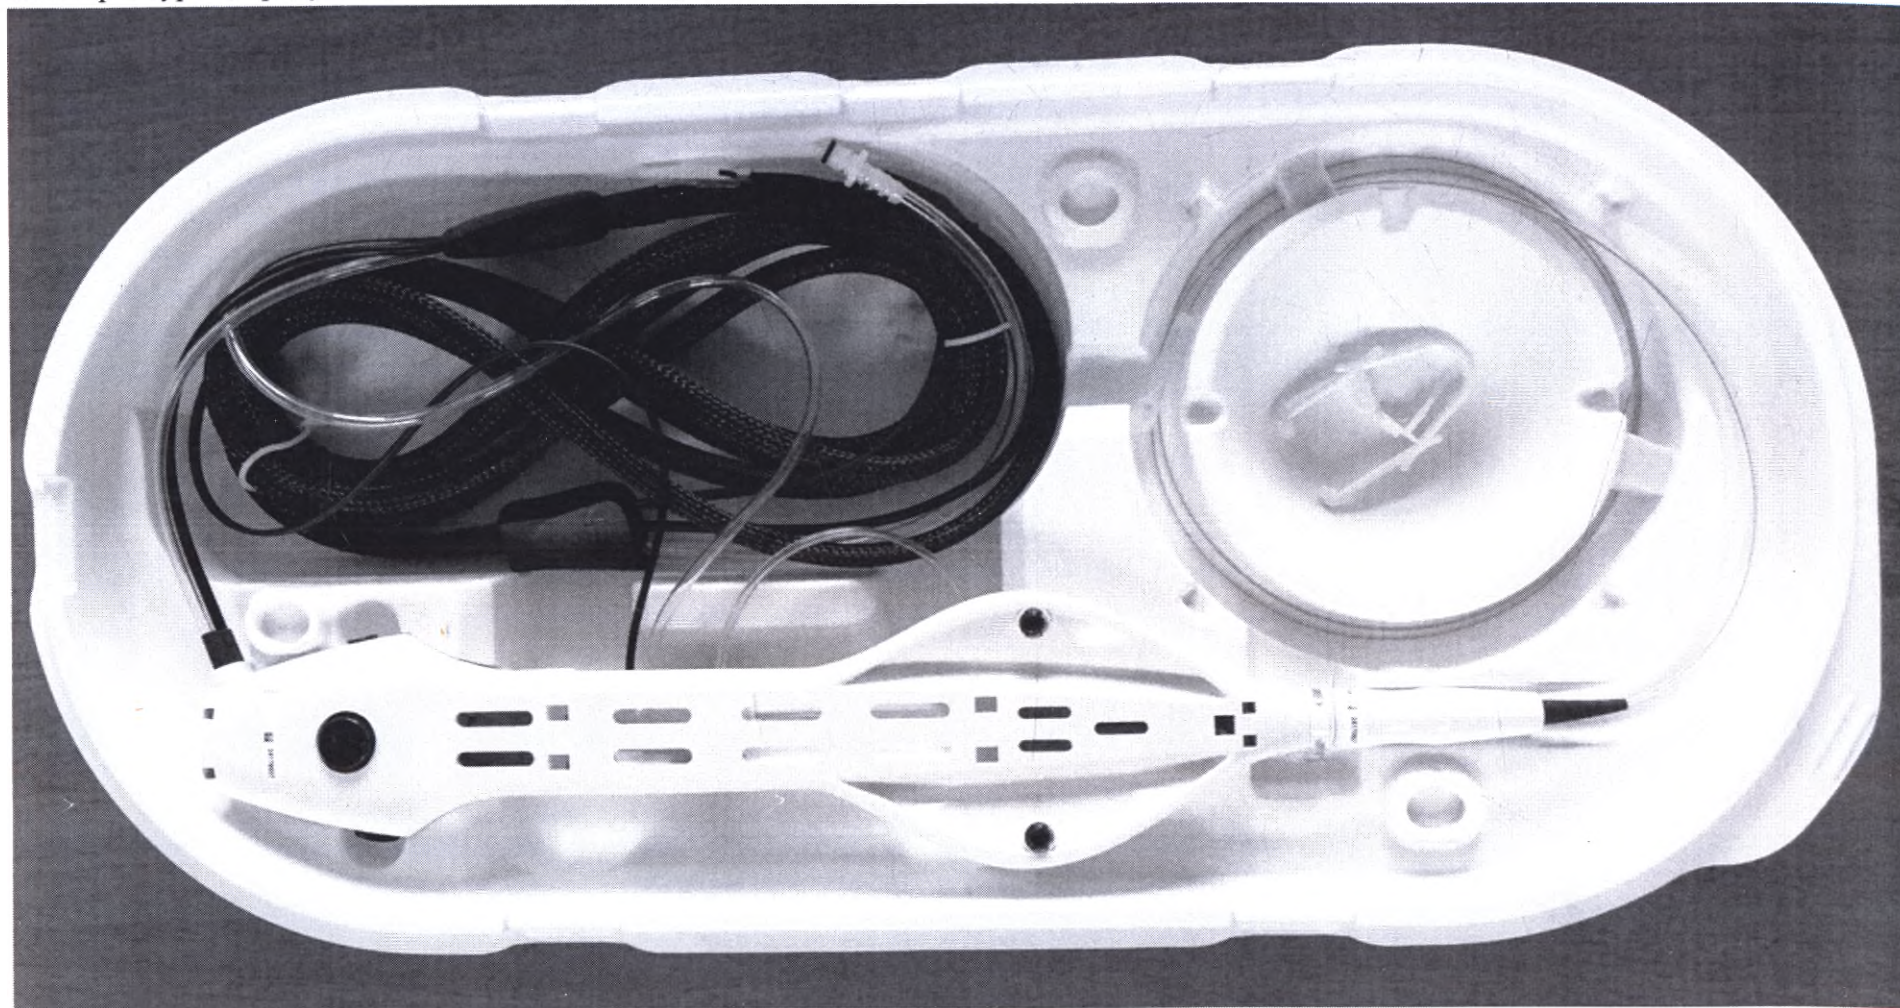


Общий вид изделия в лотке

Катетер с буром, предустановленный на рукоятку манипуляционную RotaPro: катетер с буром, предустановленный на рукоятку манипуляционную RotaPro, размер бура: 1.75мм

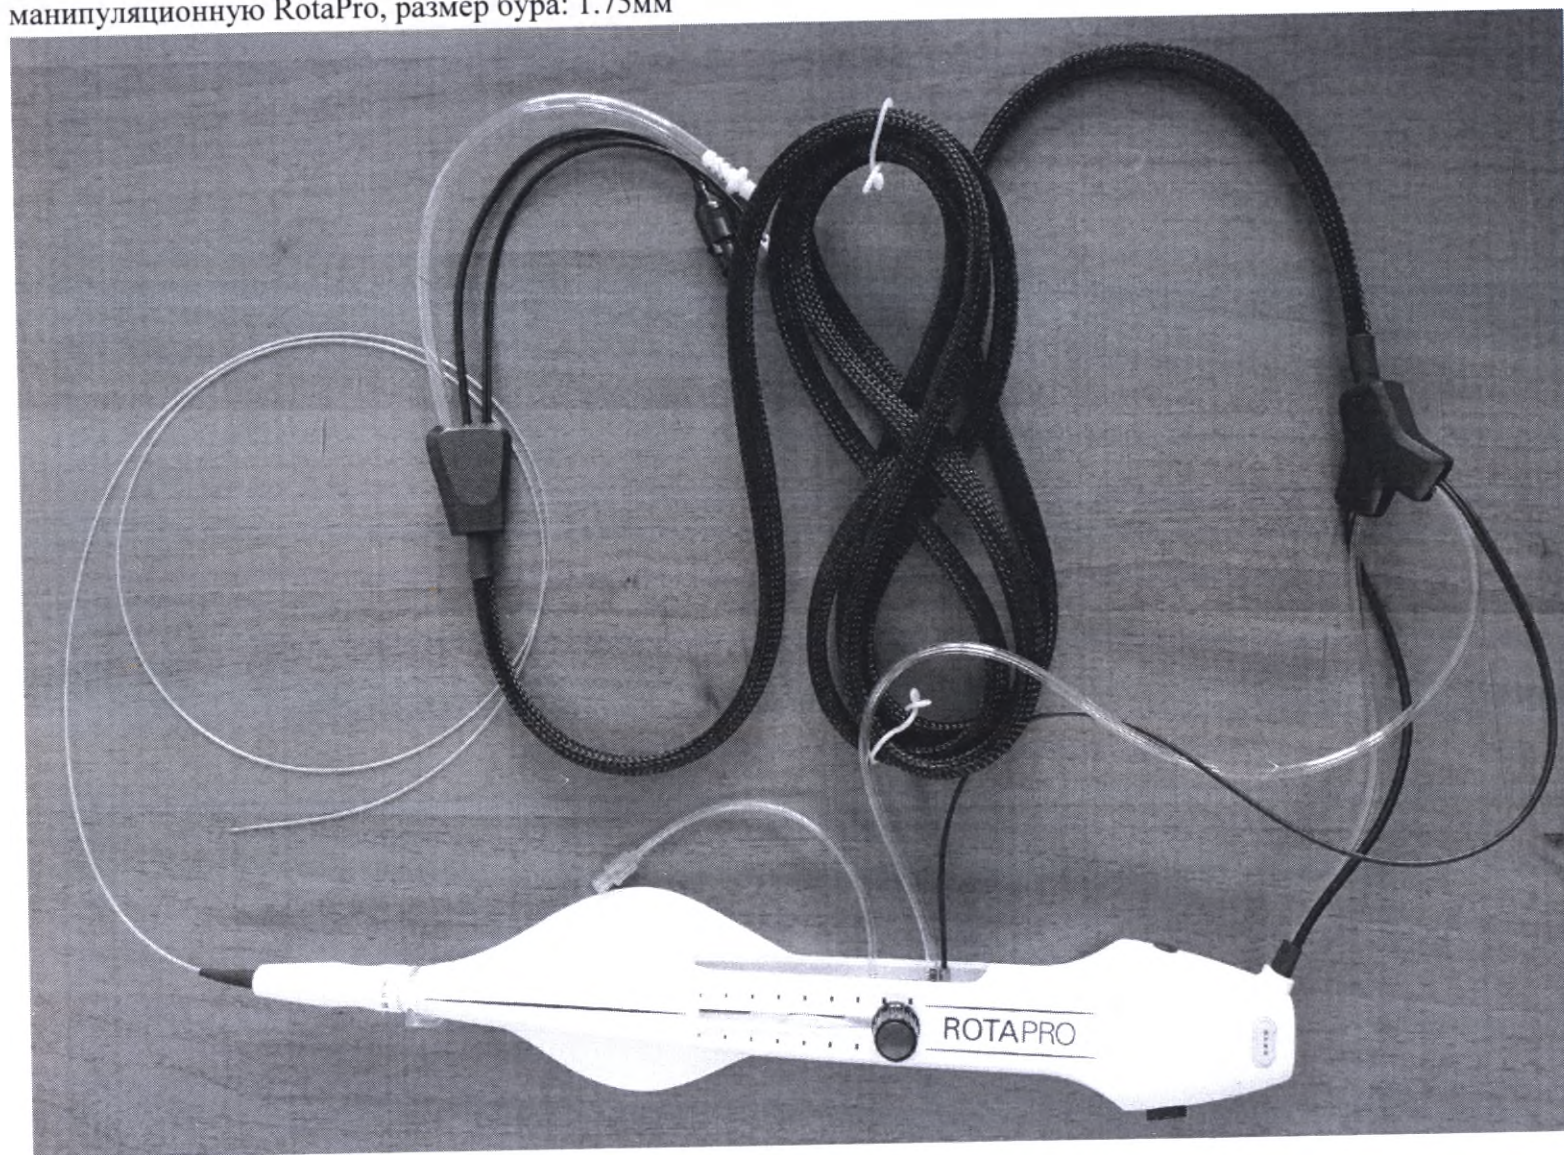


Общий вид изделия

Катетер с буром, предустановленный на рукоятку манипуляционную RotaPro

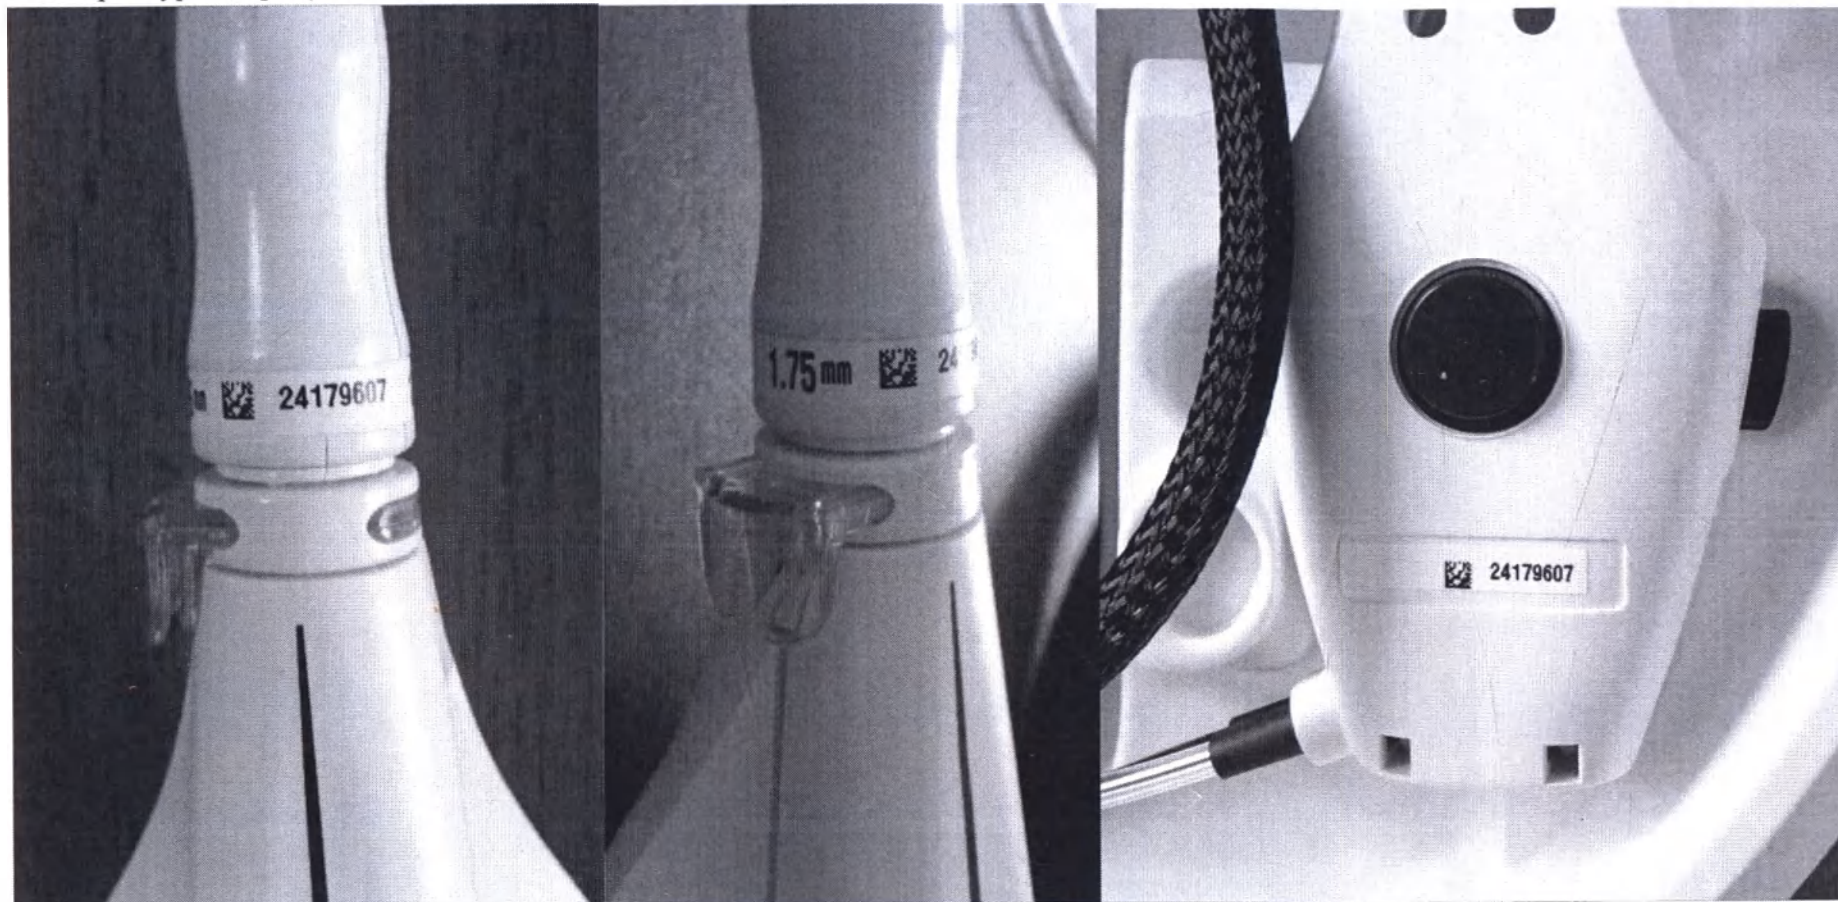

Маркировка на изделии



Катетер с буром, установленный на рукоятку манипуляционную RotaPro: зажим кабельный;

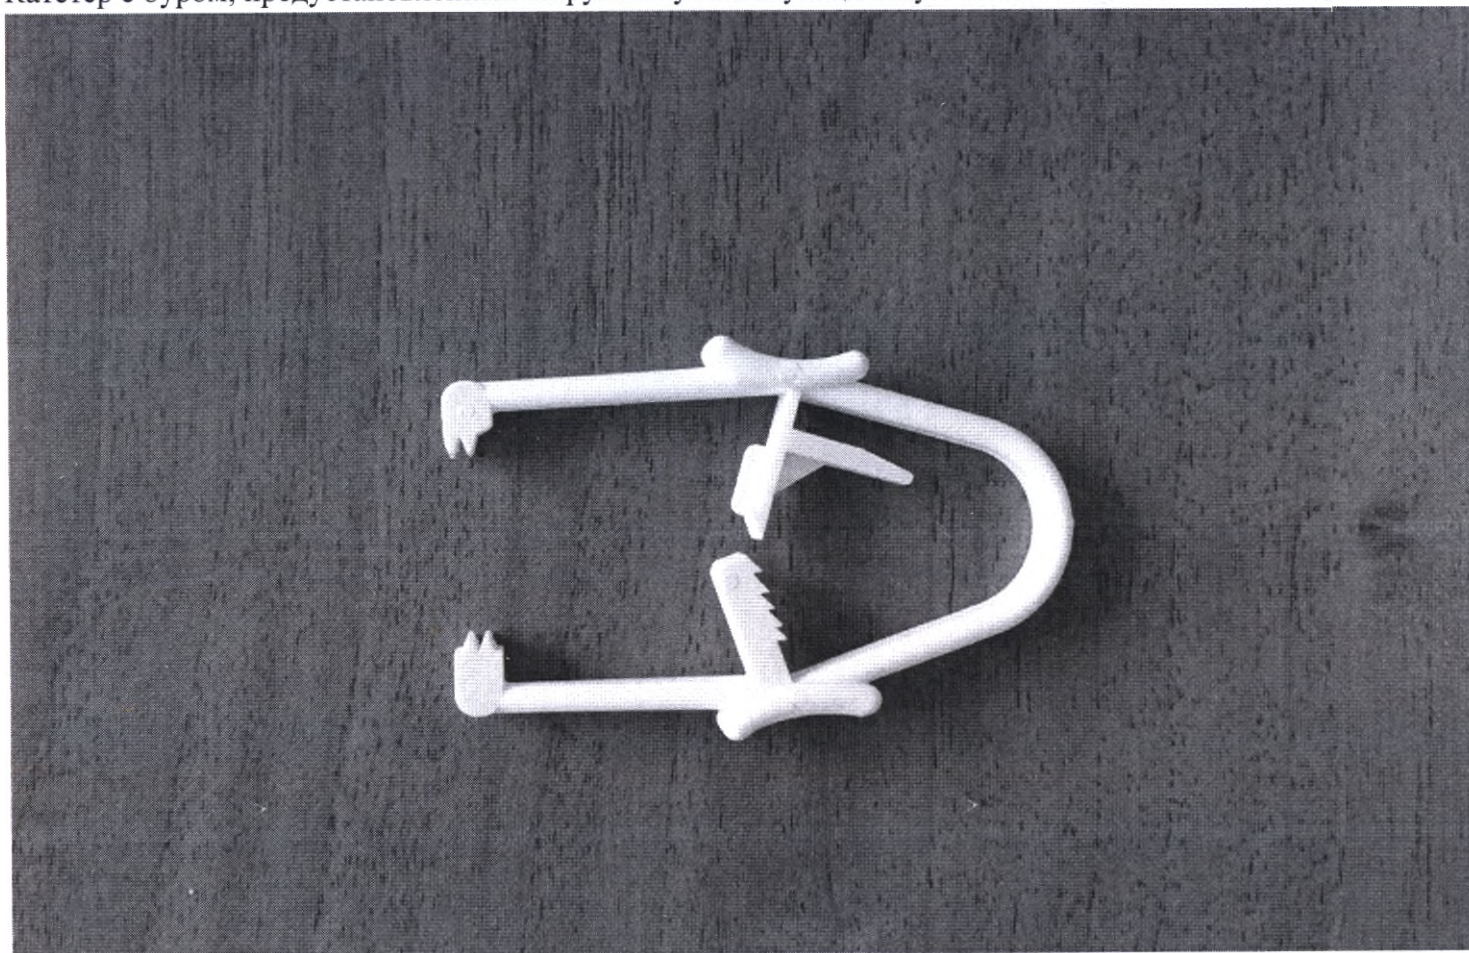

Катетер с буром RotaLink Burr, в составе:

- катетер с буром RotaLink Burr, размер бура: 1.75мм;
- инструкция по применению.

- катетер с буром RotaLink Burr, размер бура: 1.75мм;
- инструкция по применению.

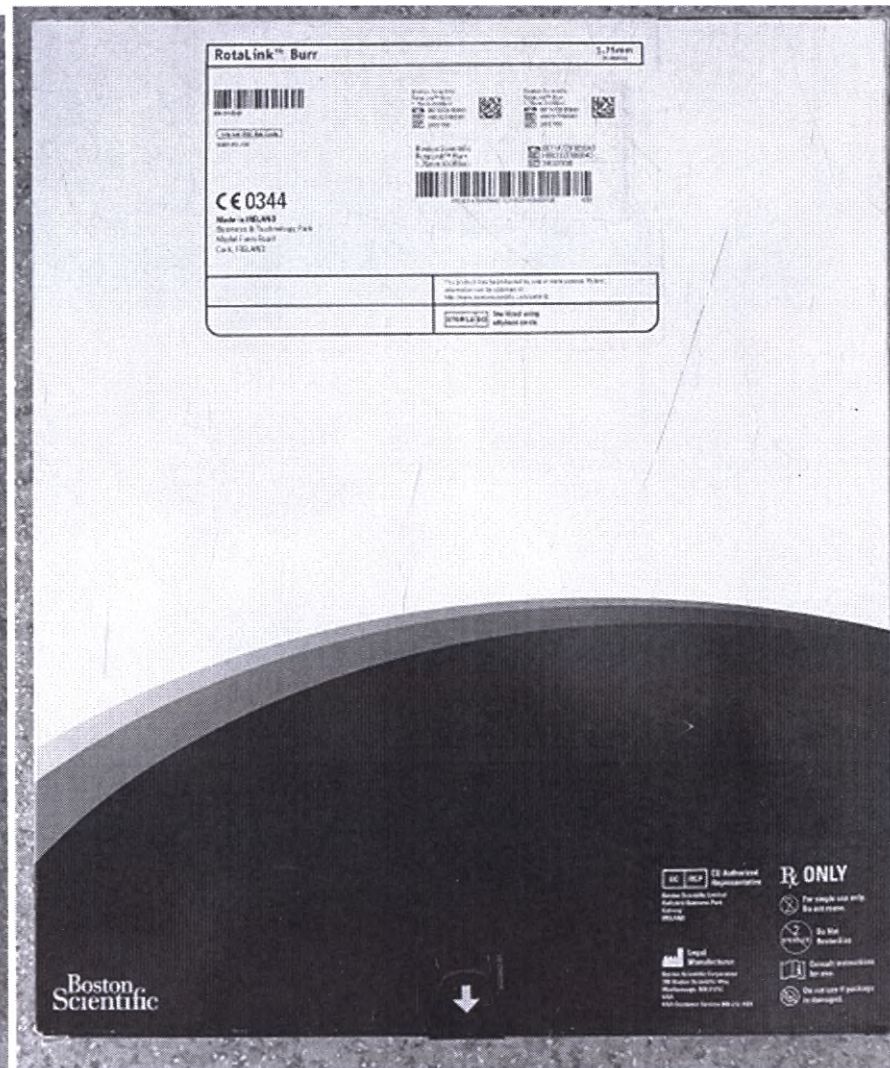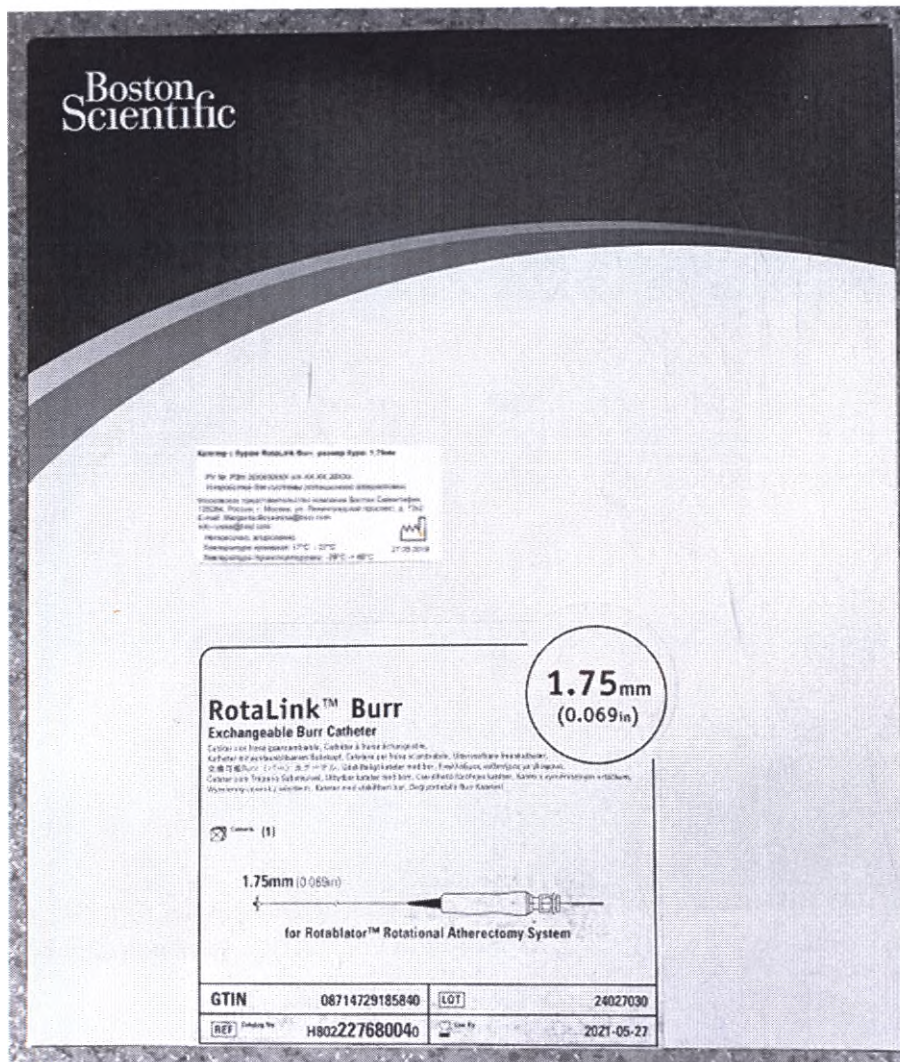


Общий вид в упаковке

27.05.2019


Sterilized using
ethylene oxide

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Катетер с буром RotaLink Burr

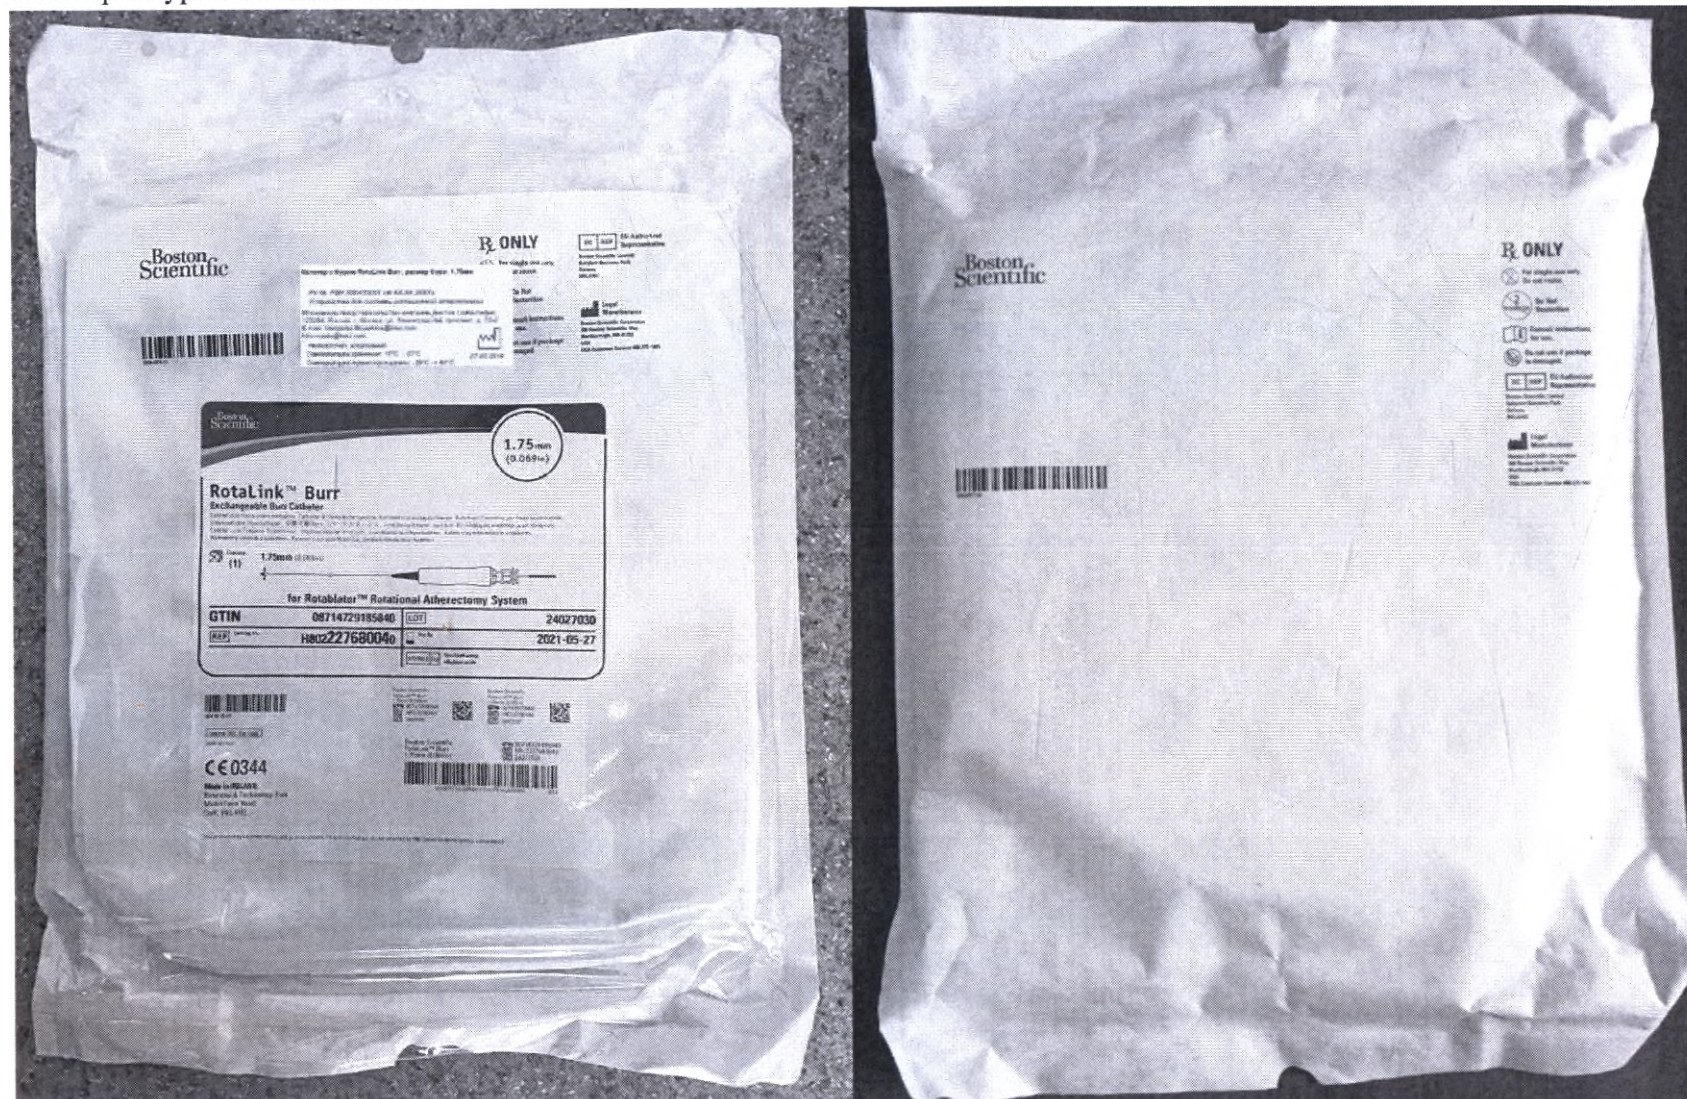


Общий вид в стерильном пакете

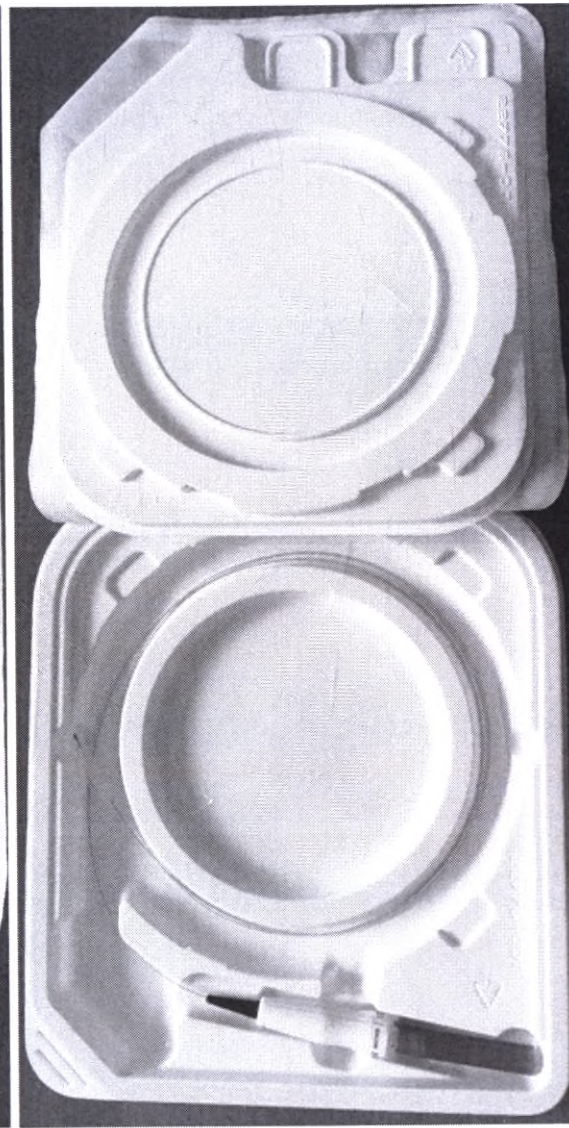[illegible]


Общий вид изделия в лотке

Катетер с буром RotaLink Burr: катетер с буром RotaLink Burr, размер бура: 1.75мм

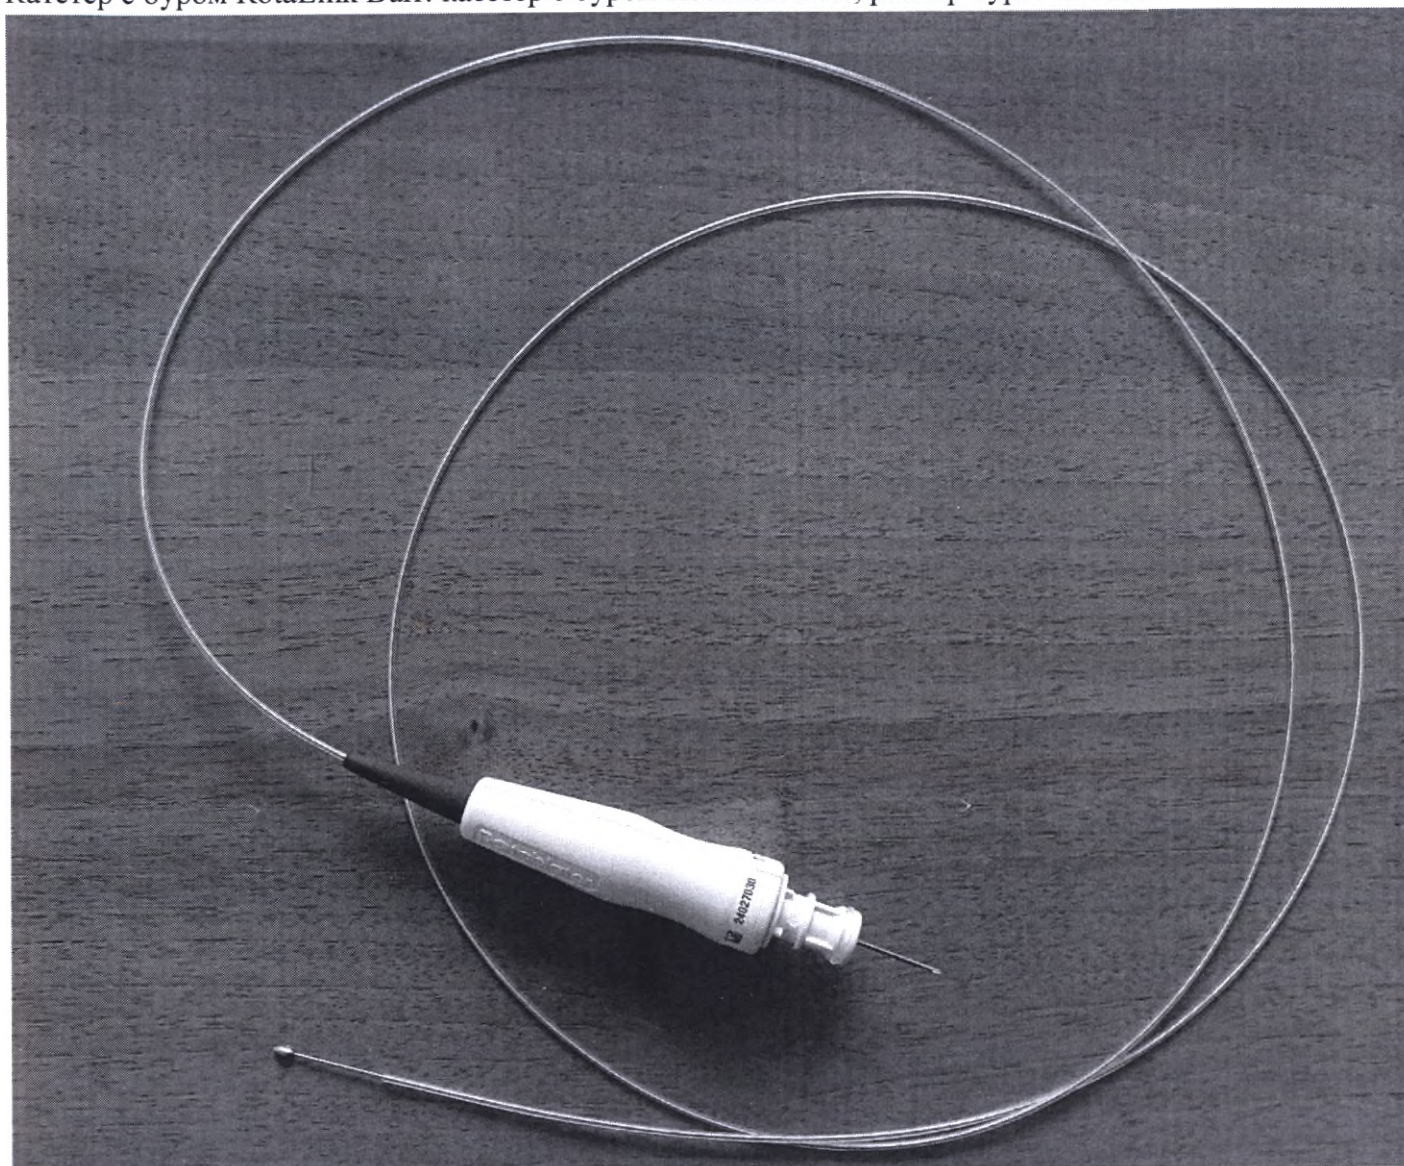

Общий вид изделия



Катетер с буром RotaLink Burr: катетер с буром RotaLink Burr, размер бура: 1.75мм

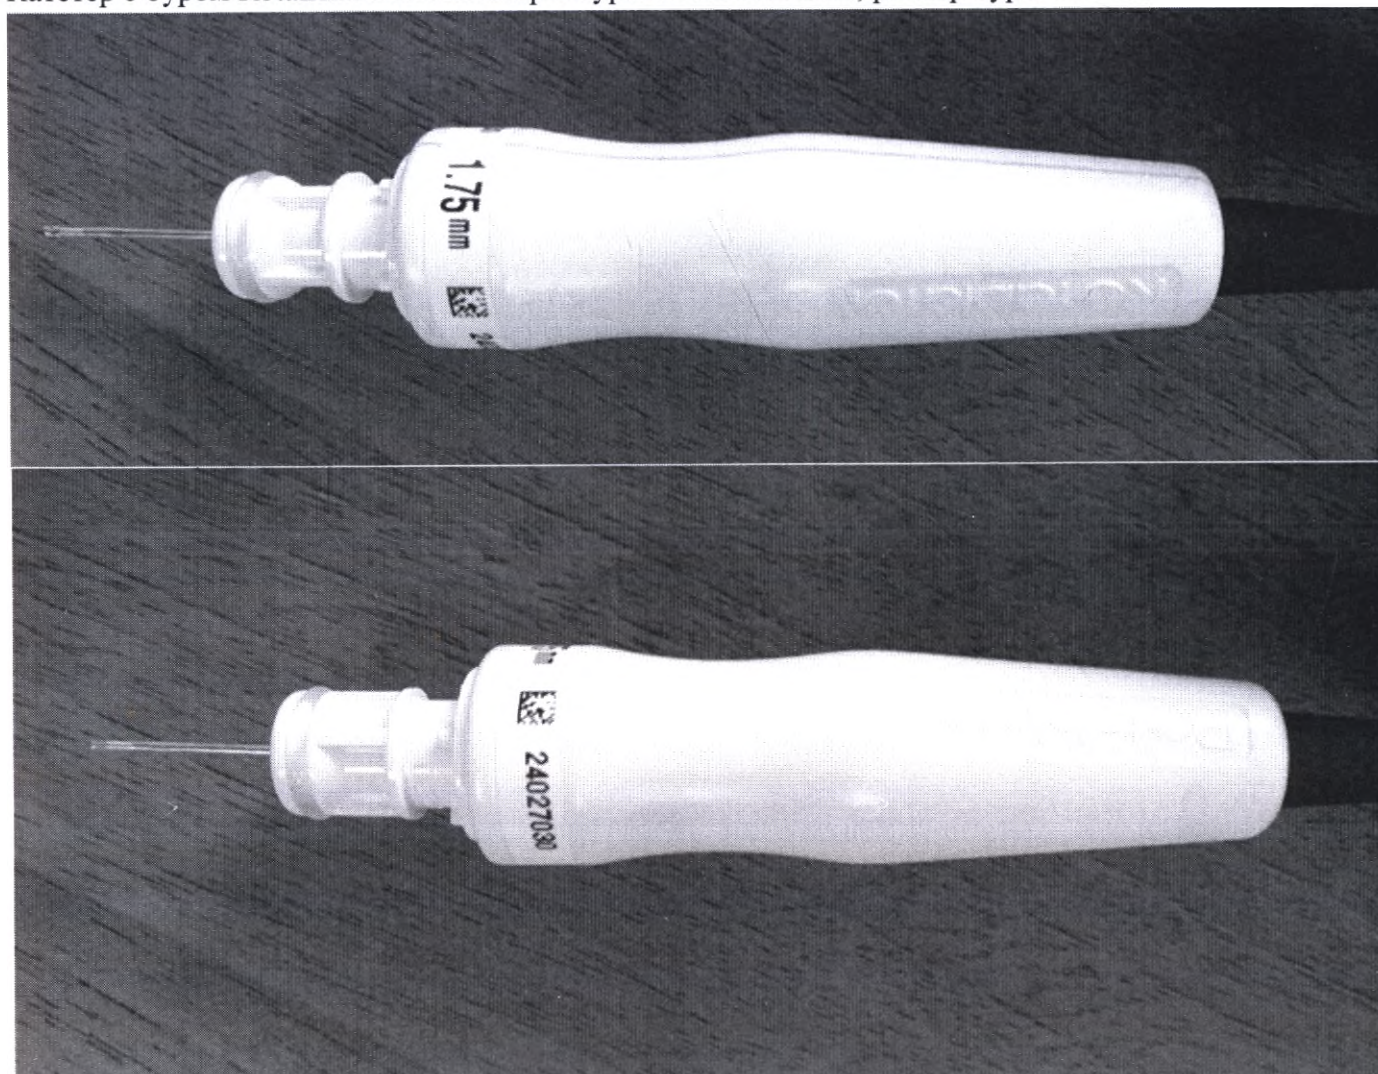

Маркировка на изделии

Проводник RotaWire с манипулятором wireClip Torquer, в составе:

- проводник RotaWire диаметром 0.009 in (≤ 0.24 мм), длиной 330см; конфигурация: гибкий (Floppy);
- манипулятор wireClip Torquer;
- инструкция по применению.

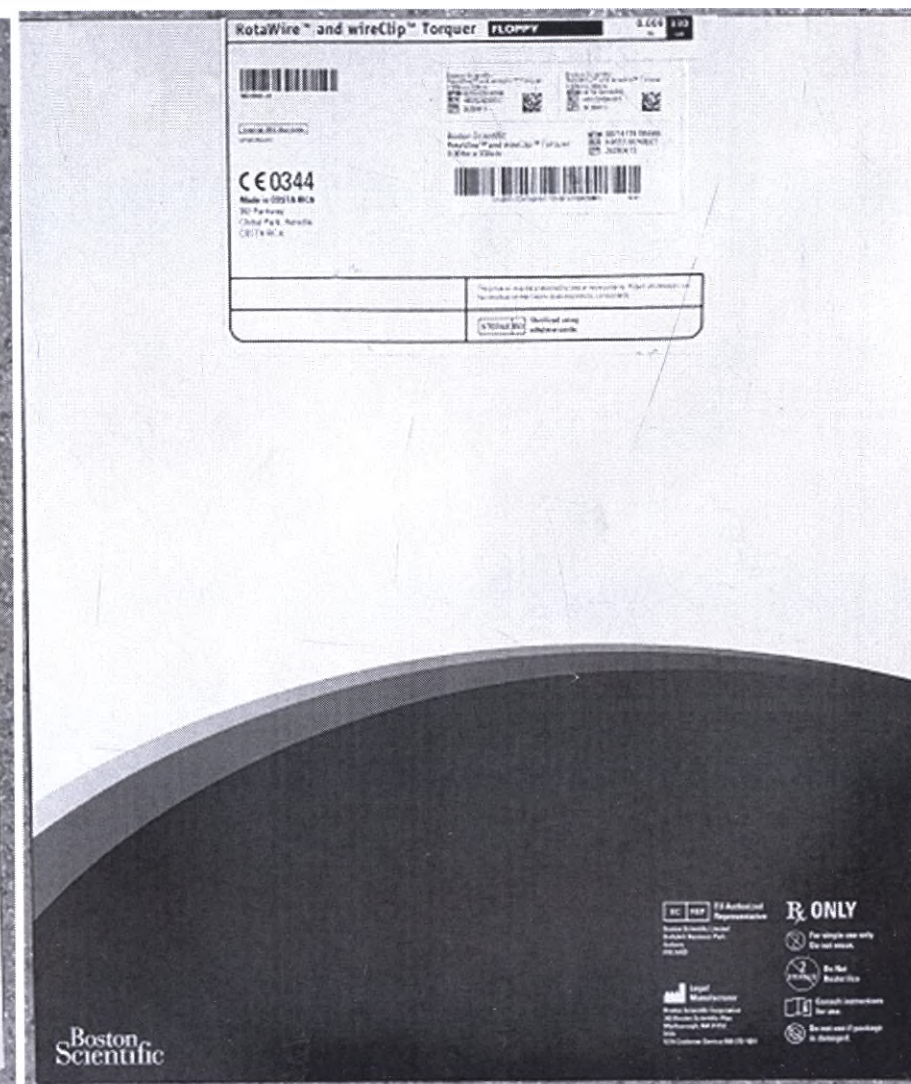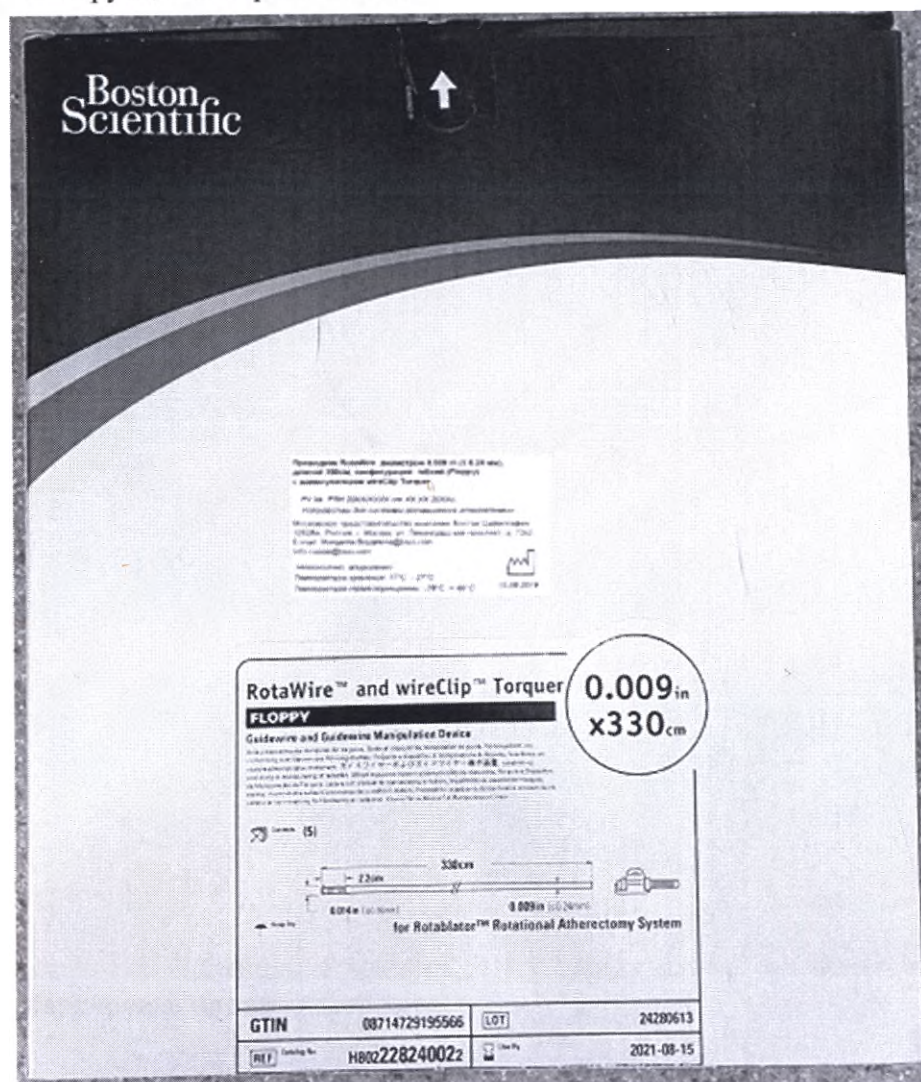

Общий вид упаковки

Проводник RotaWire с манипулятором wireClip Torquer

Проводник RotaWire диаметром 0.009 in (≤ 0.24 мм),
длиной 330 см; конфигурация: гибкий (Floppy)
с манипулятором wireClip Torquer

РУ № P3H 20XX/XXXX от XX.XX.20XXг.

Устройства для системы ротационной атерэктомии

Московское представительство компании Бостон Сайентифик:
125284, Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72х2
E-mail: Margarita.Boyarkina@bsci.com
info-russia@bsci.com

Нетоксично, апиrogenно.

Температура хранения: 17°C - 27°C

Температура транспортировки: -29°C - + 60°C



15.08.2019

Boston
Scientific

0.009in
x330cm

RotaWire™ and wireClip™ Torquer

FLOPPY


Guidewire and Guidewire Manipulation Device

Isula y dispositivo de manipulación de guías, Guide et dispositif de manipulation de guide, Führungsdraht und Vorrichtung zum Steuern des Führungsdrahtes, Floppida e dispositivo di manipolazione di filiguida, Voerdraad en voerdraadmanipulatie-instrument, ガイドワイヤーおよびガイドワイヤー操作装置, Ledertråd og anordning til manipulering af ledestrå, Ölflyddråps och ölflyddråpsgrepp, uonyu oöpusör, fio-guia e dispositivo de manipulação do fio-guia, Ledare och produkt för manipulering av ledare, Vezetődrót és vezetődrót-mozgató eszköz, Vodič drát a zařízení pro manipulaci s vodičem drátem, Prowadnik i urządzenie do sterowania prowadnikami, Ledavaier og innretning for håndtering av ledavaier, Klavuz Tel ve Klavuz Tel Manipulasyon Çihazı



Contents

(1)



Keep Dry

for Rotablator™ Rotational Atherectomy System

GTIN

08714729185871

LOT

24280613

REF

Catalog No.

H802228240020

Use By

2021-08-15

STERILE

Sterilized using
ethylene oxide.



90554702-01

Internal BSC Bar Code

90555438-01F

CE 0344

Made in COSTA RICA
302 Parkway
Global Park, Heredia
COSTA RICA

Boston Scientific
RotaWire™ and wireClip™ Torquer
0.009in x 330cm
GTIN 08714729185871
REF H802228240020
LOT 24280613

Boston Scientific
RotaWire™ and wireClip™ Torquer
0.009in x 330cm
GTIN 08714729185871
REF H802228240020
LOT 24280613

Boston Scientific
RotaWire™ and wireClip™ Torquer
0.009in x 330cm

GTIN 08714729185871
REF H802228240020
LOT 24280613



(01)08714729185871(17)210815(10)24280613

GS1

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

R ONLY

For single use only.
Do not reuse.



Do Not
Sterilize



Consult instructions
for use.



Do not use if package
is damaged.



EU Authorized
Representative



Boston Scientific Limited
Ballybricket Business Park
Galway
IRELAND

Legal
Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001


Маркировка на стерильном пакете изделия

Проводник RotaWire с манипулятором wireClip Torquer



Изделие в защитных элементах

Проводник RotaWire с манипулятором wireClip Torquer

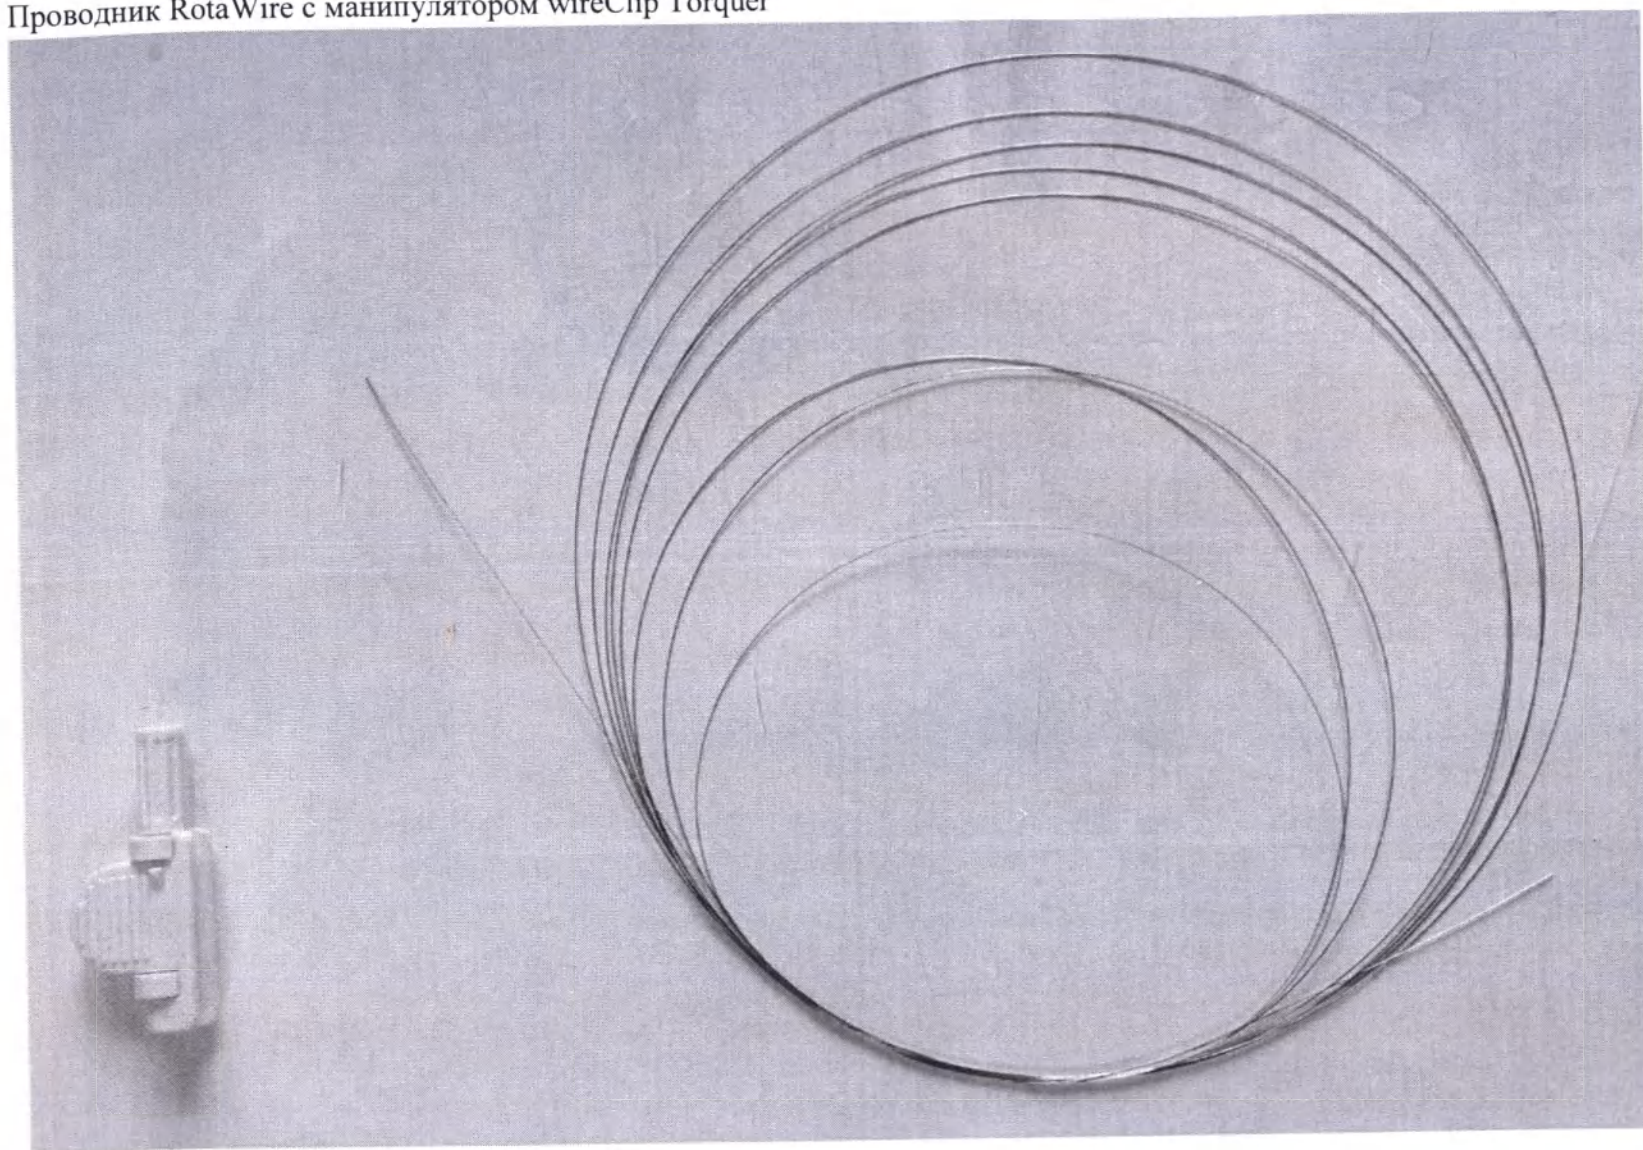

Общий вид изделия

Прошито, пронумеровано
(2) лист(ов))
скреплено печатью

