

УТВЕРЖДАЮ»

Директор по регистрации, Россия и СНГ

ООО «Дентсплай Сирона»

Хаиндрава В.Г.
« 19 » 08 2021 г.



**Фотографическое изображение
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Инструменты для системы дентальных имплантатов Astra Tech
Implant System производства**

Elos Medtech Pinol A/S


1. Ключ динамометрический EV (Torque Wrench EV)





1. **Wrench EV**
45 Nm

Рукоятка для динамометрического ключа EV (TW EV Rest. Driver Handle 4x4 L)

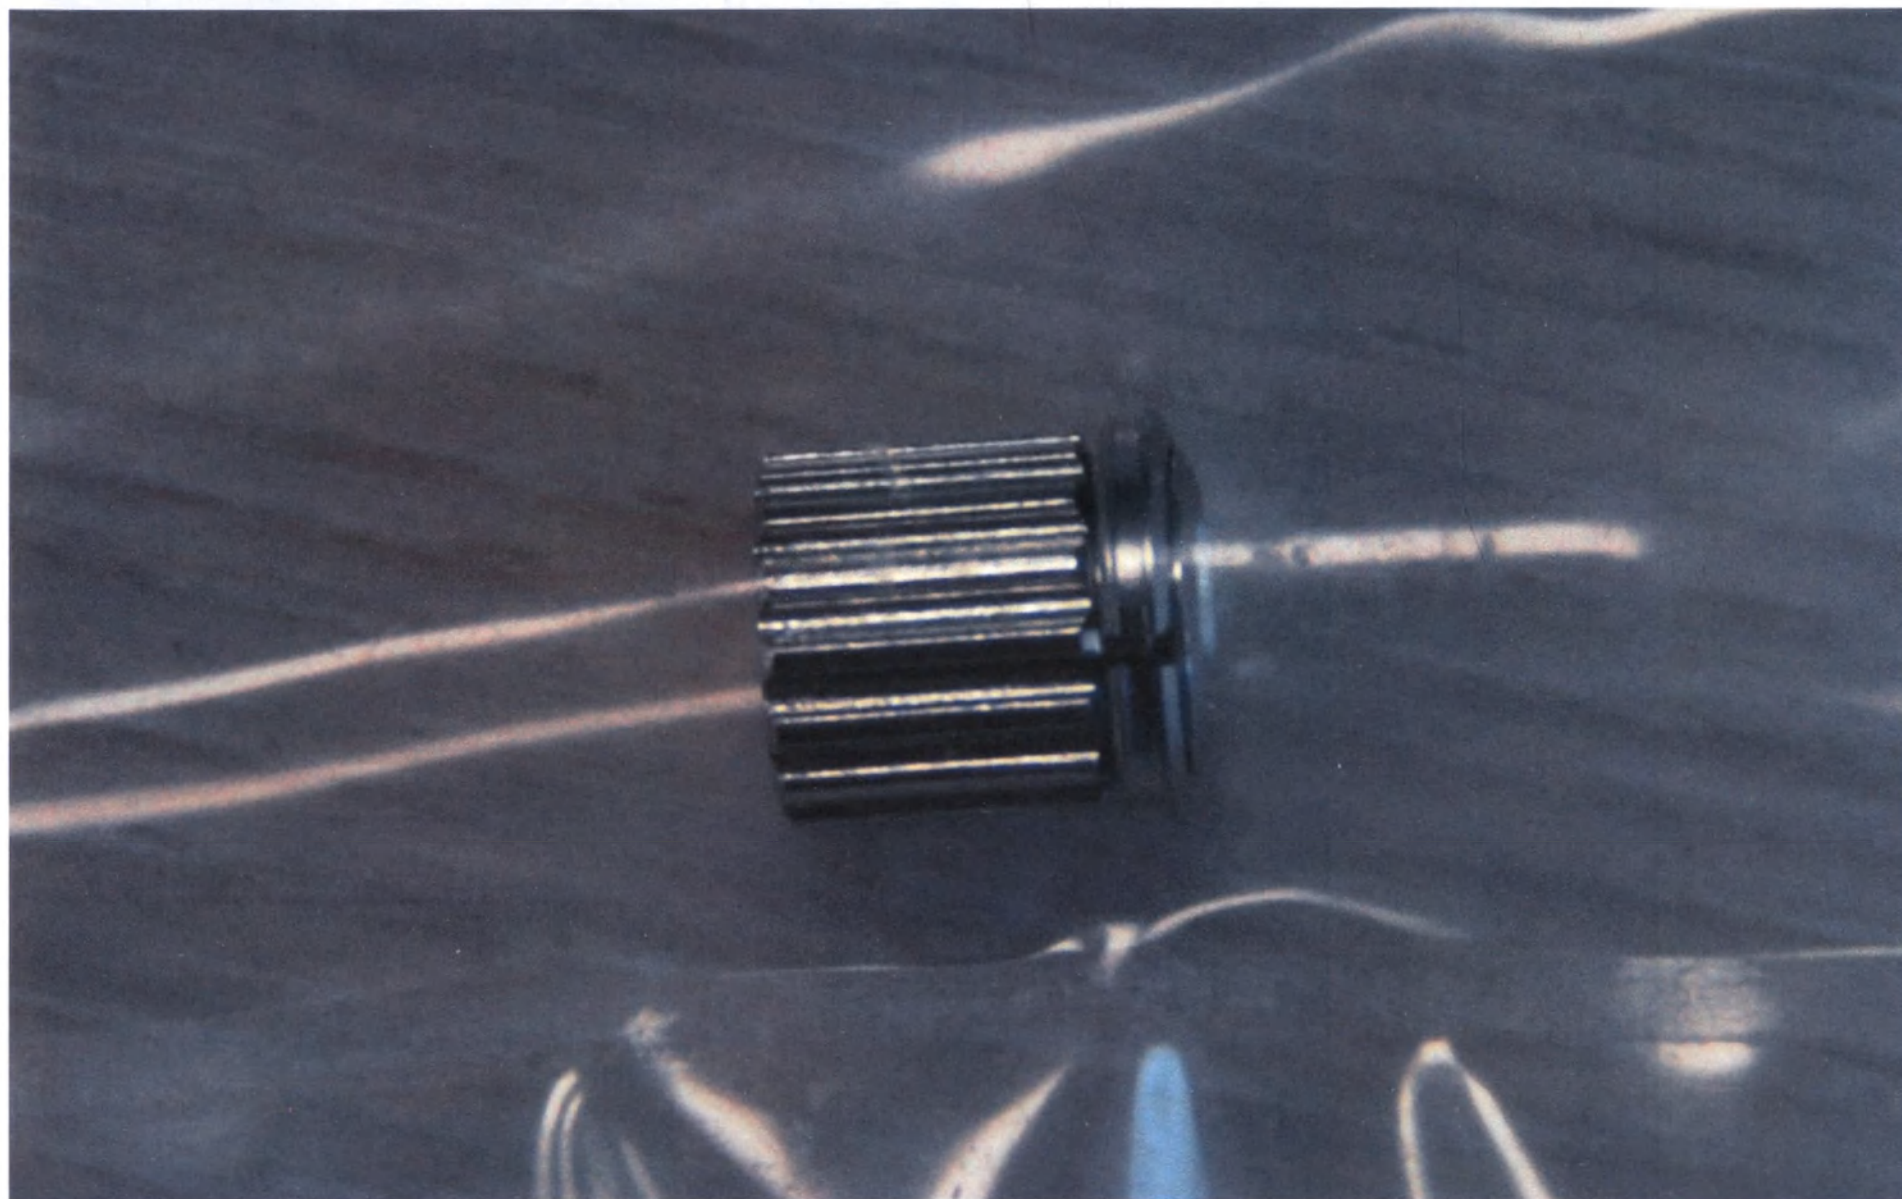

Ручка для динамометрического ключа EV (TW EV Rest. Driver Handle 4x4 L)

TW EV Rest. DriverHandle 4x4 L

РУ № РЗН2020/10912

от 6/25/2020

REF 25730

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Elos Medtech Pinol A/S
Engvej 33 DK-3330 Gørlose,
Дания

Страна происхождения:
Дания

Уполномоченный представитель в
РФ:

ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 8
Тел. +7 (495) 725-10-89



Torque Wrench EV **ELOS** MEDTECH
Restorative Driver
Handle 4x4 Low
REF 25730
www.dentsplysirona.com/implants



Dentsply
Sirona
Implants

[EN] Medical Tool Adapter [BG] Адаптер за медицински
инструмент [CS] Adaptér pro nástroje pro zdravotnický účely [DA]
Medicinsk værktøjsadapter [DE] Medizinische Werkzeugaadapter
[EL] Προσαρμογέας εργαλείων ιατρικής [ES] Adaptador
médico de herramienta [ET] Meditsiiniline tööriistaadapter [FI]
Lääkinnällisen työkalun sovitin [FR] Adaptateur d'outil médical [HR]
Medicinski adapter za alate [HU] Orvosi műszersadapter [IT] Adattatore
medico dell'utensile [LT] Medicininis įrankių adapteris [LV]
Medicīniskais instrumentu adapters [NL] Adapter voor medisch
hulpmiddel [NO] Medicinsk verktøysadapter [PL] Adapter narzędzia
medycznego [PT] Adaptador de ferramentas médicas [RO] Adapter
pentru instrumente medicale [SK] Lekársky adaptér nástroja [SL]
Medicinski adapter za orodja [SR] Adapter za medicinske alate [SV]
Medicinsk verktygsadapter [TR] Tıbbi Alet Adaptörü



www.elosmedtech.com/IFU



Elos Medtech Pinol A/S,
Engvej 33, 3330 Gørlose
Made in Denmark

LOT 156591



2021-02-04

Rx ONLY



C30076_01




(01)05712821000057



(11)210204
(10)156591



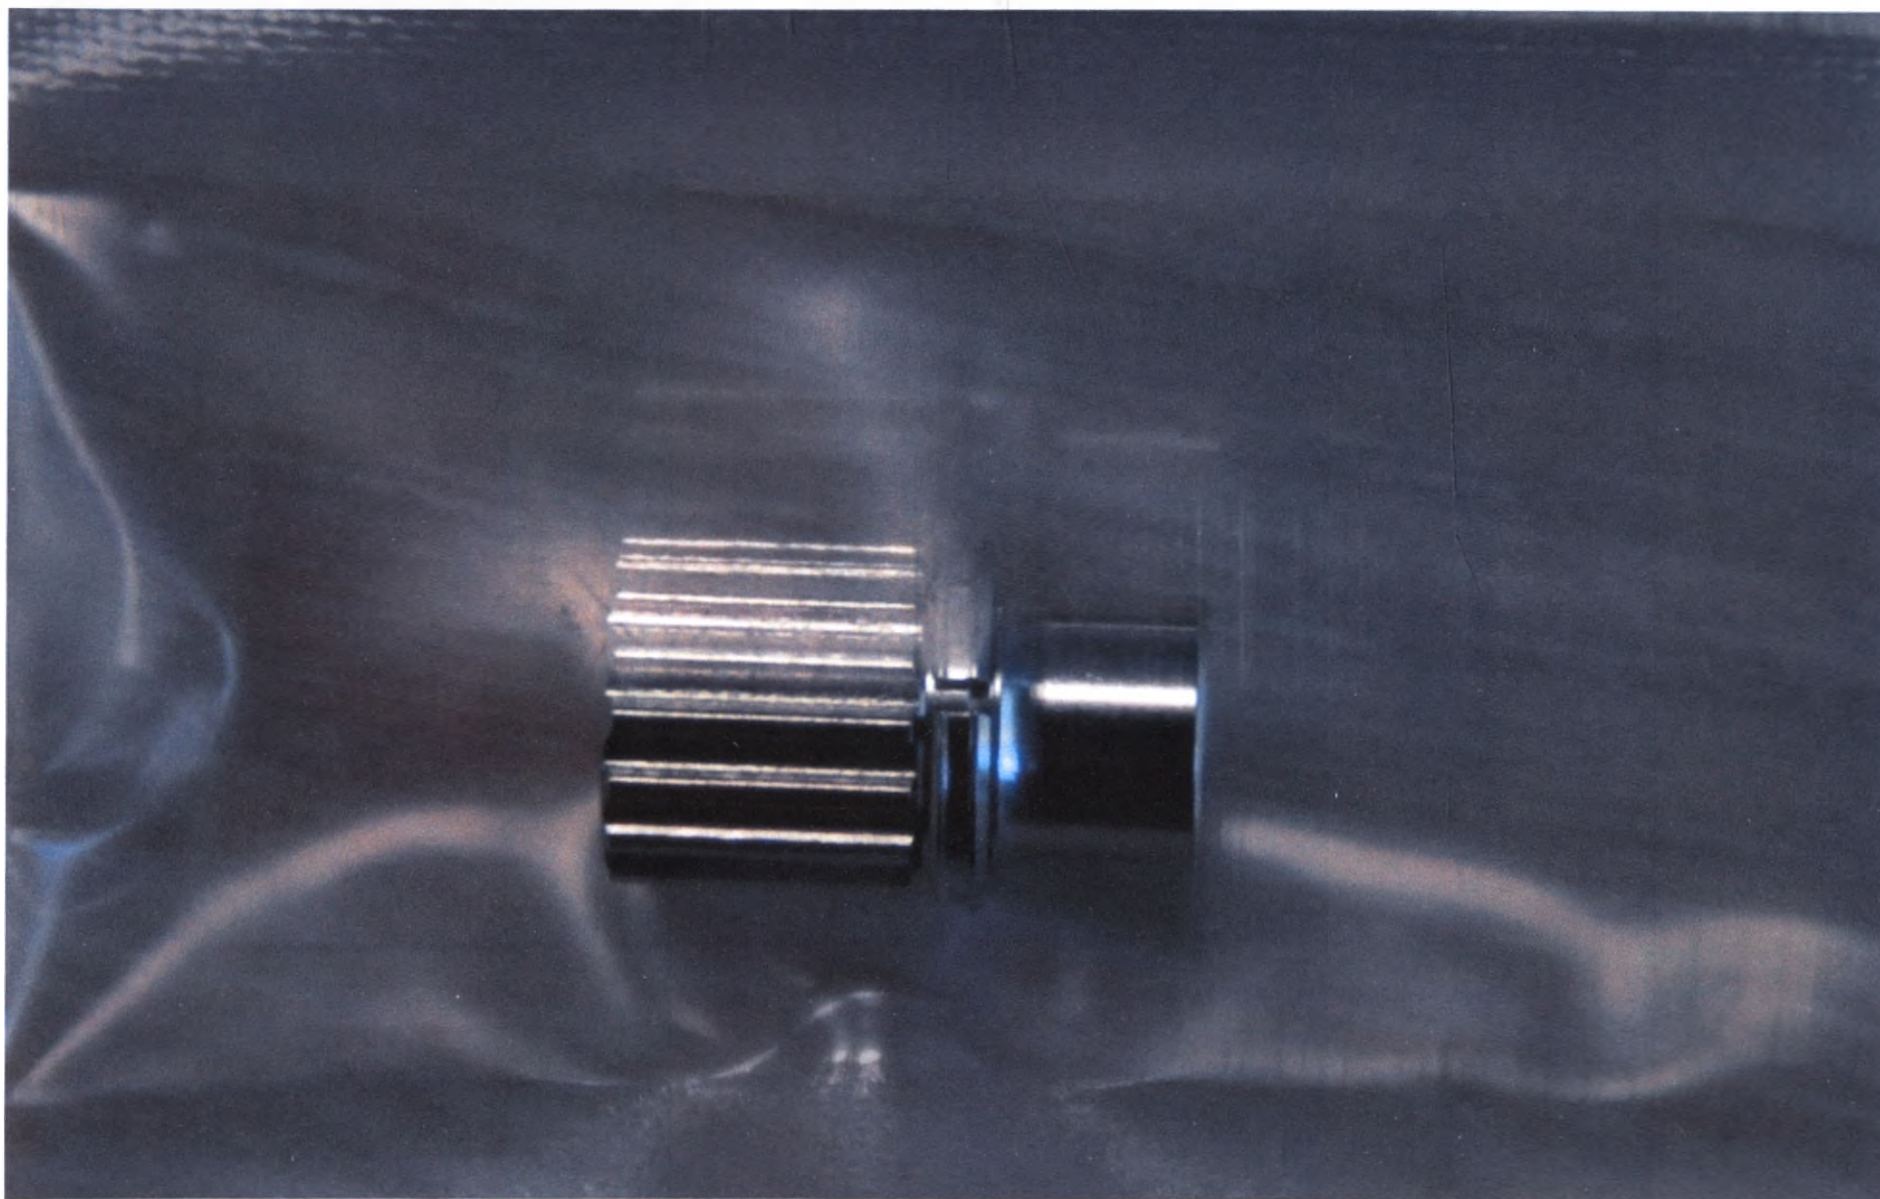

Рукоятка для динамометрического ключа EV хирургическая (TW EV Surgical Driver Handle)

TW EV Surgical Driver Handle

РУ № PZH2020/10812

от 6/25/2020

REF 25775

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.

Производитель:
Elos Medtech Pivotal A/S
Engvej 33 DK-3330 Gørlev,
Дания

Уполномоченный представитель в
РФ:
ООО «Дентоплай Сирано»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп.8
Тел. +7 (495) 725-10-89

Страна происхождения:
Дания



Torque Wrench EV **ELOS**
MEDTECH

Surgical Driver
Handle



Dentaply
Siirno
Implants

REF 25775

www.dentaplysiirno.com/implants

[EN] Medical Tool Adapter [BG] Адаптер за медицински инструменти [CS] Adaptér pro nástroje pro zdravotnické účely [DA] Medicinsk værktøjsadapter [DE] Medizinischer Werkzeugadapter [EL] Προσάρτημα εργαλείων ιατρικής χρήσης [ES] Adaptador médico de herramienta [ET] Meditsiinne tööriistadapter [FI] Lääkinnällisen työkalun sovitin [FR] Adaptateur d'outil médical [HR] Medicinski adapter za alat [HU] Orvosi eszközadapter [IT] Adattatore medico dell'utensile [LT] Medicinos prietais adapteris [LV] Medicīniskais instrumentu adapteris [NL] Adapter voor medisch hulpmiddel [NO] Medisinsk verktøysadapter [PL] Adapter narzędzi medycznych [PT] Adaptador de ferramentas médicas [RO] Adapter pentru instrumente medicale [RU] Медицинский адаптер для инструментов [SK] Medicinský adapter na orvištné nástroje [SV] Medicinsk verktygsadapter [TR] Tıbbi Alet Adaptörü

www.elosmedtech.com/RU

Elos Medtech Pivotal A/S,
Engvej 33, 3330 Gørlev
Made in Denmark

LOT 156314



2021-03-08

Rx ONLY



C30076_01



CE


MD

UDI

(01)05712621000026
(11)210308
(10)156314



Рукоятка для динамометрического ключа EV ортопедическая (TW EV Restorative Driver Handle)

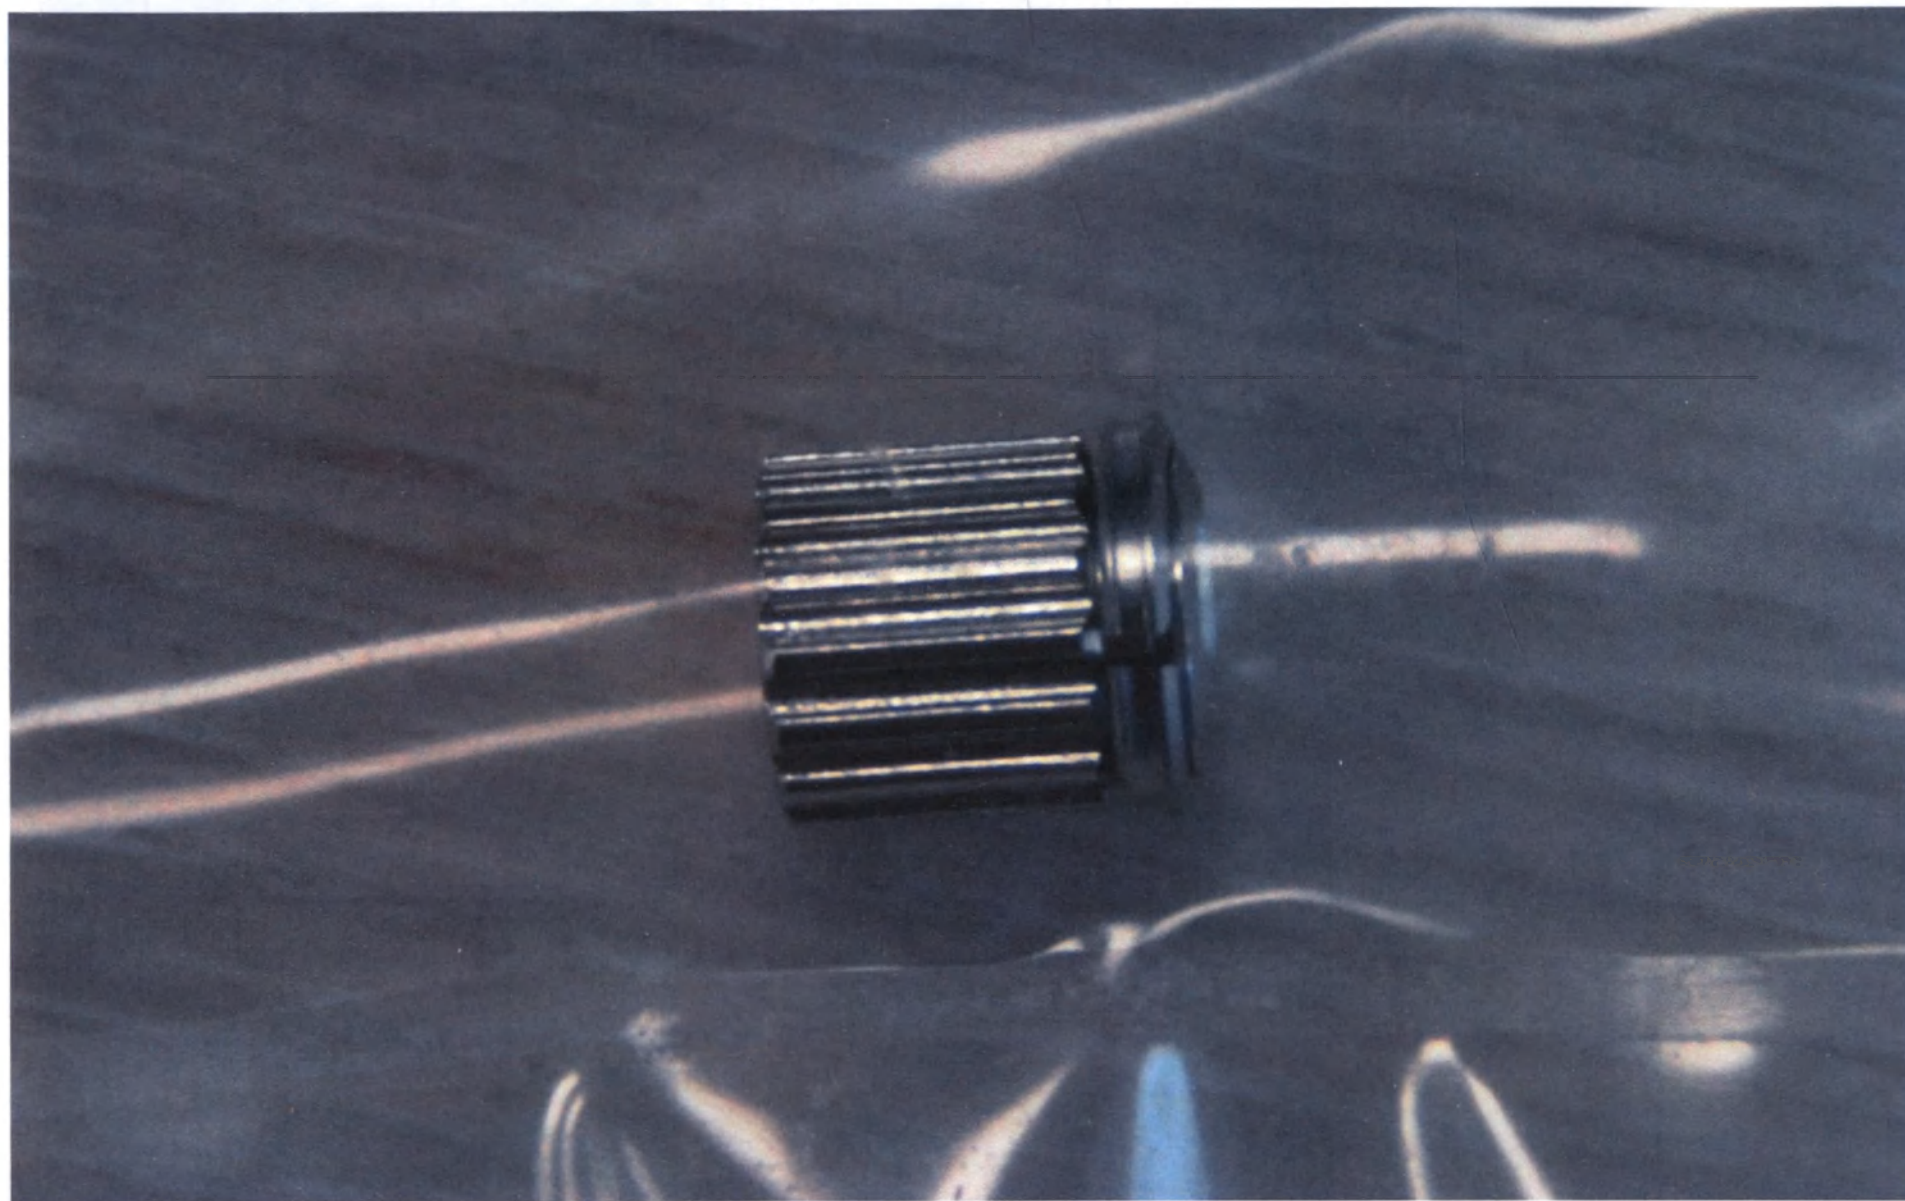

Ручка для динамометрического ключа EV ортопедическая (TW EV Restorative Driver Handle)

TW EV Rest. Driver Handle

ПУ № P3H2020/10912

от 6/25/2020

REF 25776

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях. см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:
Elos Medtech Pinol A/S
Engvej 33 DK-3330 Gørlese,
Дания

Уполномоченный представитель в
РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп.8
Тел. +7 (495) 725-10-89

Страна происхождения:
Дания



2 Описание изделия
Ключ динамометрический (основной корпус, головка и ручка)

Torque Wrench EV **ELOS** MEDTECH
Restorative Driver
Handle

REF 25776



Dentsply
Sirona
Implants

www.dentsplysirona.com/implants

[EN] Medical Tool Adapter [BG] Адаптер за медицински инструменти [CS] Adaptér pro náhradu pro náhradní nástroj [DA] Medicinsk værktøjadapter [DE] Medizinischer Werkzeuadapter [EL] Προσάρτημα εργαλείων χειρός [ES] Adaptador médico de herramienta [ET] Meditsiinseline tööriistadapter [FI] Lääkinnäköön työkalun sovitin [FR] Adaptateur d'instrument médical [HR] Medicinski adapter za alat [HU] Orvosi eszközadapter [IT] Adattatore medico dell'utensile [LT] Medicininis įrankių adapteris [LV] Medicīniskais instrumentu adapters [NL] Adapter voor medisch hulpmiddel [NO] Medicinsk verktøysadapter [PL] Adapter narzędzia medycznego [PT] Adaptador de ferramentas médicas [RO] Adapter pentru instrumente medicale [SK] Lekársky adapter nástroja [SL] Medicinski adapter za orodja [SR] Adapter za medicinske alate [SV] Medicinsk verktygsadapter [TR] Tıbbi Alet Adaptörü



www.elosmedtech.com/IFU



Elos Medtech Pinol A/S,
Engvej 33, 3330 Gørlese
Made in Denmark

LOT 156746



2021-03-28

Rx ONLY



(01)05712821000033



(11)210328

(10)156746



C30076_01



Ручка для динамометрического ключа EV ортопедическая низкая (TW EV Restorative Driver Handle Low)

TW EV Rest. Driver Handle Low

РУ № РЗН2020/10912

от 6/25/2020

REF 25777

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях см. в инструкции. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.

Производитель:
Elos Medtech Pivotal A/S
Engvej 33 DK-3330 Gørlev,
Дания


Уполномоченный представитель в
РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 8
Тел. +7 (495) 725-10-89

Страна происхождения:
Дания



Torque Wrench EV **ELOS**
Restorative Driver
Handle Low

REF 25777



www.dentsplysirona.com/implants

[H] Medical Tool Adapter [BG] Adapter za vezivanje
[C] Adapter pro nástup pro zbrovnicu úst [D]
Medicinskí verijayadapler [OE] Medizinischer Verwijngadapler
[K] Προσχωρητικό εργαλείου κλειδιού, σπρώχνει [E] Adapter
nádica do ferramenta [T] Medicinske štitnjačnice [P]
Läkemedelsföremål för att [H] Adapter för medicinska
Medicinskí adapter za ključ [H] Orvosi eszközadapter [T] Adaptatore
medicin dell'utensile [T] Medicinske partikul adapter [L]
Medicinskí instrumentu adapter [N] Adapter voor medisch
hulpmiddel [NO] Medicinsk verijayadapler [A] Adapter voor medisch
medicijn [P] Adapter de farmaceutische medicijn [C] Adapter
pentru instrumente medicale [D] Lekársky adapter nástup [L]
Medicinskí adapter za orodja [C] Adapter za medicinske stave [H]
Medicinskí verijayadapler [TR] Tabs And Adapter



www.elosmedtech.com/IFU


Elos Medtech Pivotal A/S,
Engvej 33, 3330 Gørlev
Made in Denmark

LOT 156335

2021-01-22 R_X ONLY



MD UDI (01)05712821000040 (11)210122 (10)156335



CS0078_01

Сшито и скреплено печатью «12» листов.

Генеральный директор
ООО «Дентсплай Сирона»
Левин К.Г.



Дата: 19 08 2021