


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Томограф спектральный оптический когерентный,
варианты исполнения: НОСТ-1, НОСТ-1F с принадлежностями**


Томограф спектральный оптический когерентный НОСТ-1 с принадлежностями (вид спереди)

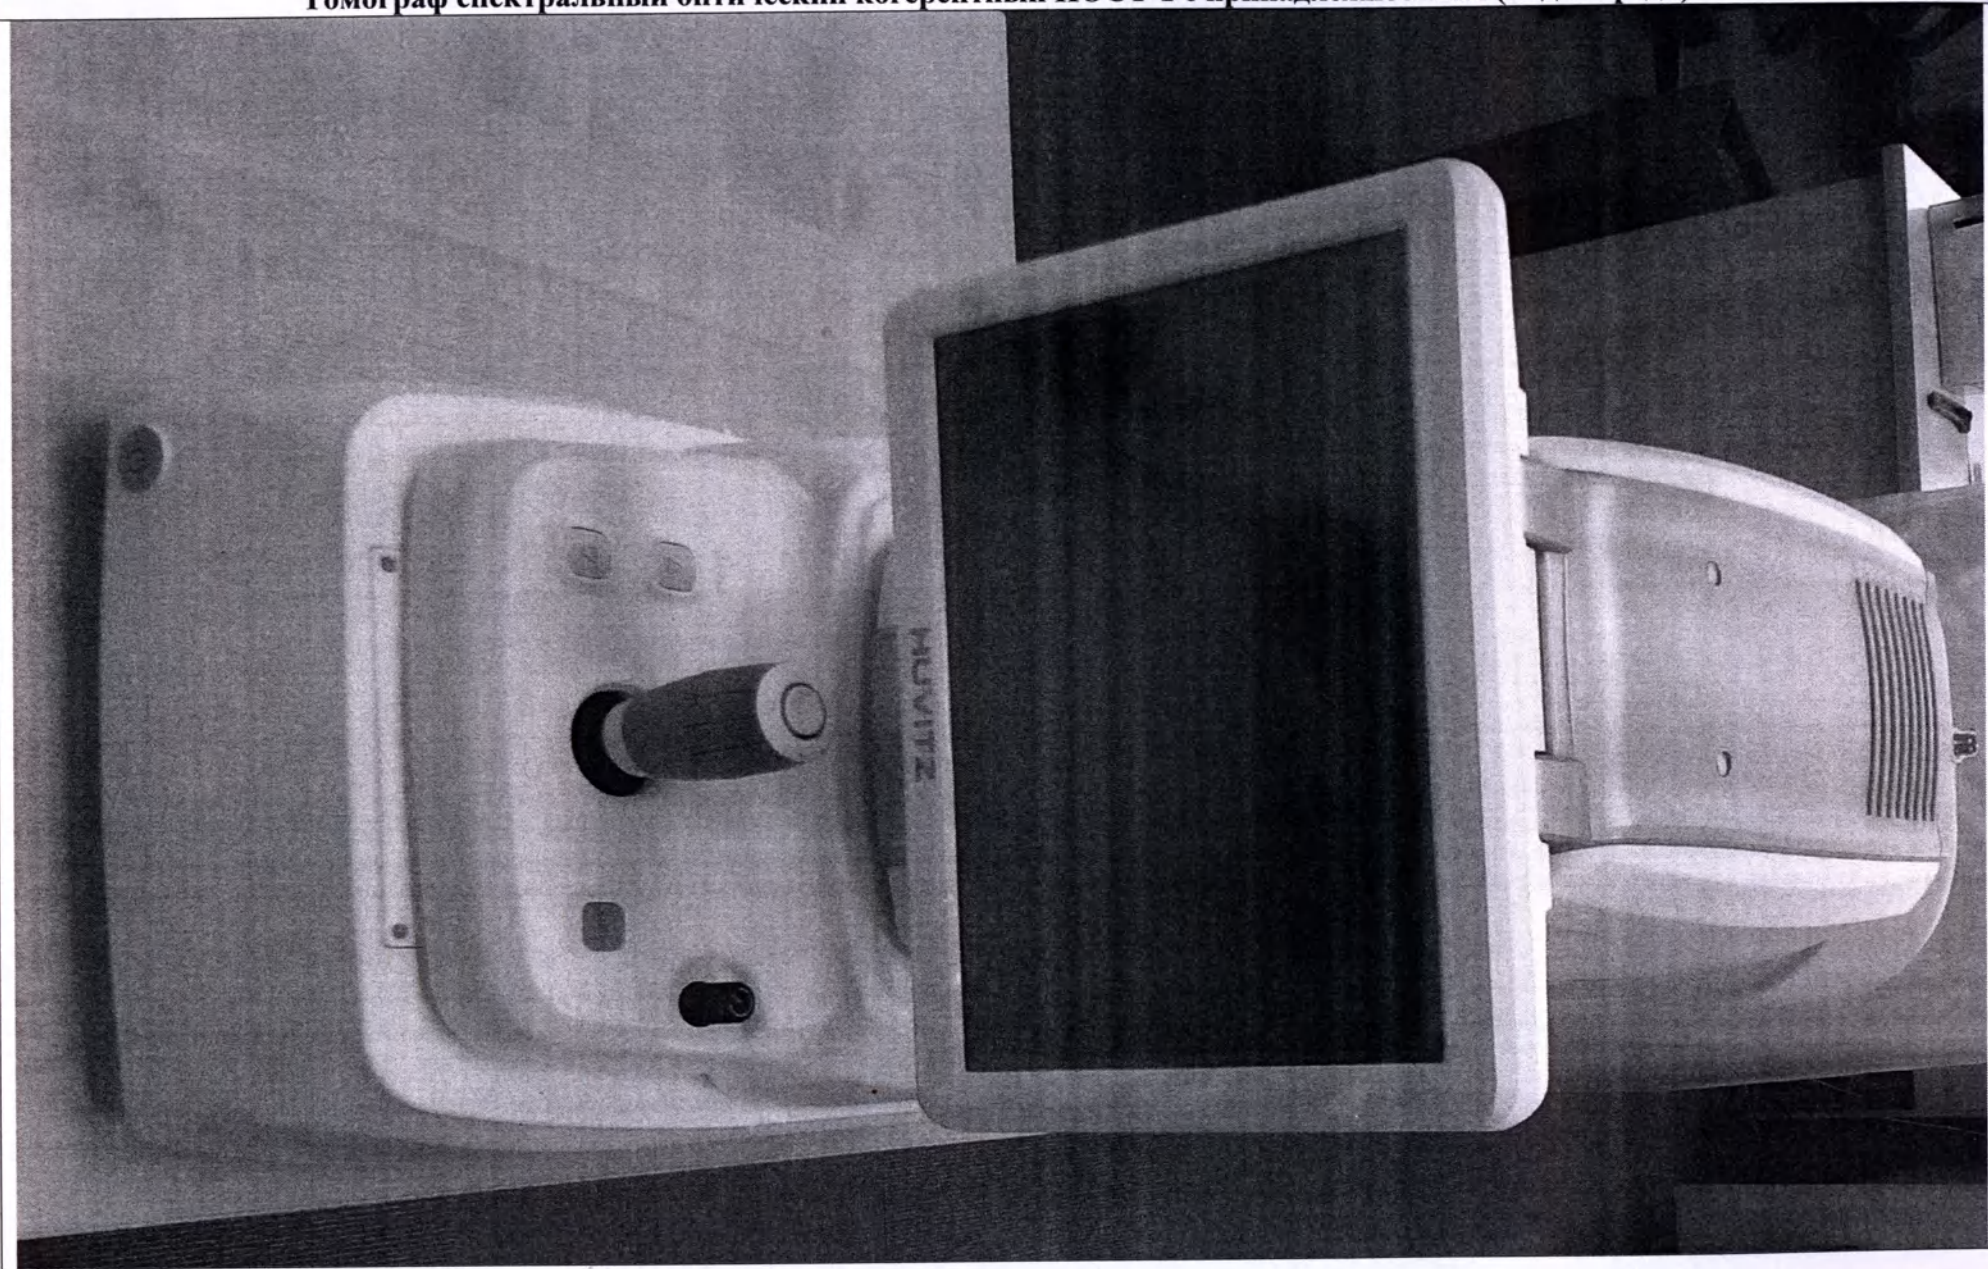


Томограф спектральный оптический когерентный НОСТ-1 с принадлежностями (вид сбоку)



Томограф спектральный оптический когерентный НОСТ-1 с принадлежностями (вид сзади)

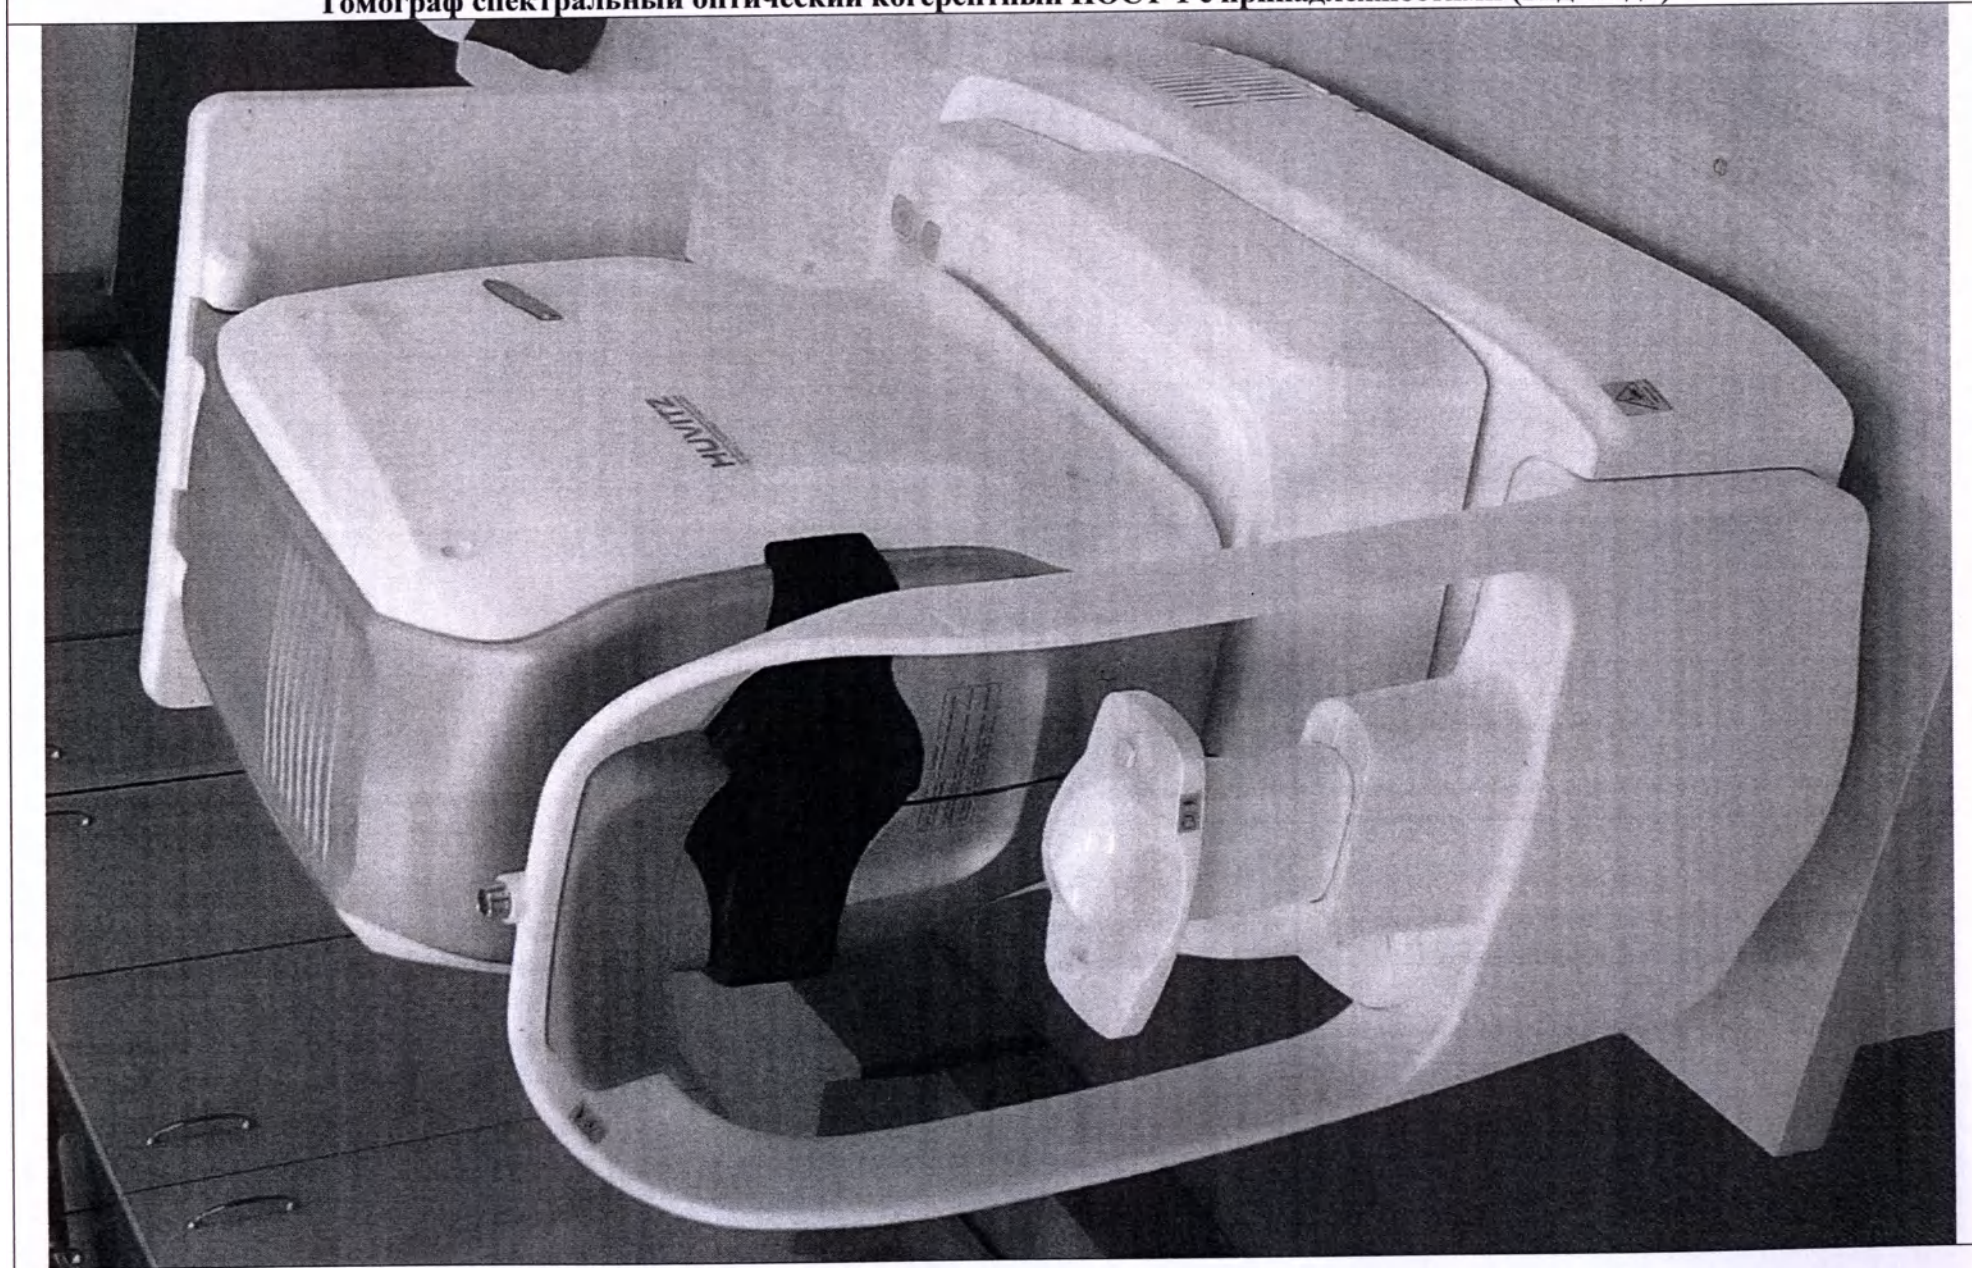


Томограф спектральный оптический когерентный НОСТ-1 F с принадлежностями (вид спереди)

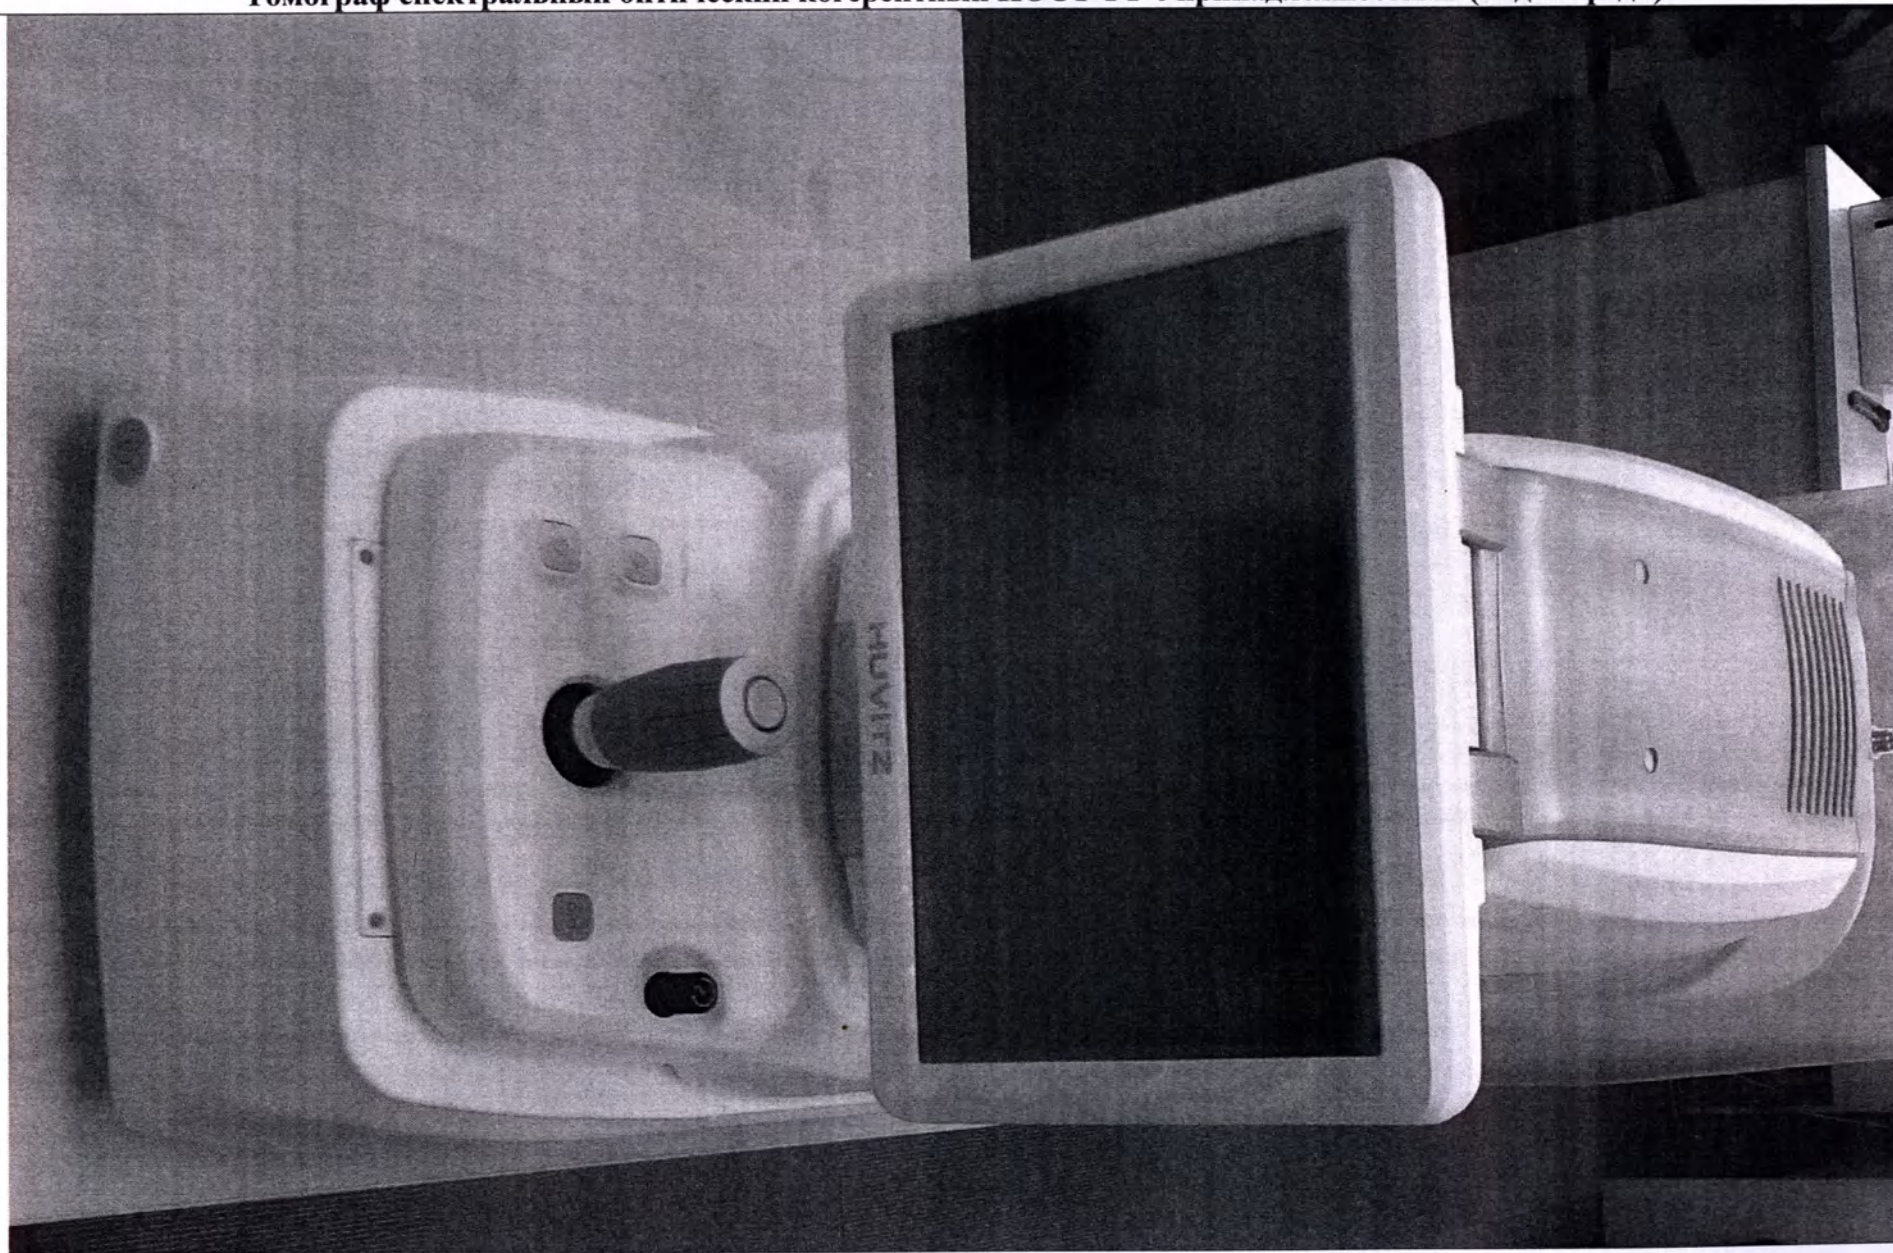


Томограф спектральный оптический когерентный НОСТ-1 F с принадлежностями (вид сбоку)



Томограф спектральный оптический когерентный НОСТ-1 F с принадлежностями (вид сзади)

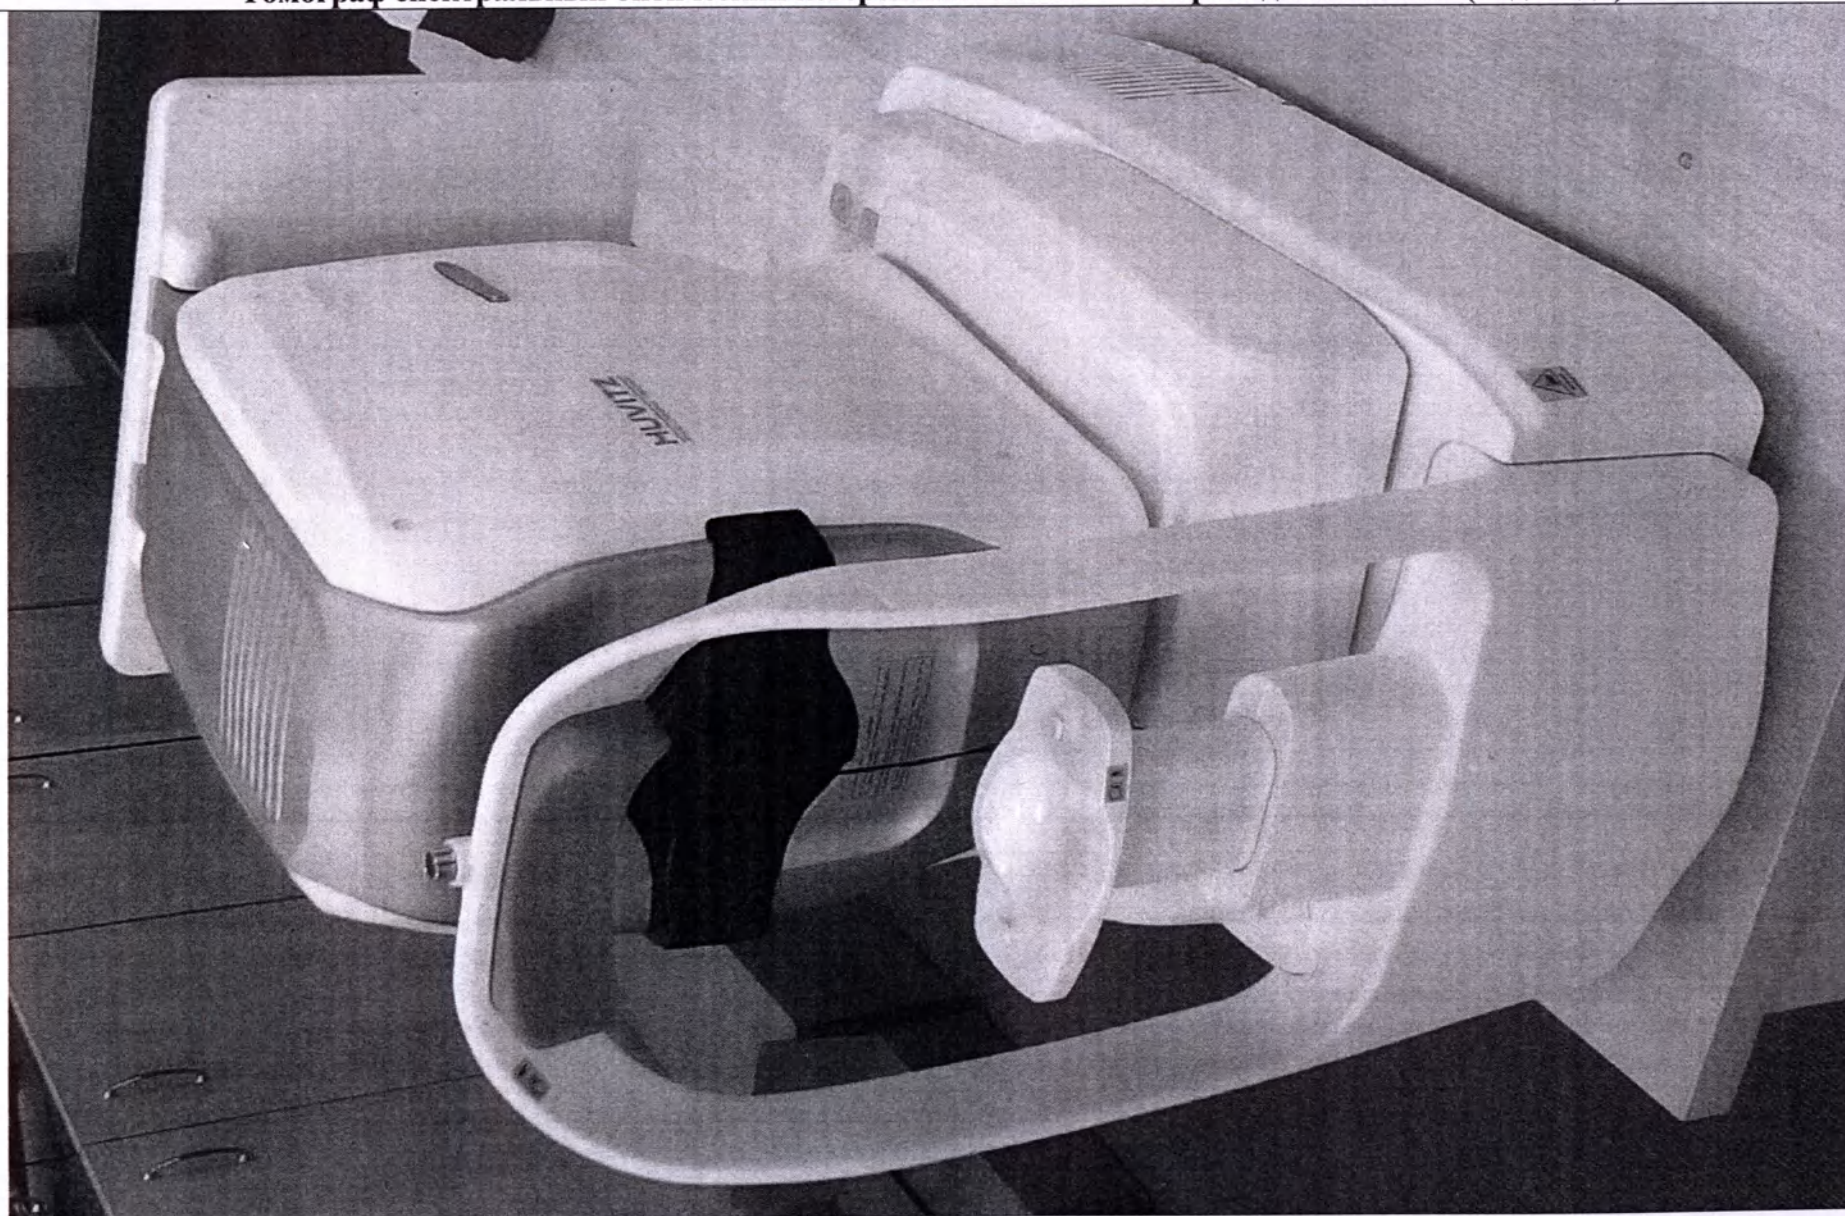


Кабель сетевого питания

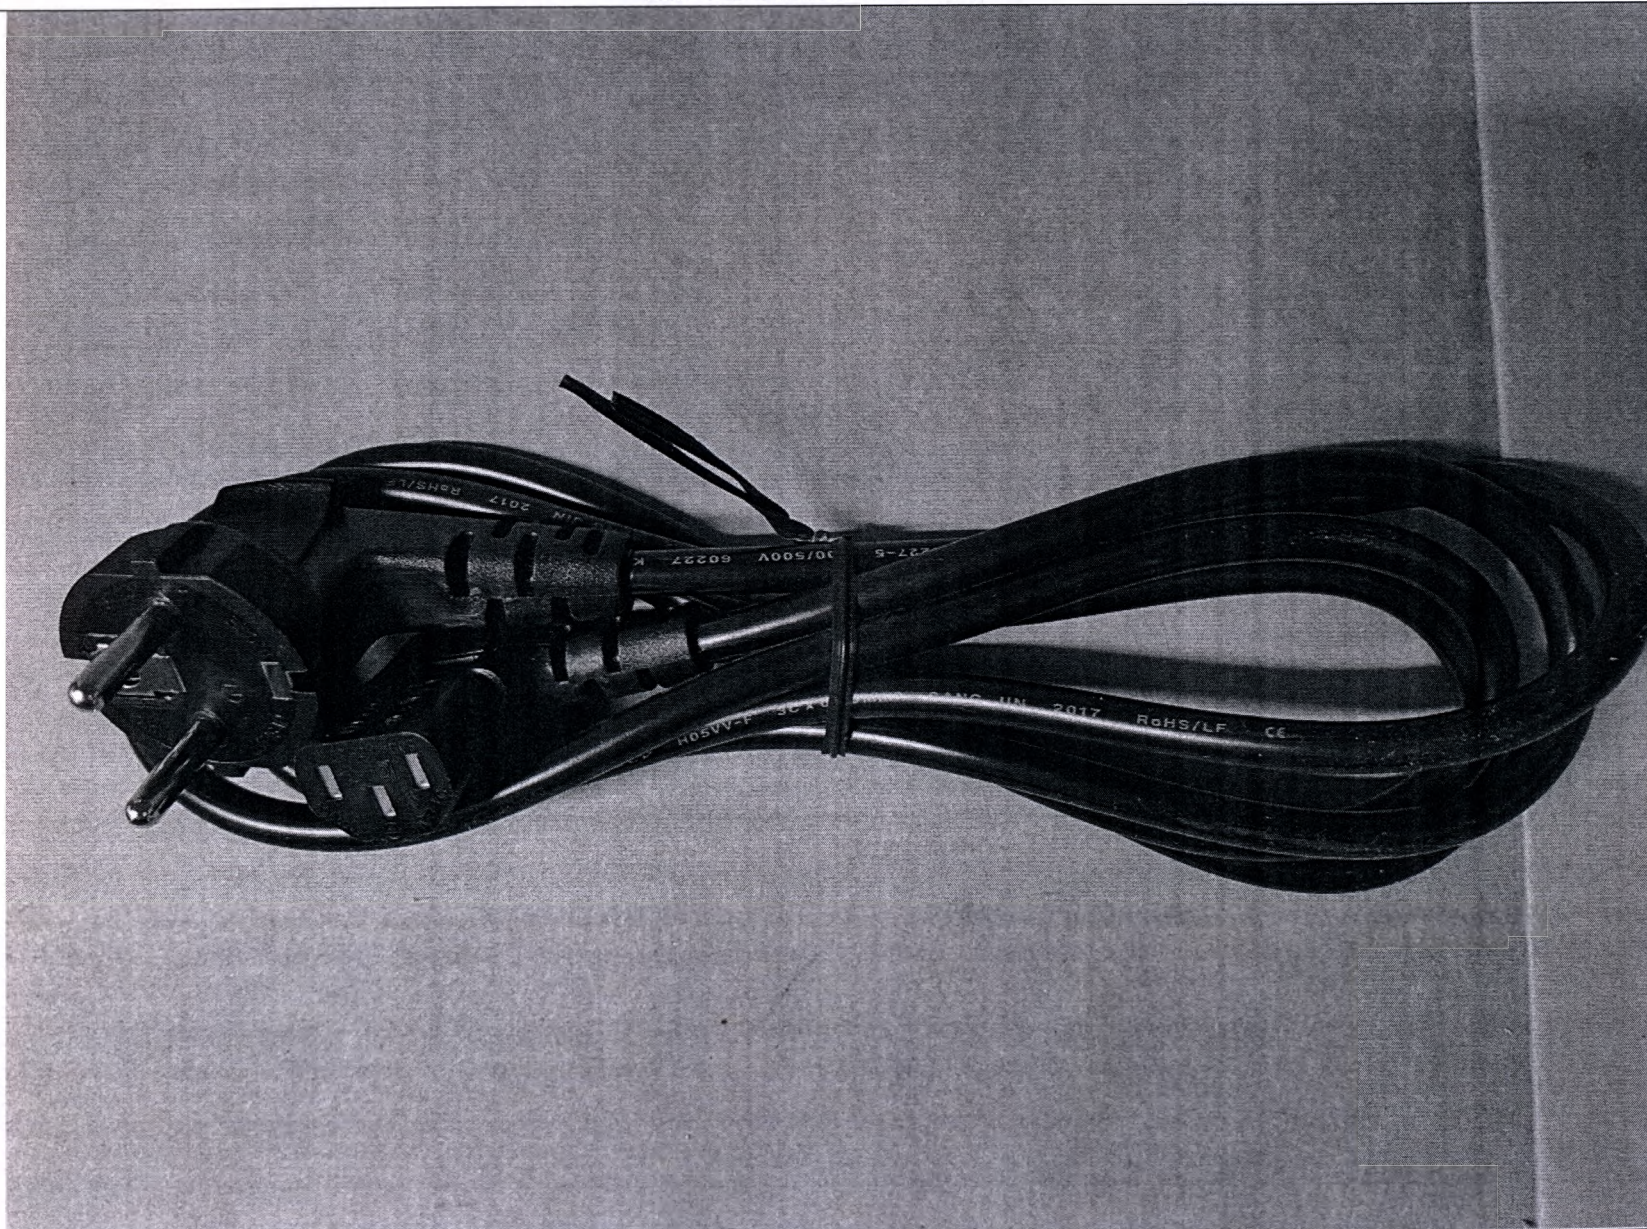


Светодиод (поставляется при необходимости)




Стилус (поставляется при необходимости)

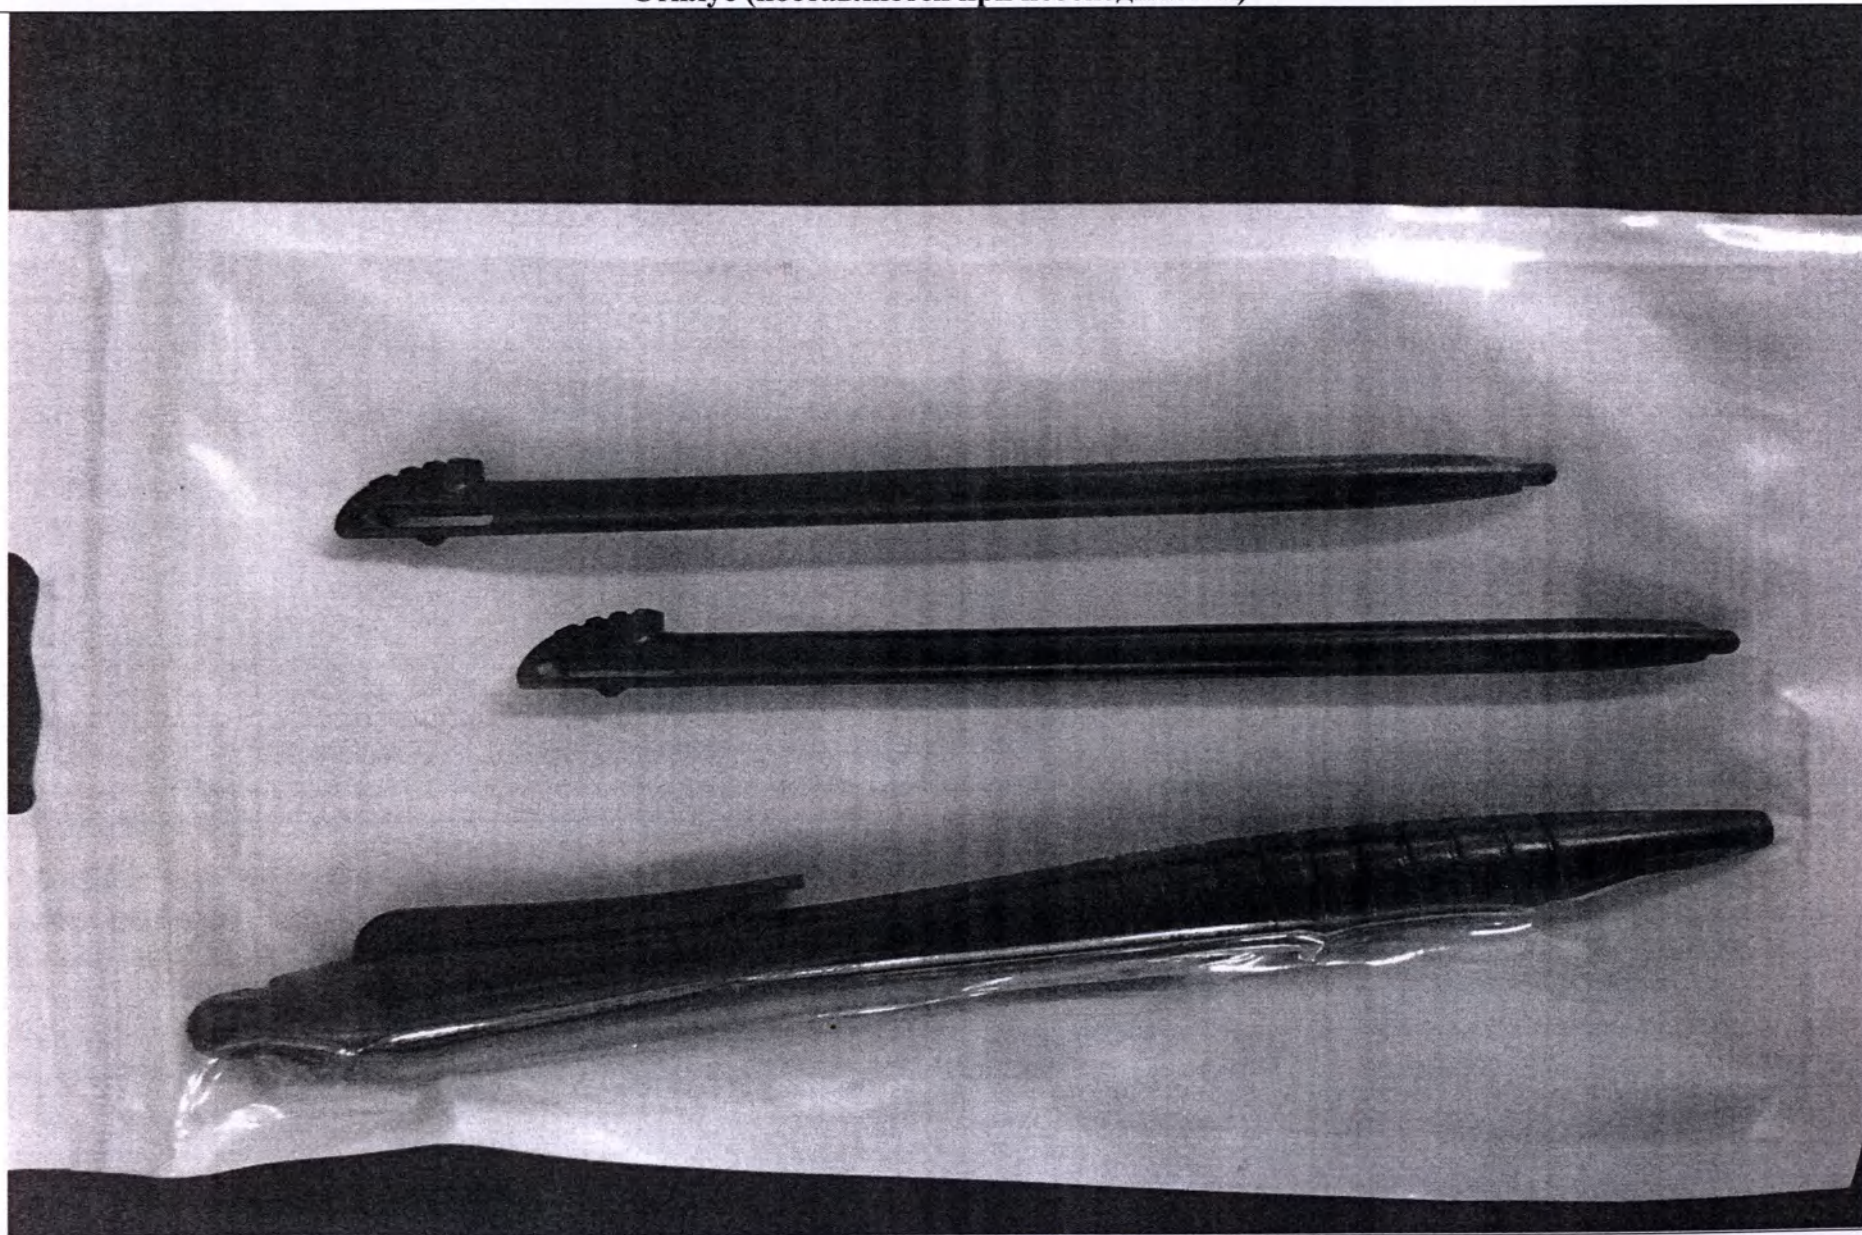

Крышка для линзы объектива (поставляется при необходимости)

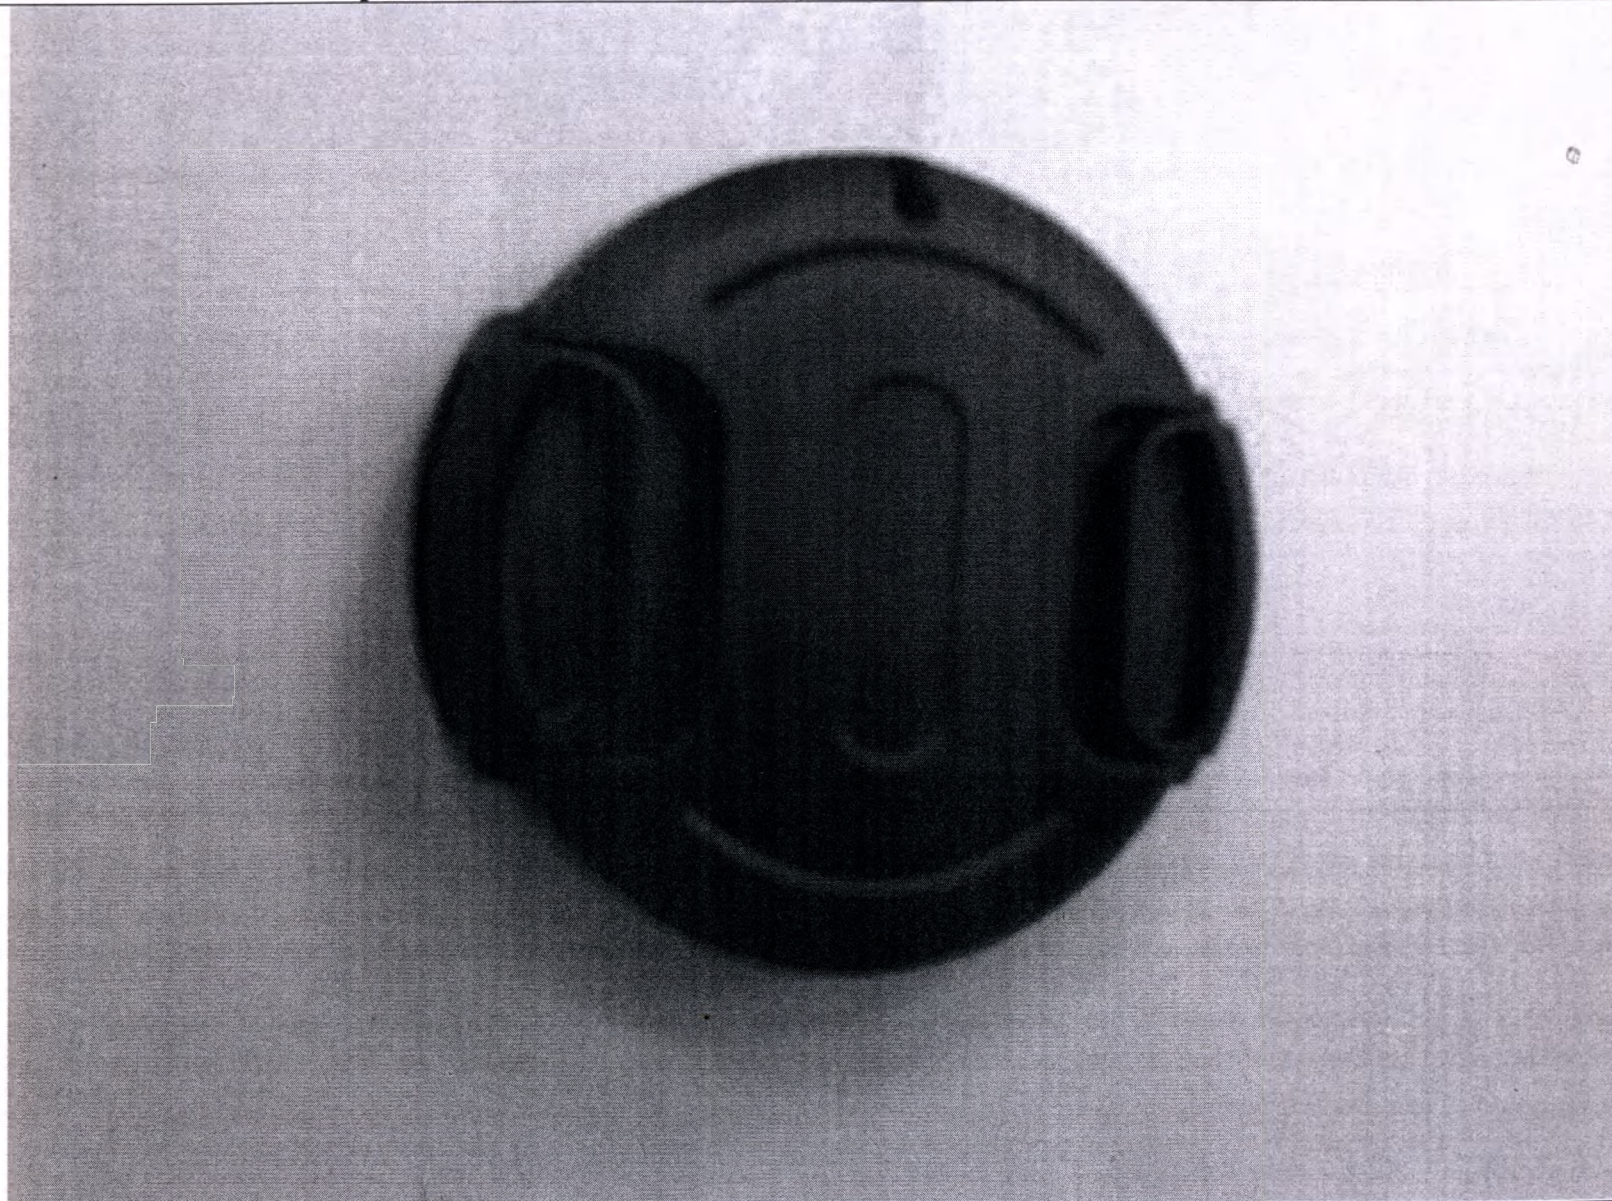


Заглушка (поставляется при необходимости)

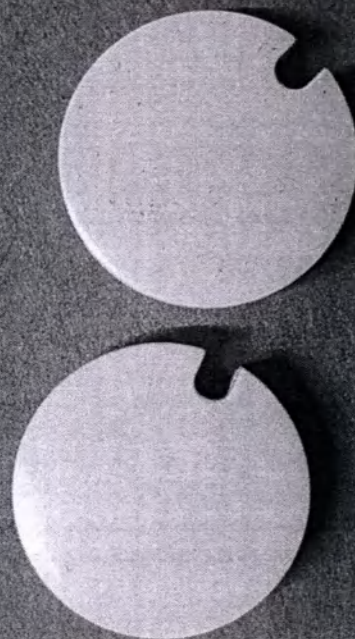

Модель глаза (поставляется при необходимости)



Адаптер для исследования переднего отрезка глаза (поставляется при необходимости)

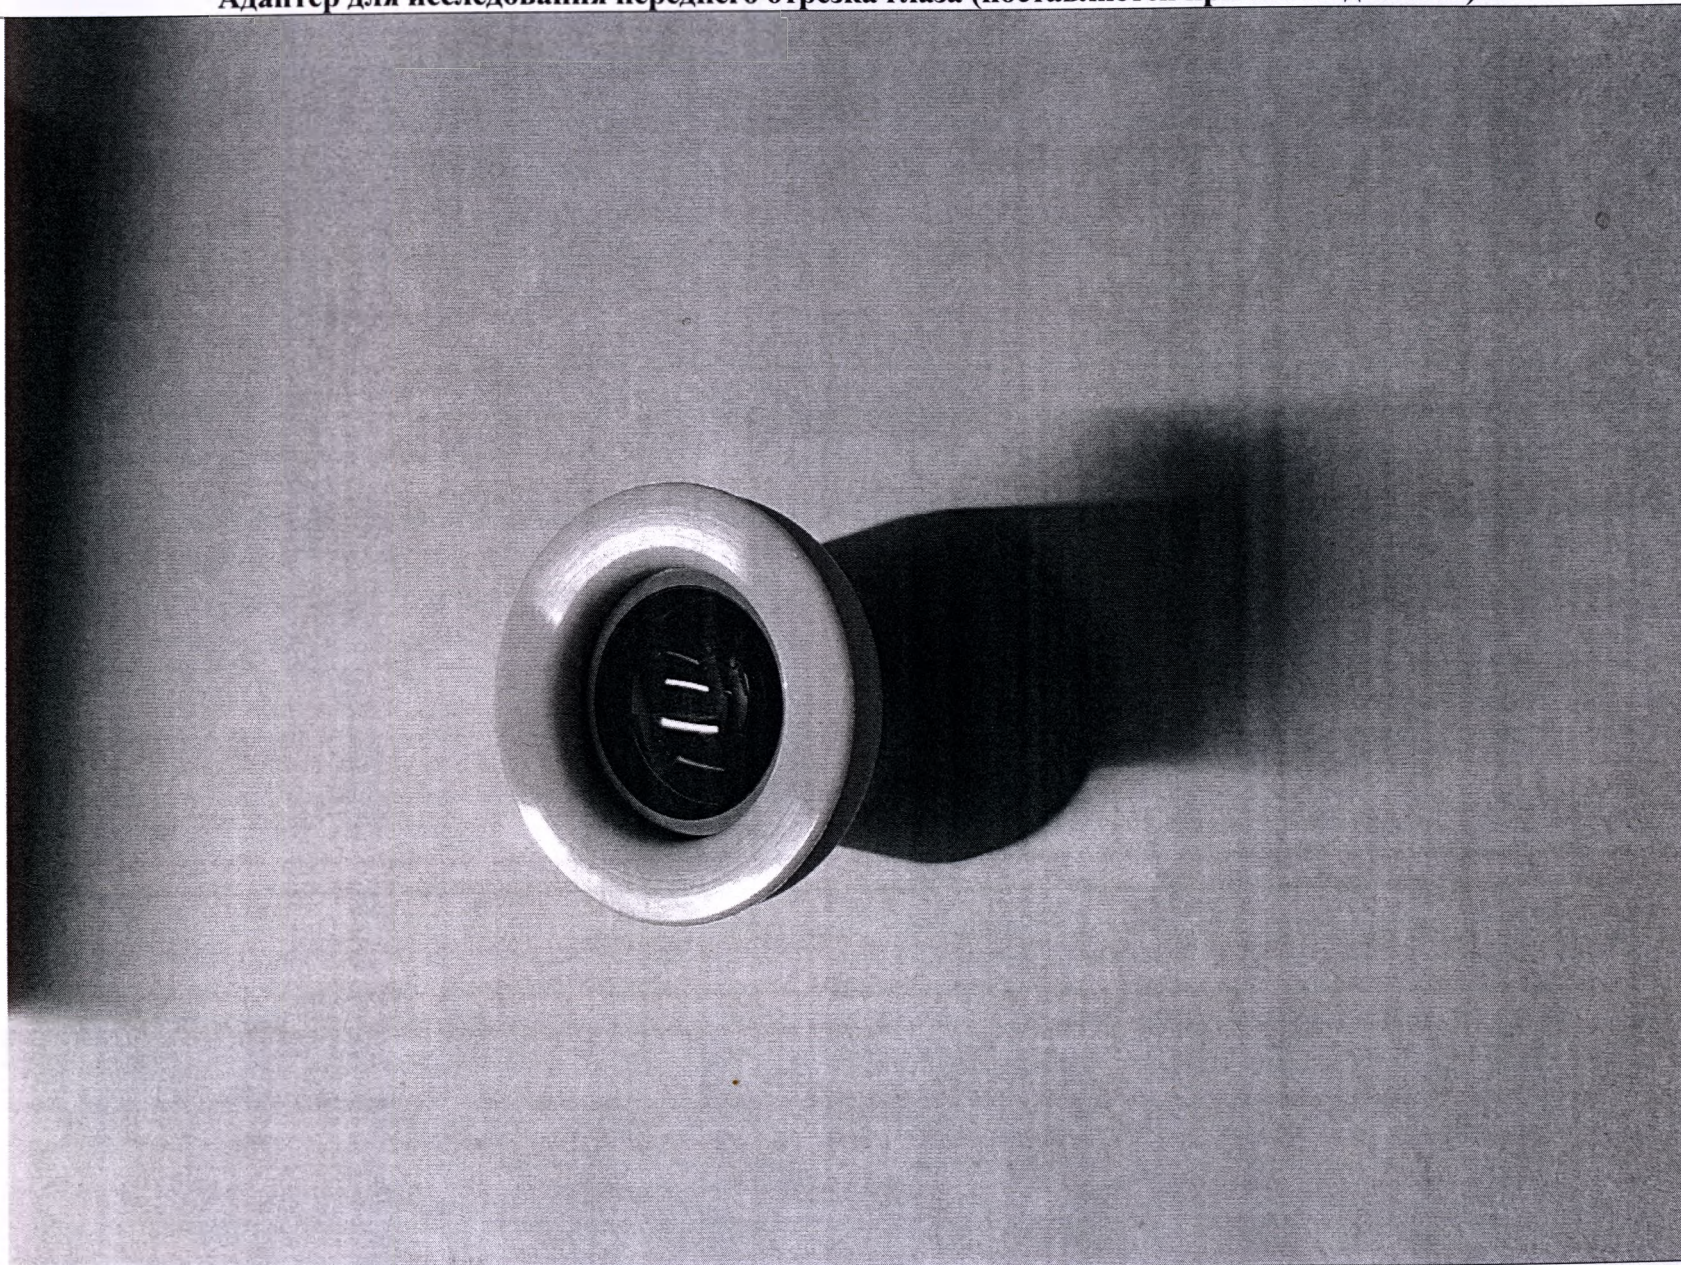

Подголовник резиновый (поставляется при необходимости)




Huvitz

OPTICAL COHERENCE
TOMOGRAPHY

HOCT-1F/1


USER MANUAL

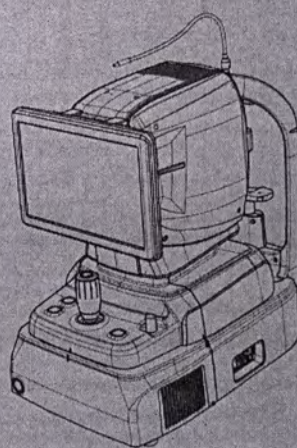


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Принадлежности:


Чехол пылезащитный

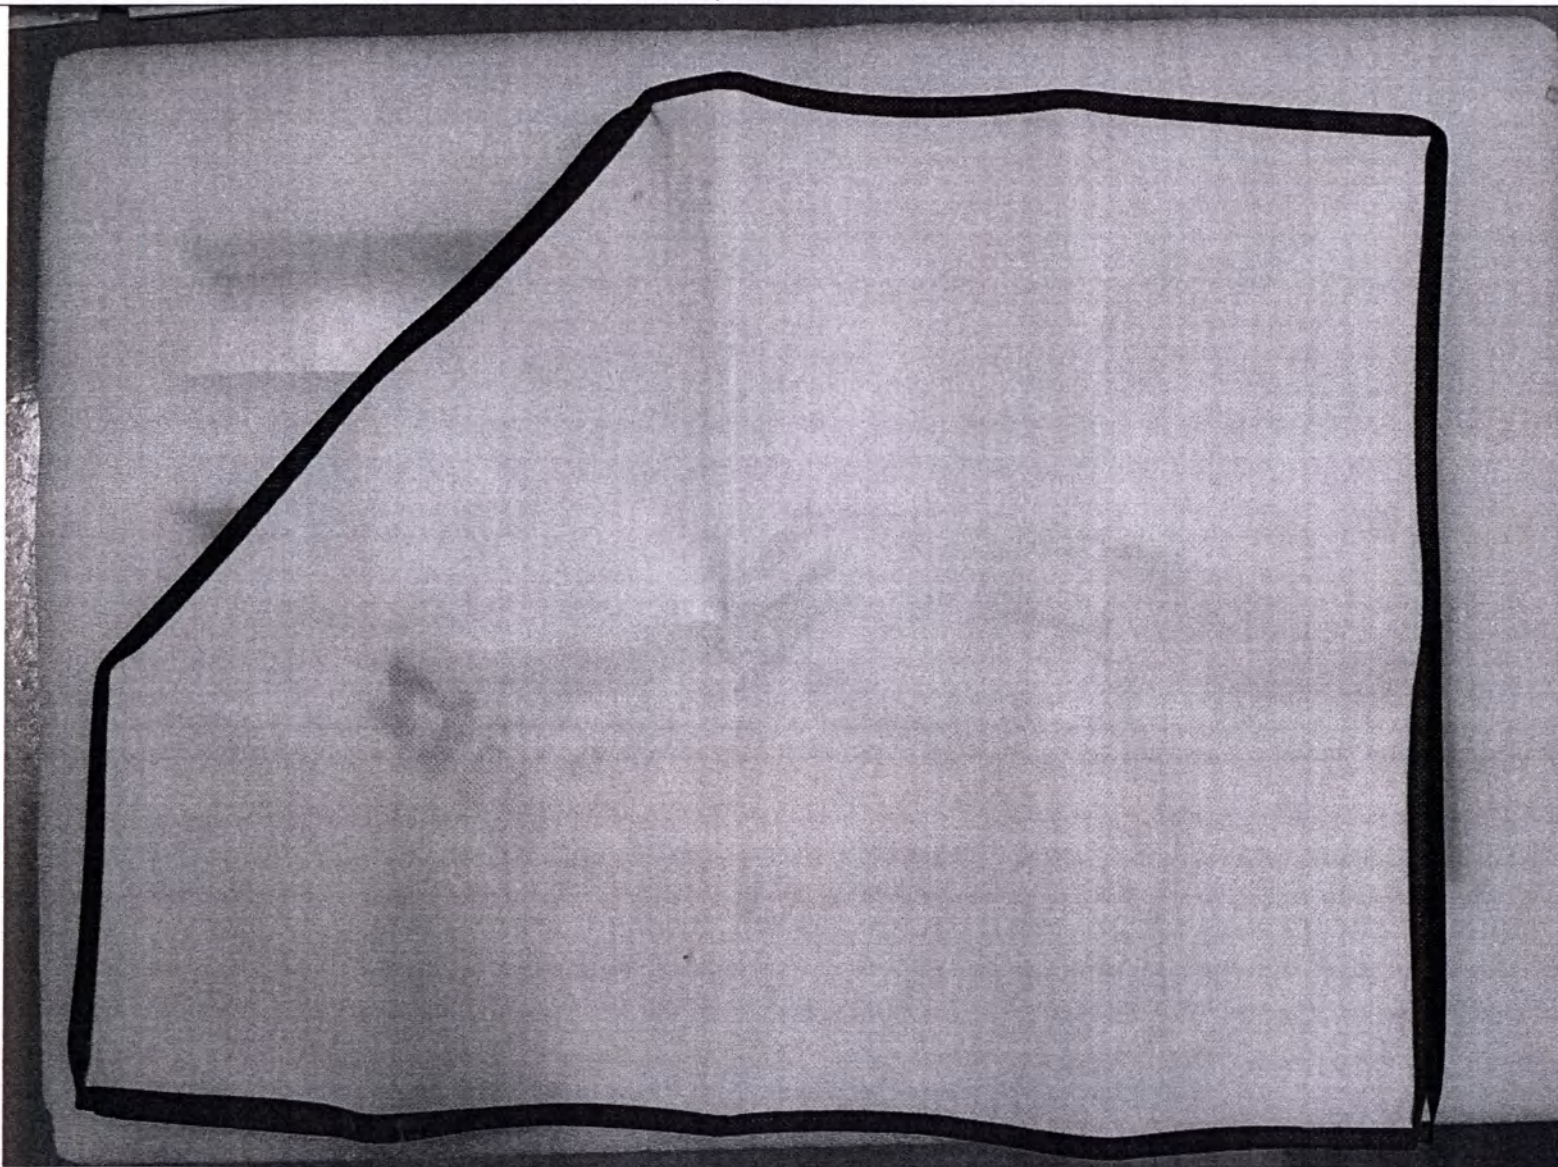


Плавкий предохранитель

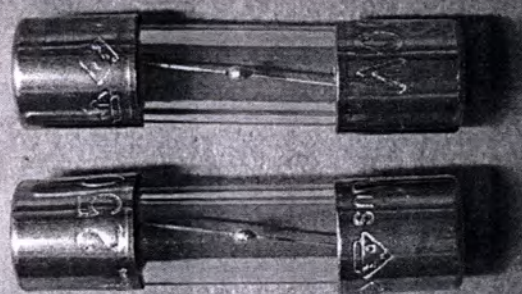

Груша резиновая

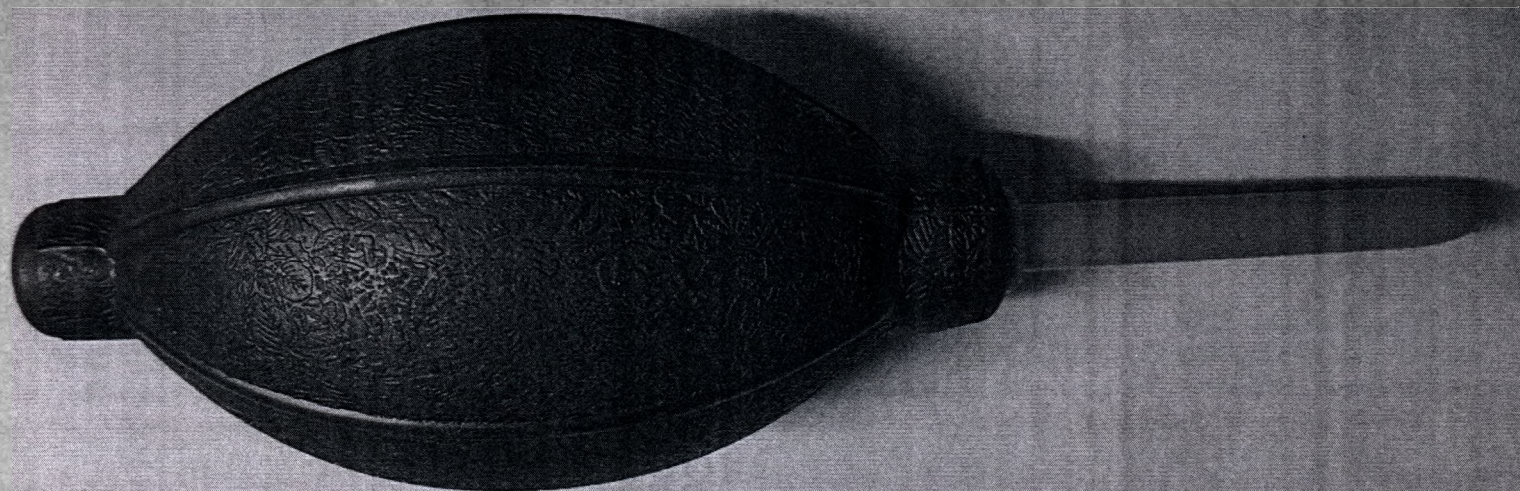

Бумага для упора под подбородок

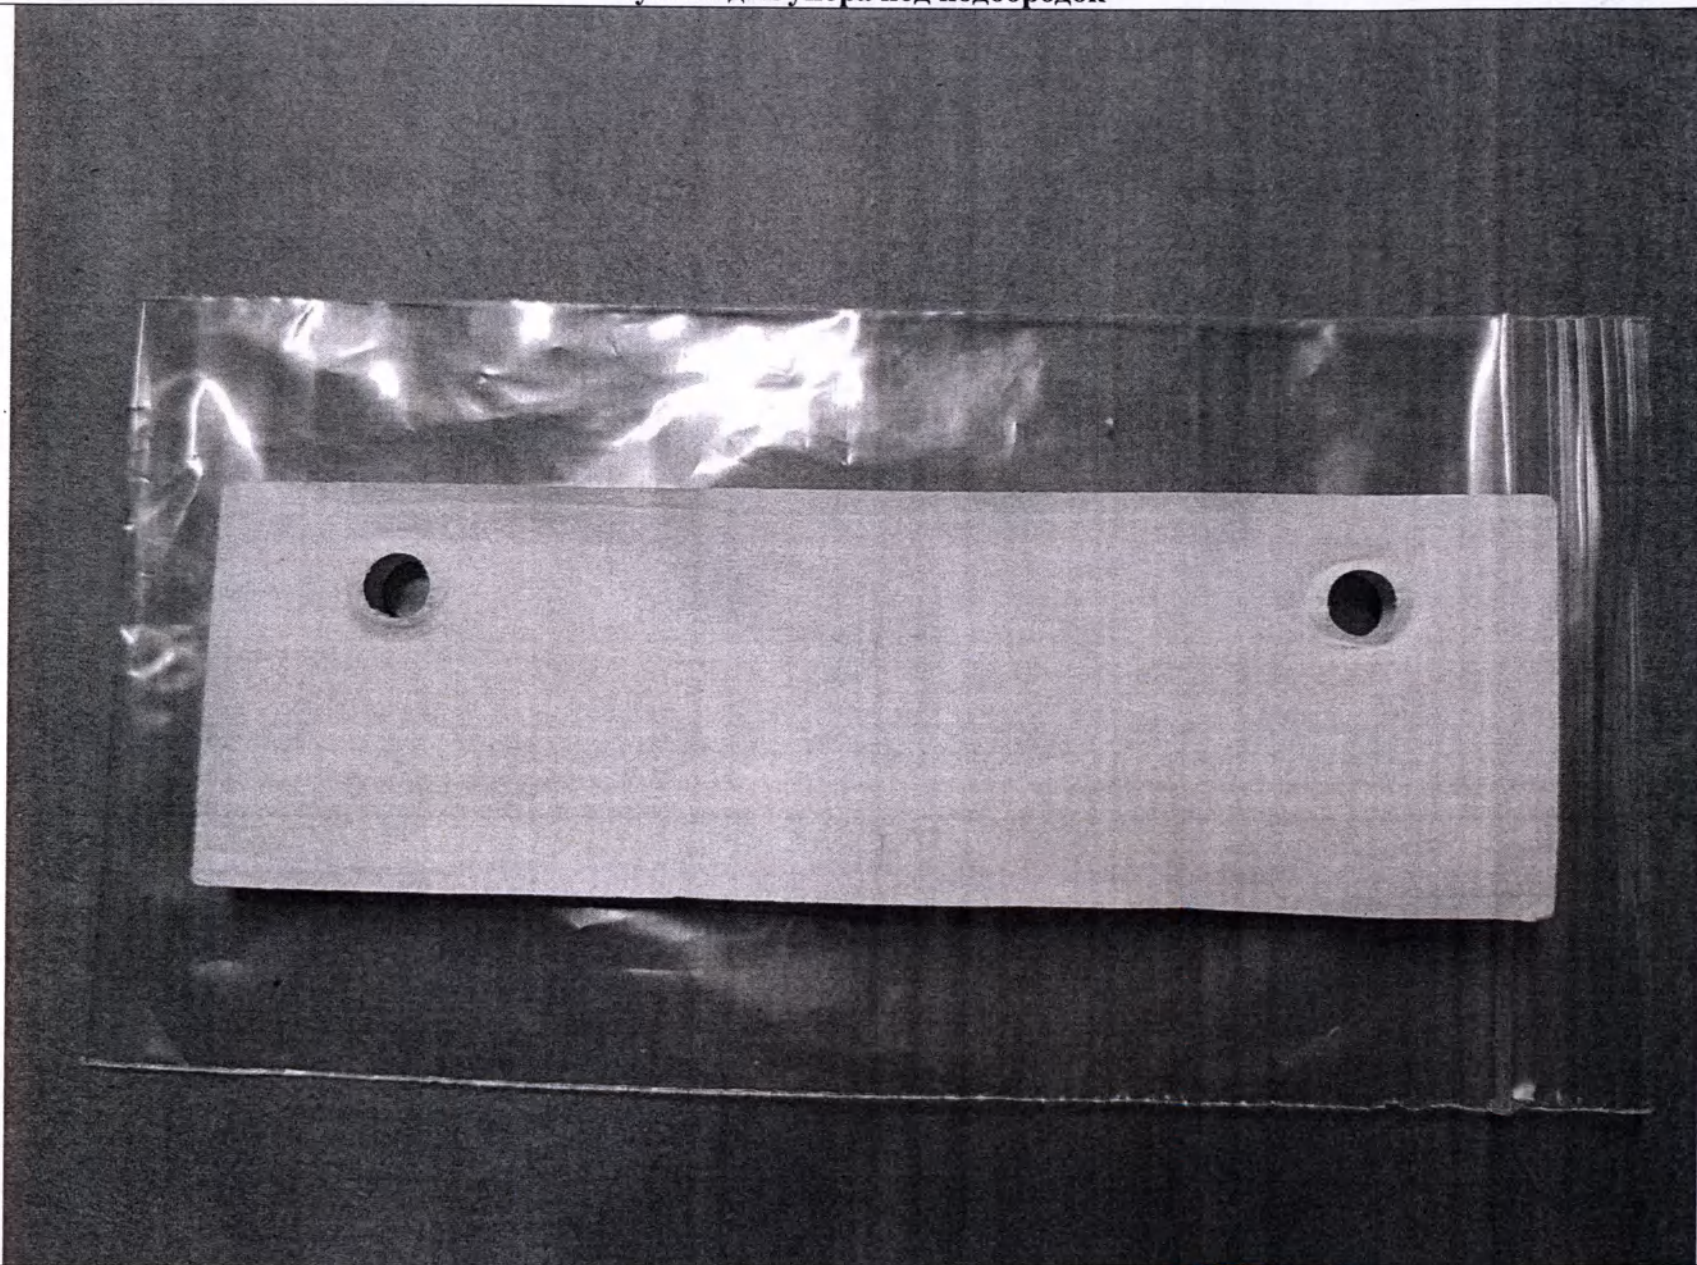

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО

20 ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «МТО Стормовъ»
Брукс Е.В.




**Фотографические изображения
макета маркировки медицинского изделия**

**Томограф спектральный оптический когерентный,
варианты исполнения: НОСТ-1, НОСТ-1F с принадлежностями**

Фотографические изображения маркировки медицинского изделия

Макет маркировки *Томографа НОСТ-1* представлен ниже.

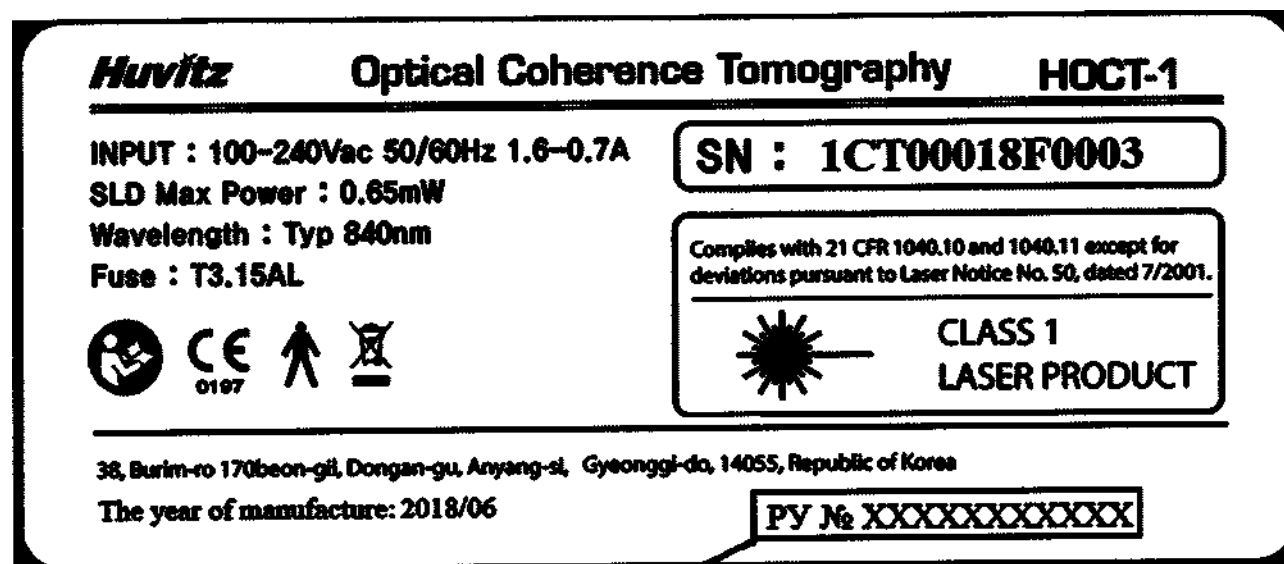

Место нанесения стикера с номером
регистрационного удостоверения

	HUVITZ Co., Ltd. 38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea
	06/2018
EC REP	Medical Device Safety Service GmbH Schiffgraben 41. 301 75 Hannover, Germany

Перевод макета маркировки Томографа **НОСТ-1** на русский язык представлен ниже.

Huvitz Томограф спектральный оптический когерентный НОСТ-1	
Питание: 100-240В переменный ток 50/60Гц 1.6-0.7 А Максимальная оптическая мощность : 0.65 мВ Длина волны : 840 нм Предохранитель: T3.15AL	SN : 1CT00018F0003 Соответствует положениям согласно 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, от 7/2001  ЛАЗЕР КЛАСС 1
  	
Бурим-ро, 170 поон-гиль, Донган-гу, Анян-си, Кёнги-до, 14055, Республика Корея Год изготовления: 2018/06	
	РУ № XXXXXXXXXXXXX

Место нанесения стикера с номером
регистрационного удостоверения

	Хувитс Ко., Лтд. Бурим-ро, 170 поон-гиль, Донган-гу, Анган-си, Кёнги-до, 14055, Республика Корея
	06/2018
EC REP	Служба Безопасности Медицинского Оборудования GmbH Шиффграбен 41. 301 75 Ганновер, Германия

Макет маркировки Томографа *НОСТ-1F* представлен ниже.

Huvitz	Optical Coherence Tomography	НОСТ-1F
INPUT : 100-240Vac 50/60Hz 1.6-0.7A SLD Max Power : 0.65mW Wavelength : Typ 840nm Fuse : T3.15AL		SN : 1CT00F18E0025
   		Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated 7/2001.  CLASS 1 LASER PRODUCT
38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea The year of manufacture: 2019/01		
		RU № XXXXXXXXXXXXXXX

Место нанесения стикера с номером
регистрационного удостоверения

	HUVITZ Co., Ltd. 38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea
	01/2019
EC REP	Medical Device Safety Service GmbH Schiffgraben 41. 301 75 Hannover, Germany

Перевод макета маркировки Томографа *НОСТ-1F* на русский язык представлен ниже.

Huvitz Томограф спектральный оптический когерентный НОСТ-1F

Питание: 100-240В переменный ток 50/60Гц 1.6-0.7 А

Максимальная оптическая мощность : 0.65 мВ

Длина волны : 840 нм

Предохранитель: T3.15AL



SN : 1CT00F18E0025

Соответствует положениям согласно 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, от 7/2001



ЛАЗЕР
КЛАСС 1

Бурим-ро, 170 пон-гиль, Донган-гу, Анян-си, Кёнги-до, 14055, Республика Корея

Год изготовления: 2018/06

РУ № XXXXXXXXXXXXX

Место нанесения стикера с номером
регистрационного удостоверения



Хувитз Ко., Лтд.
Бурим-ро, 170 пон-гиль, Донган-гу,
Анян-си, Кёнги-до, 14055, Республика Корея



01/12019



Служба Безопасности Медицинского Оборудования GmbH
Шиффграбен 41. 301 75 Ганновер, Германия

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
_____ ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «МТО Стормовь»
Брукс Е.В.

