

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «Штрауманн»



А. Вроблевски


2019 г.

## ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



**Инструменты и приспособления для установки стоматологических  
имплантатов в наборах и отдельных упаковках**

## Наборы инструментов и приспособлений для установки стоматологических имплантатов:

### 1. Набор хирургический №1 (INMODOPS2)

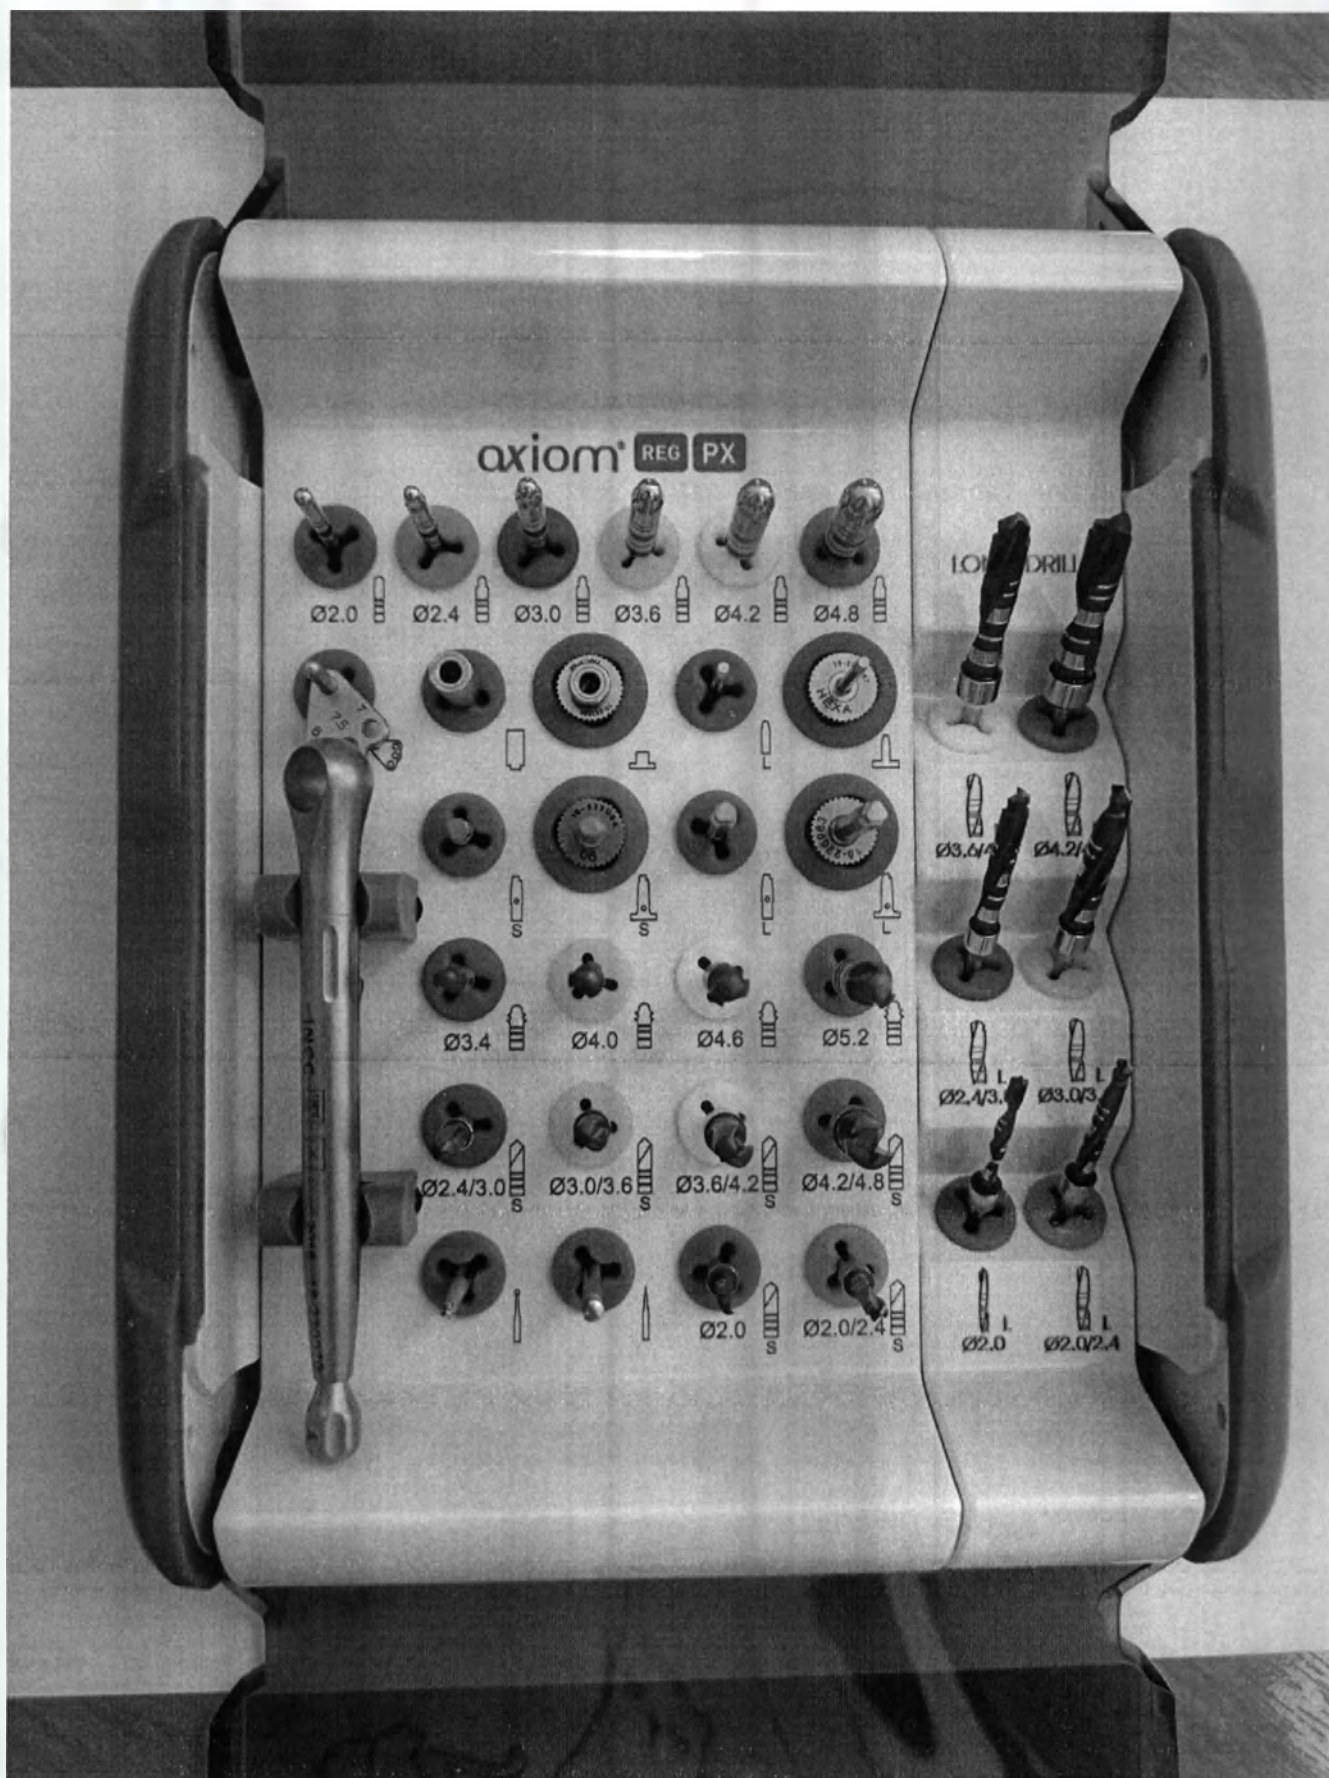


## 2. Набор хирургический AXIOM Ø2.8 (INKITOP28)

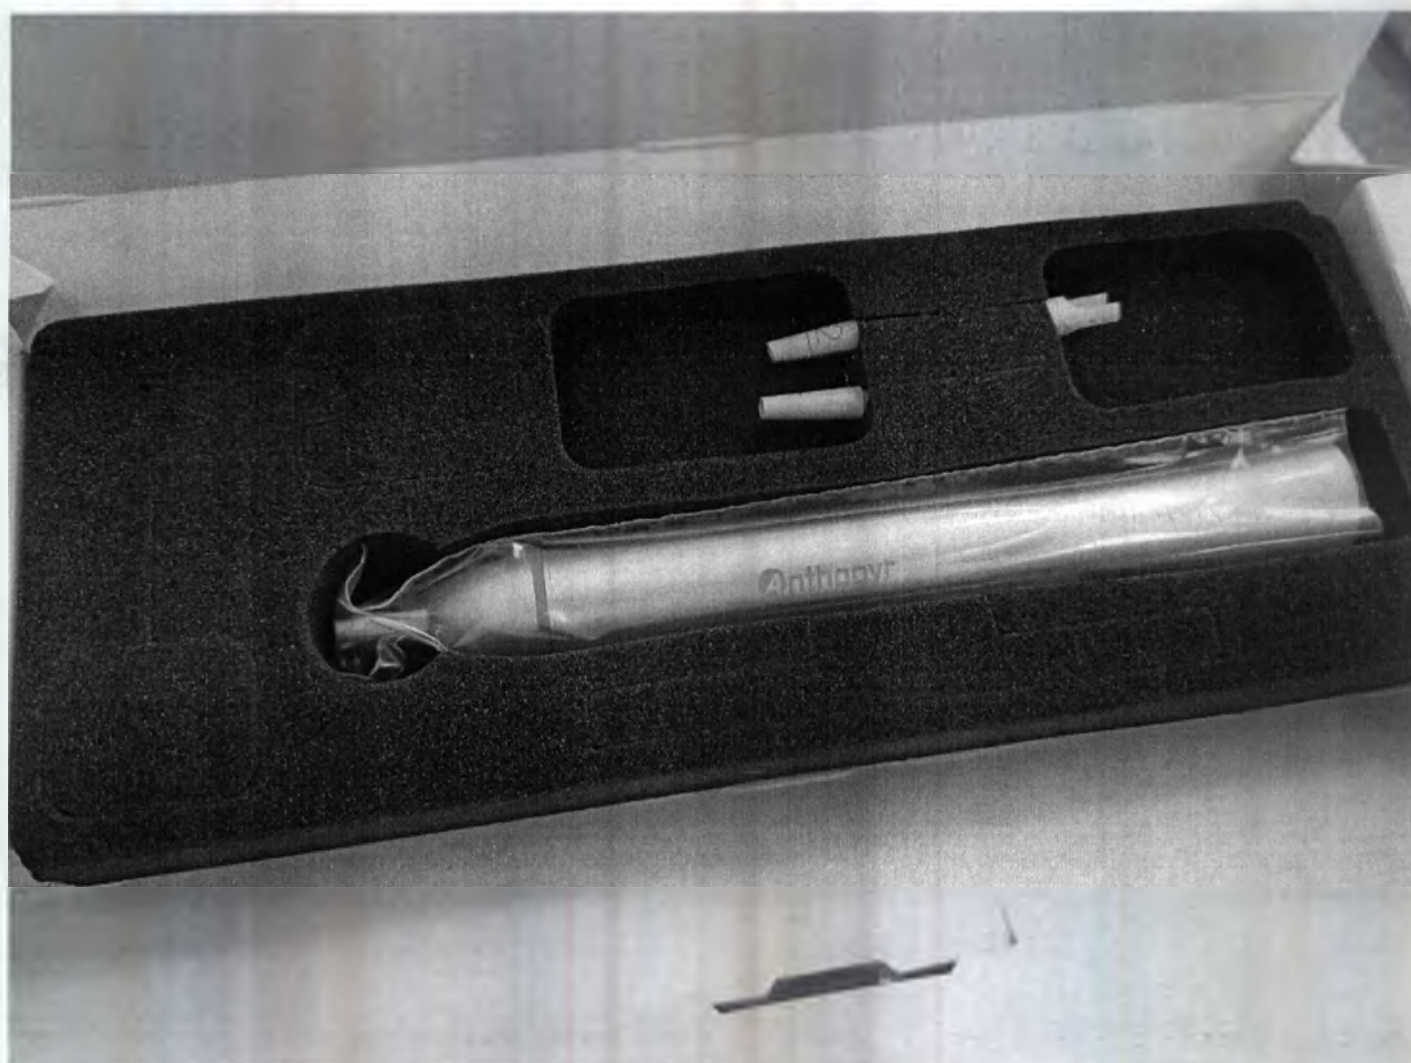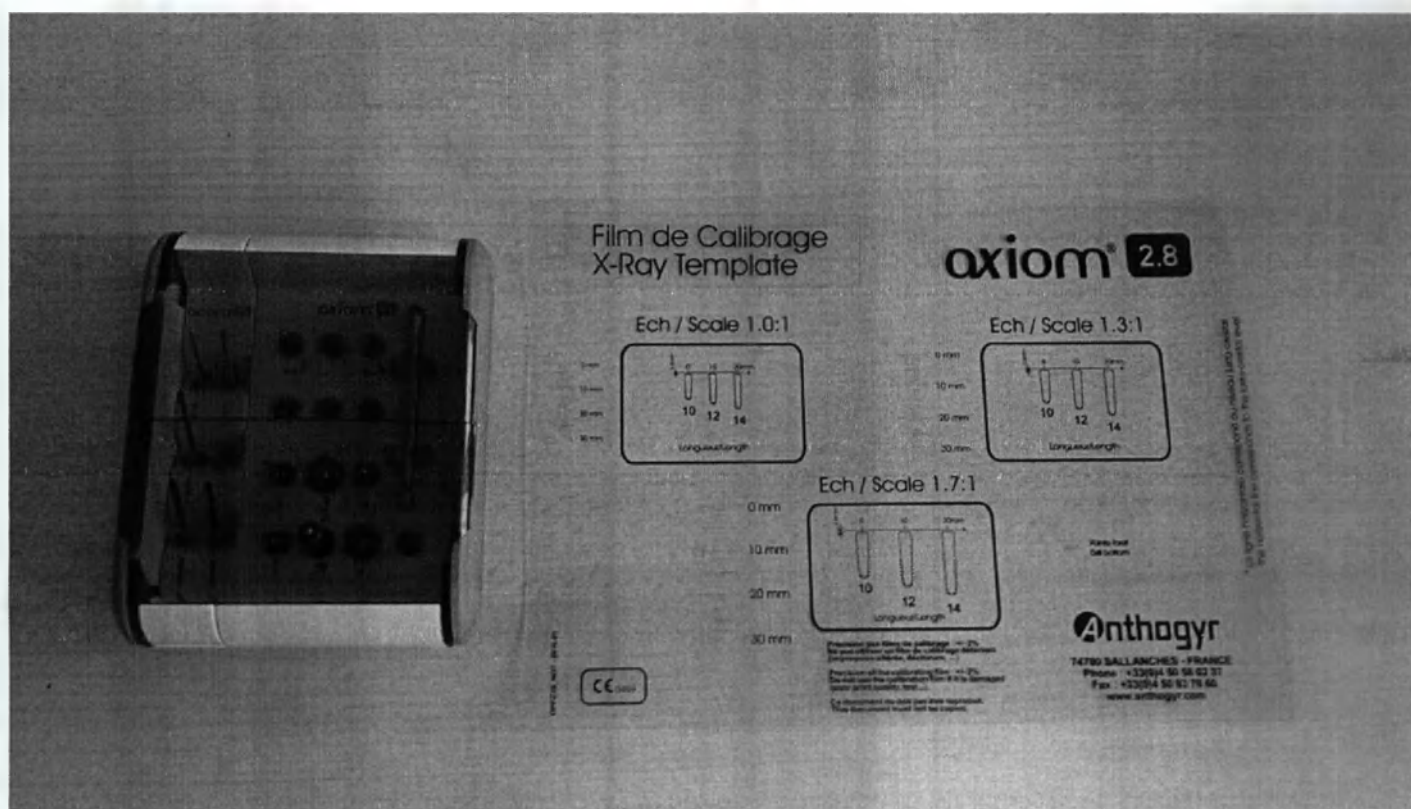





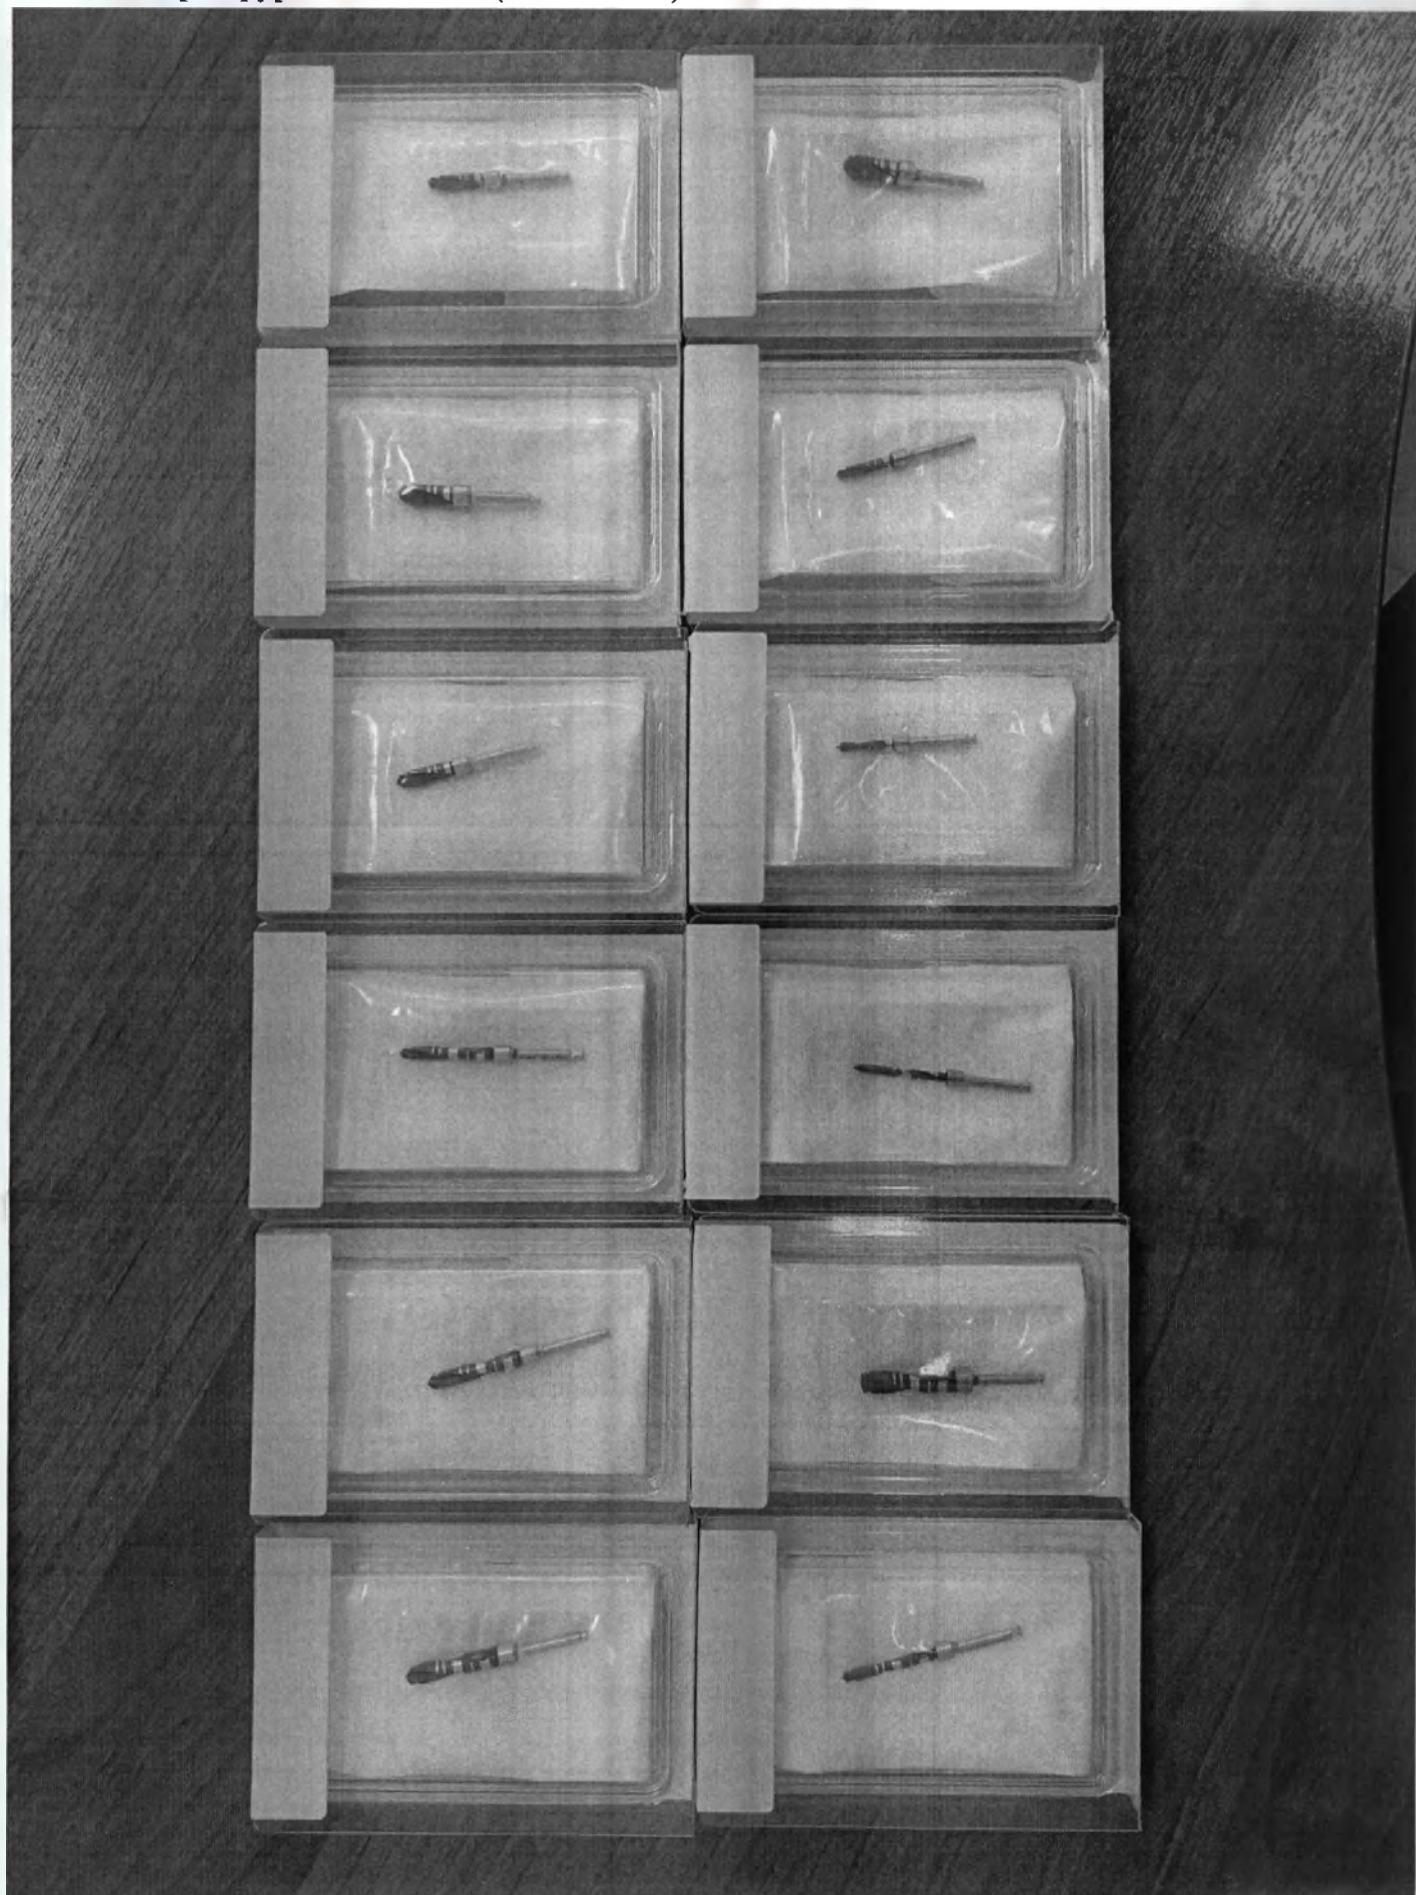




6 Набор хирургический №7 (ОРА-4)




7 Набор для протезных работ (6920)

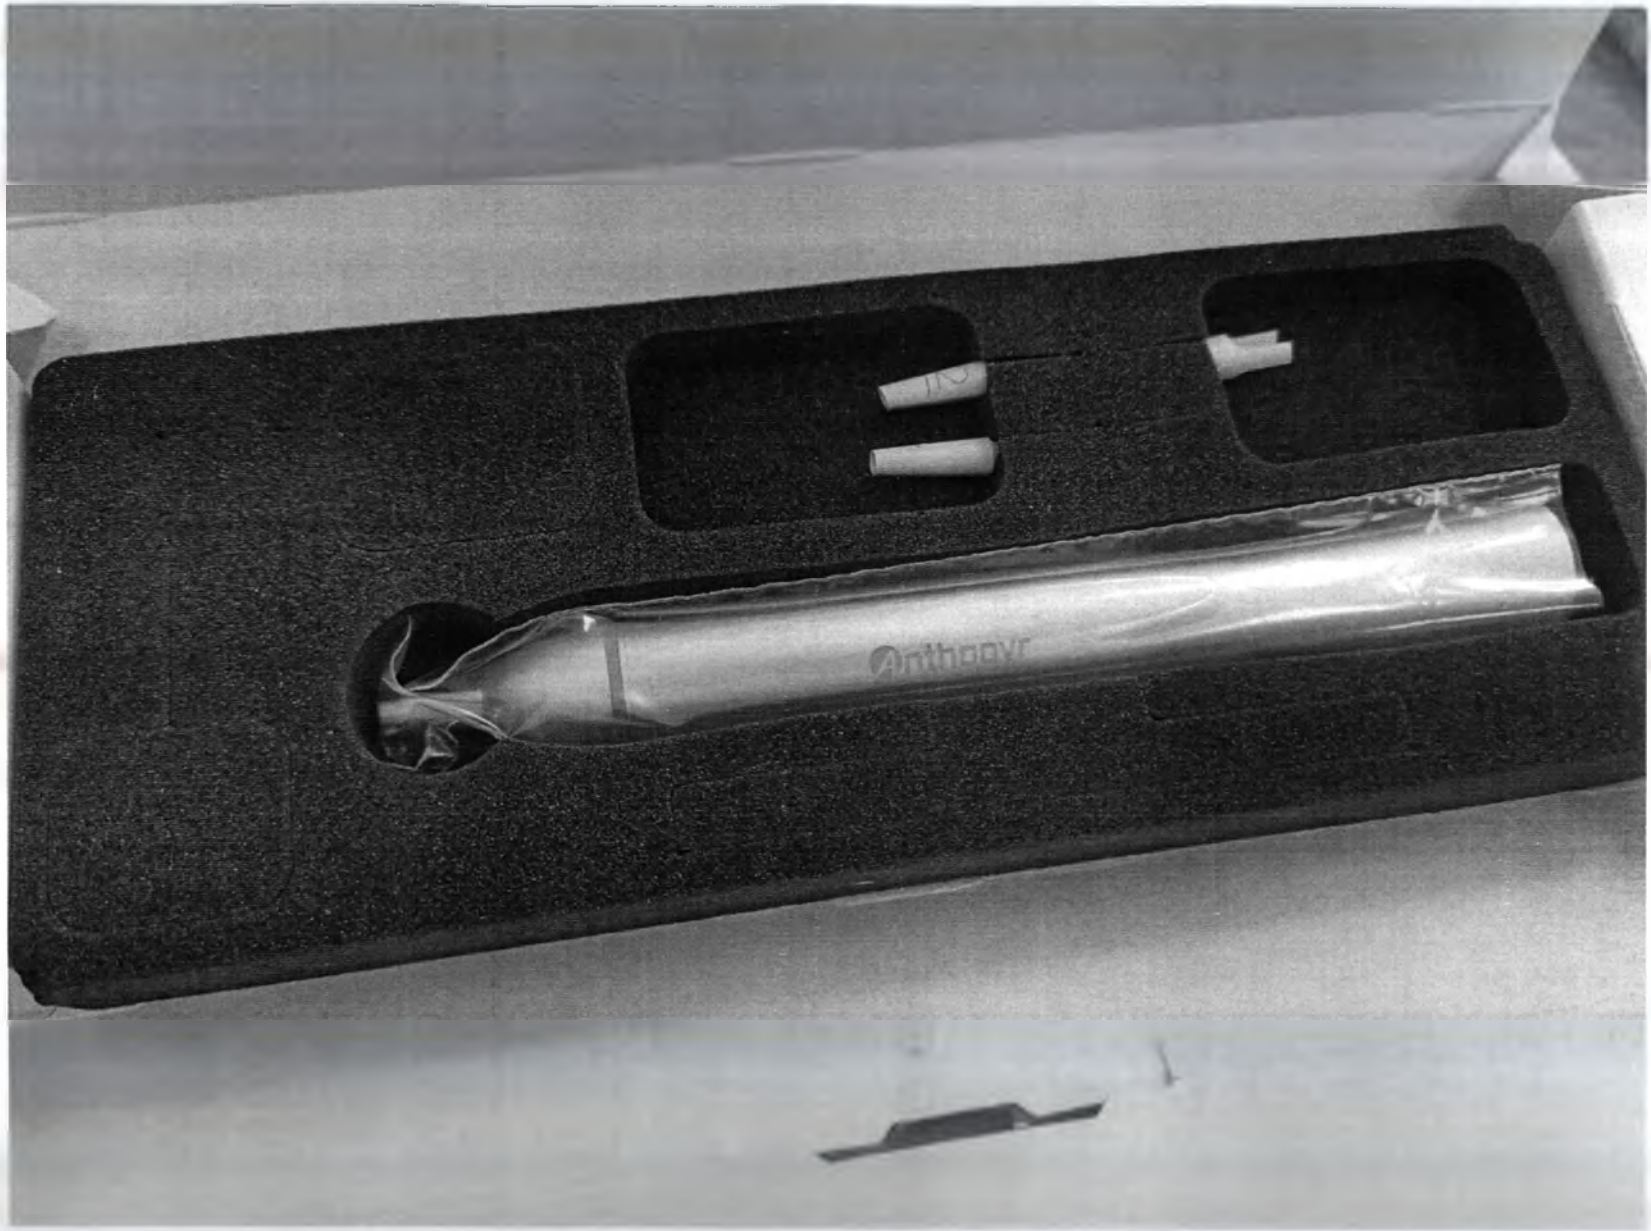



9 Набор для протезных работ №2 (INMODOPP)

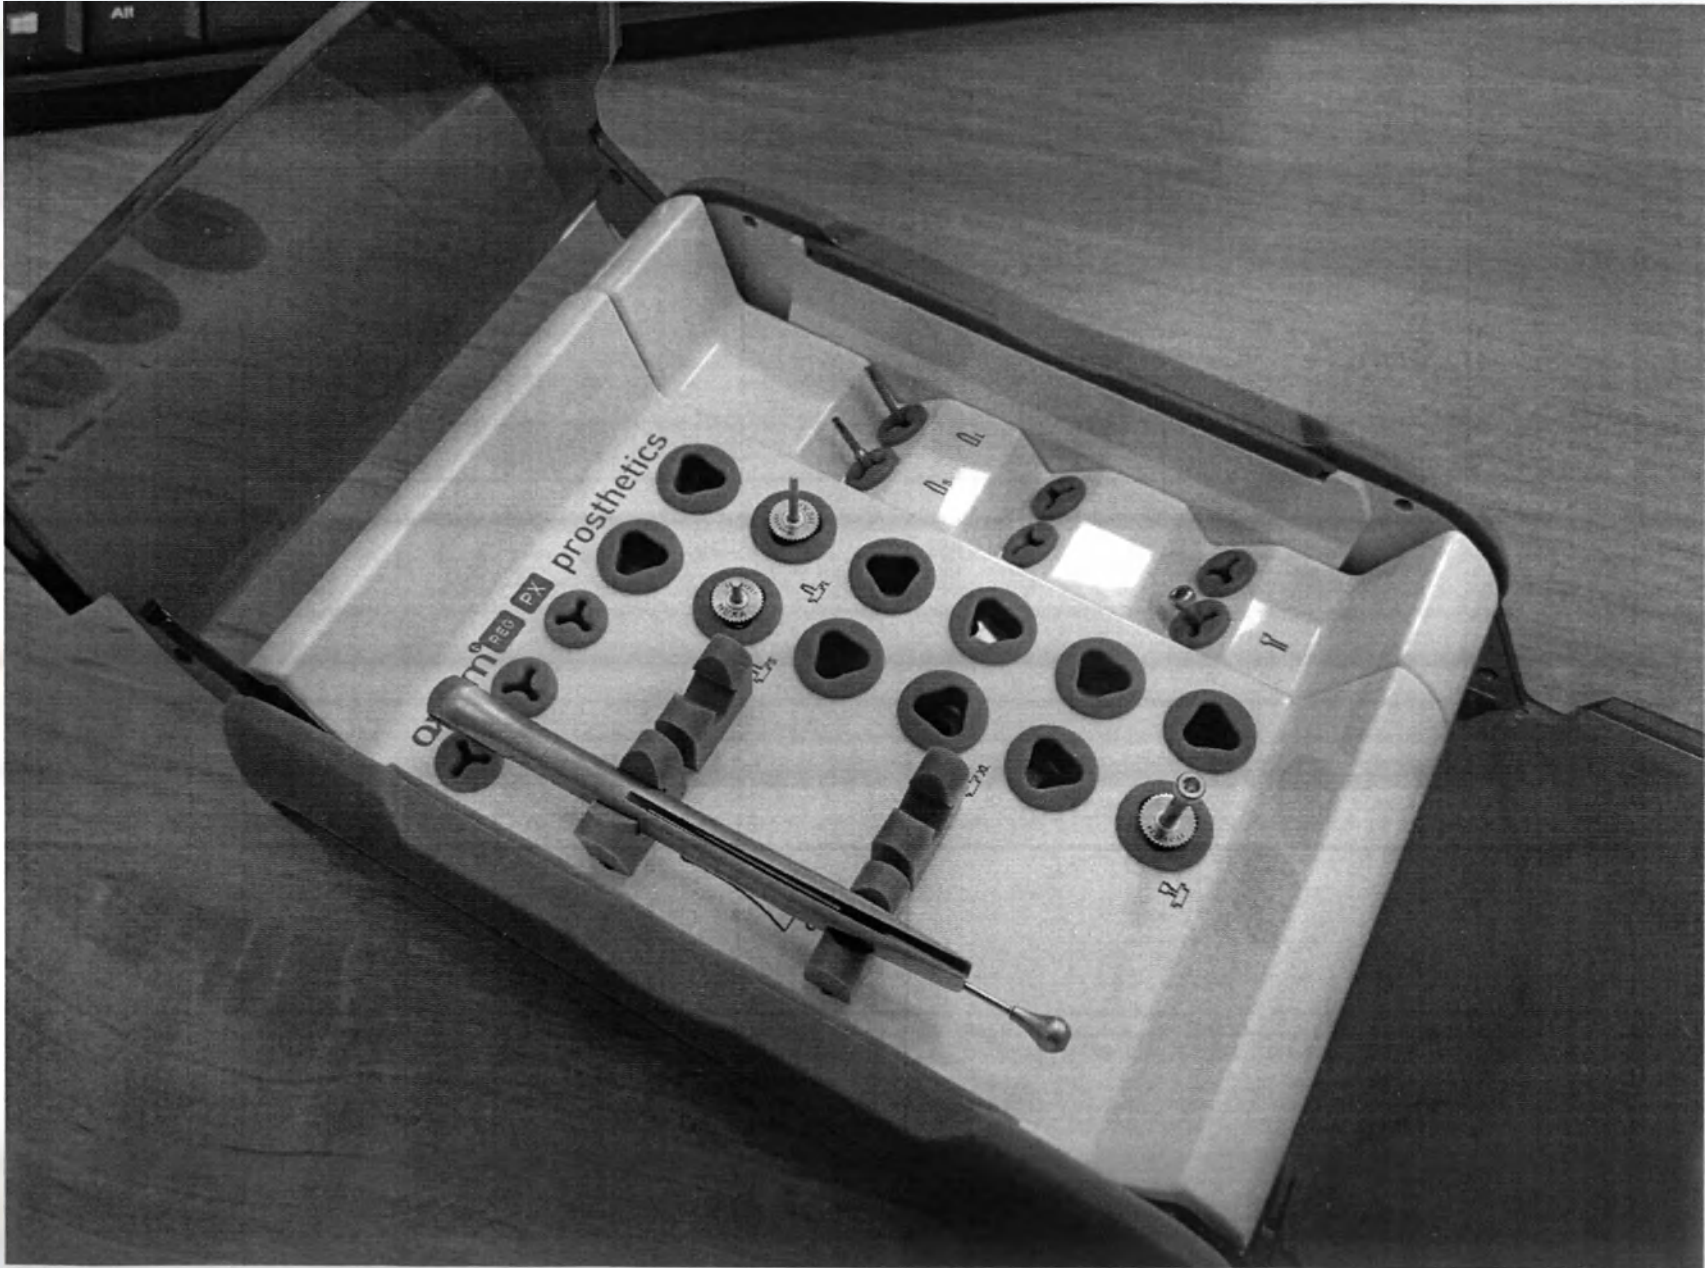





12. Набор корректировочный (INEXPR), в составе:



13. Набор корректировочный (INKITEXPR)




Отдельные инструменты и приспособления для установки имплантатов:

**1. Колпачок протезный:**


**1.1 Колпачок протезный выгораемый (ОРСА028);**



- 1.2 Колпачок протезный выгораемый для коронки Ø3.4 Н4 (ОРСА304);
- 1.3 Колпачок протезный выгораемый для коронки Ø3.4 Н6 (ОРСА306);
- 1.4 Колпачок протезный выгораемый для коронки Ø4.0 Н4 (ОРСА404);
- 1.5 Колпачок протезный выгораемый для коронки Ø4.0 Н6 (ОРСА406);
- 1.6 Колпачок протезный выгораемый для коронки Ø5.0 Н4 (ОРСА504);
- 1.7 Колпачок протезный выгораемый для коронки Ø5.0 Н6 (ОРСА506);
- 1.8 Колпачок протезный выгораемый для коронки Ø6.0 Н4 (ОРСА604);
- 1.9 Колпачок протезный выгораемый для коронки Ø6.0 Н6 (ОРСА606);

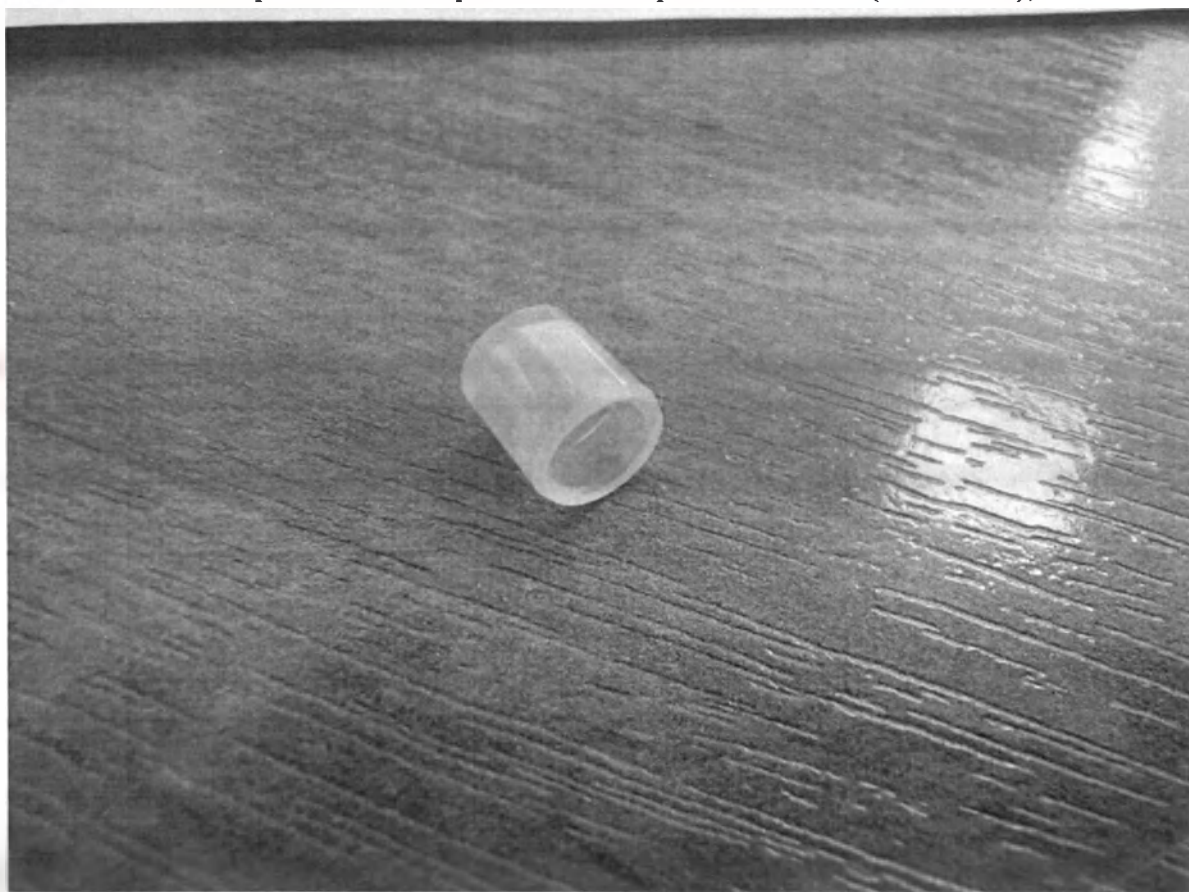

- 1.10 Колпачок протезный выгораемый для моста Ø3.4 Н4 (OPCR304);
- 1.11 Колпачок протезный выгораемый для моста Ø3.4 Н6 (OPCR306);
- 1.12 Колпачок протезный выгораемый для моста Ø4.0 Н4 (OPCR404);
- 1.13 Колпачок протезный выгораемый для моста Ø4.0 Н6 (OPCR406);
- 1.14 Колпачок протезный выгораемый для моста Ø5.0 Н4 (OPCR504);
- 1.15 Колпачок протезный выгораемый для моста Ø5.0 Н6 (OPCR506);
- 1.16 Колпачок протезный выгораемый для моста Ø6.0 Н4 (OPCR604);
- 1.17 Колпачок протезный выгораемый для моста Ø6.0 Н6 (OPCR606);

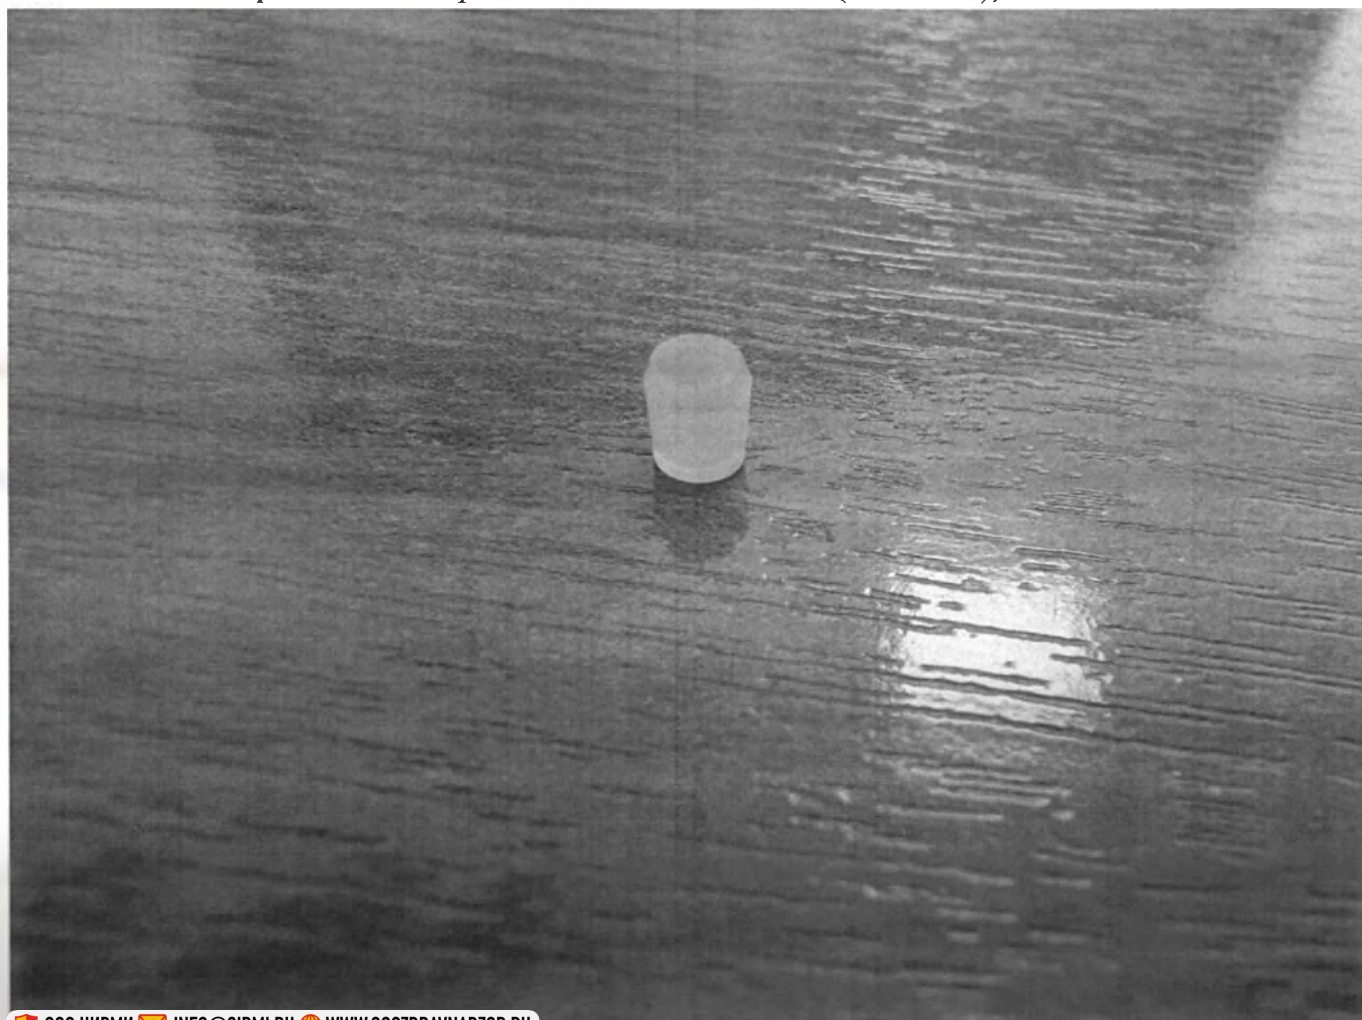

1.18 Колпачок протезный FlexiBase Ø4 Ch 3.5 (OPFLEXC403);



1.19 Колпачок протезный FlexiBase Ø5 Ch 3.5 (OPFLEXC503);




1.20 Колпачок протезный выгораемый для абатментов MU Ø4.0, с винтом (MUNC300);




1.21 Колпачок протезный выгораемый для абатментов MU Ø4.0 (MUNPAC120)




1.22 Колпачок протезный выгораемый для абатментов MU Ø4.8, с винтом (MUC300)

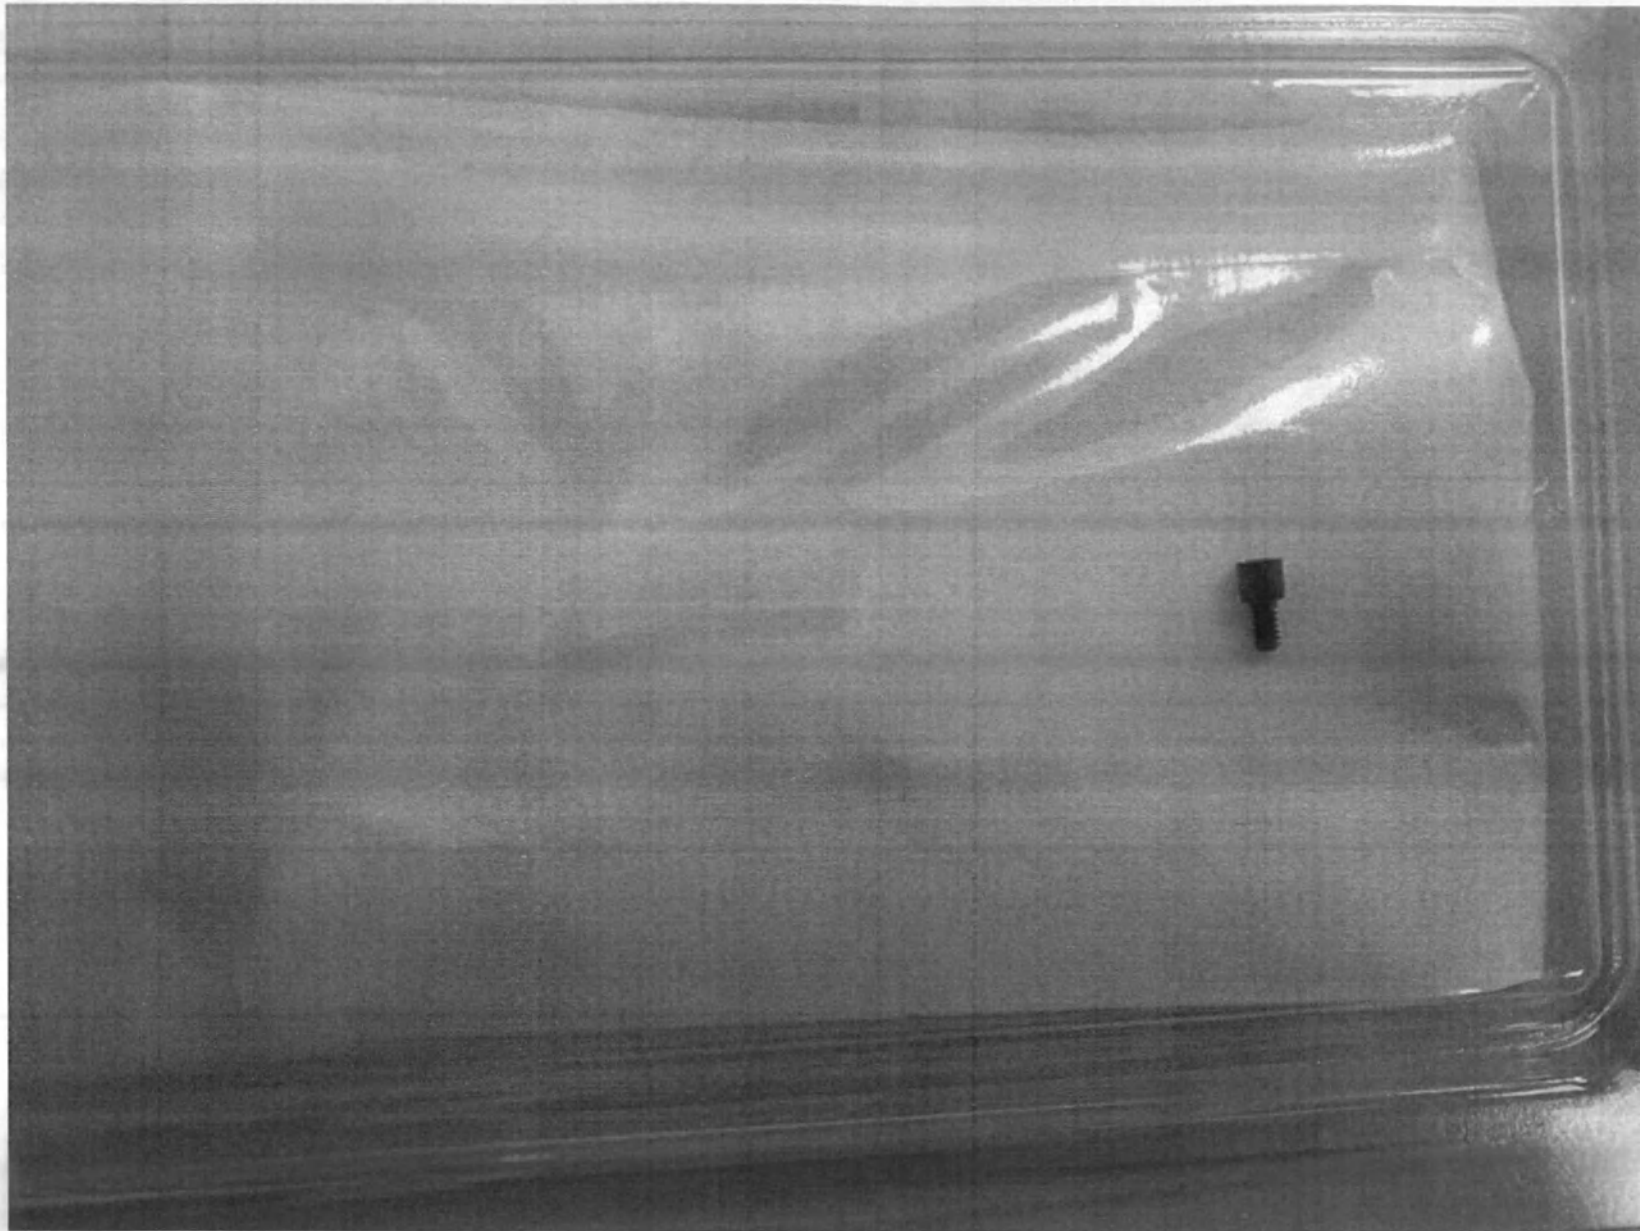

1.23 Колпачок протезный временный для абатментов MU Ø4.8, с винтом (MUC200)

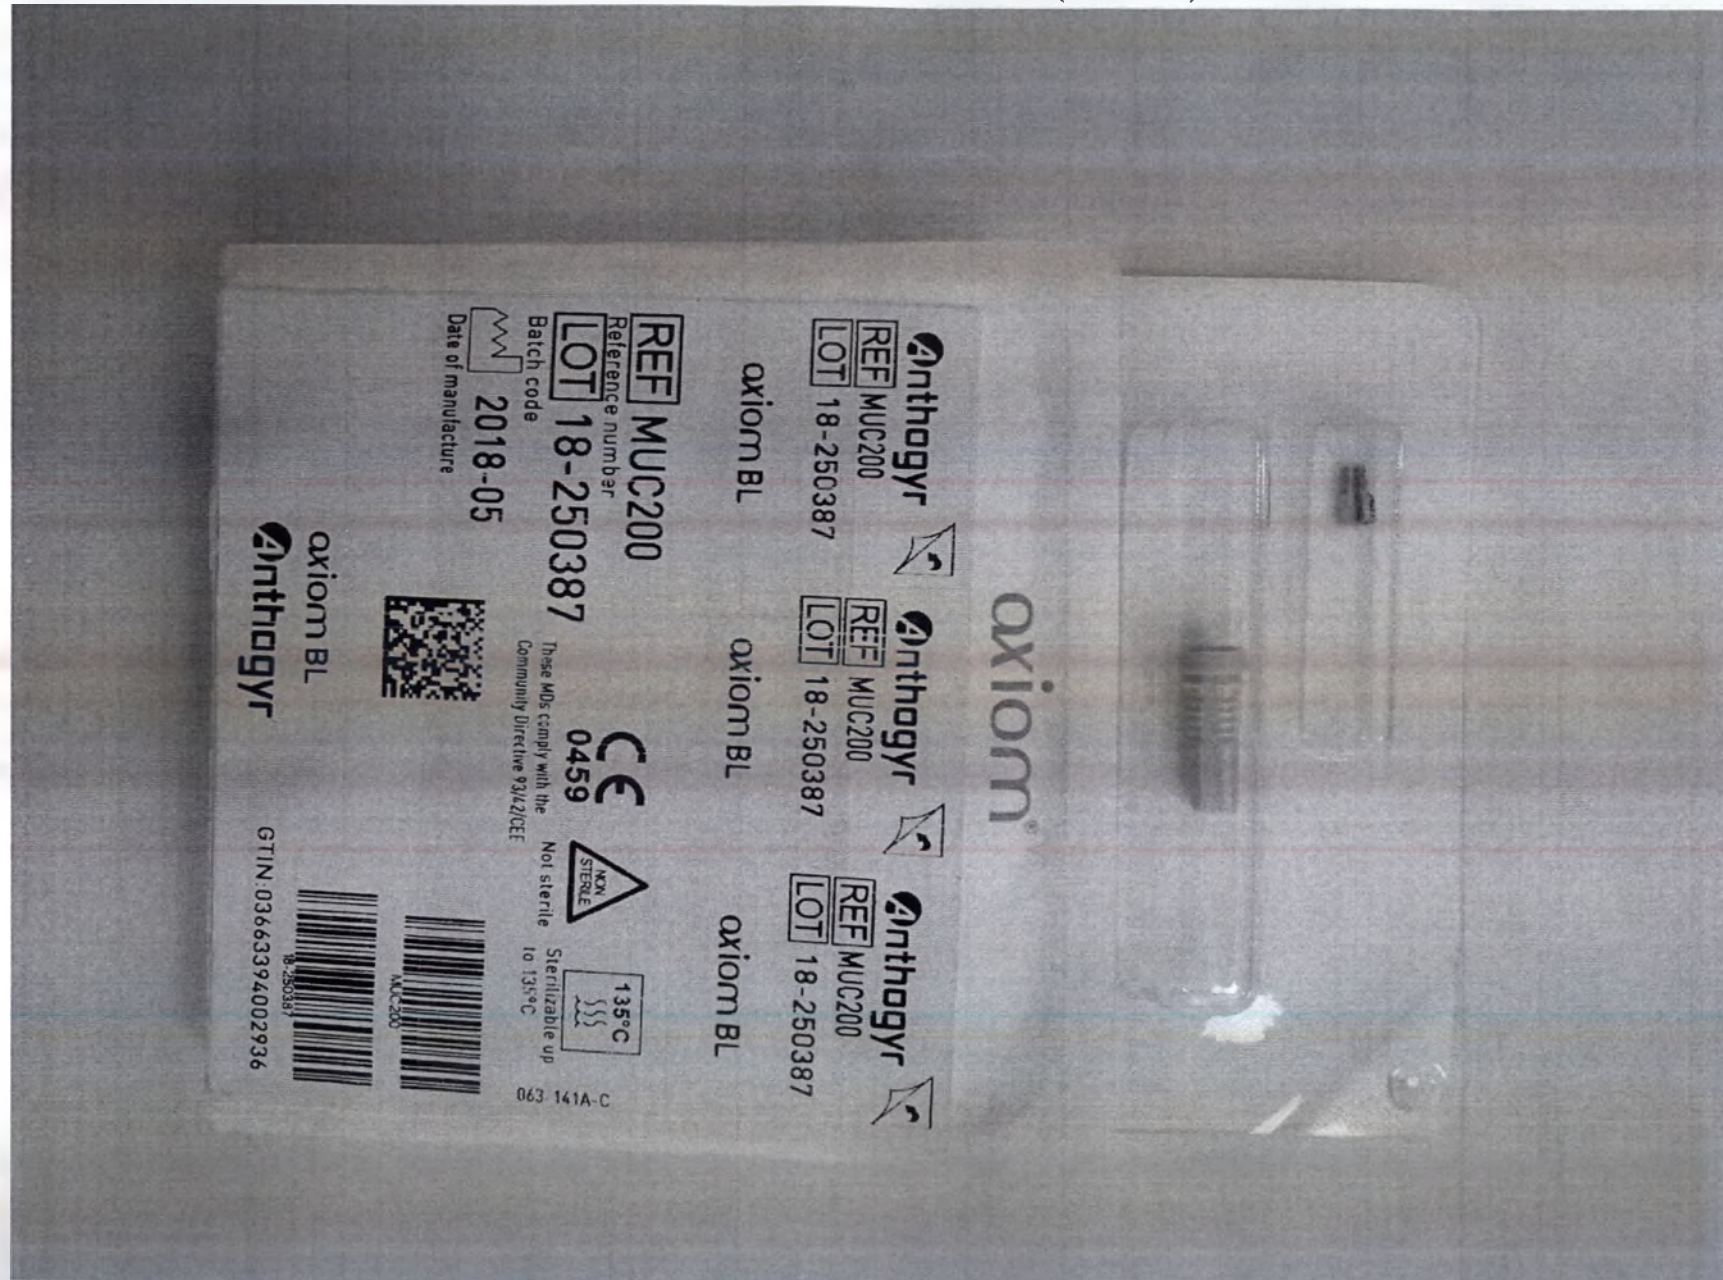

1.24 Колпачок протезный временный для абатментов MU Ø4.0, с винтом (MUNC200)

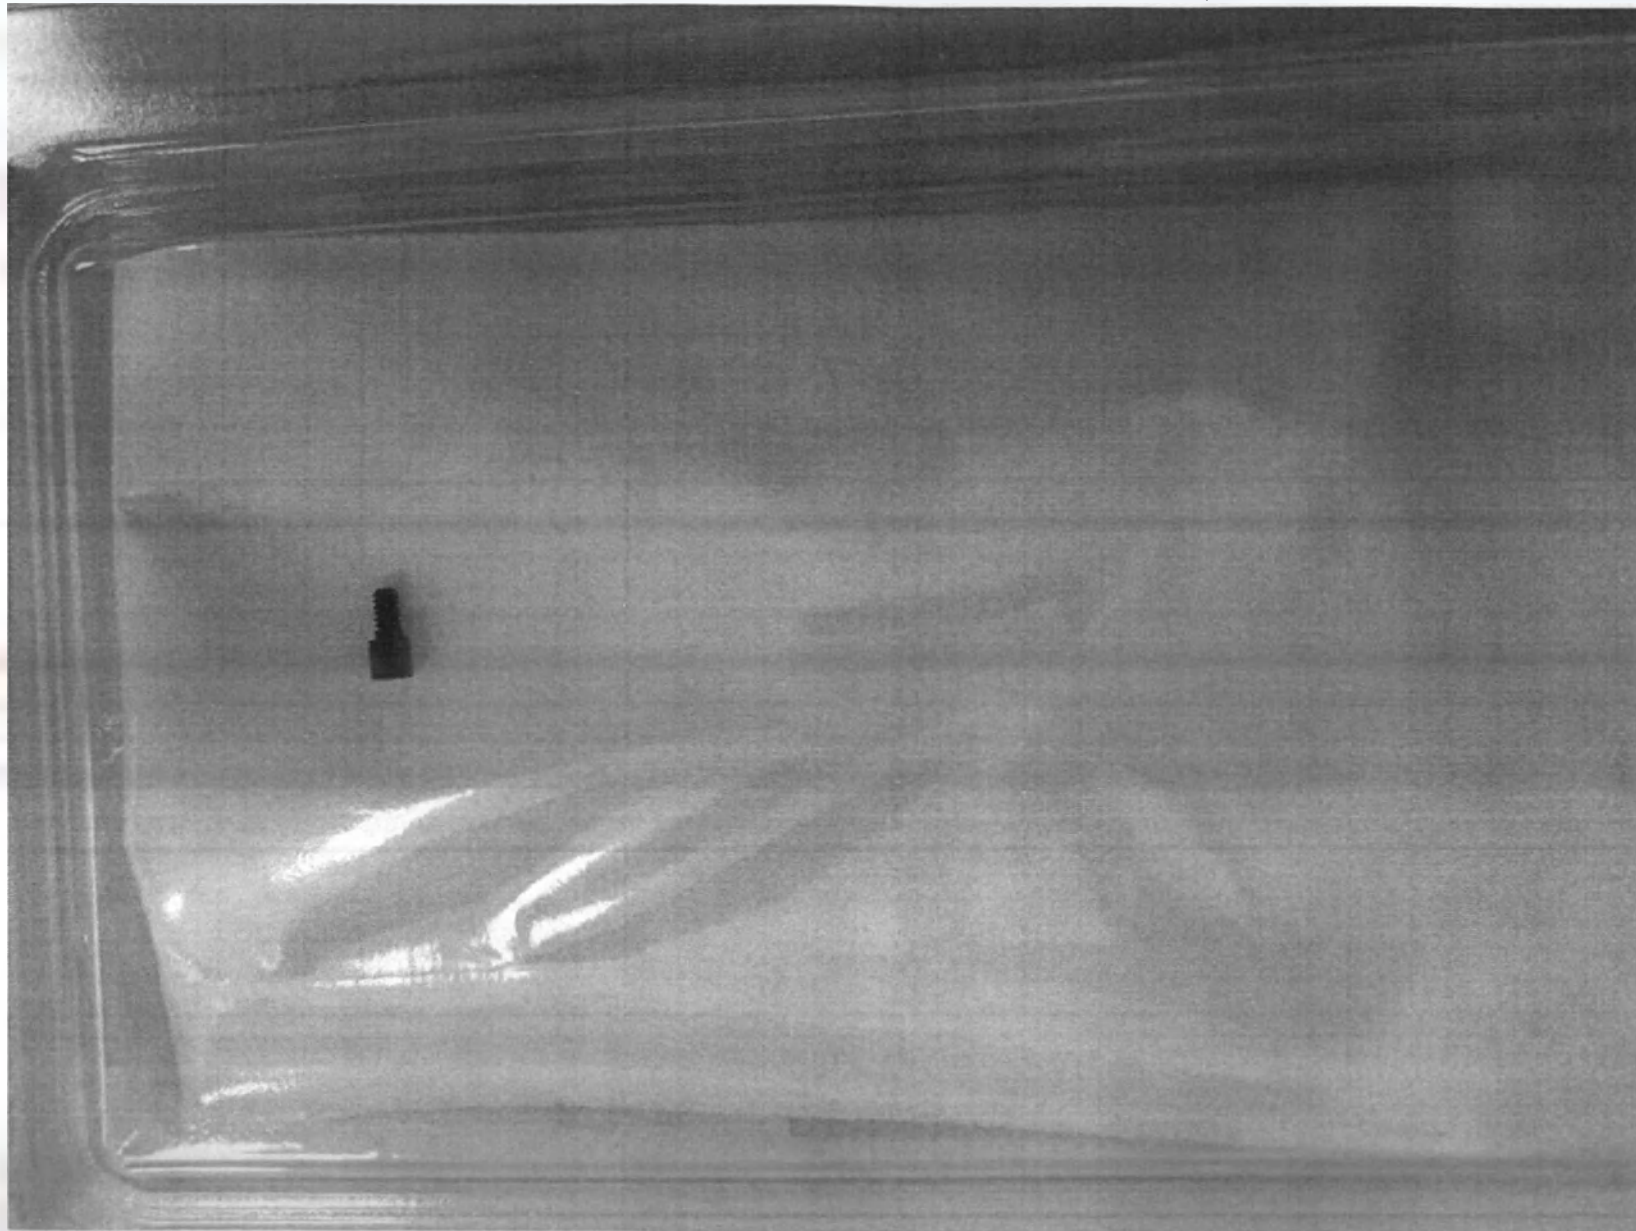


- 1.25 Колпачок протезный защитный Ø3.4 H4 (OPPC304)
- 1.26 Колпачок протезный защитный Ø3.4 H6 (OPPC306)
- 1.27 Колпачок протезный защитный Ø4.0 H4 (OPPC404)
- 1.28 Колпачок протезный защитный Ø4.0 H6 (OPPC406)
- 1.29 Колпачок протезный защитный Ø5.0 H4 (OPPC504)
- 1.30 Колпачок протезный защитный Ø5.0 H6 (OPPC506)
- 1.31 Колпачок протезный защитный Ø6.0 H4 (OPPC604)
- 1.32 Колпачок протезный защитный Ø6.0 H6 (OPPC606)




1.33 Колпачок протезный защитный Ø2.8 (OPPC028)




1.34 Колпачок протезный LOCATOR, 5 шт. в упаковке, в составе: колпачок протезный LOCATOR, прокладка блокирующая белая LOCATOR, колпачок протезный прозрачный стандартной фиксации LOCATOR, колпачок протезный легкой фиксации LOCATOR, колпачок протезный экстра-легкой фиксации LOCATOR (OPLA100)

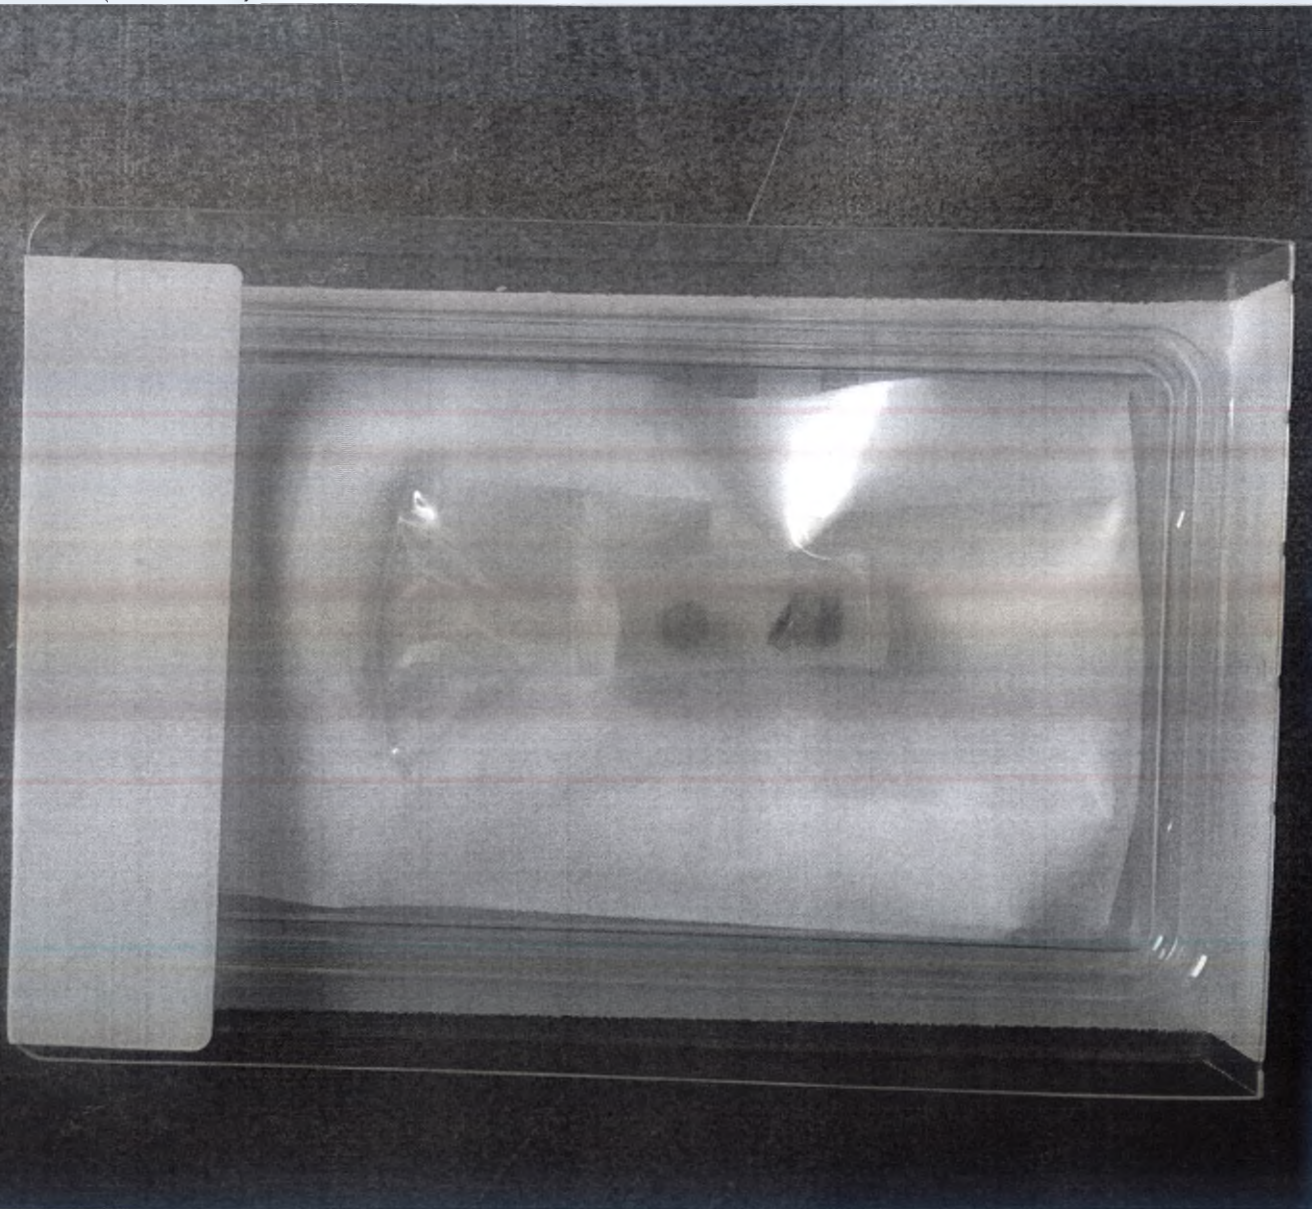


1.35 Колпачок протезный LOCATOR, 5 шт. в упаковке, в составе: колпачок протезный LOCATOR, прокладка блокирующая белая LOCATOR, колпачок протезный зеленый LOCATOR, колпачок протезный оранжевый LOCATOR, колпачок протезный красный LOCATOR (OPLA700).

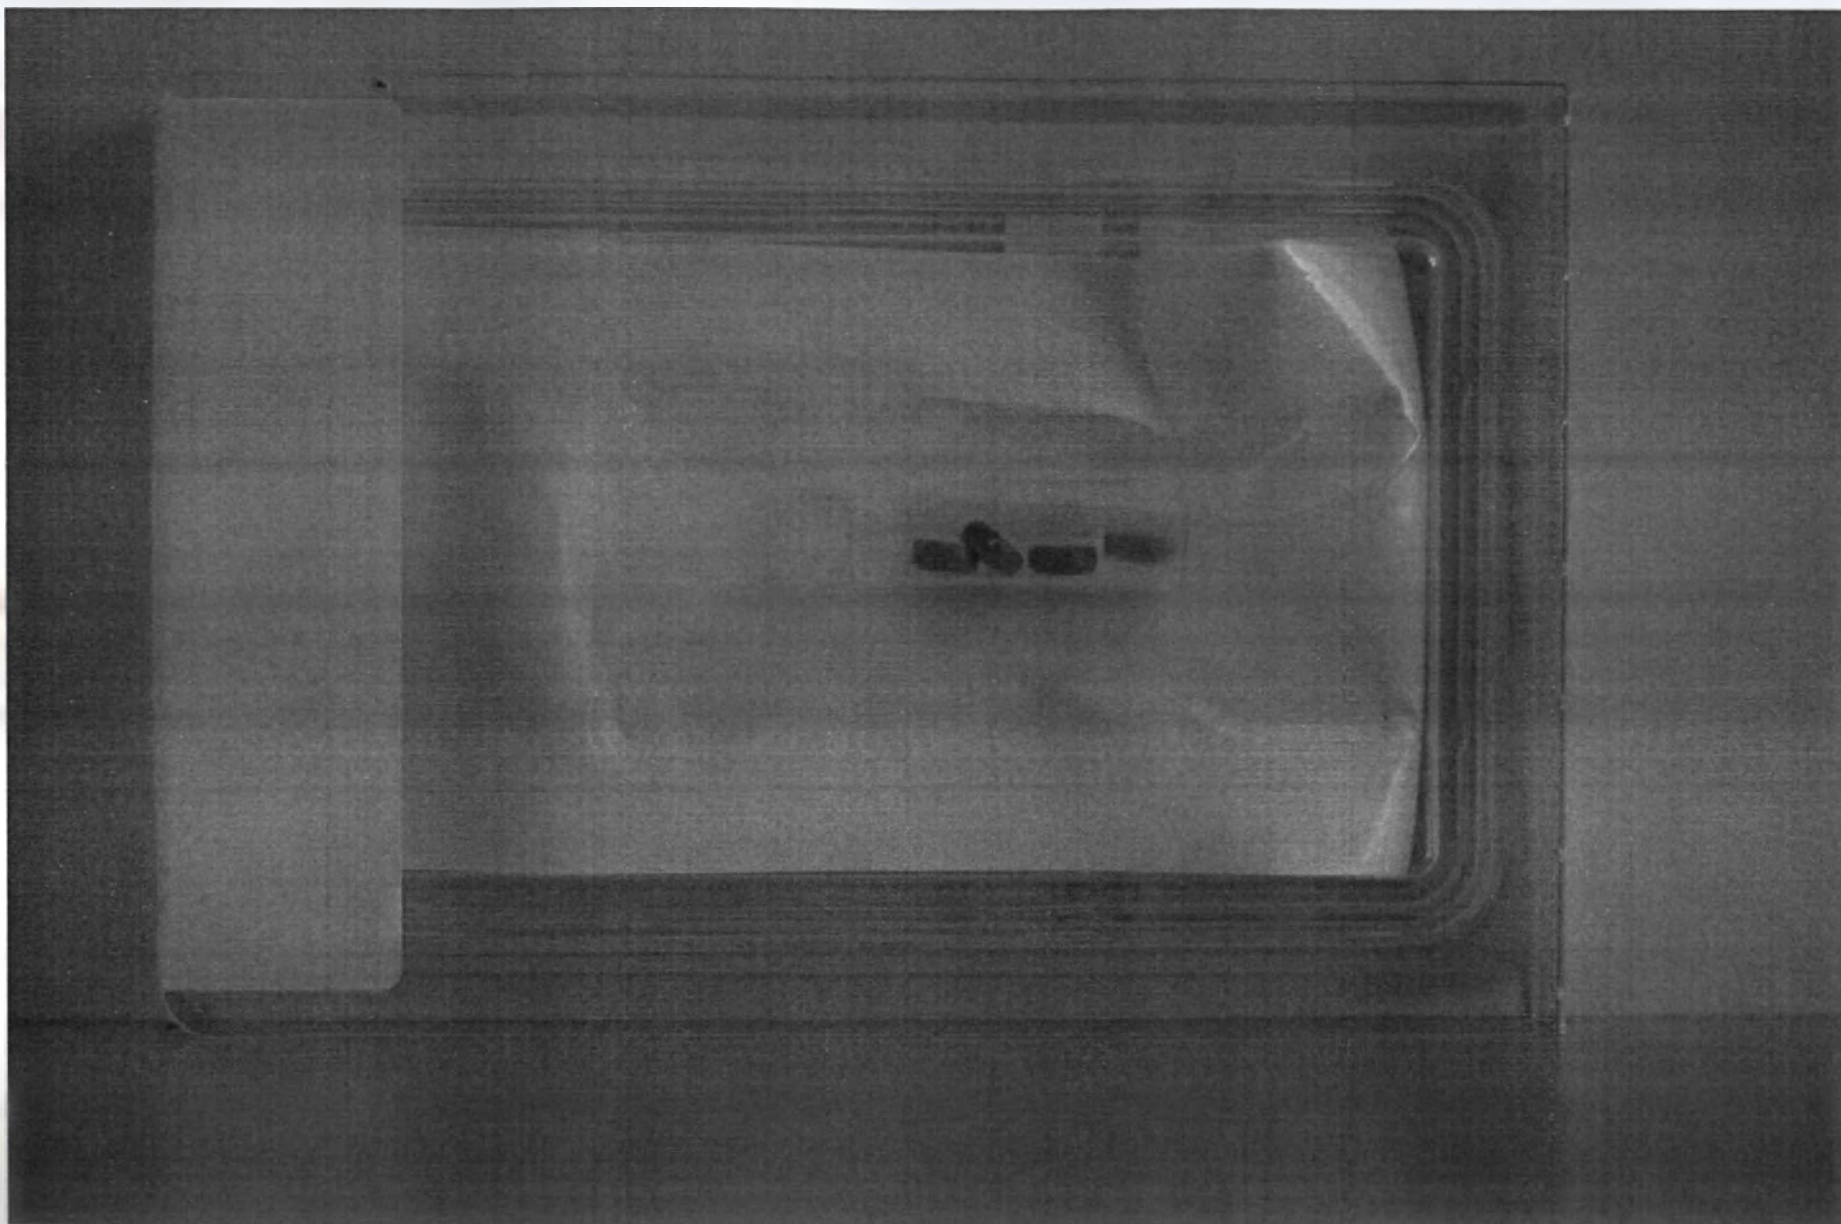


1.36 Колпачок протезный прозрачный LOCATOR, 4 шт. в упаковке (OPLA200)

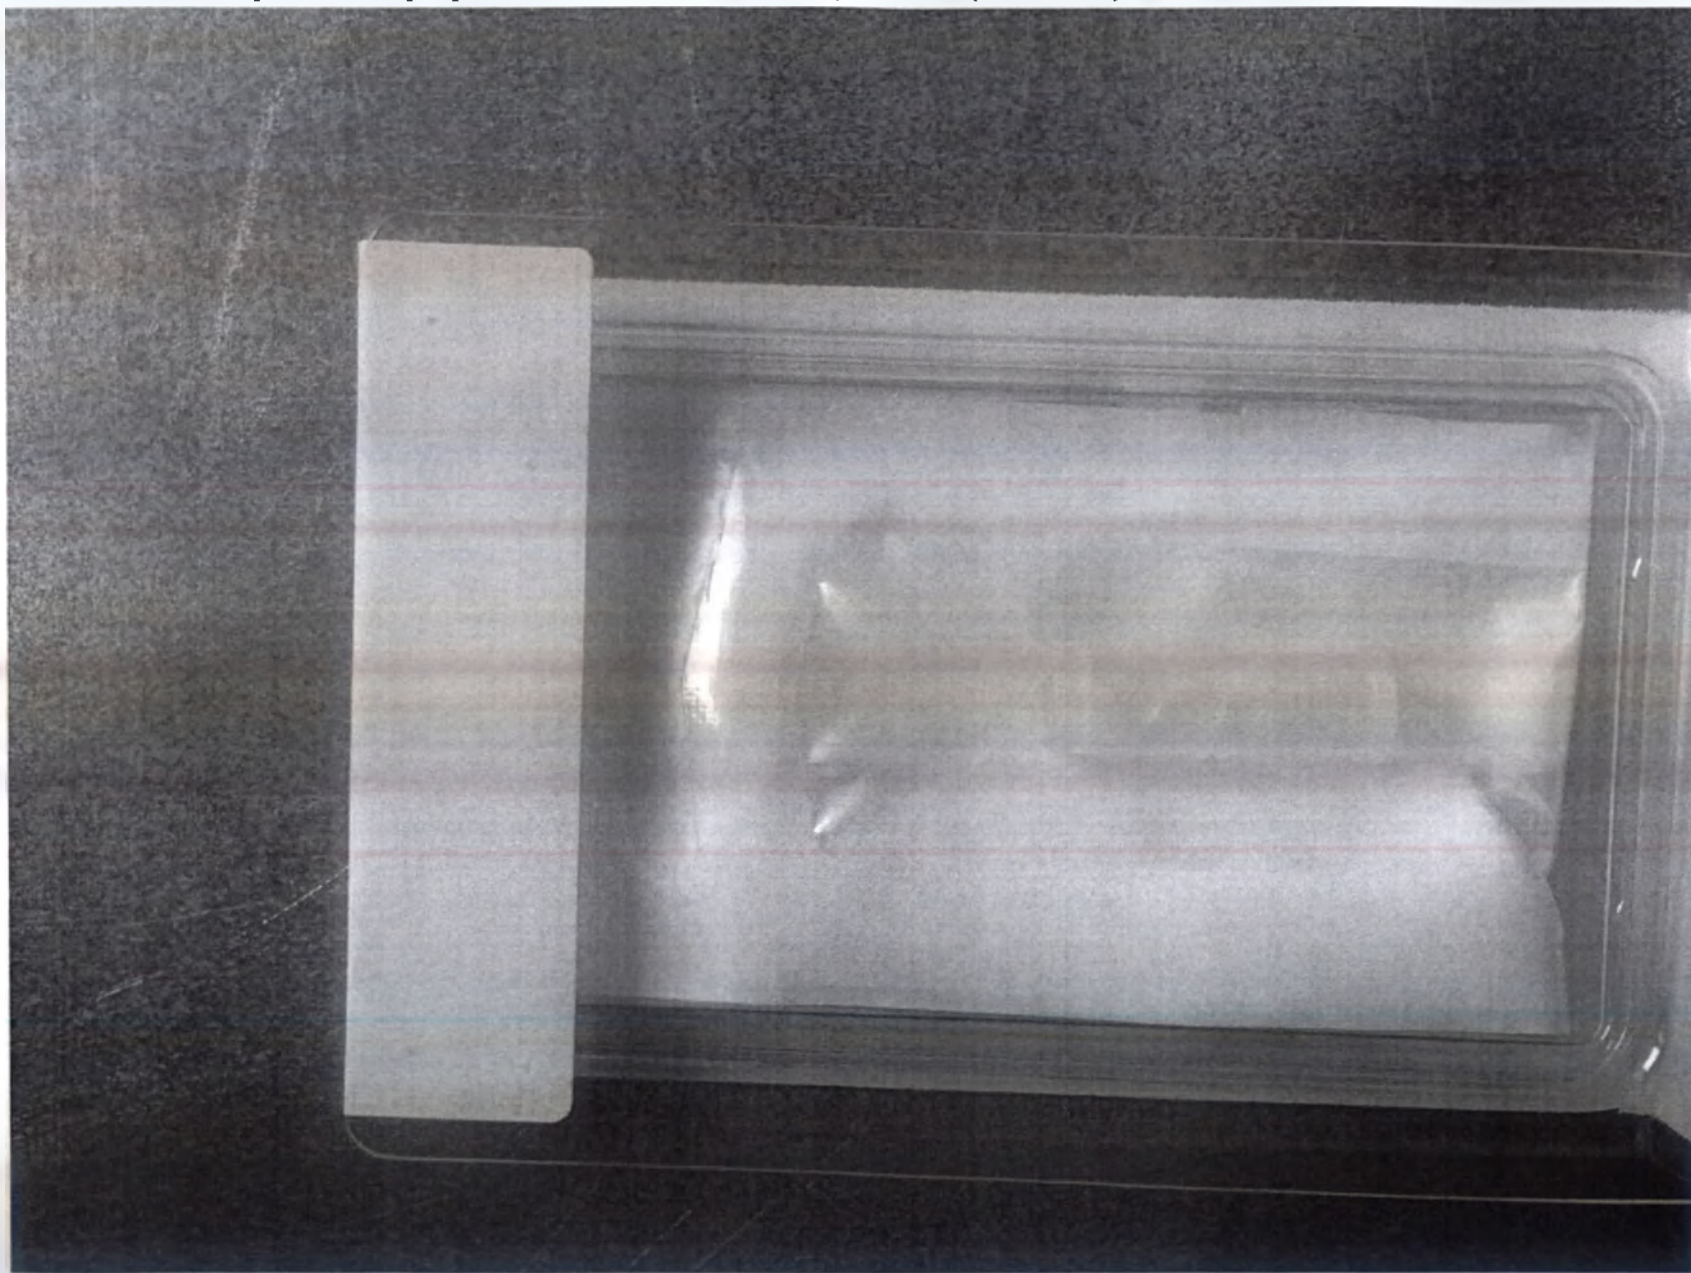

1.37 Колпачок протезный легкой фиксации LOCATOR, 4 шт. в упаковке (OPLA300)

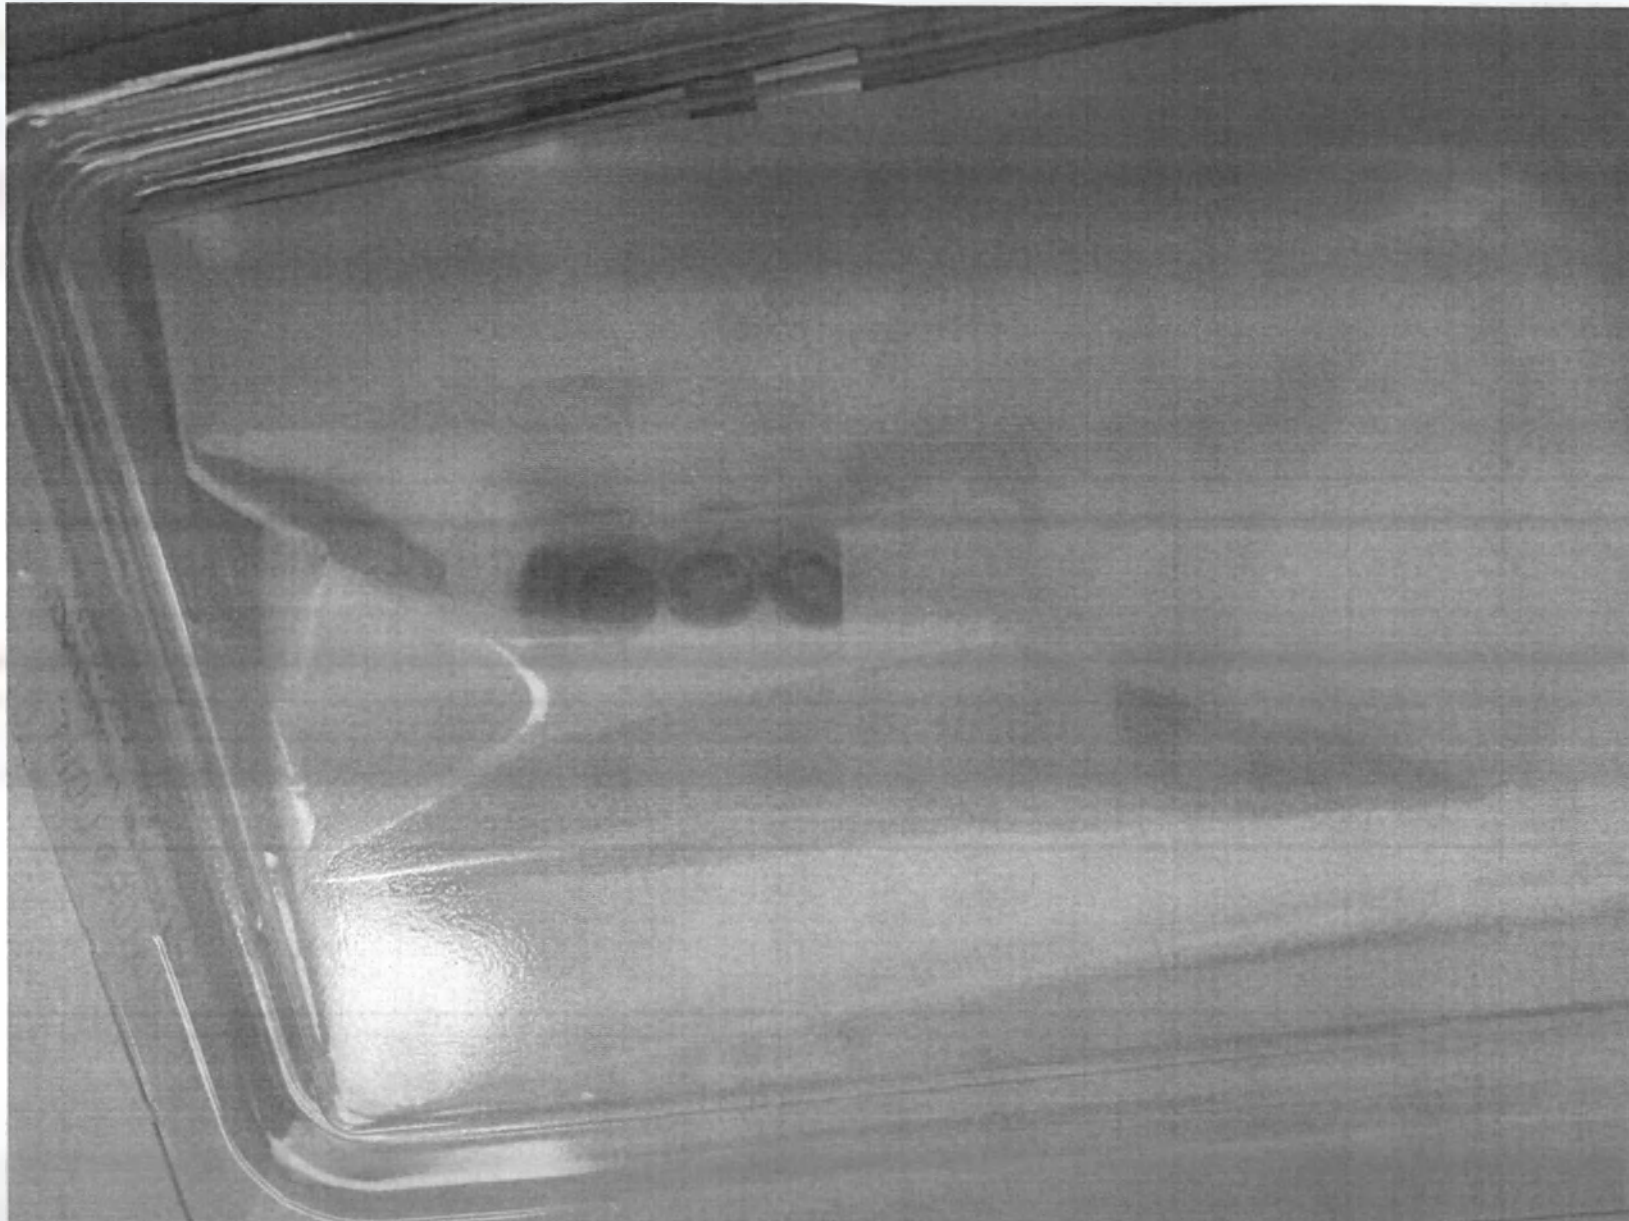


1.38 Колпачок протезный экстра-легкой фиксации LOCATOR, 4 шт. в упаковке (OPLA400)

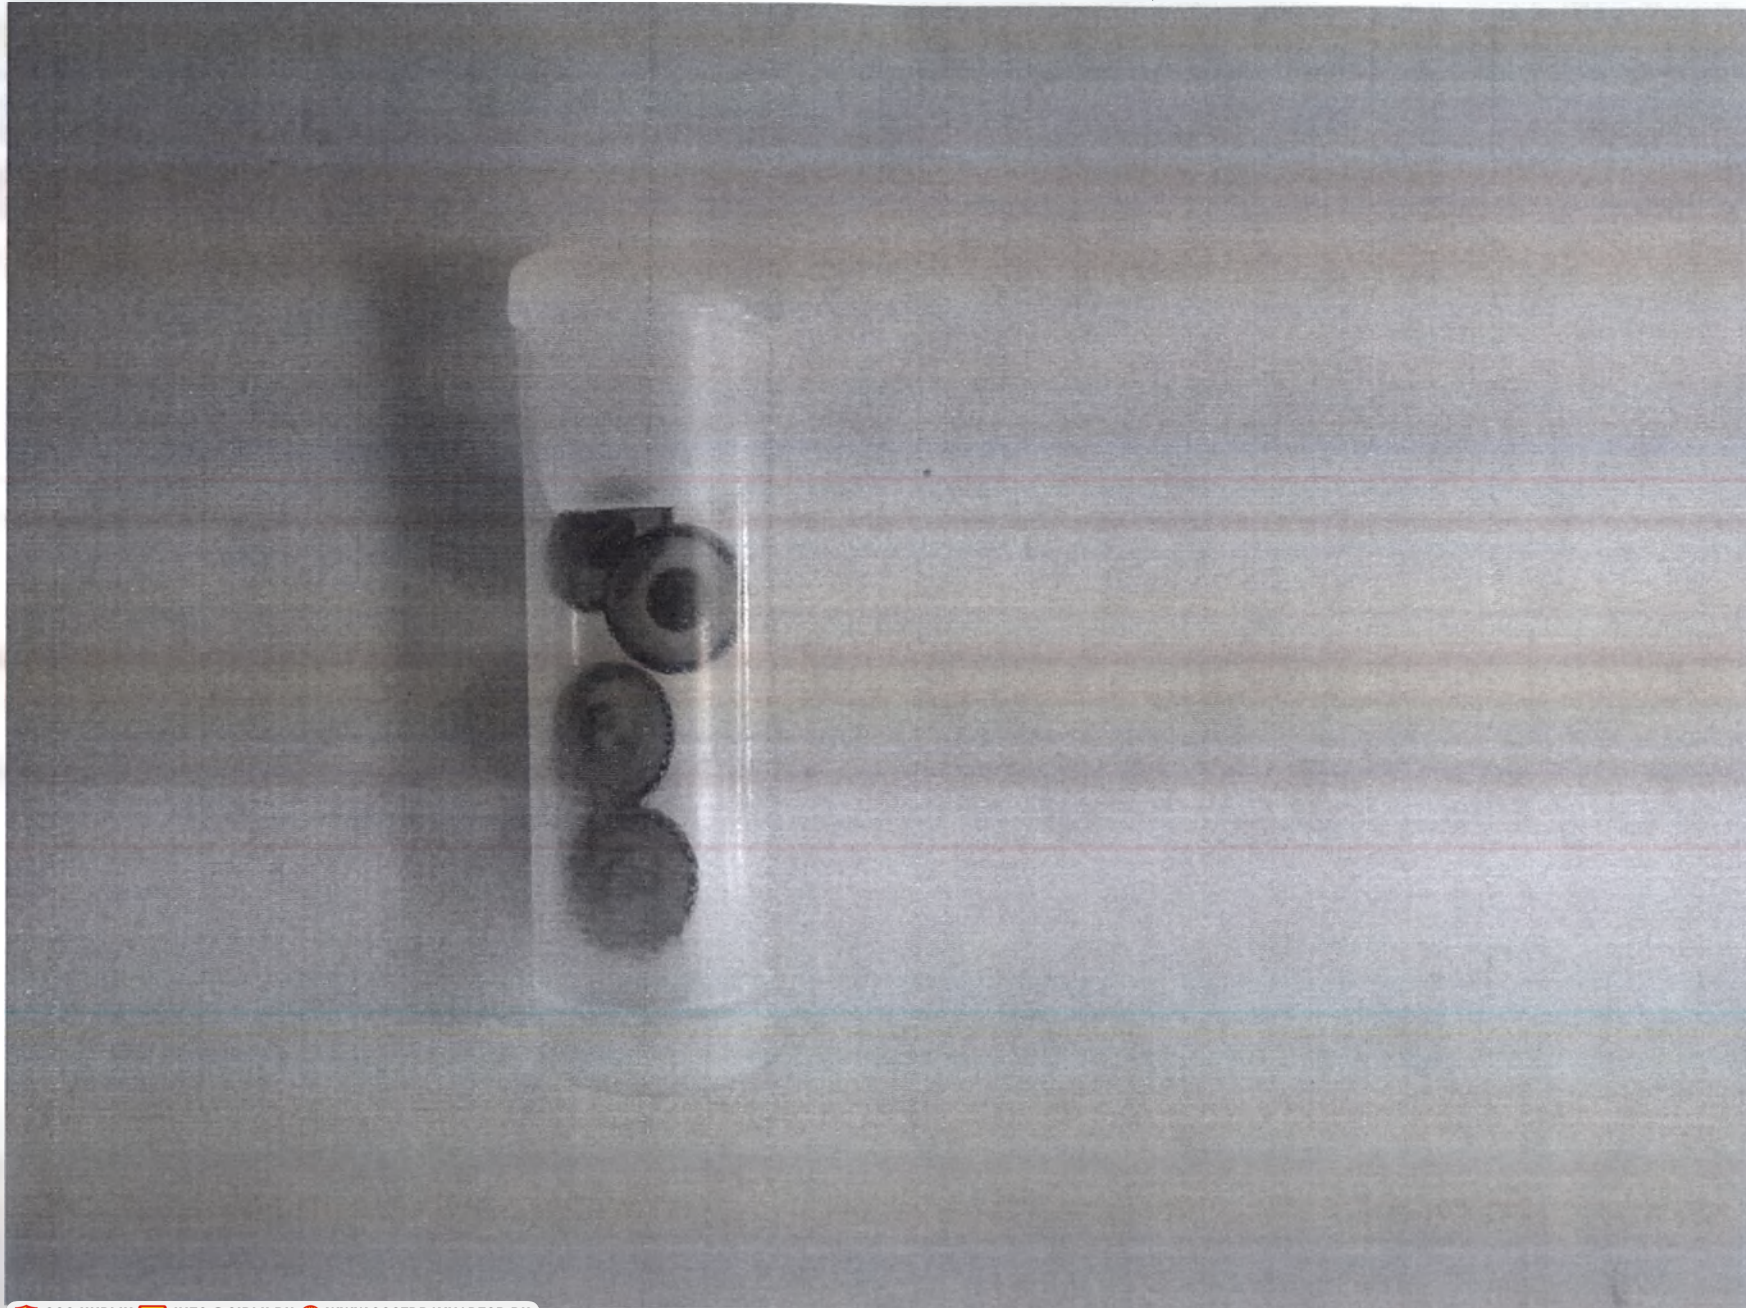


1.39 Колпачок протезный серый LOCATOR, 4 шт. в упаковке (OPLA710)




1.40 Колпачок протезный красный LOCATOR, 4 шт. в упаковке (OPLA720)

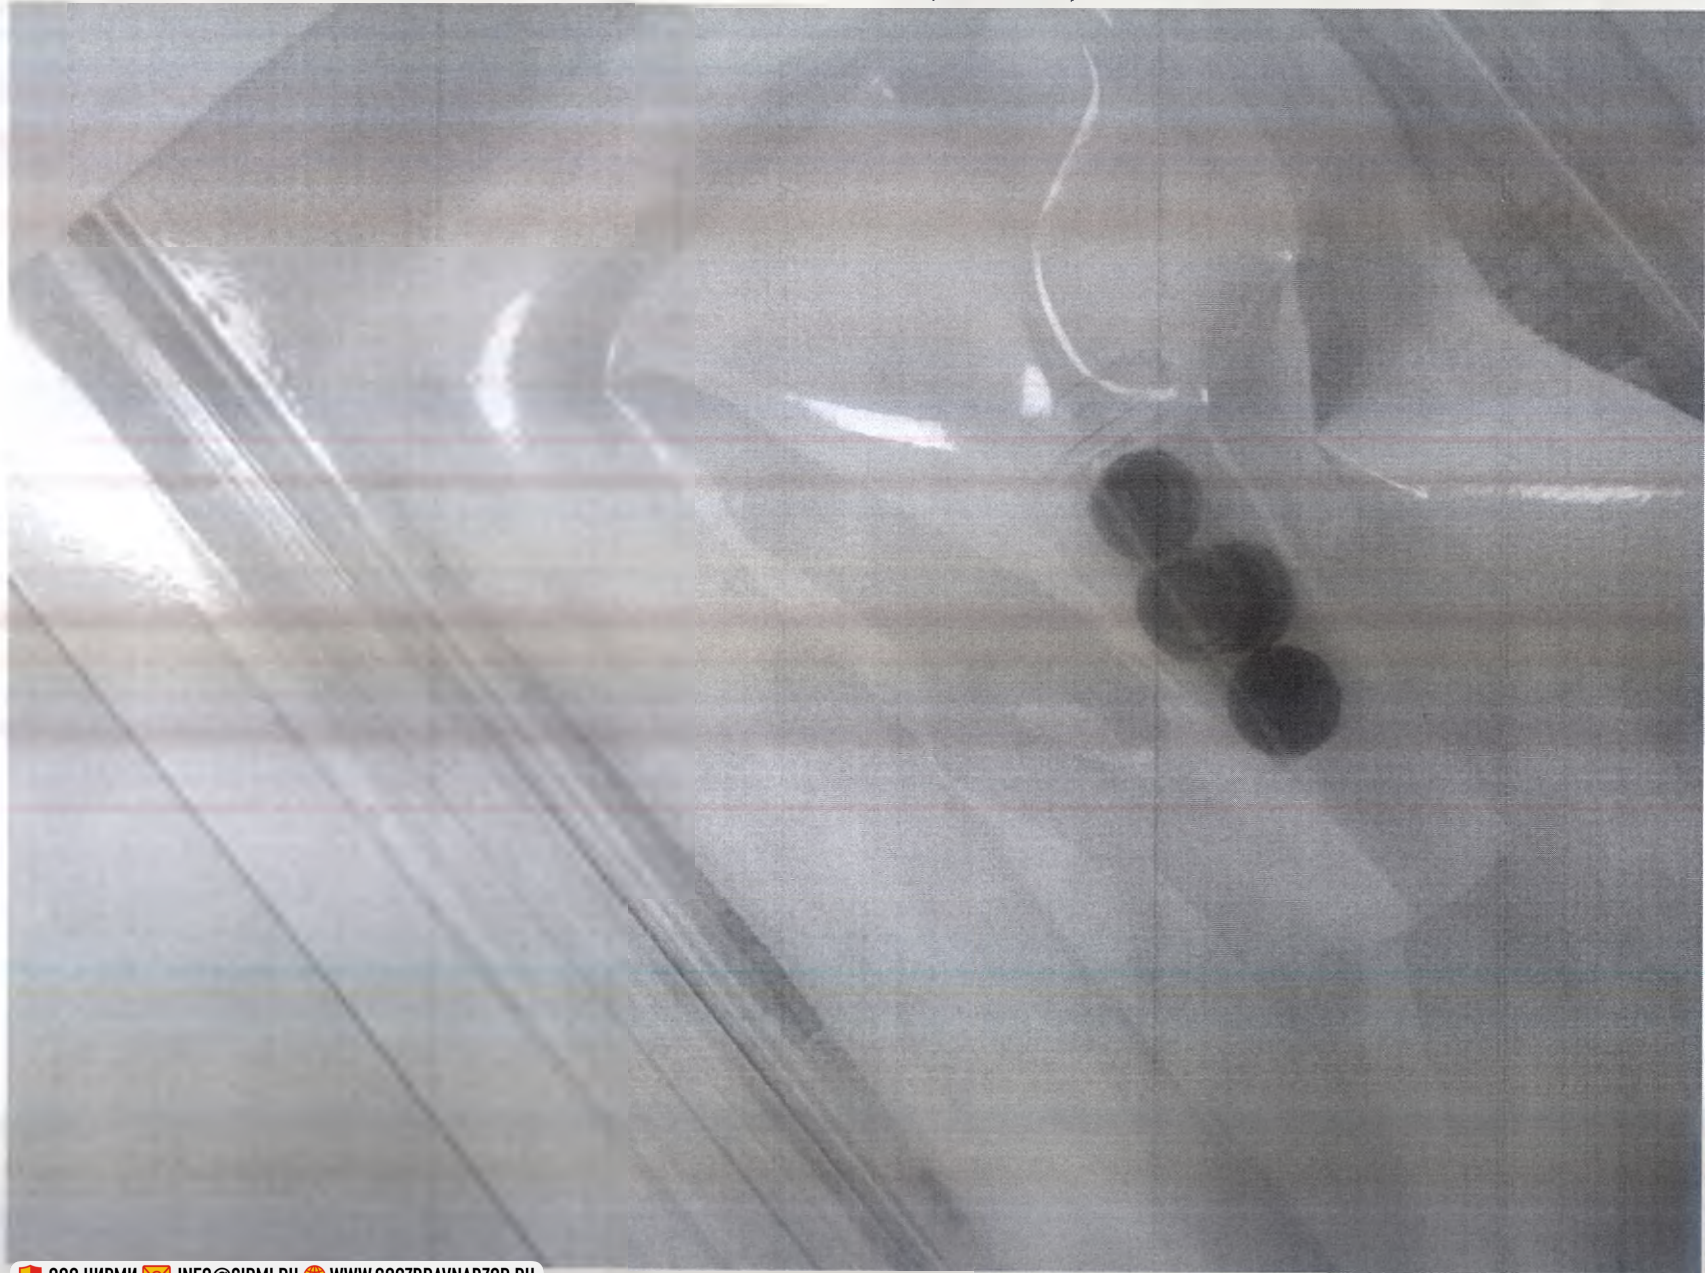

1.41 Колпачок протезный оранжевый LOCATOR, 4 шт. в упаковке (OPLA730)

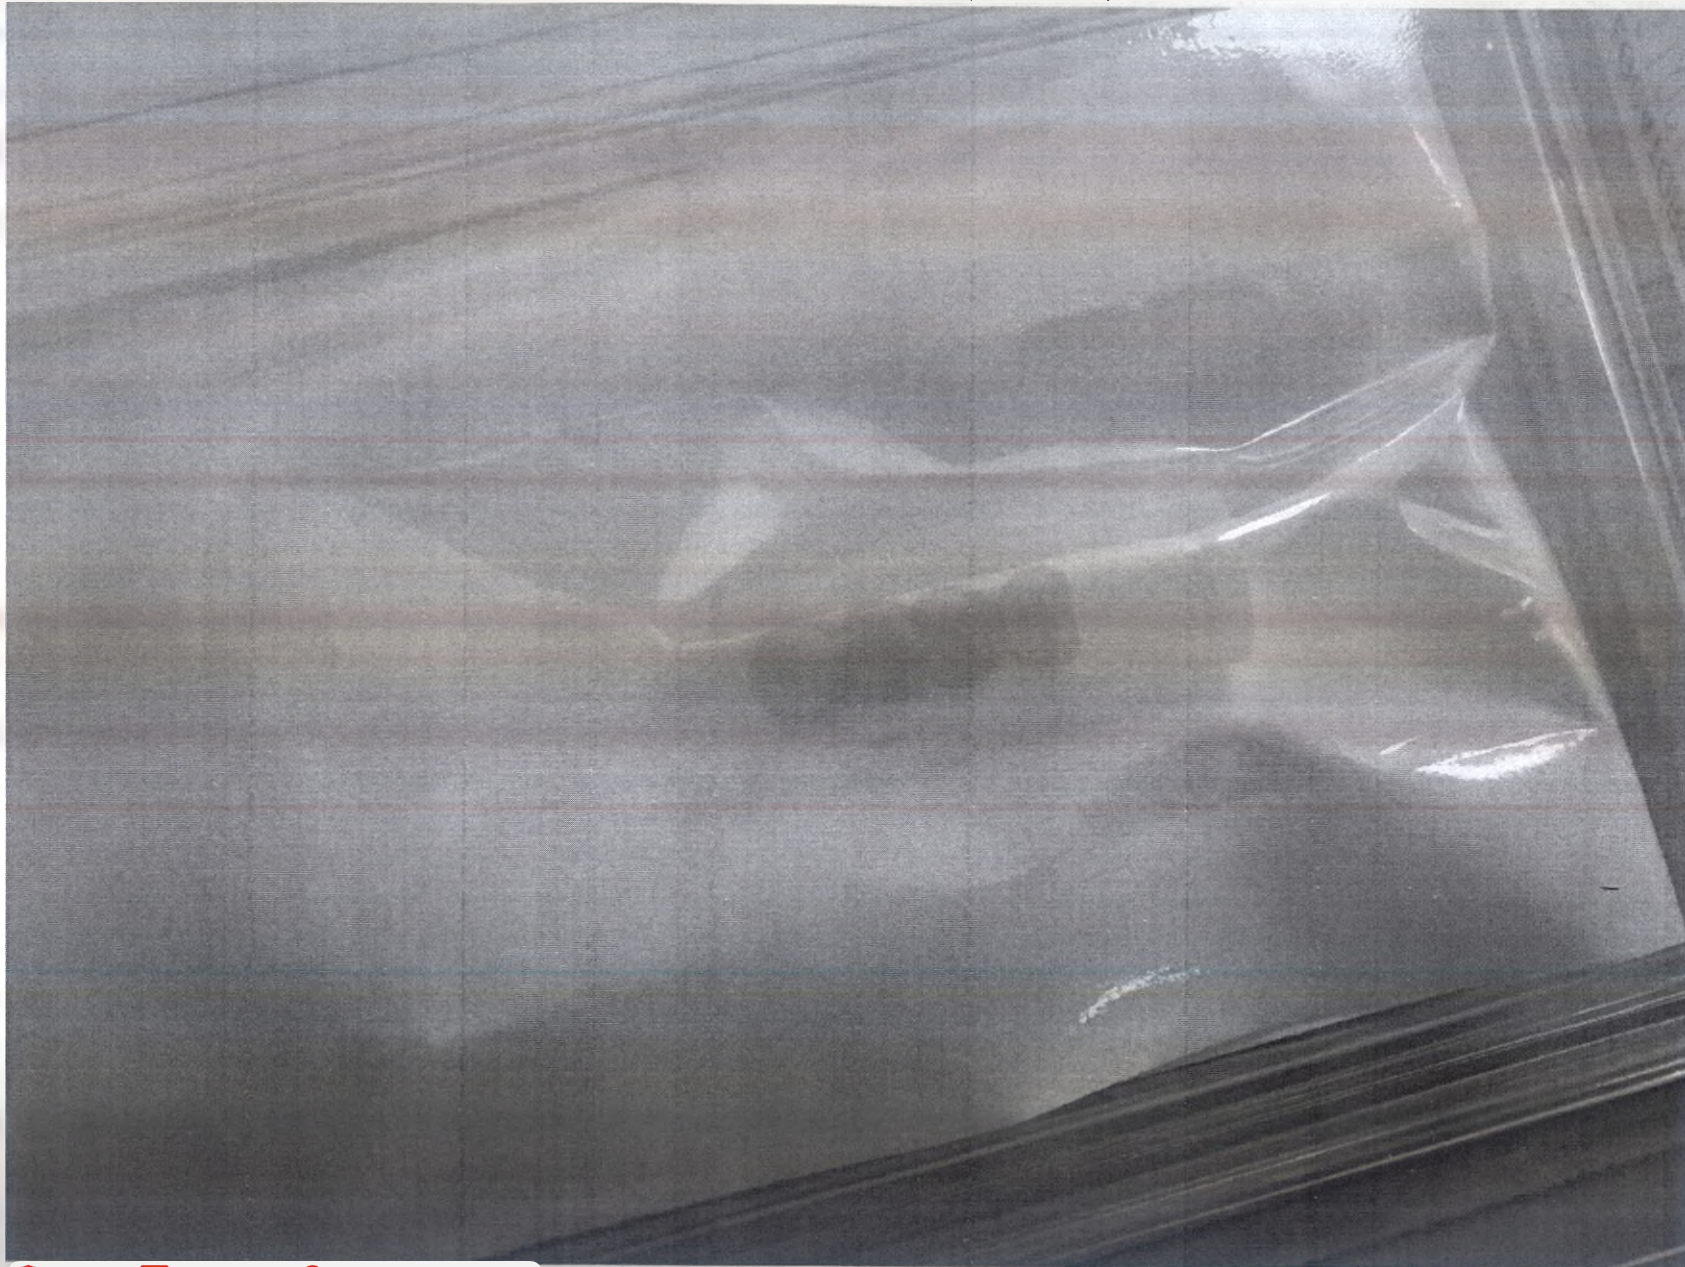

1.42 Колпачок протезный зеленый LOCATOR, 4 шт. в упаковке (OPLA740).

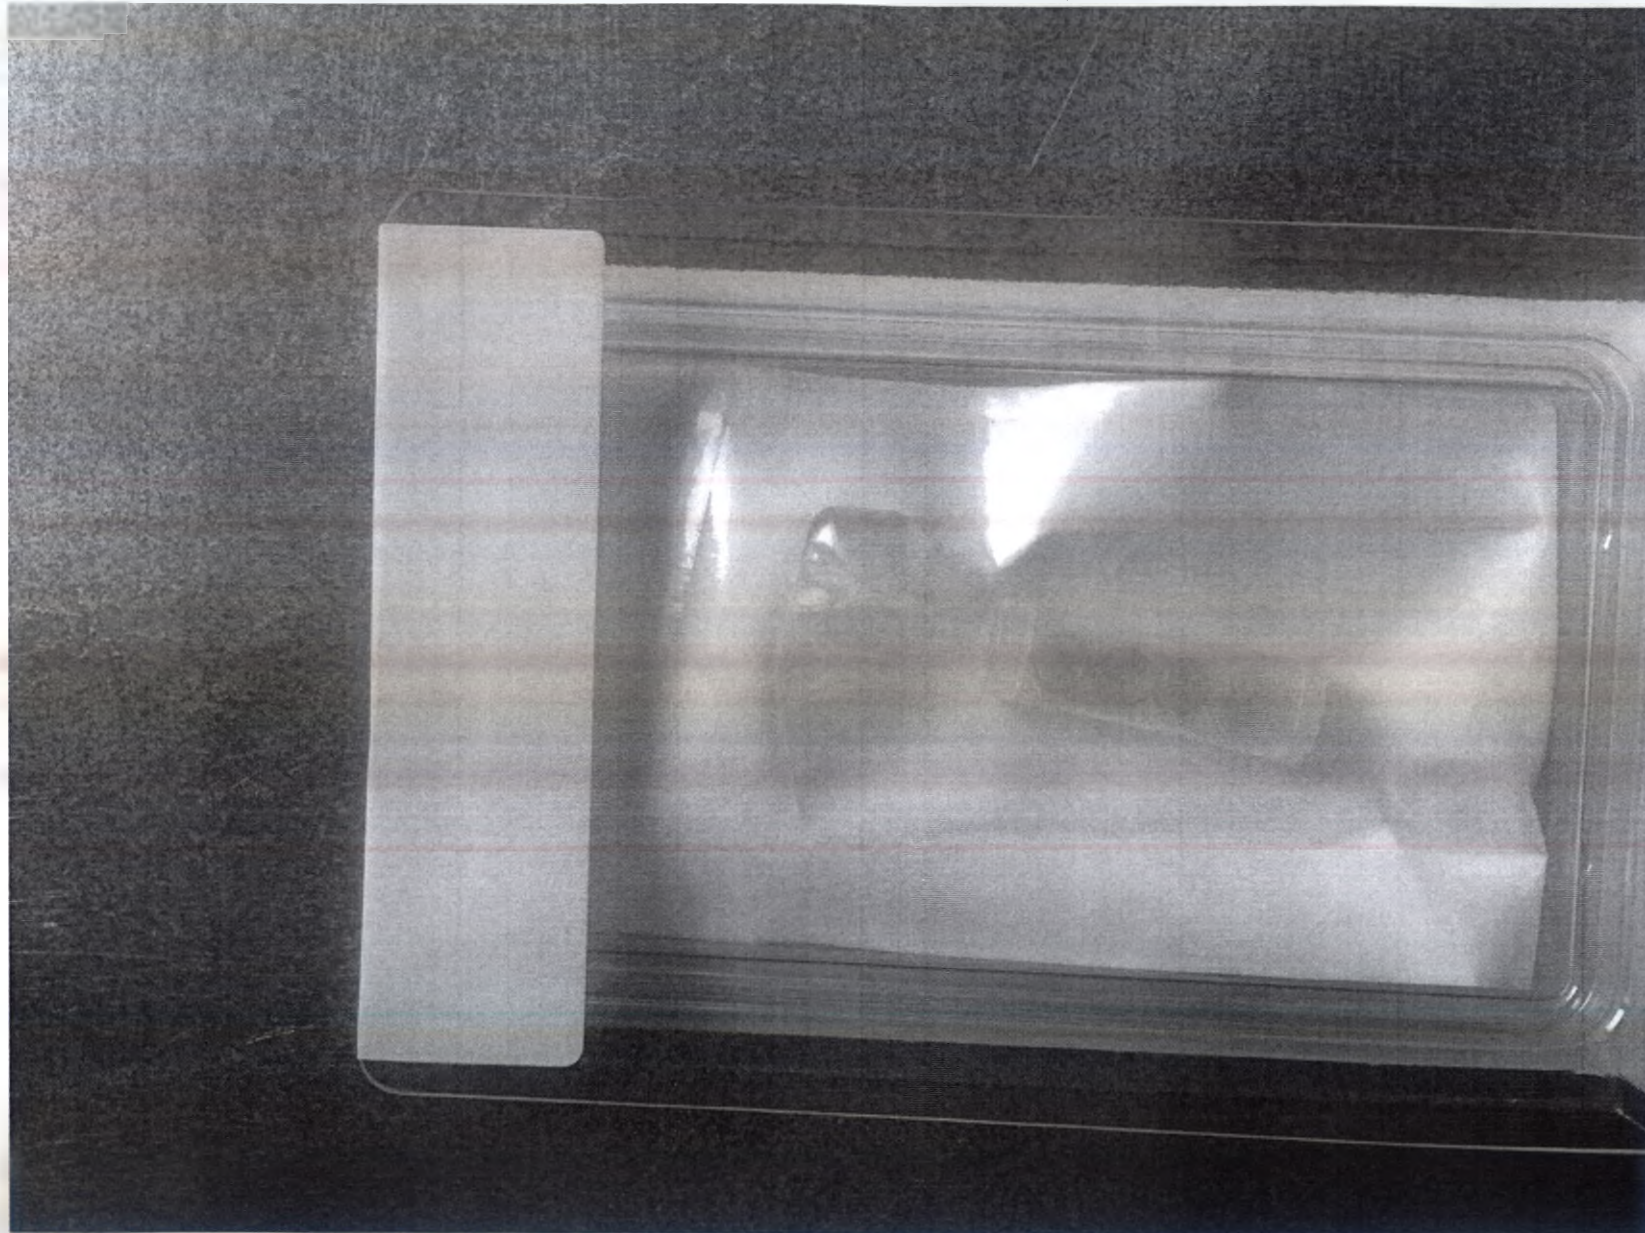

## 2. Колпачок титановый:

### 2.1. Колпачок титановый временный для абатментов MU Ø4.8, с винтом (MUC100)



2.2. Колпачок титановый временный для абатментов MU Ø4.0, с винтом (MUNC100)



- 2.3. Колпачок титановый защитный для абатментов MU Ø4.8, с винтом (MUCAP)
- 2.4. Колпачок титановый защитный для абатментов MU Ø4.8, с винтом, 4 шт. в упаковке (MUCAP-4)



2 Колпачок титановый для абатментов MU Ø4.0, с винтом (MUNPAC100)

**Anthogyr**

REF MUNPAC100

LOT 18-290450

axiom BL

**Anthogyr**

REF MUNPAC100

LOT 18-290450

axiom BL

**Anthogyr**

REF MUNPAC100

LOT 18-290450

axiom BL

REF MUNPAC100

Reference number

LOT 18-290450

Batch code



2018-11

Date of manufacture

CE  
0459

These MDs comply with the  
Community Directive 93/42/CEE



Not sterile



Sterilizable up  
to 135°C

043 141A-C



REF MUNPAC100



LOT 18-290450

axiom BL

**Anthogyr**

GTIN 03663394003148

3.Бор шаровидный (INFB20).

#### 4. Сверло:

4.1. Сверло ступенчатое короткое Ø2.0/2.4 (OPFE24S);



4 Сверло ступенчатое короткое Ø2.4/3.0 (OPFE30S);



#### 4.3. Сверло ступенчатое короткое Ø3.0/3.6 (OPFE36S);



4.4. Сверло ступенчатое короткое Ø3.6/4.2 (OPFE42S);



4.5. Сверло ступенчатое короткое Ø4.2/4.8 (OPFE48S);



4.6. Сверло ступенчатое длинное Ø2.0/2.4 (OPFE24L);



4.7. Сверло ступенчатое длинное Ø2.4/3.0 (OPFE30L);



4.8. Сверло ступенчатое длинное Ø3.0/3.6 (OPFE36L);



4.9. Сверло ступенчатое длинное Ø3.6/4.2 (OPFE42L);



4.10.Сверло ступенчатое длинное Ø4.2/4.8 (OPFE48L);



4.11. Сверло спиральное Ø2.6 x 25.0 (OPFE26250);



4.12. Сверло пилотное Ø2.0x 25.0 (OPFI20250);



4.13. Сверло стартовое длинное Ø2.0(OPFI20L);




4.14. Сверло стартовое короткое Ø2.0(OPFI20S);




4.15. Сверло остроконечное Ø1.5(OPPO15150);




4.16. Сверло центрирующее(OPFHD125);

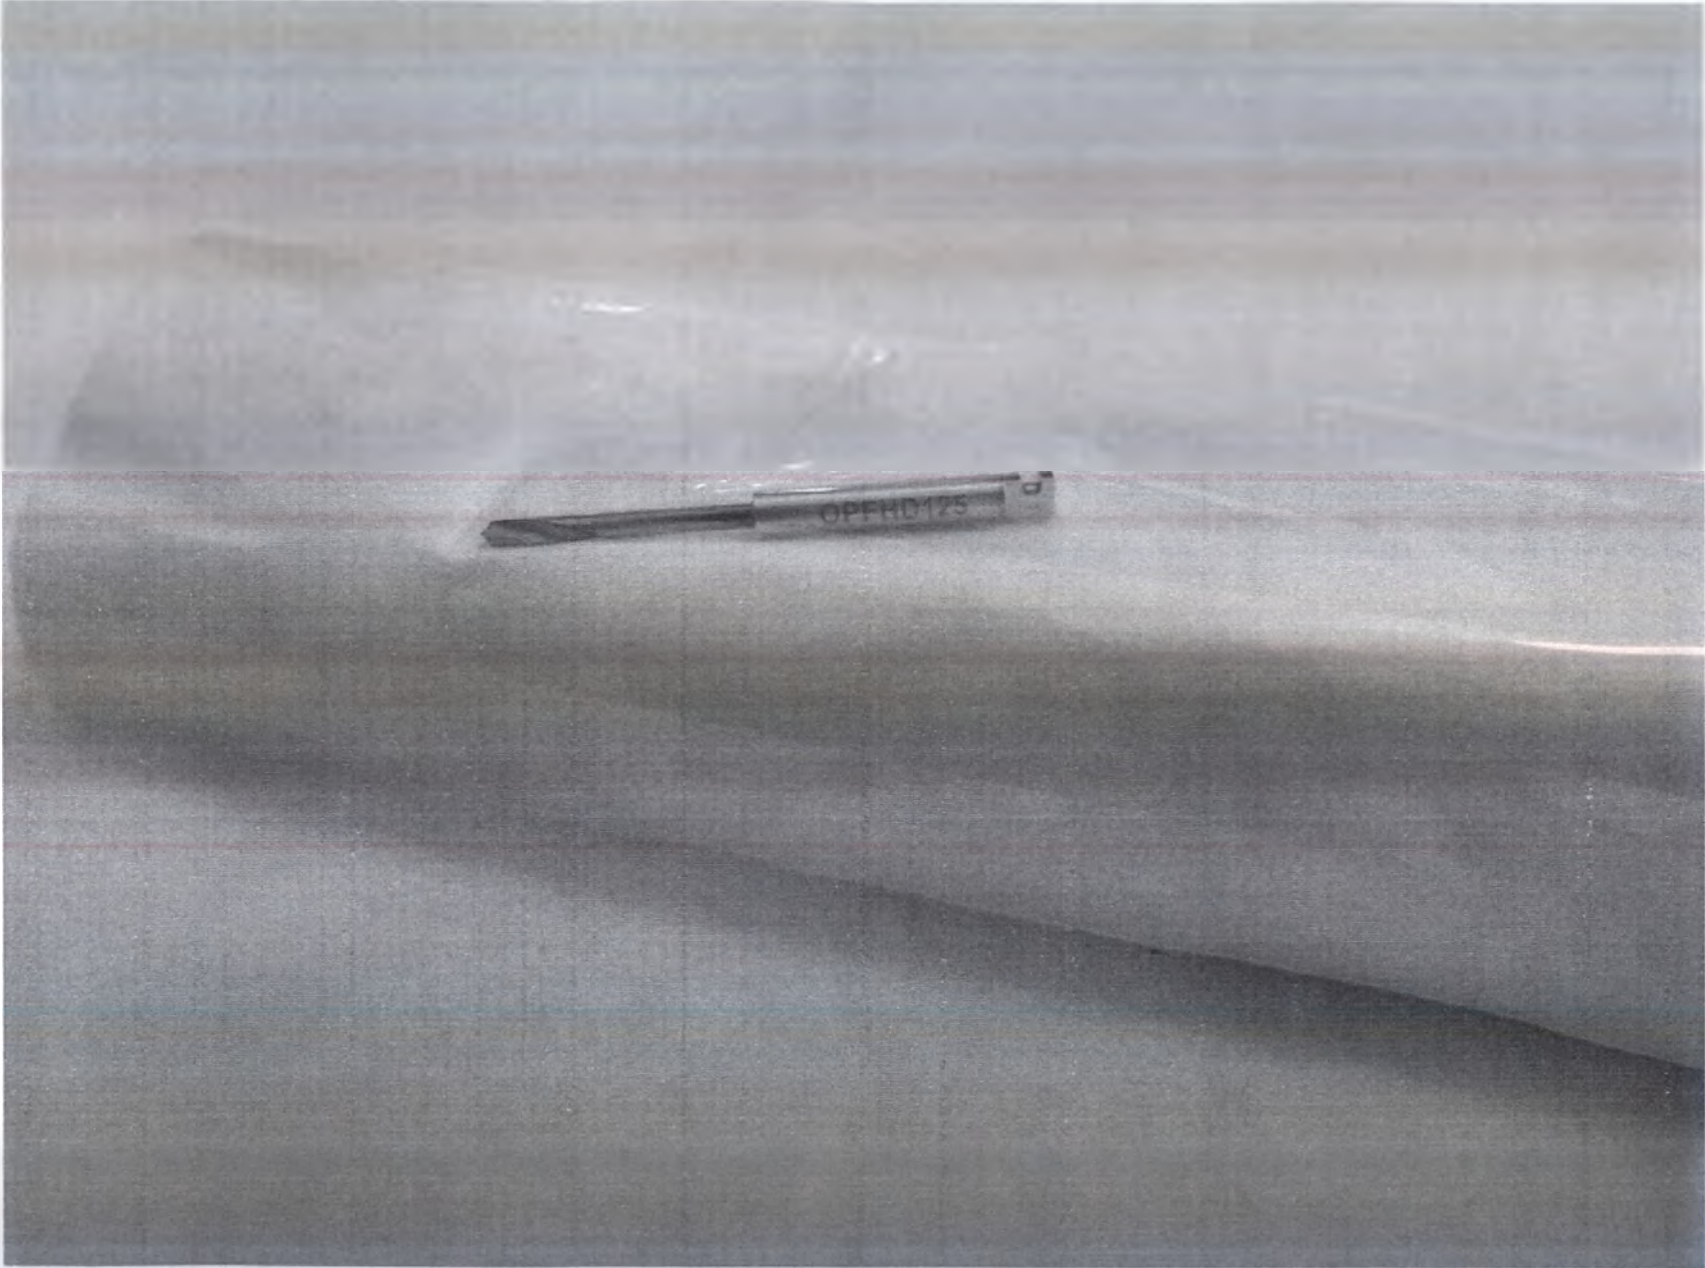

4.17. Сверло с левосторонней резьбой Ø1.25 (OPFHG125);

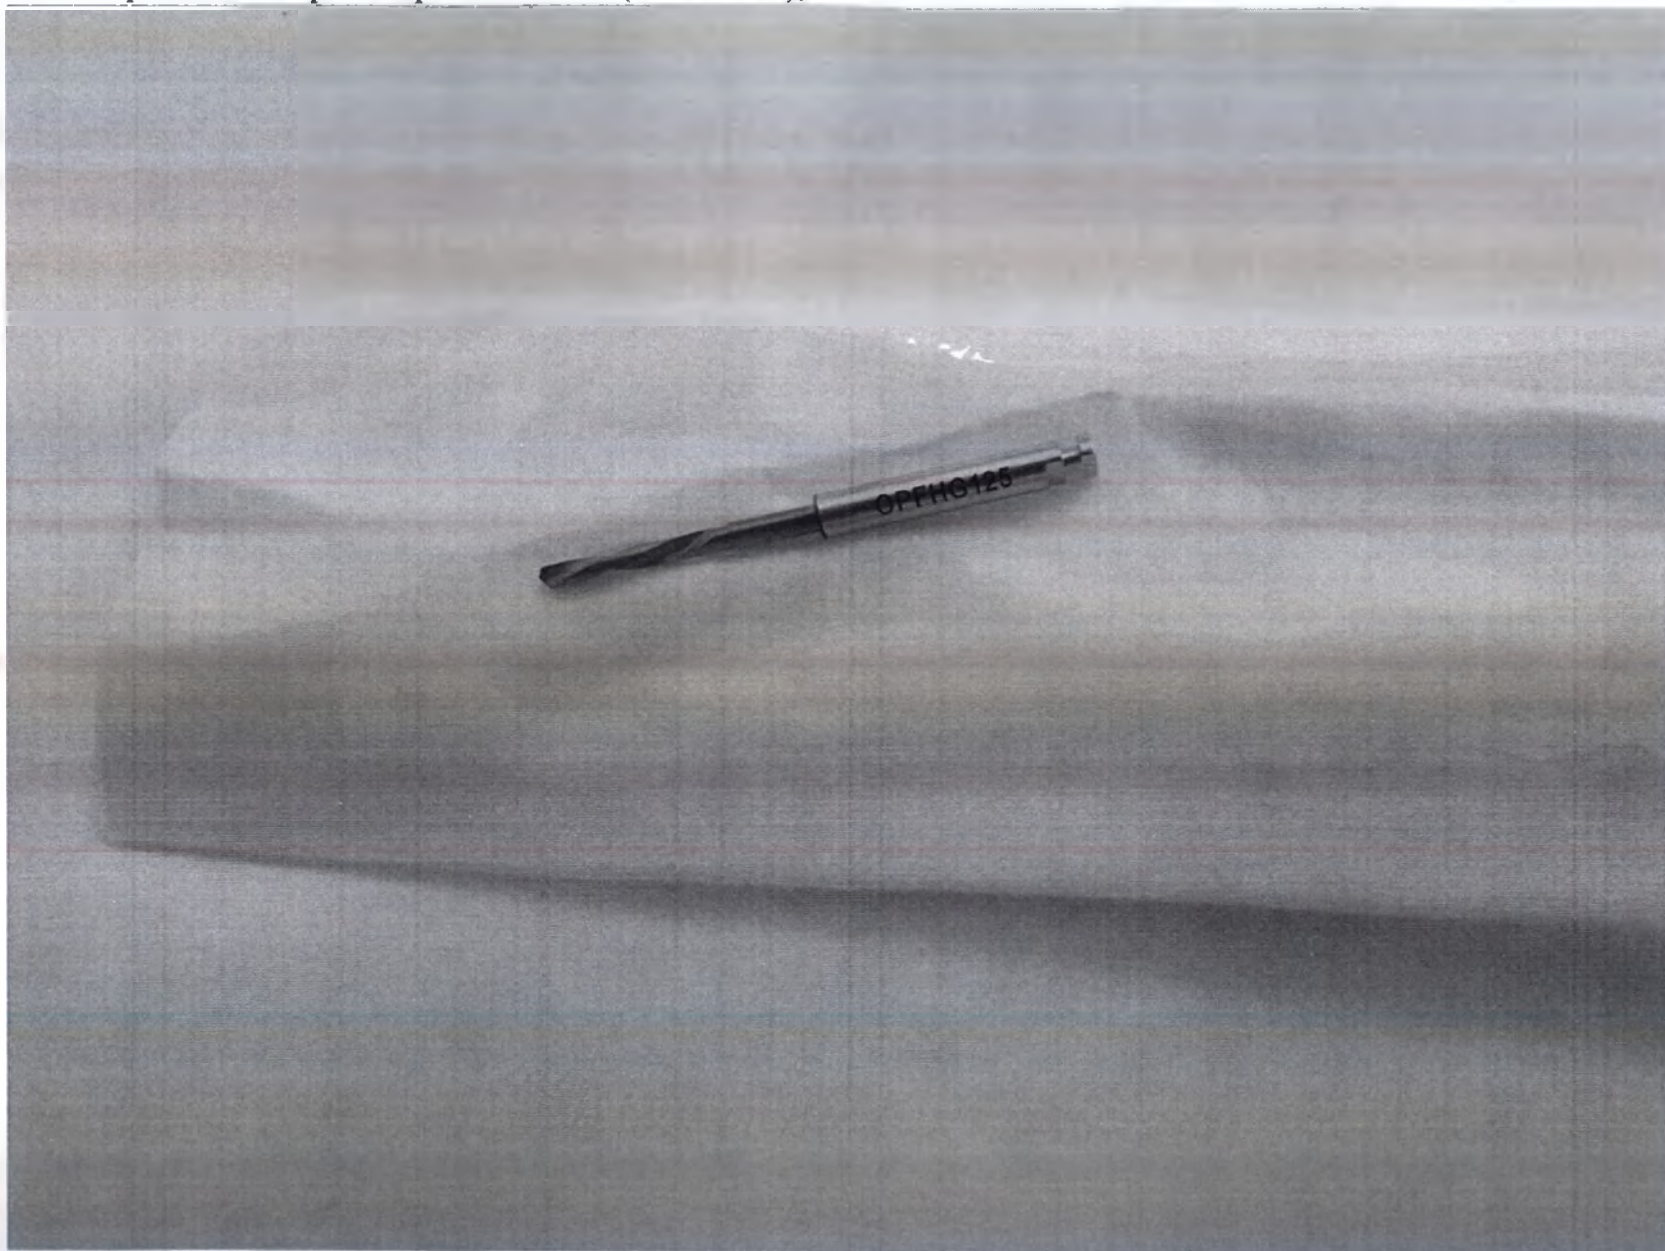

4.18. Сверло LINDEMANN Ø2 (OPR20).

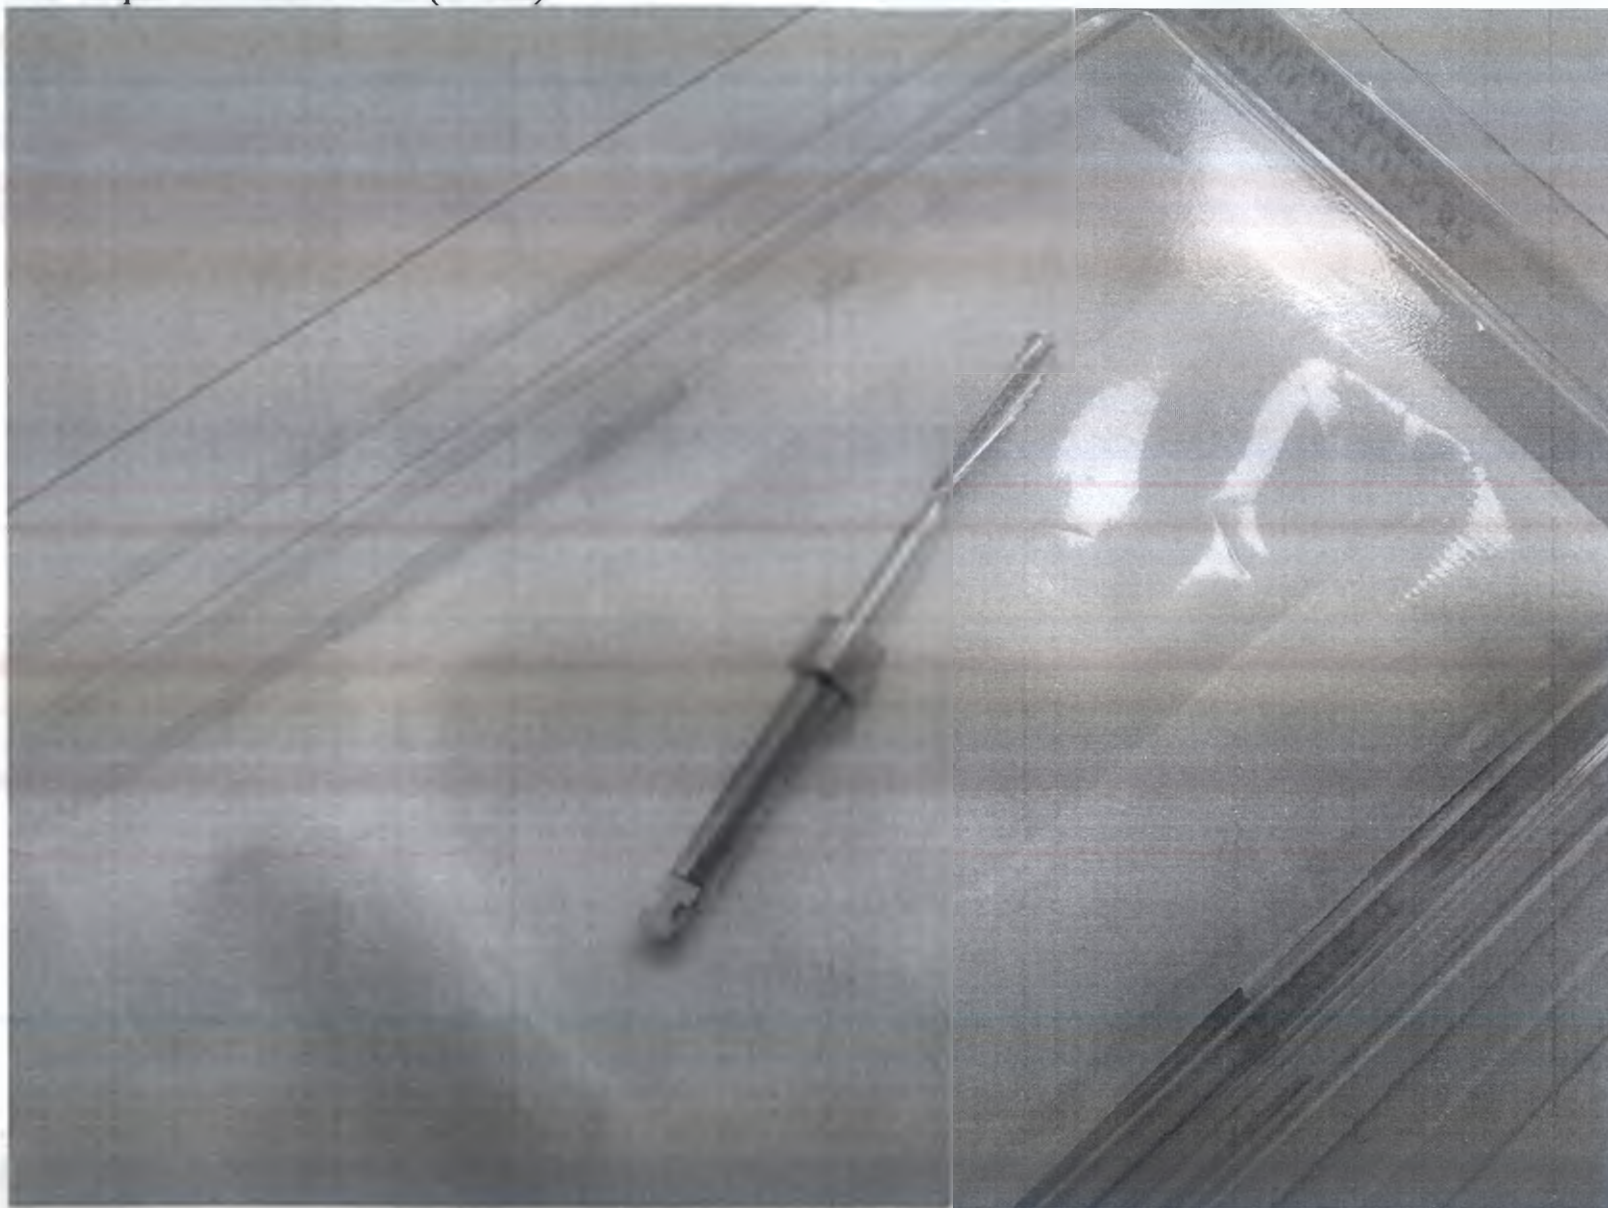

## 5.Метчик:

### 5.1. Метчик восстанавливающий (ОПТАВРМ2);



5.2. Метчик Ø2.8 x 25 (ОРТА28250)



5.3. Метчик длинный Ø3.4 (ОРТА34L)



5.4. Метчик длинный Ø4.0 (ОРТА40L)




5.5. Метчик длинный Ø4.6 (ОРТА46L)



5.6. Метчик длинный Ø5.2 (ОПТА52L)



5.7. Метчик для винта M1.6 x 0.35 (OPTAM16)

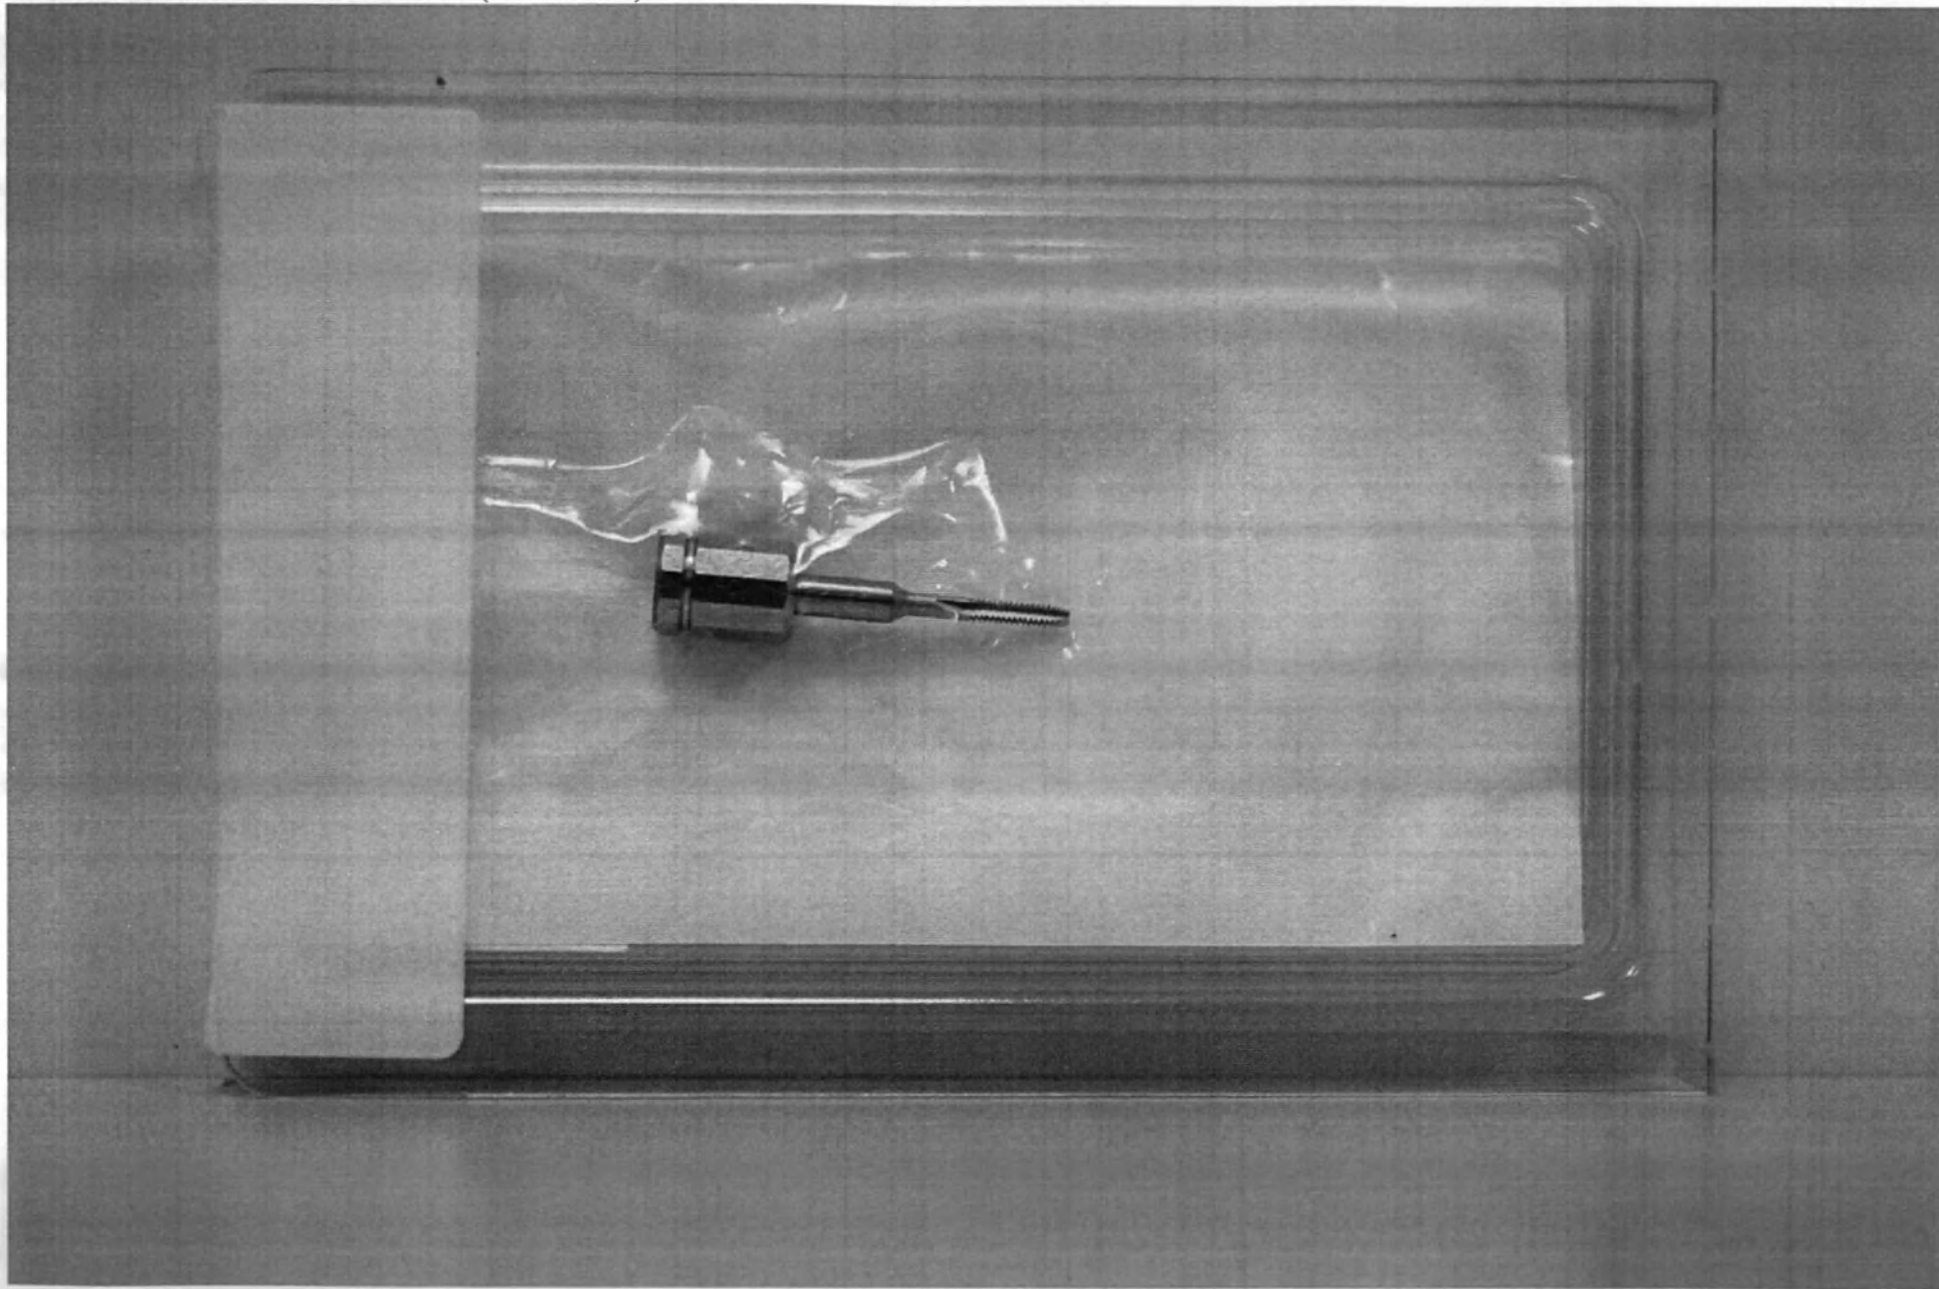

## 6.Ключ:


6.1. Ключ плоский 7мм (INCP070);



6.2. Ключ-переходник (INCPM);



- 6.3. Ключ для извлечения абатментов длинный (INEXPL);  
6.4. Ключ для извлечения абатментов короткий (INEXPS);

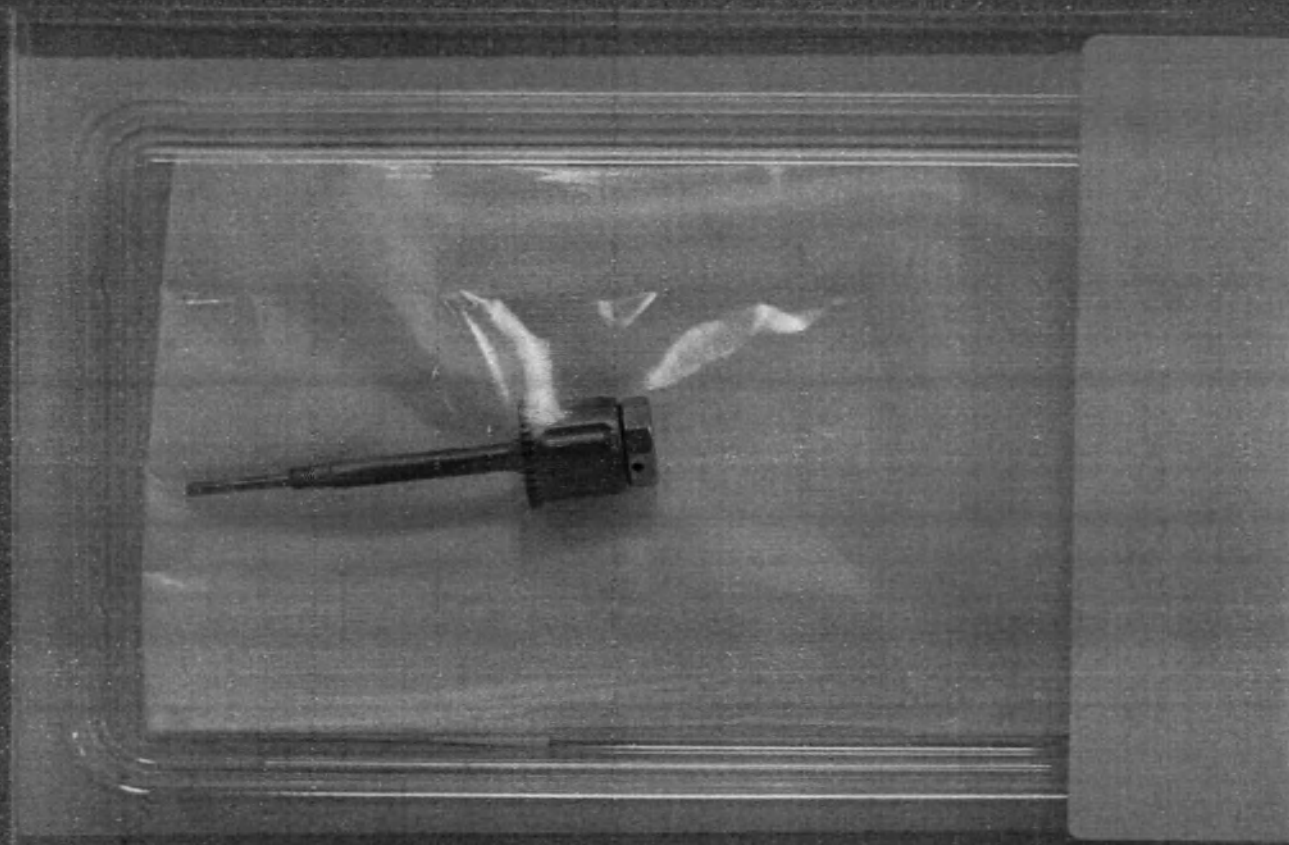


6.5. Ключ зажимной (ОРСФ100):



6.6. Ключ захватывающий (ОРОР028);



6.7. Ключ для углового наконечника для абатмента MU, короткий (MUWS);

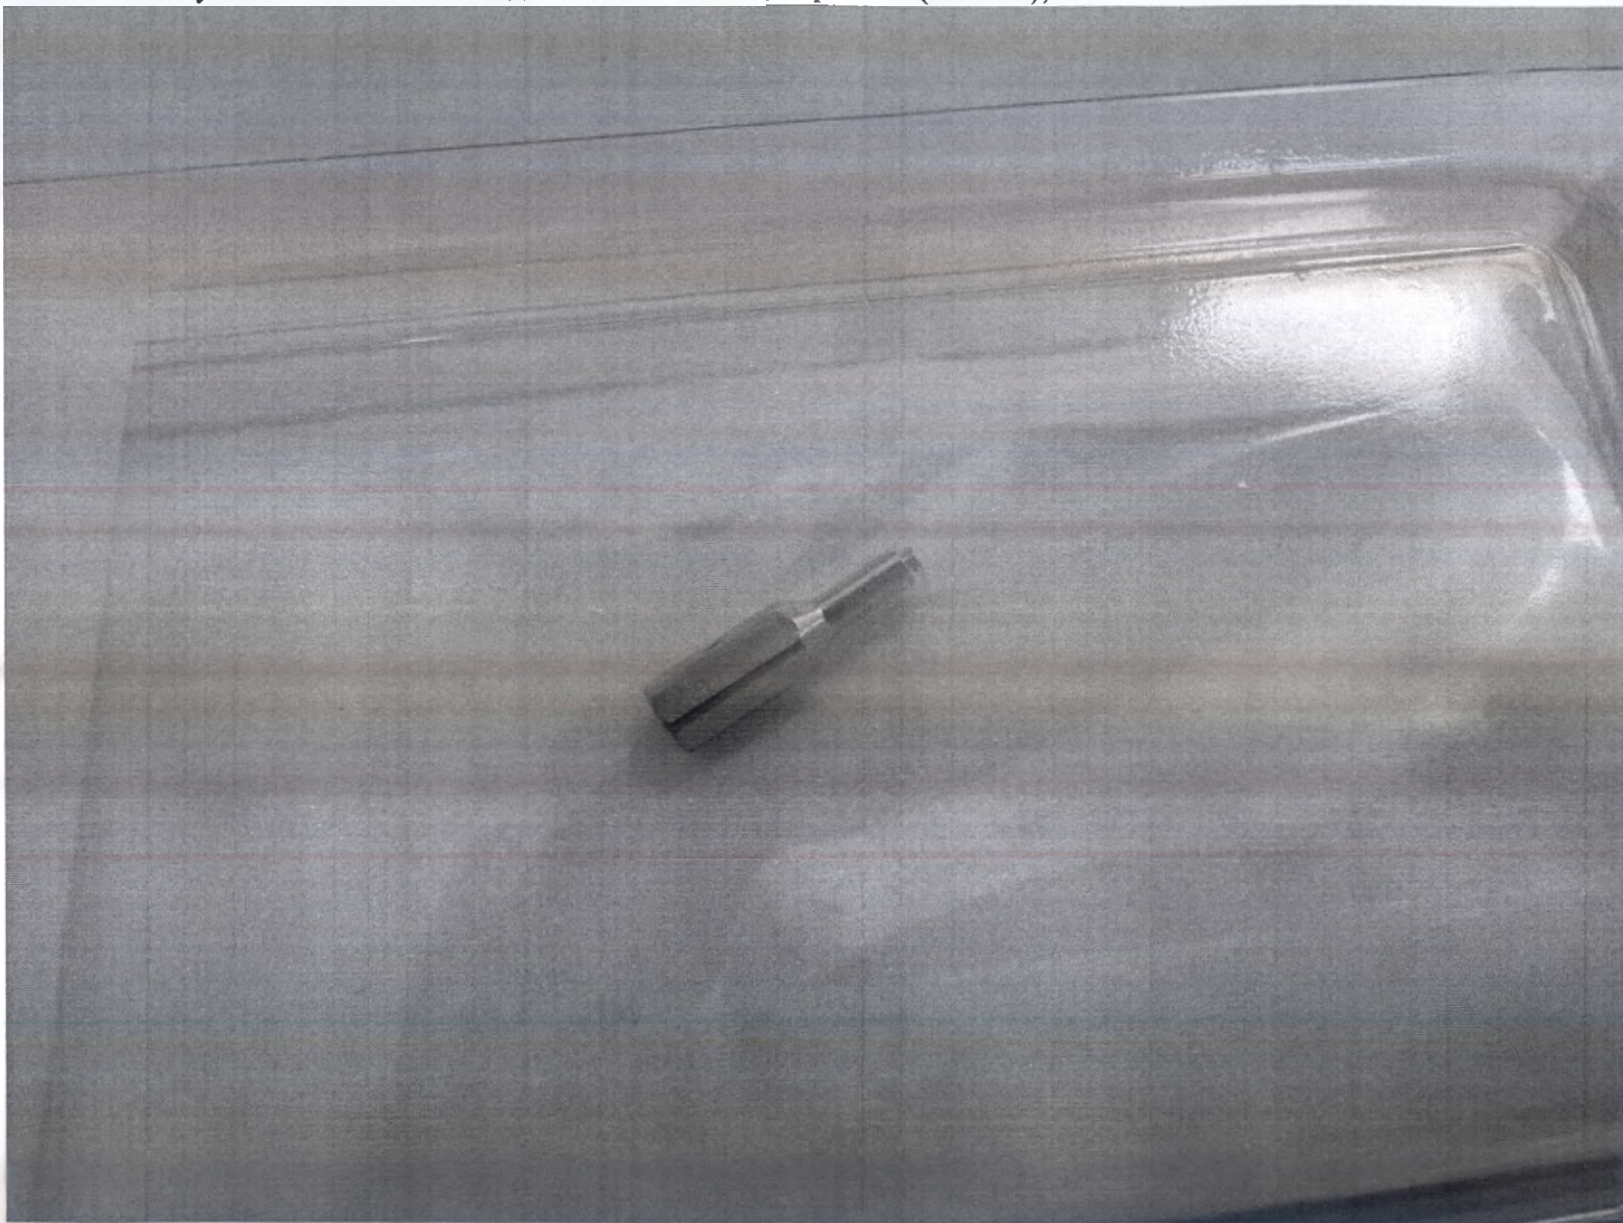


6.8. Ключ для прямых абатментов MU (MUW100);



6.9. Ключ LOCATOR 3 в 1 (OPCL3E1);




6.10. Ключ ручной хирургический (OPCS100);

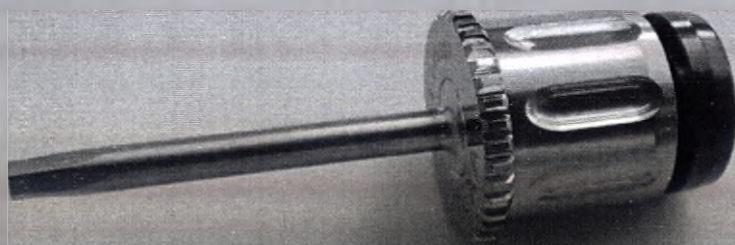

6.11. Ключ для установки имплантата AXIOM 2.8 (OPCV028);



6.12. Ключ для конического абатмента (ОРСР160);

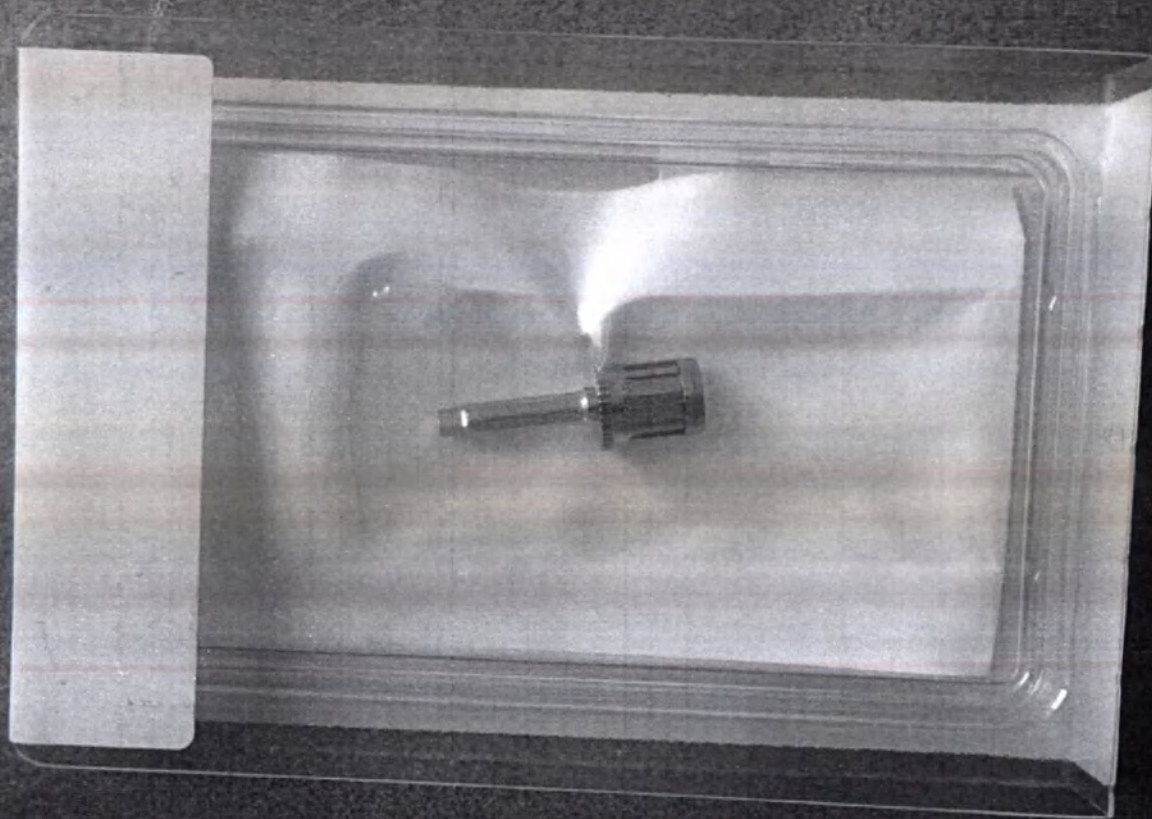

- 6.13. Ключ ручной короткий (OPCV060);
- 6.14. Ключ ручной средний (OPCV110);
- 6.15. Ключ ручной длинный (OPCV160).



6.16. Ключ удерживающий (INCMA)



## 7. Мандрель:

7.1. Мандрель для извлечения винта, длинная (INMDL);



7.2. Мандрель для извлечения винта, короткая (INMDS);



- 7.3. Мандрель шестигранная короткая (INMHECV);
- 7.4. Мандрель шестигранная длинная (INMHELV);
- 7.5. Мандрель шестигранная экстра-длинная (INMHEXLV);



- 7.6. Мандрель для установки имплантата, короткая (OPMV180);
- 7.7. Мандрель для установки имплантата, средняя (OPMV215)
- 7.8. Мандрель для установки имплантата, длинная (OPMV250);



7.9. Мандрель для абатментов MU (MUM100);

7.10. Мандрель для абатментов MU, длинная (MUM100L);



7.13. Мандрель для установки имплантата AXIOM 2.8 (OPMV028)



**8. Держатель инструмента:**

8.1 Держатель инструмента, средний: (INPIL);

8.2 Держатель инструмента, длинный: (INPIM).



## 9. Глубиномер:


9.1. Глубиномер Ø2.0 (OPJD020);



9.2. Глубиномер Ø2.4 (OPJD024);



9.3. Глубиномер Ø2.6 (OPJD026);

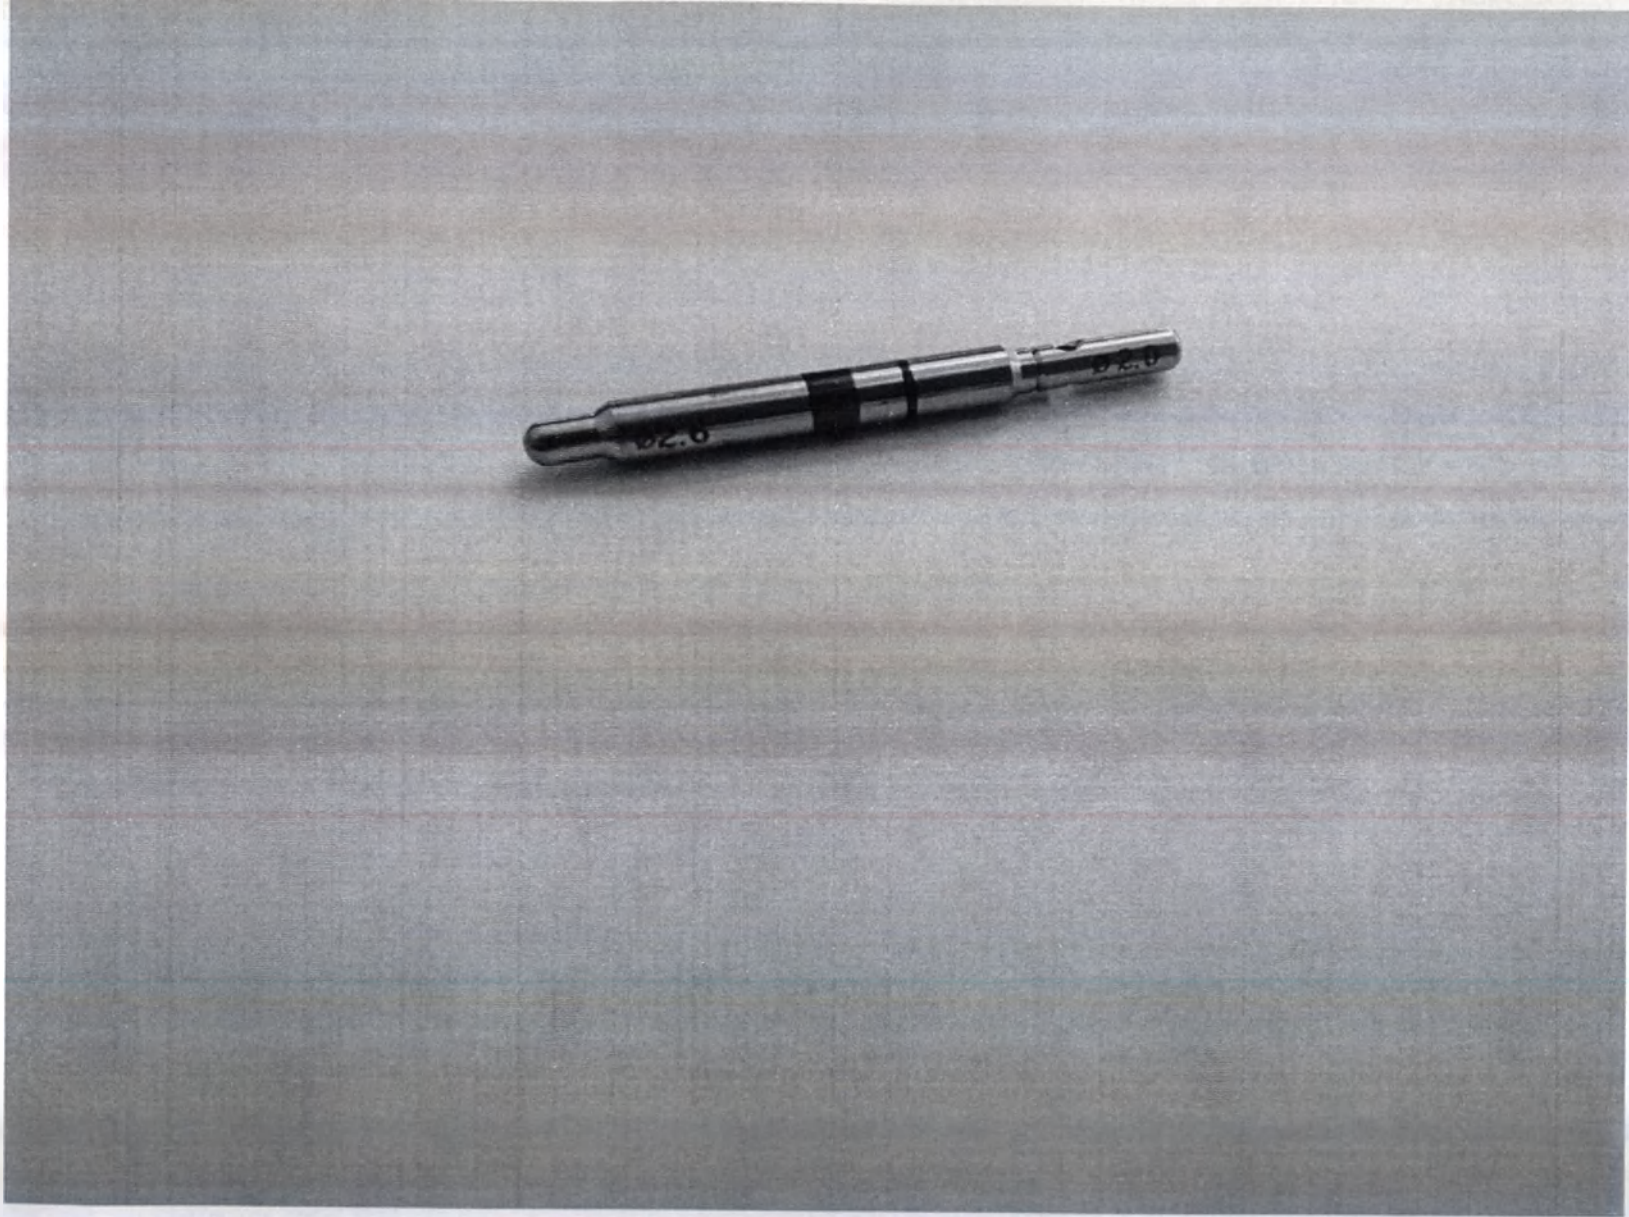

9.4. Глубиномер Ø3.0 (OPJD030);



9.5. Глубиномер Ø3.6 (OPJD036);



9.6. Глубиномер Ø4.2 (OPJD042);




9.7. Глубиномер Ø4.8 (OPJD048);



9.8. Глубиномер для имплантата 2.8 (OPJD028)



9.9. Глубиномер (ОРЈС001)

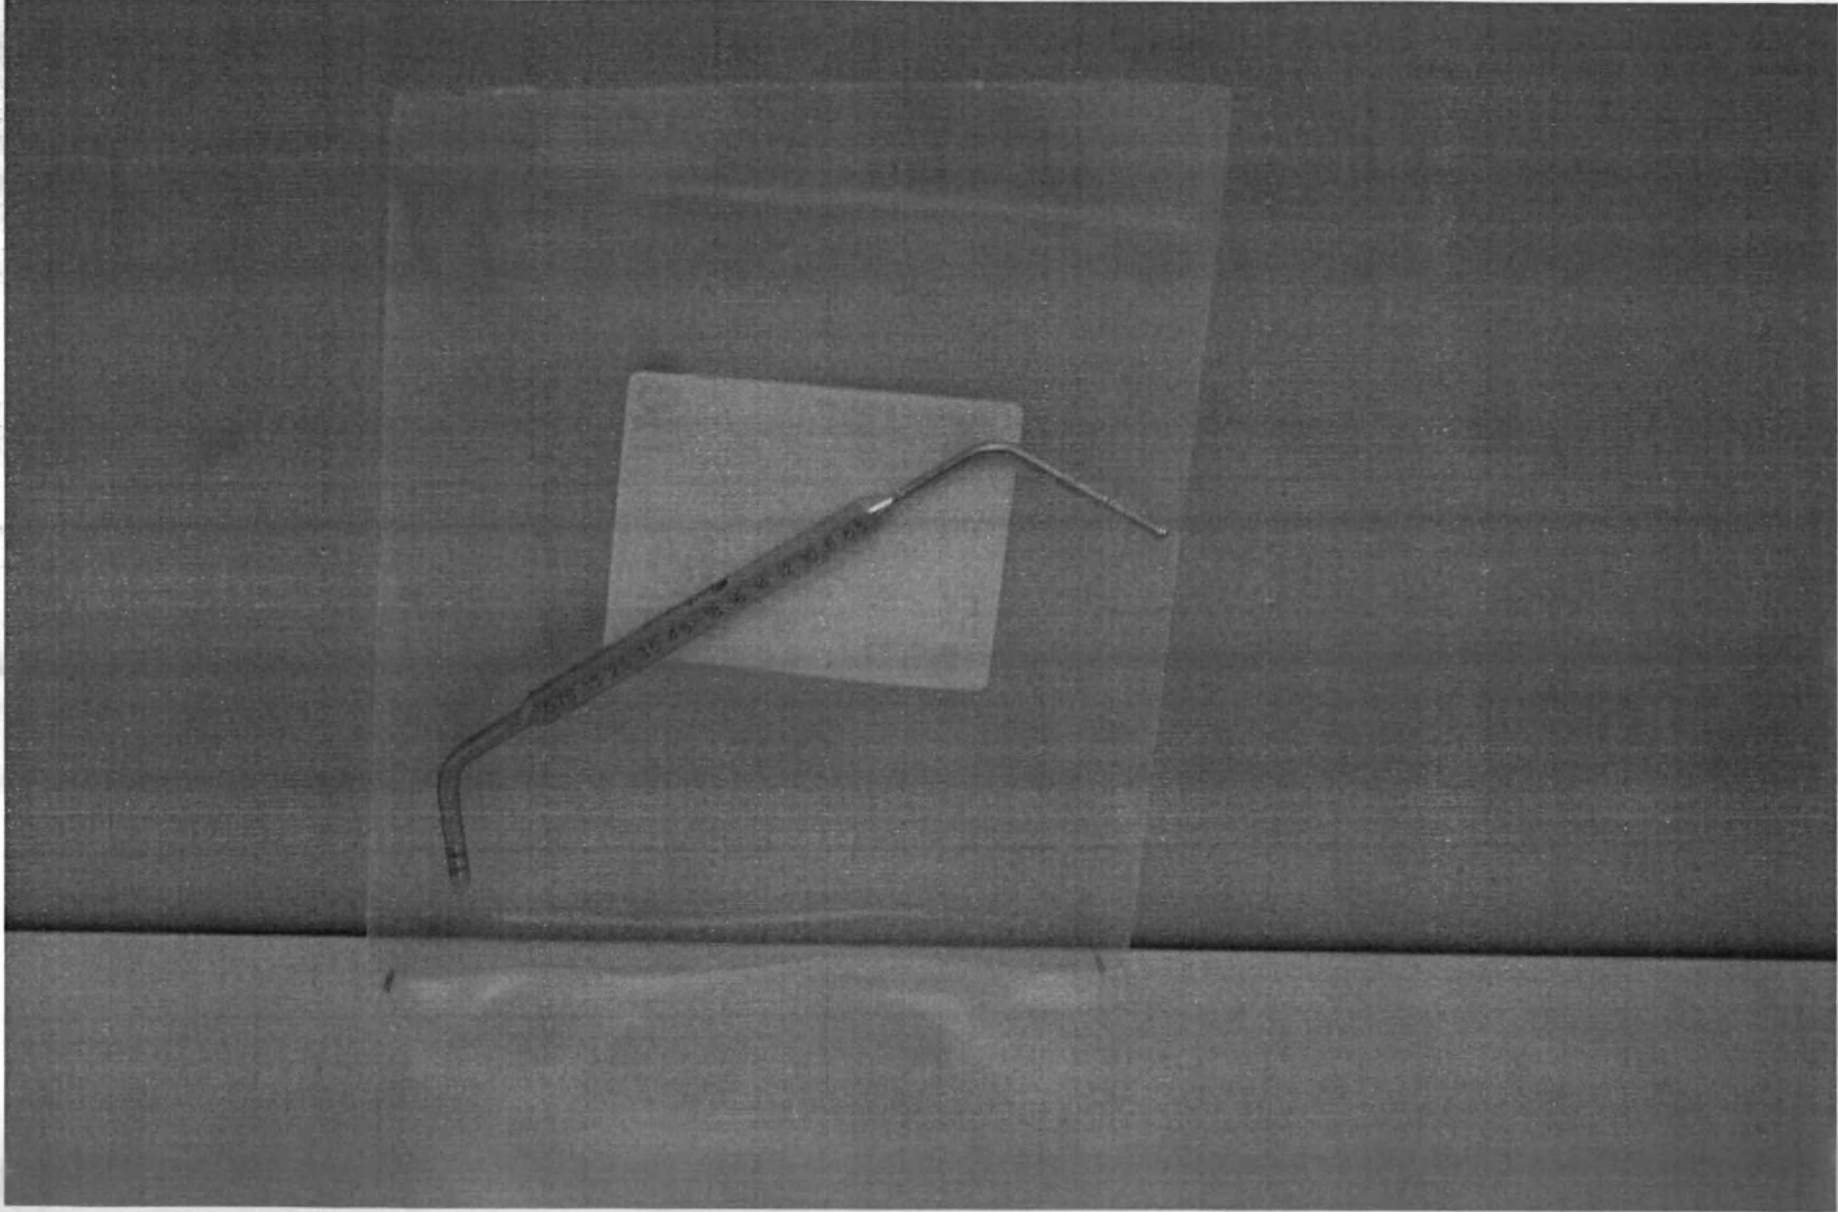

**10. Ключ динамометрический:**  
**10.1. Ключ динамометрический (INCC)**



10.2. Ключ динамометрический (INCCD)



10.3. Ключ динамометрический хирургический (INCCDC)



10.4. Ключ динамометрический универсальный (15501) в составе: ключ динамометрический универсальный; наконечник распылителя



**11. Контролер параллельности:**  
**11.1. Контроллер параллельности (INGPPA)**



1.2. Контроллер параллельности наклона сверла (INGFA)



### 11.3. Контроллер параллельности AXIOM REG/PX (OPGU125)



## 12.Отвертка:

12.1.Отвертка шестигранная короткая (INCHECV);

12.2.Отвертка шестигранная длинная (INCHELV);


12.3.Отвертка шестигранная экстра-длинная (INCHEXLV);




#### 12.4.Отвертка хирургическая ручная (OPCS100);




12.5.Отвертка для LOCATOR короткая (OPCL150);

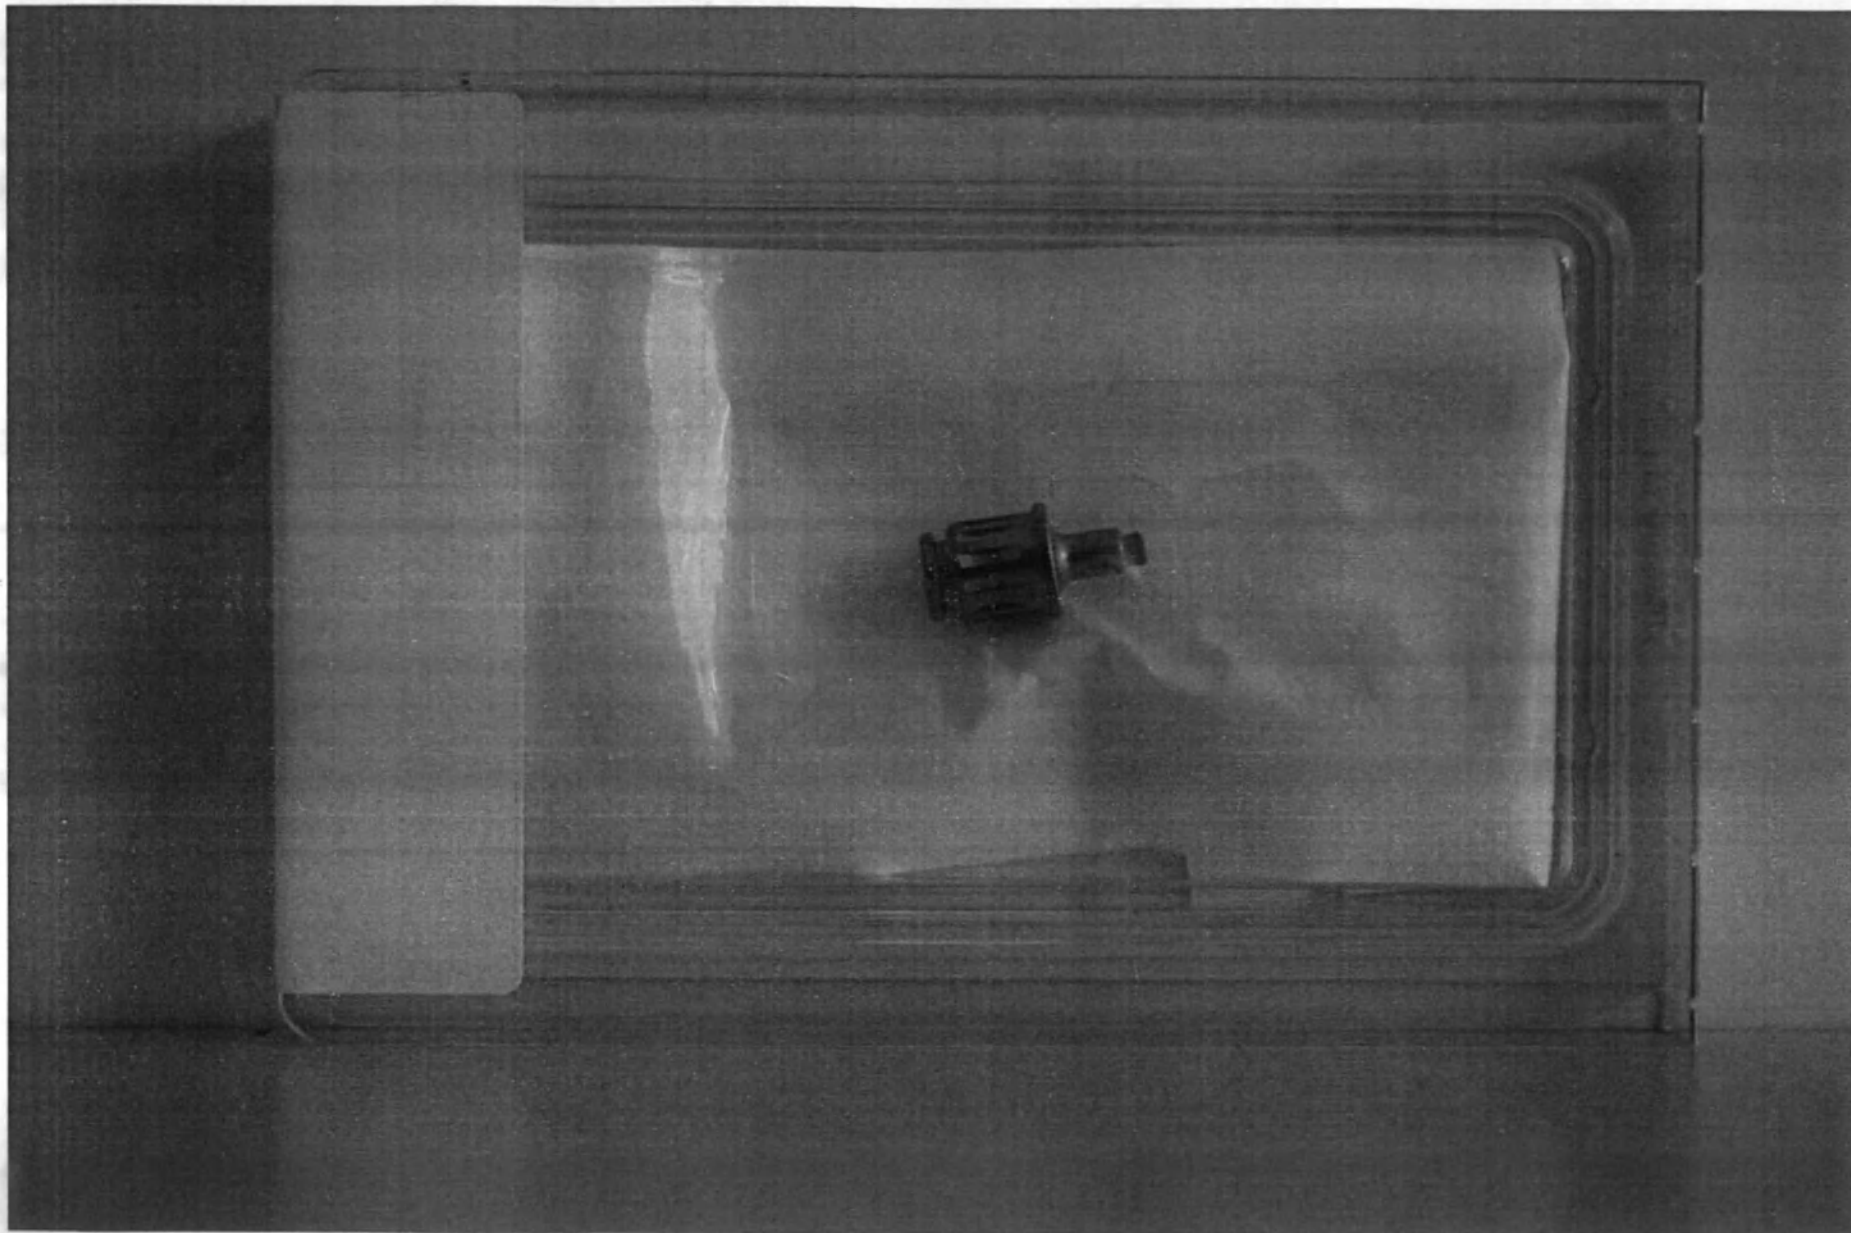

12.6.Отвертка для извлечения винта М А.6 (OPFBR16);

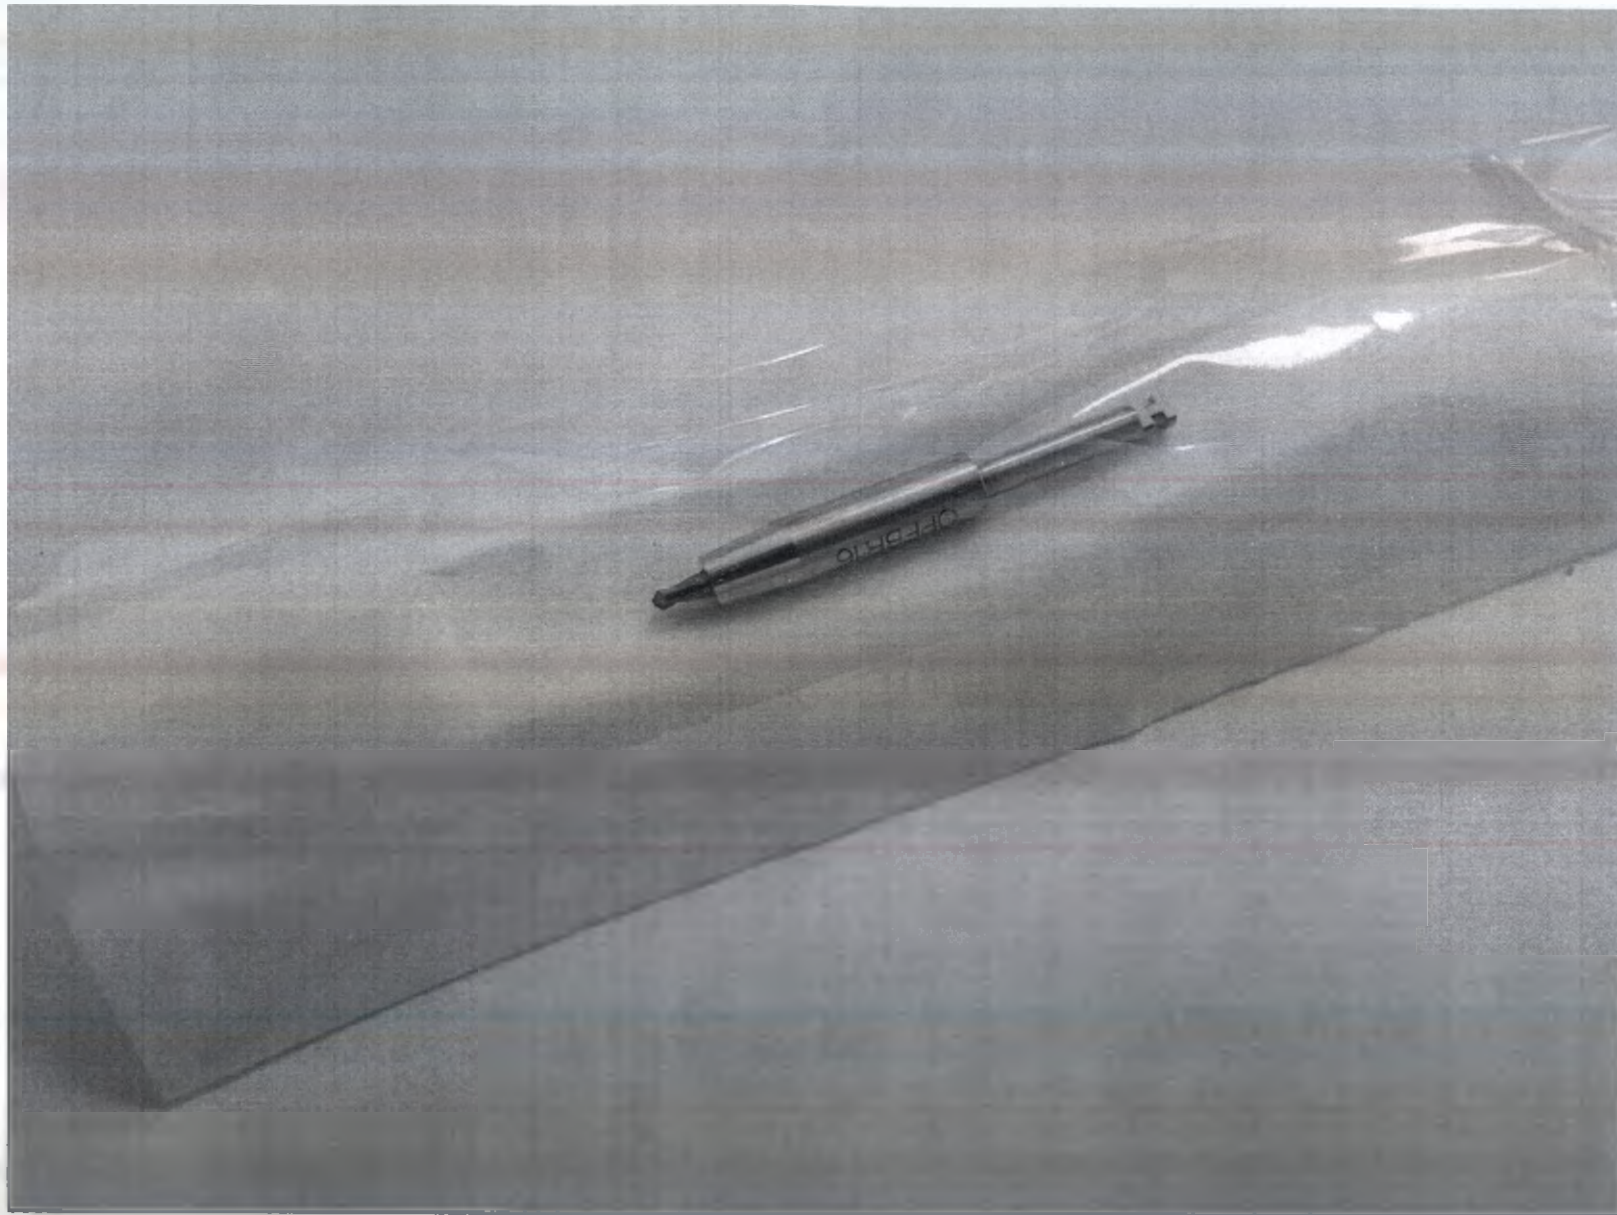

12.7.Отвертка для извлечения винта М 1.6 (ОРЕХТ125);

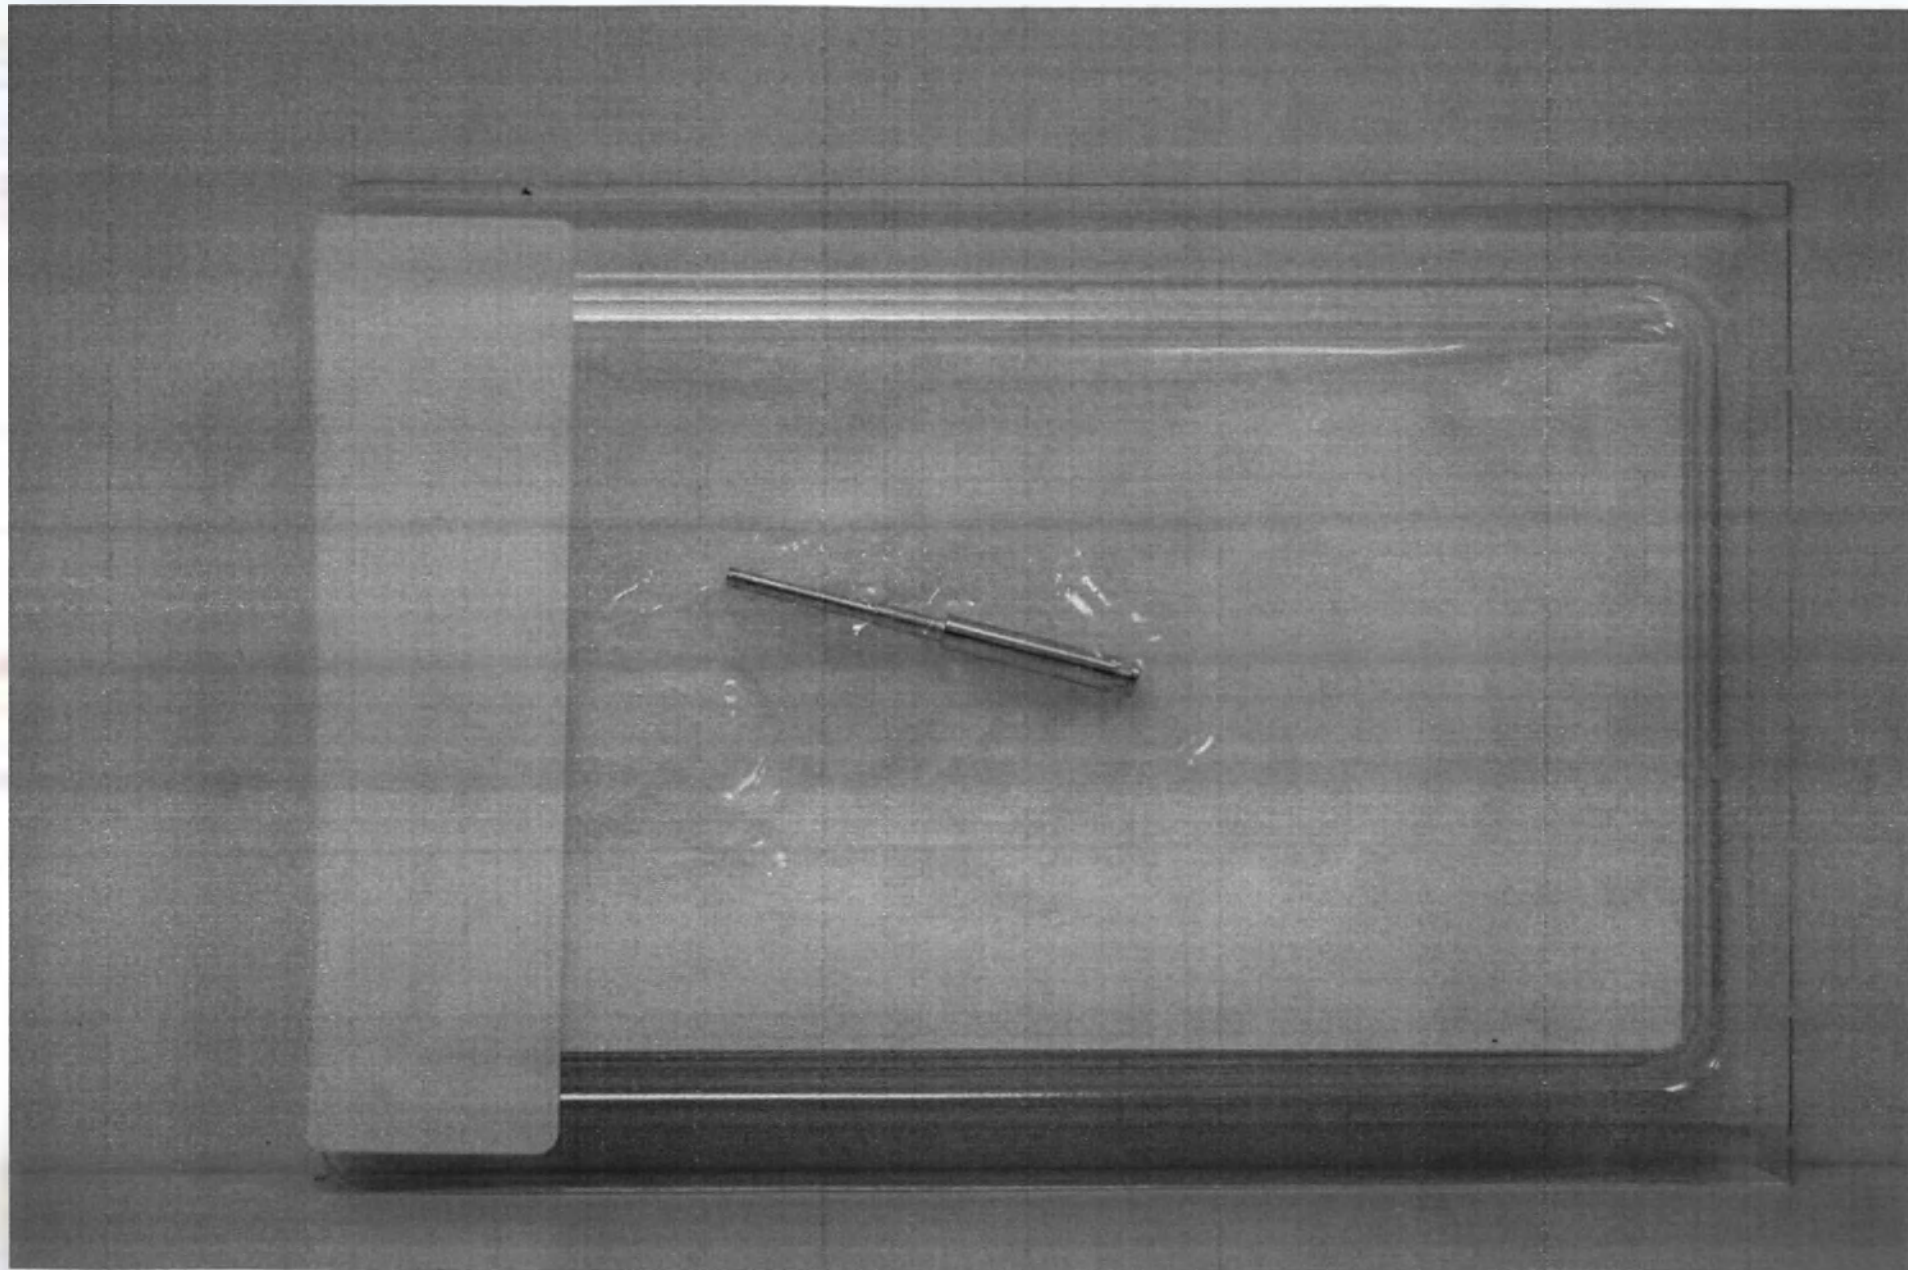

12.8.Отвертка SA (SATOOL-01).




13. Ловушка костных остатков Aspero, в составе: ловушка, 3 фильтра, адаптер (12010)



**14. Фильтр костных остатков:**

14.1. Фильтр костных остатков, одноразовый, 6 шт. в упаковке (12006);

14.1. Фильтр костных остатков, одноразовый, 12 штук в упаковке (12012)

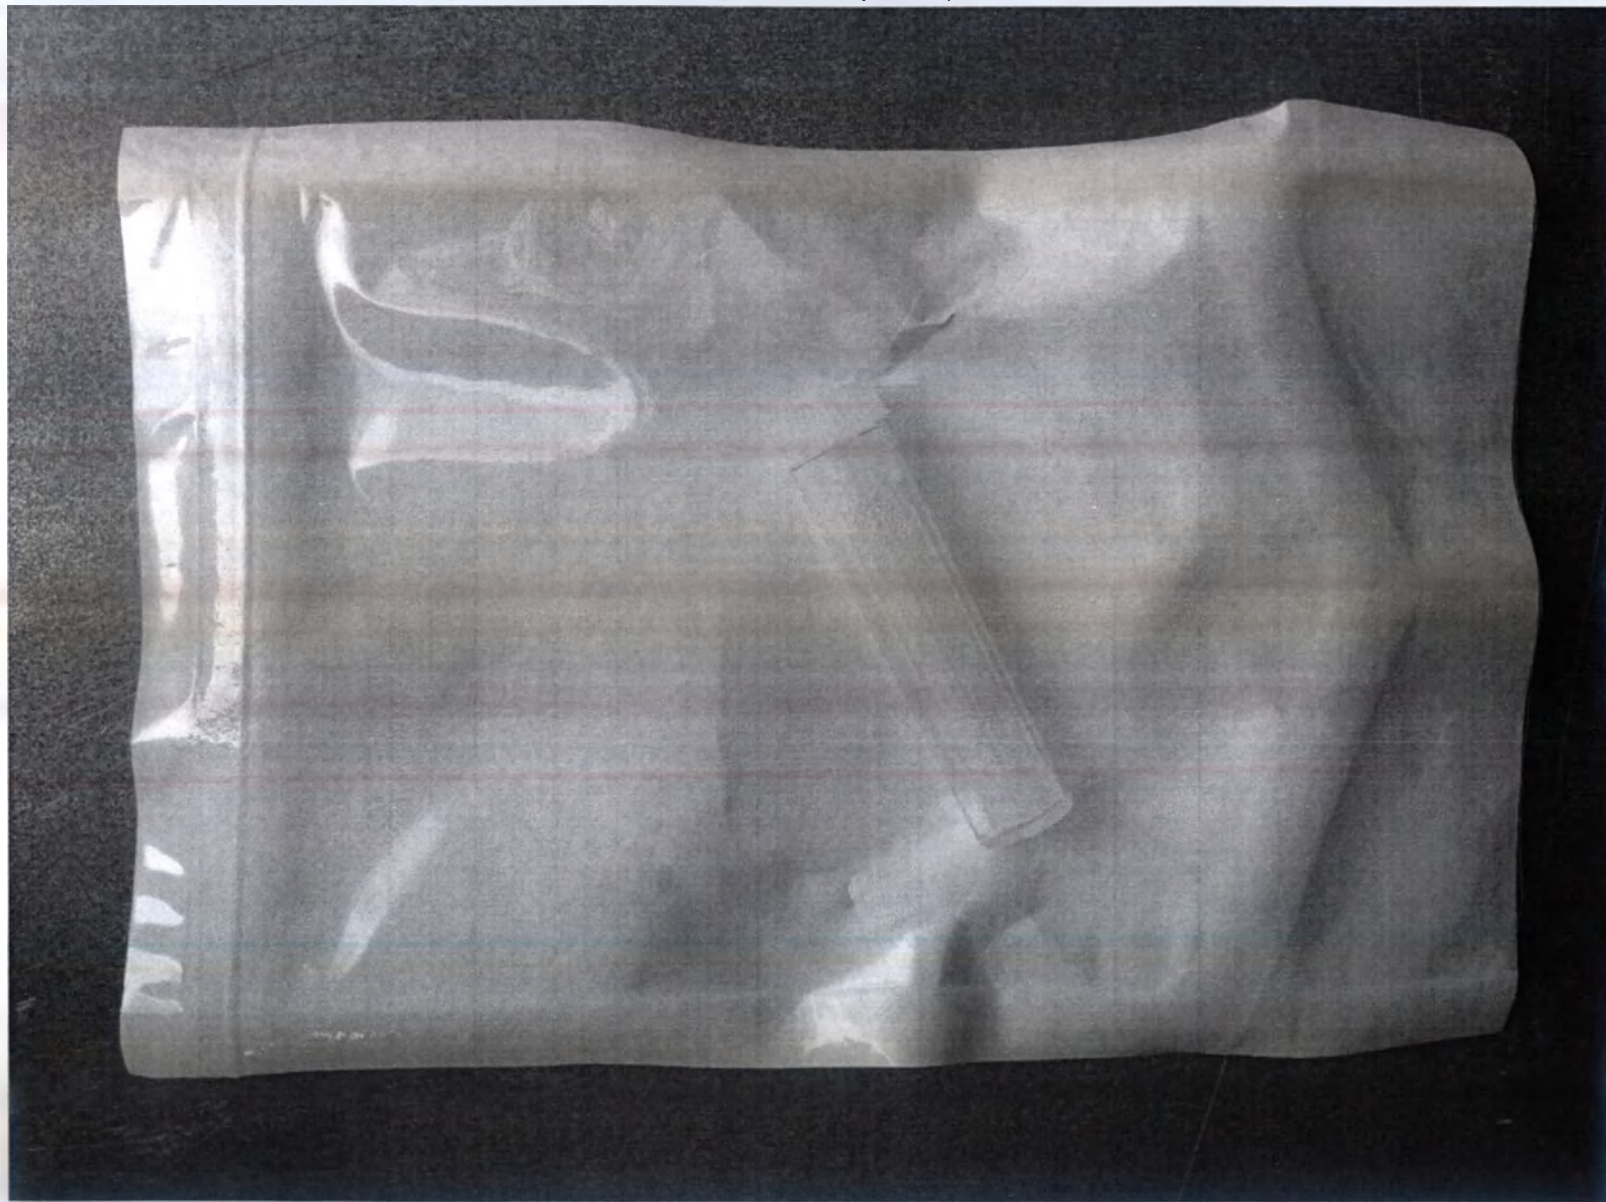

## 15. Ограничитель глубины:

15.1. Ограничитель глубины, длинный Ø3.0 IMP 6 мм (OPB3006L);

15.2. Ограничитель глубины, длинный Ø3.6 IMP 6 мм (OPB3606L);

15.3. Ограничитель глубины, длинный Ø4.2 IMP 6 мм (OPB4206L);

15.4. Ограничитель глубины, длинный Ø4.8 IMP 6 мм (OPB4806L);



- 15.5. Ограничитель глубины, длинный Ø3.0 IMP 8 мм (OPB3008L);  
15.6. Ограничитель глубины, длинный Ø3.6 IMP 8 мм (OPB3608L);  
15.7. Ограничитель глубины, длинный Ø4.2 IMP 8 мм (OPB4208L);  
15.8. Ограничитель глубины, длинный Ø4.8 IMP 8 мм (OPB4808L);



- 15.9. Ограничитель глубины, длинный Ø3.0 IMP 10 мм (OPB3010L);
- 15.10. Ограничитель глубины, длинный Ø3.6 IMP 10 мм (OPB3610L);
- 15.11. Ограничитель глубины, длинный Ø4.2 IMP 10 мм (OPB4210L);
- 15.12. Ограничитель глубины, длинный Ø4.8 IMP 10 мм (OPB4810L);



- 15.13. Ограничитель глубины, длинный Ø3.0 IMP 12 мм (OPB3012L);
- 15.14. Ограничитель глубины, длинный Ø3.6 IMP 12 мм (OPB3612L);
- 15.15. Ограничитель глубины, длинный Ø4.2 IMP 12 мм (OPB4212L);
- 15.16. Ограничитель глубины, длинный Ø4.8 IMP 12 мм (OPB4812L);



- 15.17. Ограничитель глубины, длинный Ø3.0 IMP 14 мм (OPB3014L);
- 15.18. Ограничитель глубины, длинный Ø3.6 IMP 14 мм (OPB3614L);
- 15.19. Ограничитель глубины, длинный Ø4.2 IMP 14 мм (OPB4214L);
- 15.20. Ограничитель глубины, длинный Ø4.8 IMP 14 мм (OPB4814L).



15.21. Ограничитель глубины, длинный Ø3.0 IMP 16 мм (OPB3016L);

15.22. Ограничитель глубины, длинный Ø3.6 IMP 16 мм (OPB3616L);



15.23. Ограничитель глубины, длинный Ø3.0 IMP 18 мм (OPB3018L);

15.24. Ограничитель глубины, длинный Ø3.6 IMP 18 мм (OPB3618L);




- 15.25. Ограничитель глубины короткий Ø3.0 IMP 6 мм (OPB3006C);  
15.26. Ограничитель глубины короткий Ø3.6 IMP 6 мм (OPB3606C);  
15.27. Ограничитель глубины короткий Ø4.2 IMP 6 мм (OPB4206C);  
15.28. Ограничитель глубины короткий Ø4.8 IMP 6 мм (OPB4806C);



- 15.29. Ограничитель глубины короткий Ø3.0 IMP 8 мм (OPB3008C);  
15.30. Ограничитель глубины короткий Ø3.6 IMP 8 мм (OPB3608C);  
15.31. Ограничитель глубины короткий Ø4.2 IMP 8 мм (OPB4208C);  
15.32. Ограничитель глубины короткий Ø4.8 IMP 8 мм (OPB4808C);




- 15.33. Ограничитель глубины короткий Ø3.0 IMP10 мм (OPB3010C);  
15.34. Ограничитель глубины короткий Ø3.6 IMP 10 мм (OPB3610C);  
15.35. Ограничитель глубины короткий Ø4.2 IMP 10 мм (OPB4210C);  
15.36. Ограничитель глубины короткий Ø4.8 IMP 10 мм (OPB4810C);

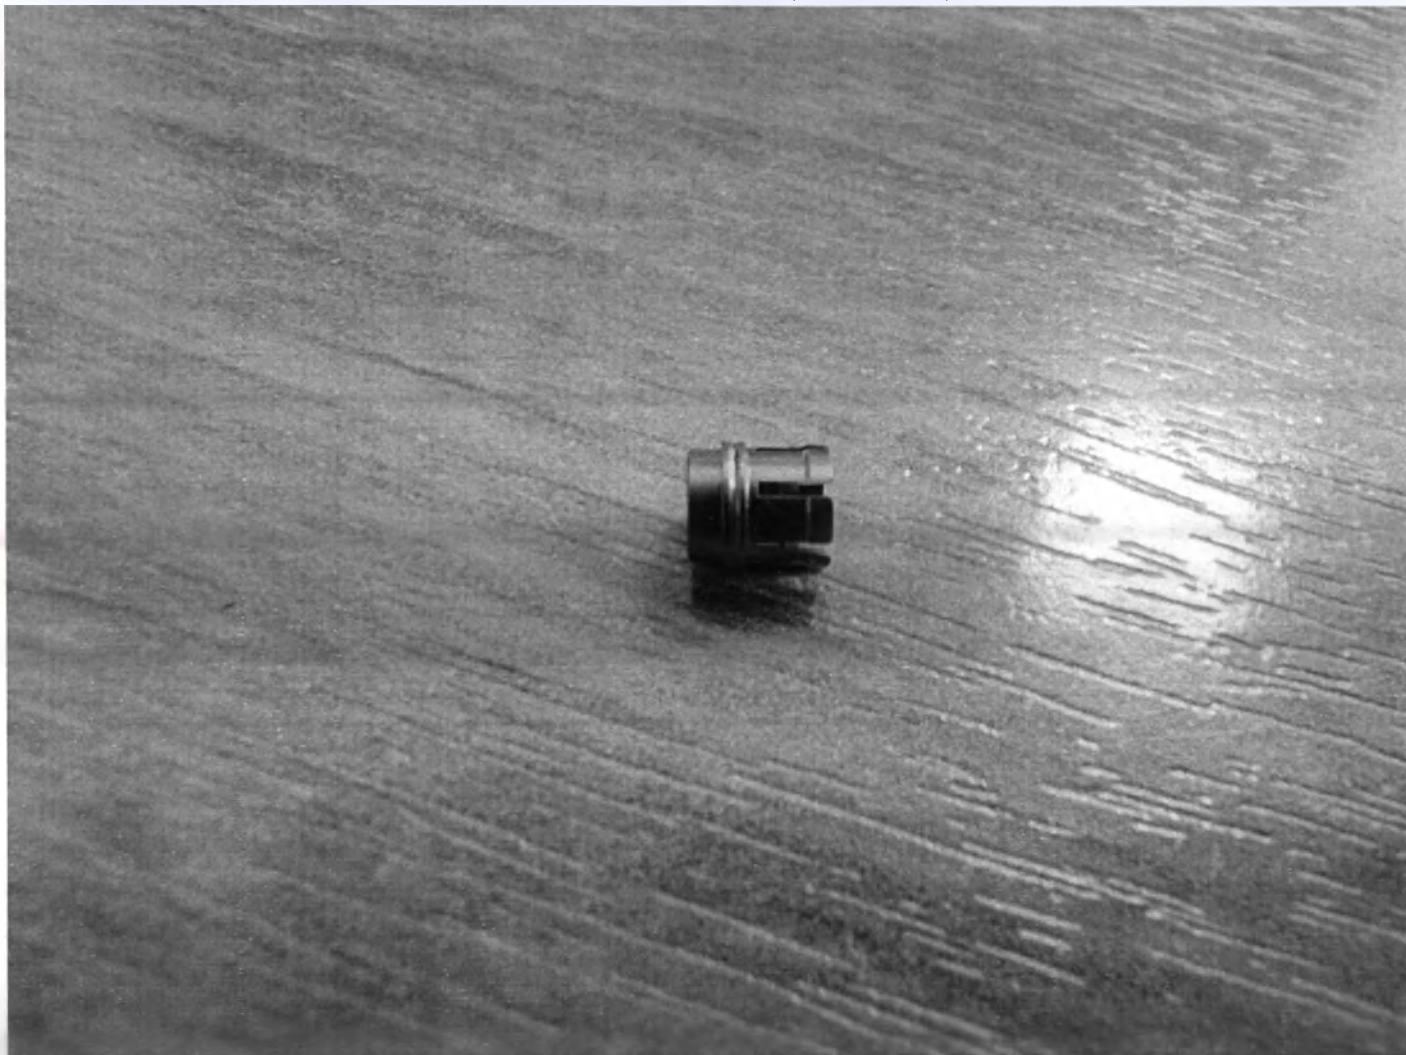


**16. Модуль слепочный (трансфер):**

**16.1. Модуль слепочный LOCATOR, 4 шт. в упаковке (OPLA500);**

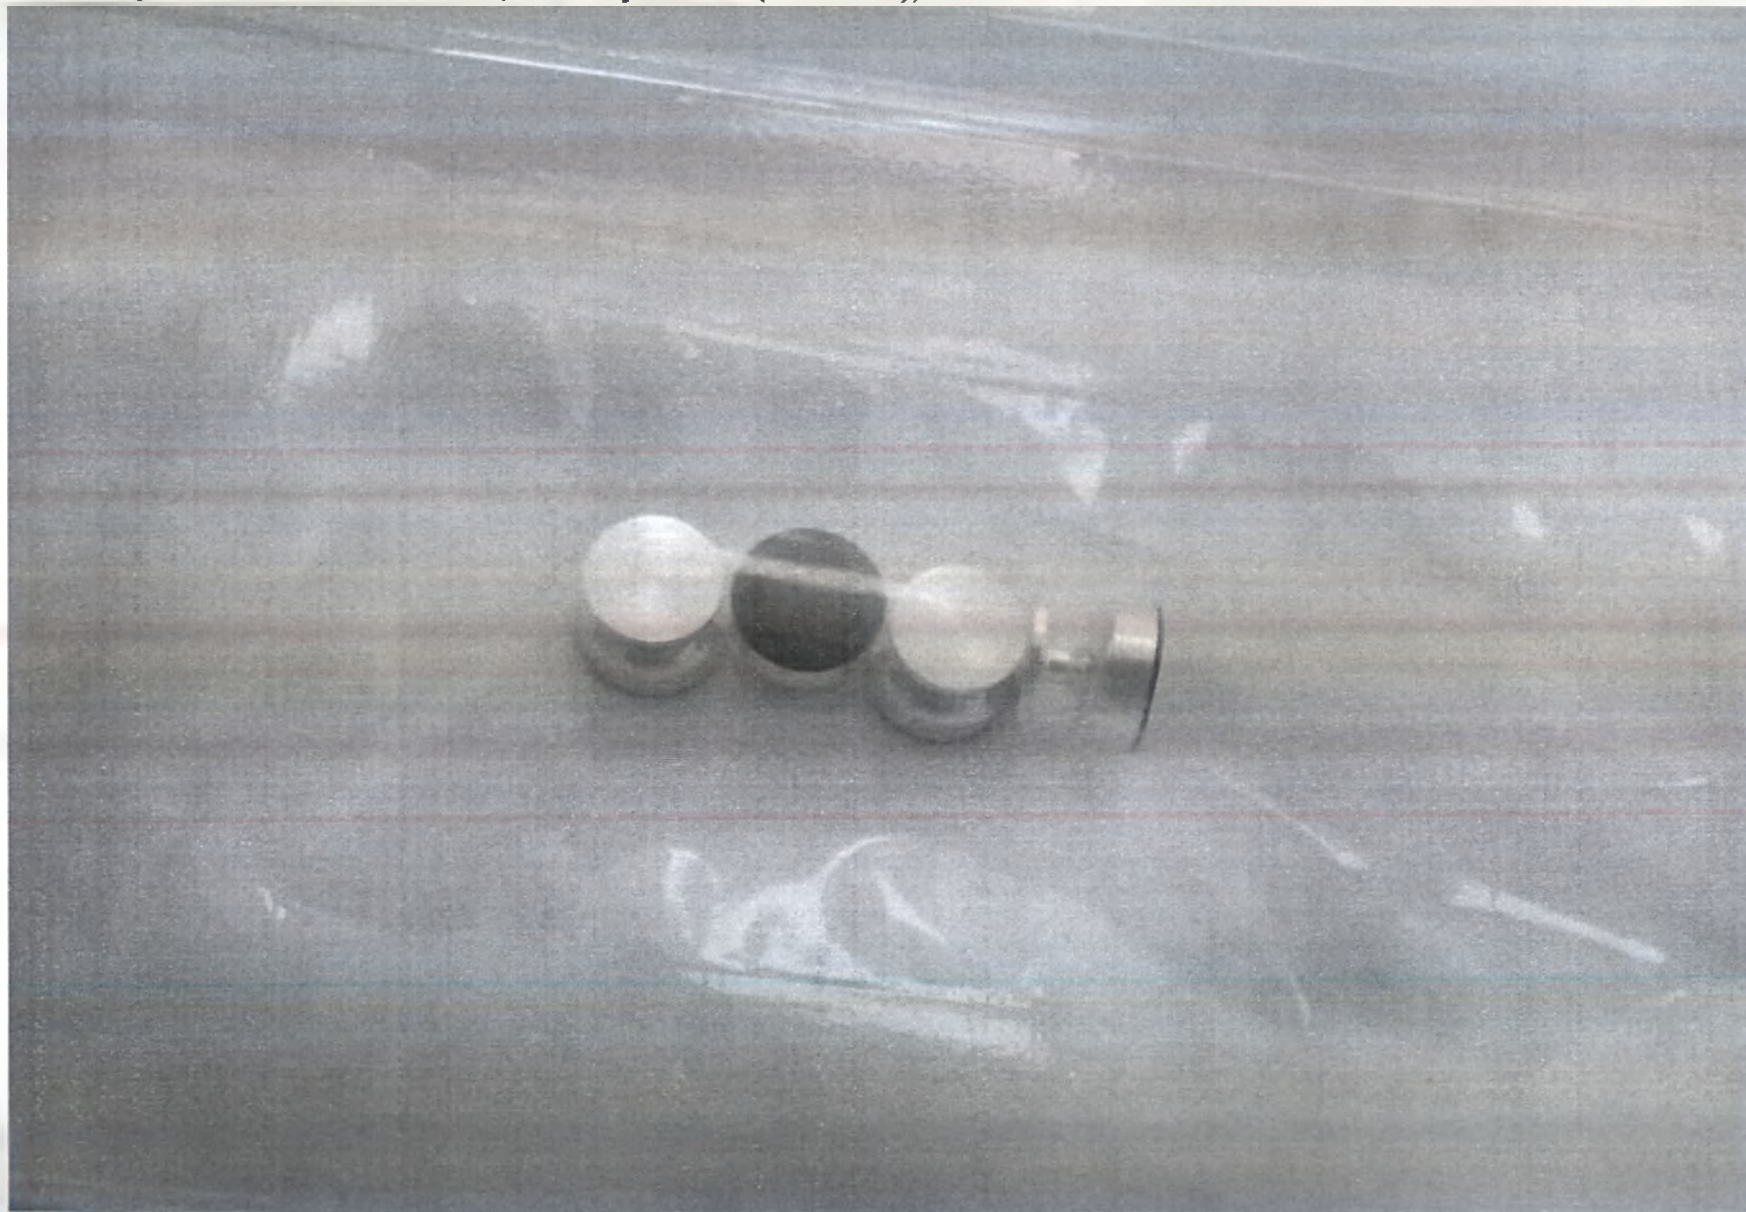


16.2. Трансфер для закрытой ложки для имплантата 2.8 (OPPI028);

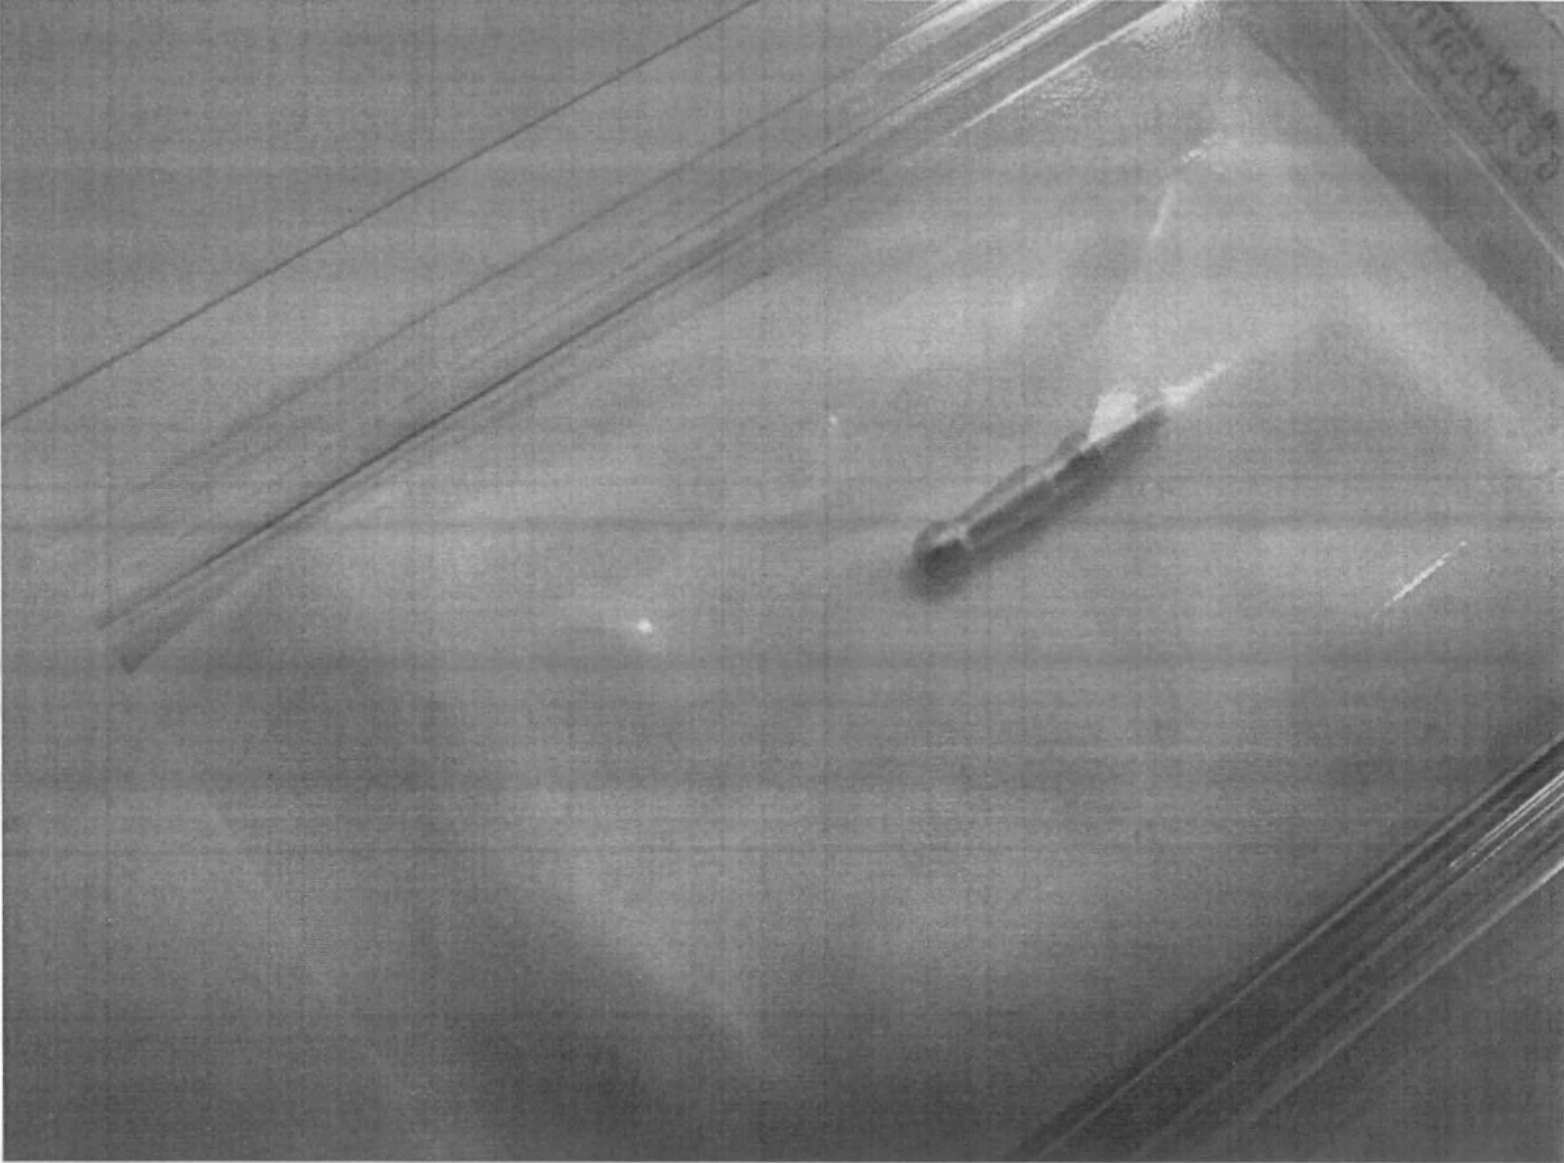


16.3. Трансфер для закрытой ложки для имплантата REG/PX, с винтом (OPPI100);

16.4. Трансфер для закрытой ложки для имплантата REG/PX, с винтом, 4 шт. в упаковке (OPPI100-4)

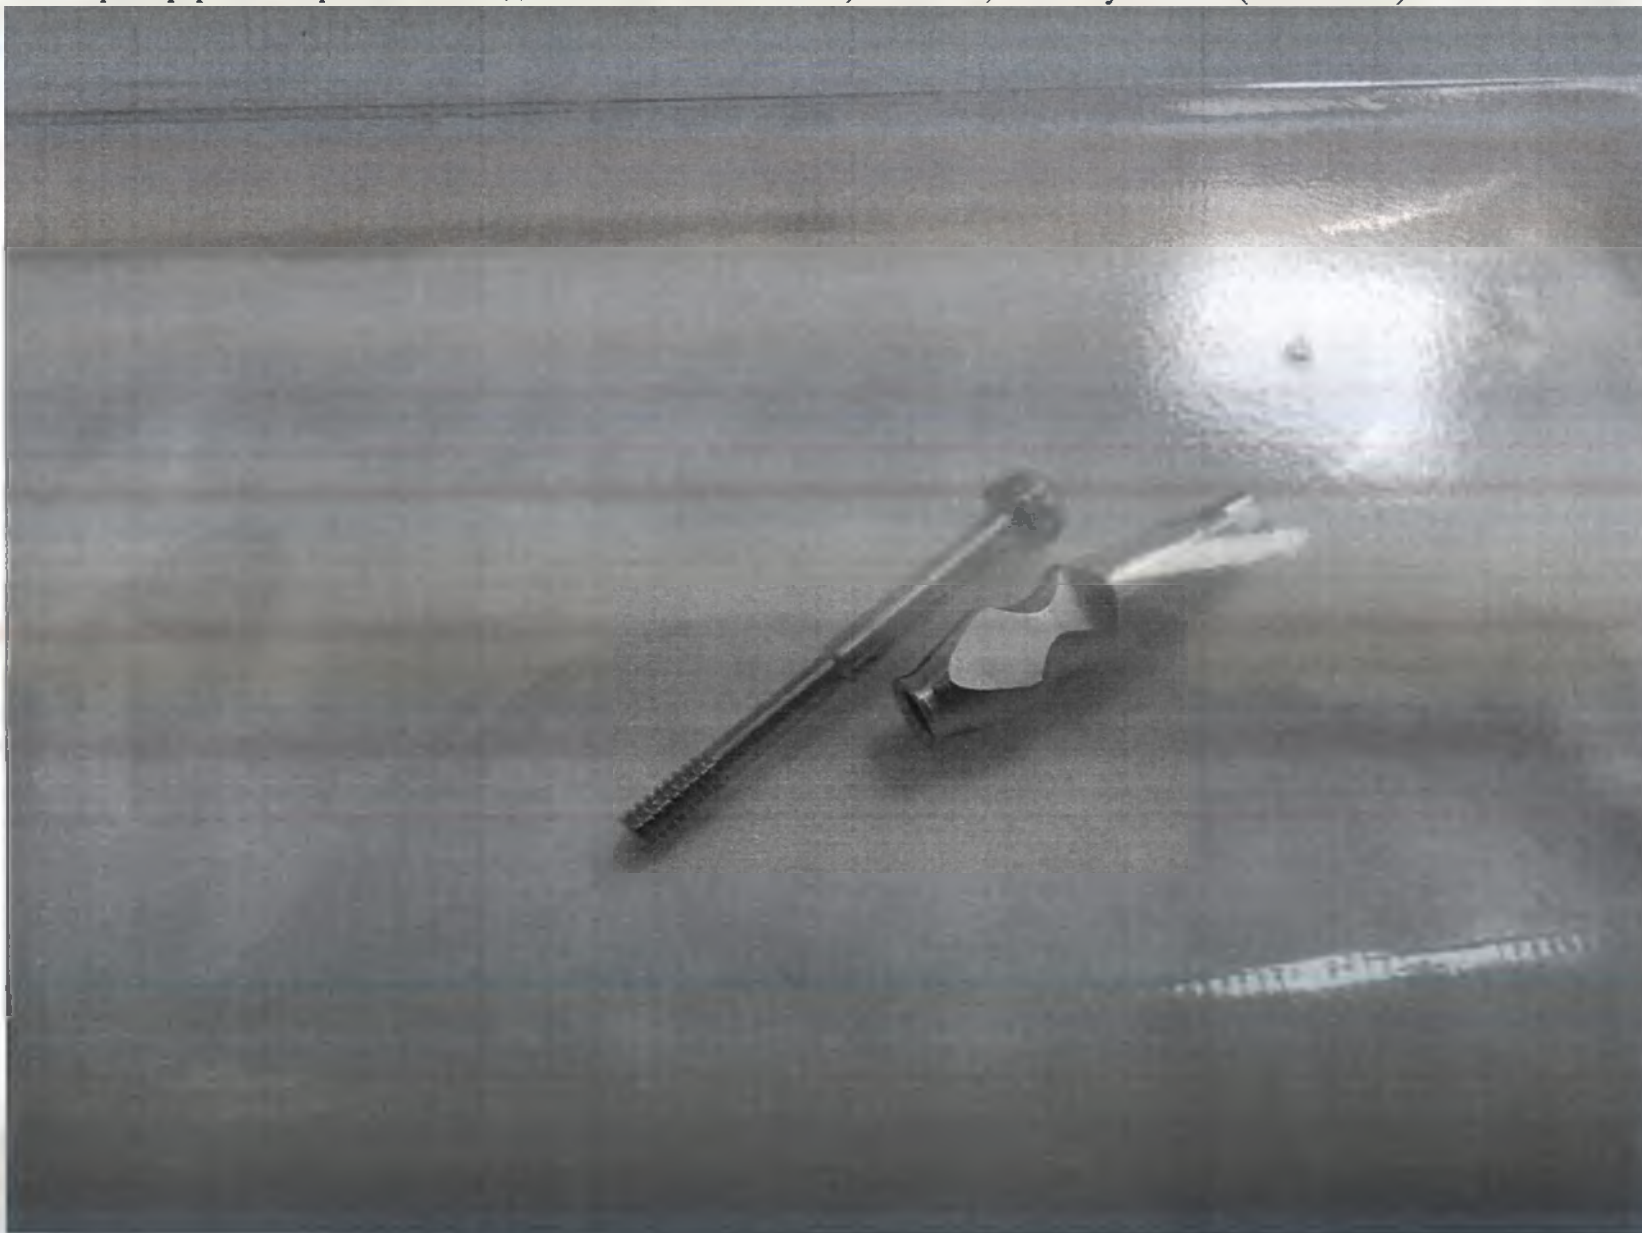

- 16.5. Трансфер для закрытой ложки для имплантата REG/PX, короткий, с винтом (OPPI100S);  
16.6. Трансфер для закрытой ложки для имплантата REG/PX, короткий, с винтом, 4 шт. в упаковке (OPPI100S-4);

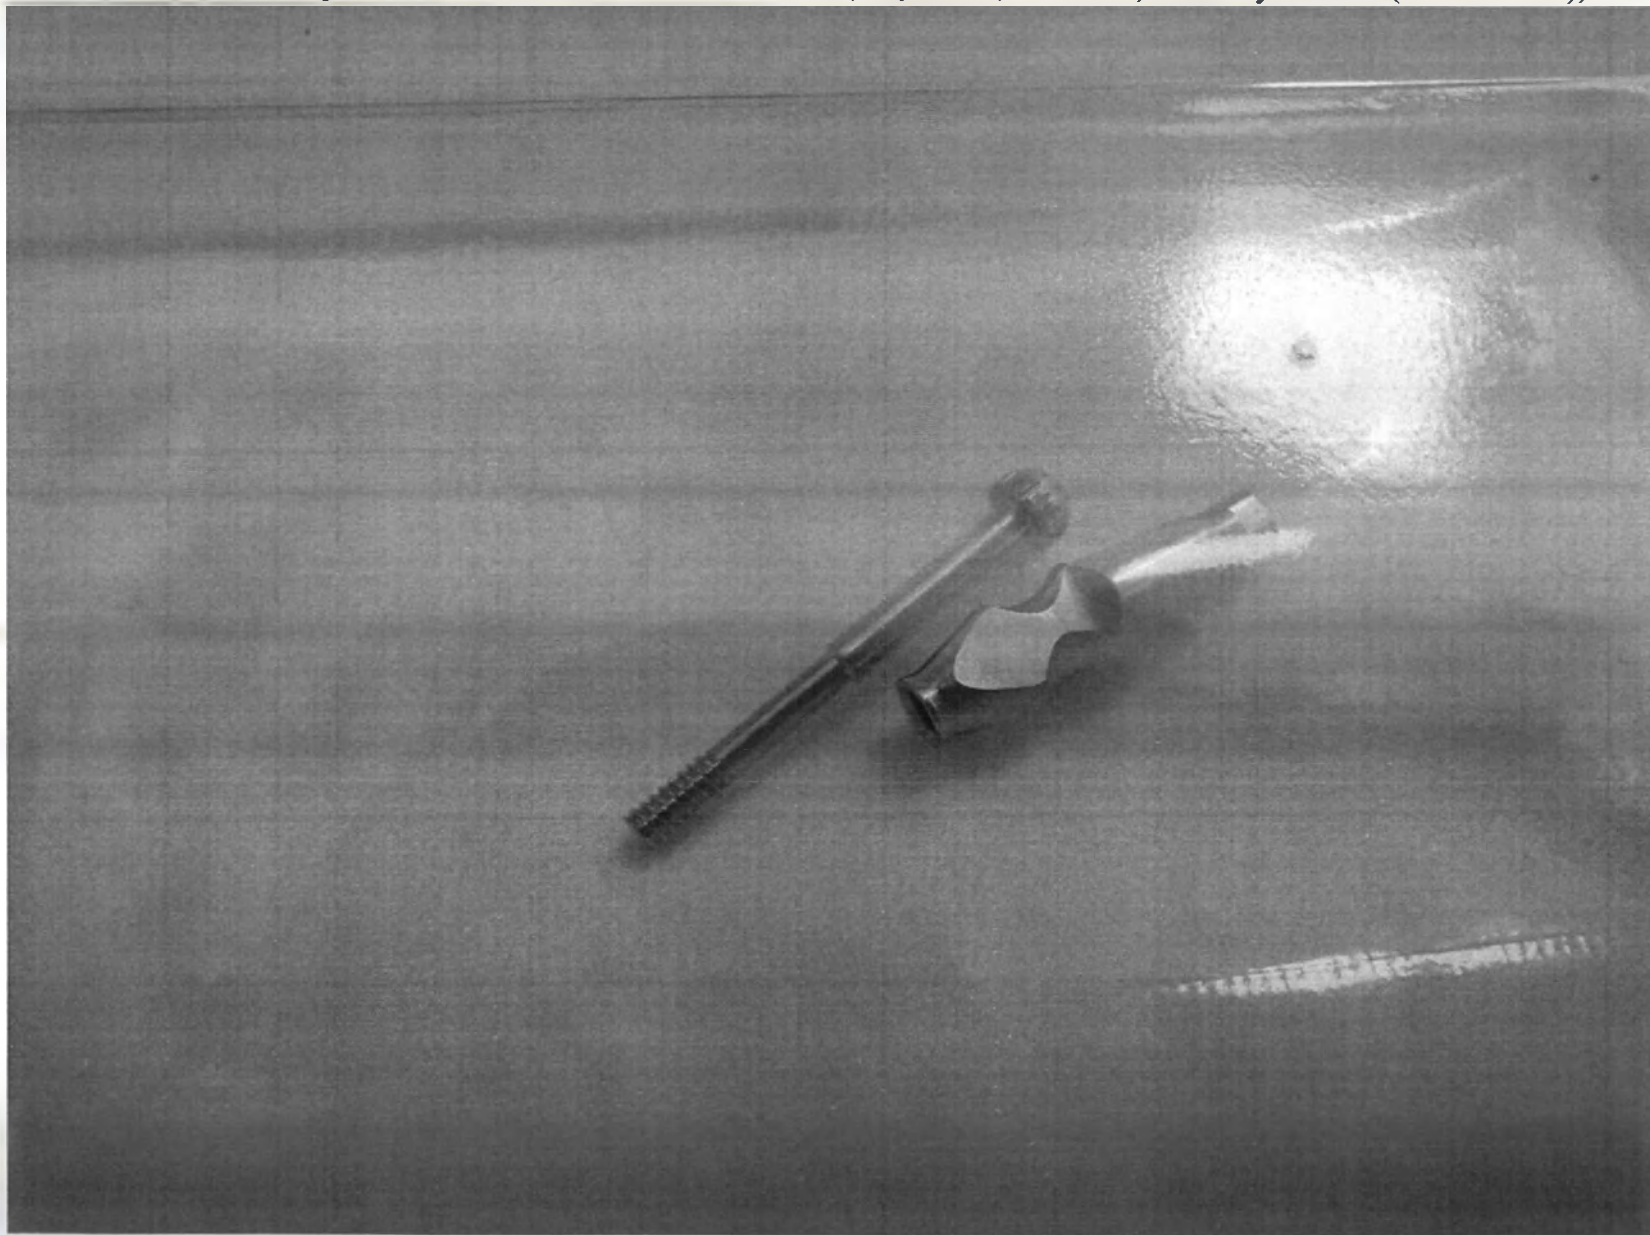

16.7. Трансфер для открытой ложки, с 2 винтами (OPPU100);


16.8. Трансфер для открытой ложки, с 2 винтами, 4 шт. в упаковке (OPPU100-4);




- 16.9. Трансфер для открытой ложки, длинный, с 2 винтами (OPPU100L);  
16.10. Трансфер для открытой ложки, длинный, с 2 винтами (OPPU100L-4);



16.11. Трансфер абатмента 2.8 (ОРТТ028);

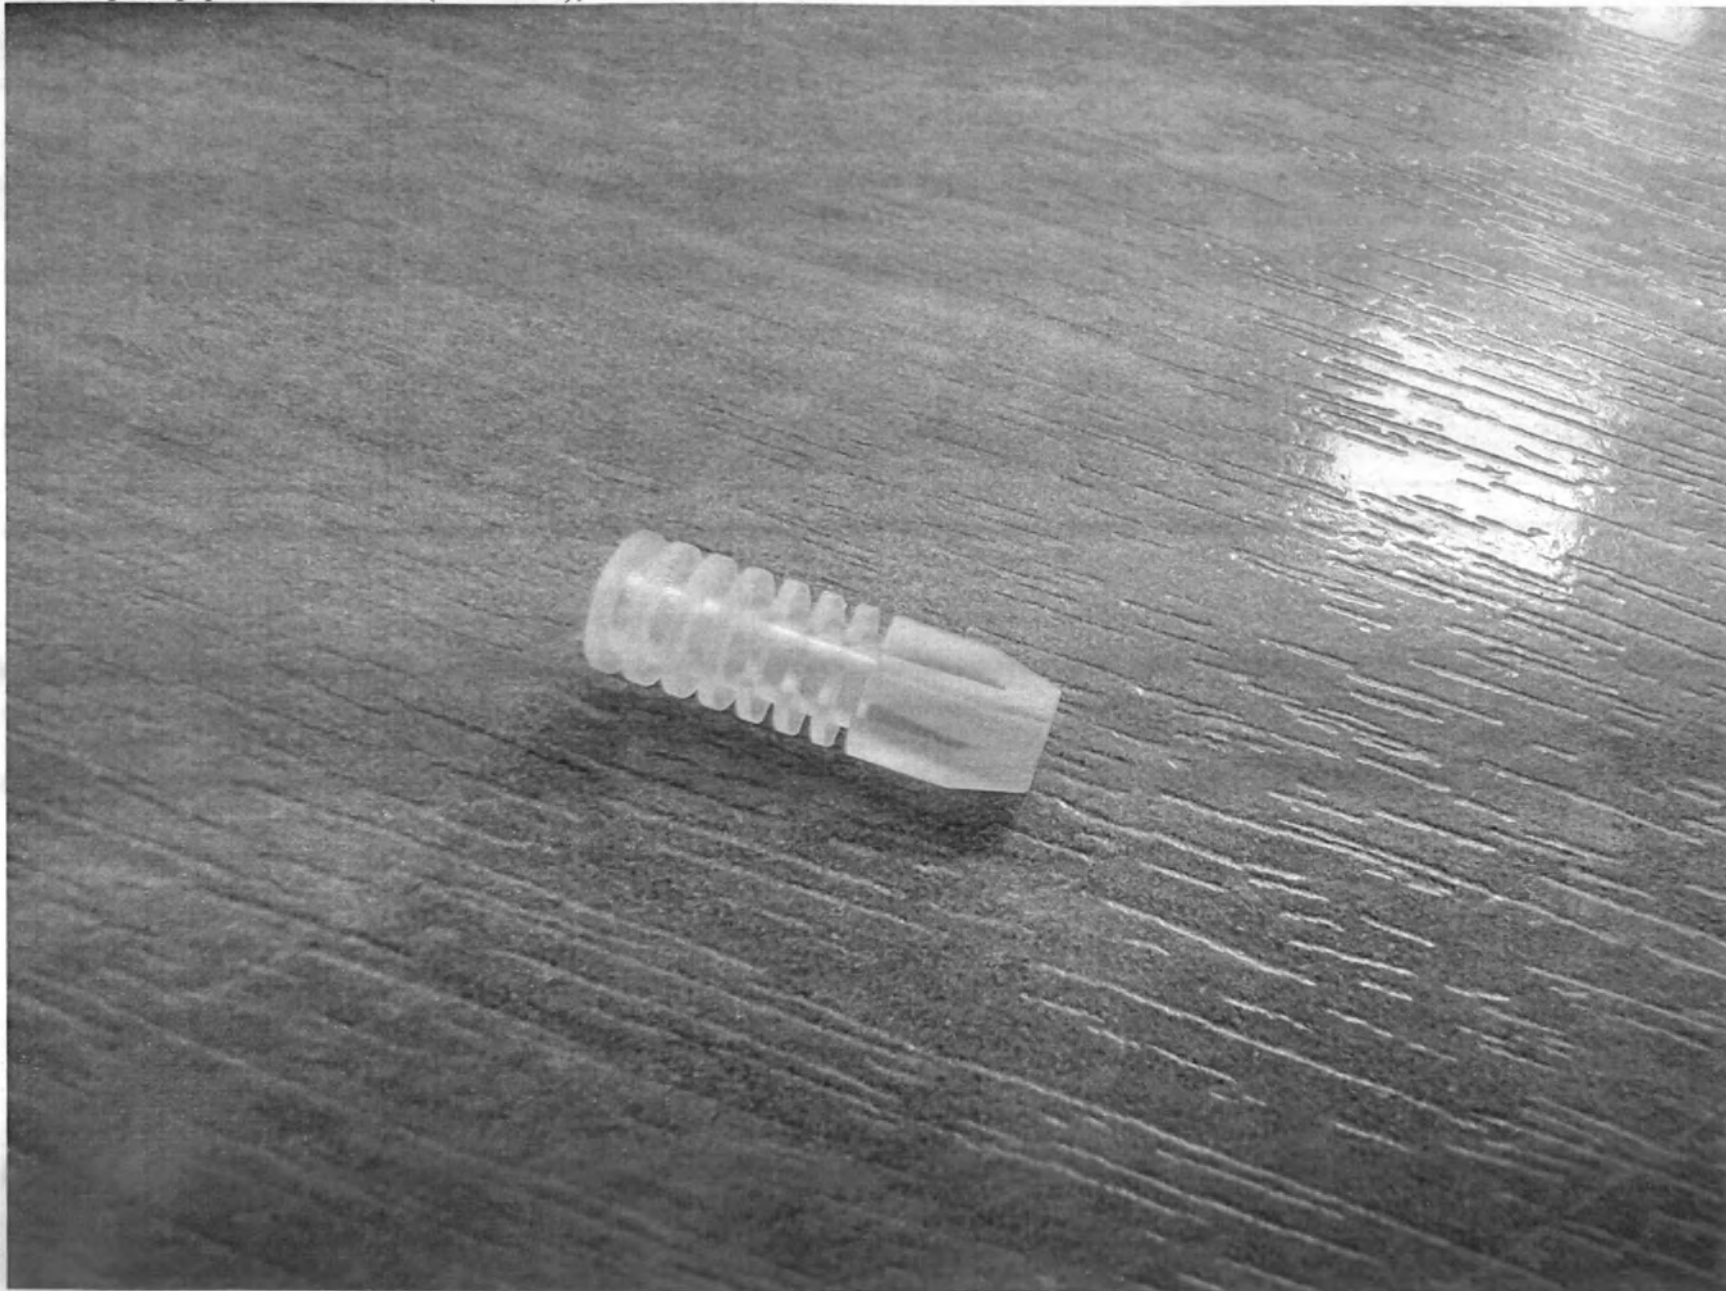

16.12. Трансфер абатмента REG/PX (OPTT100);

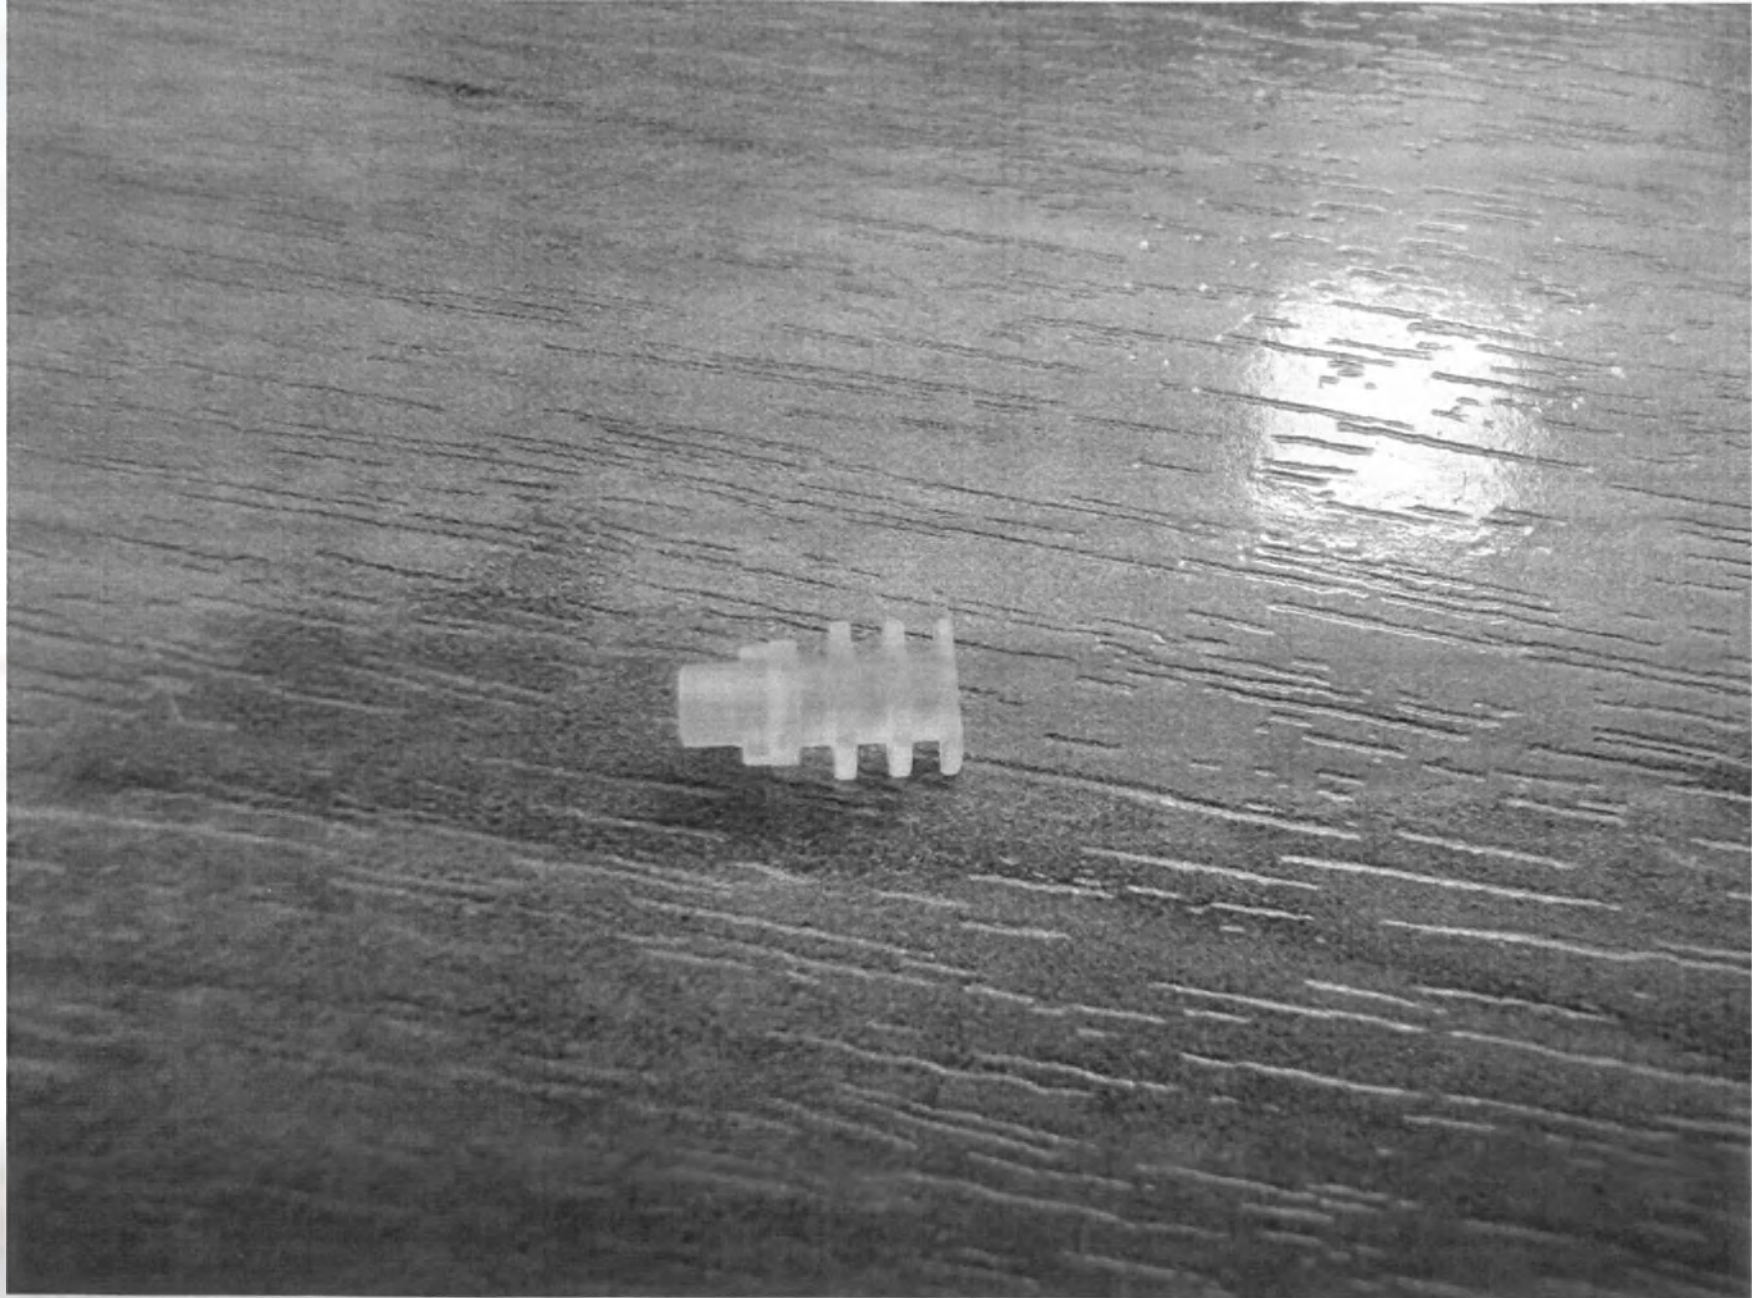


16.13. Трансфер абатмента REG/PX, 5 шт. в упаковке (ОРТТ100-5):




16.14. Трансфер для открытой ложки для абатментов MU Ø4.0, с 2 винтами (MUNT100);

16.15. Трансфер для открытой ложки для абатментов MU Ø4.0, с 2 винтами, 4 шт. в упаковке (MUNT100-4);

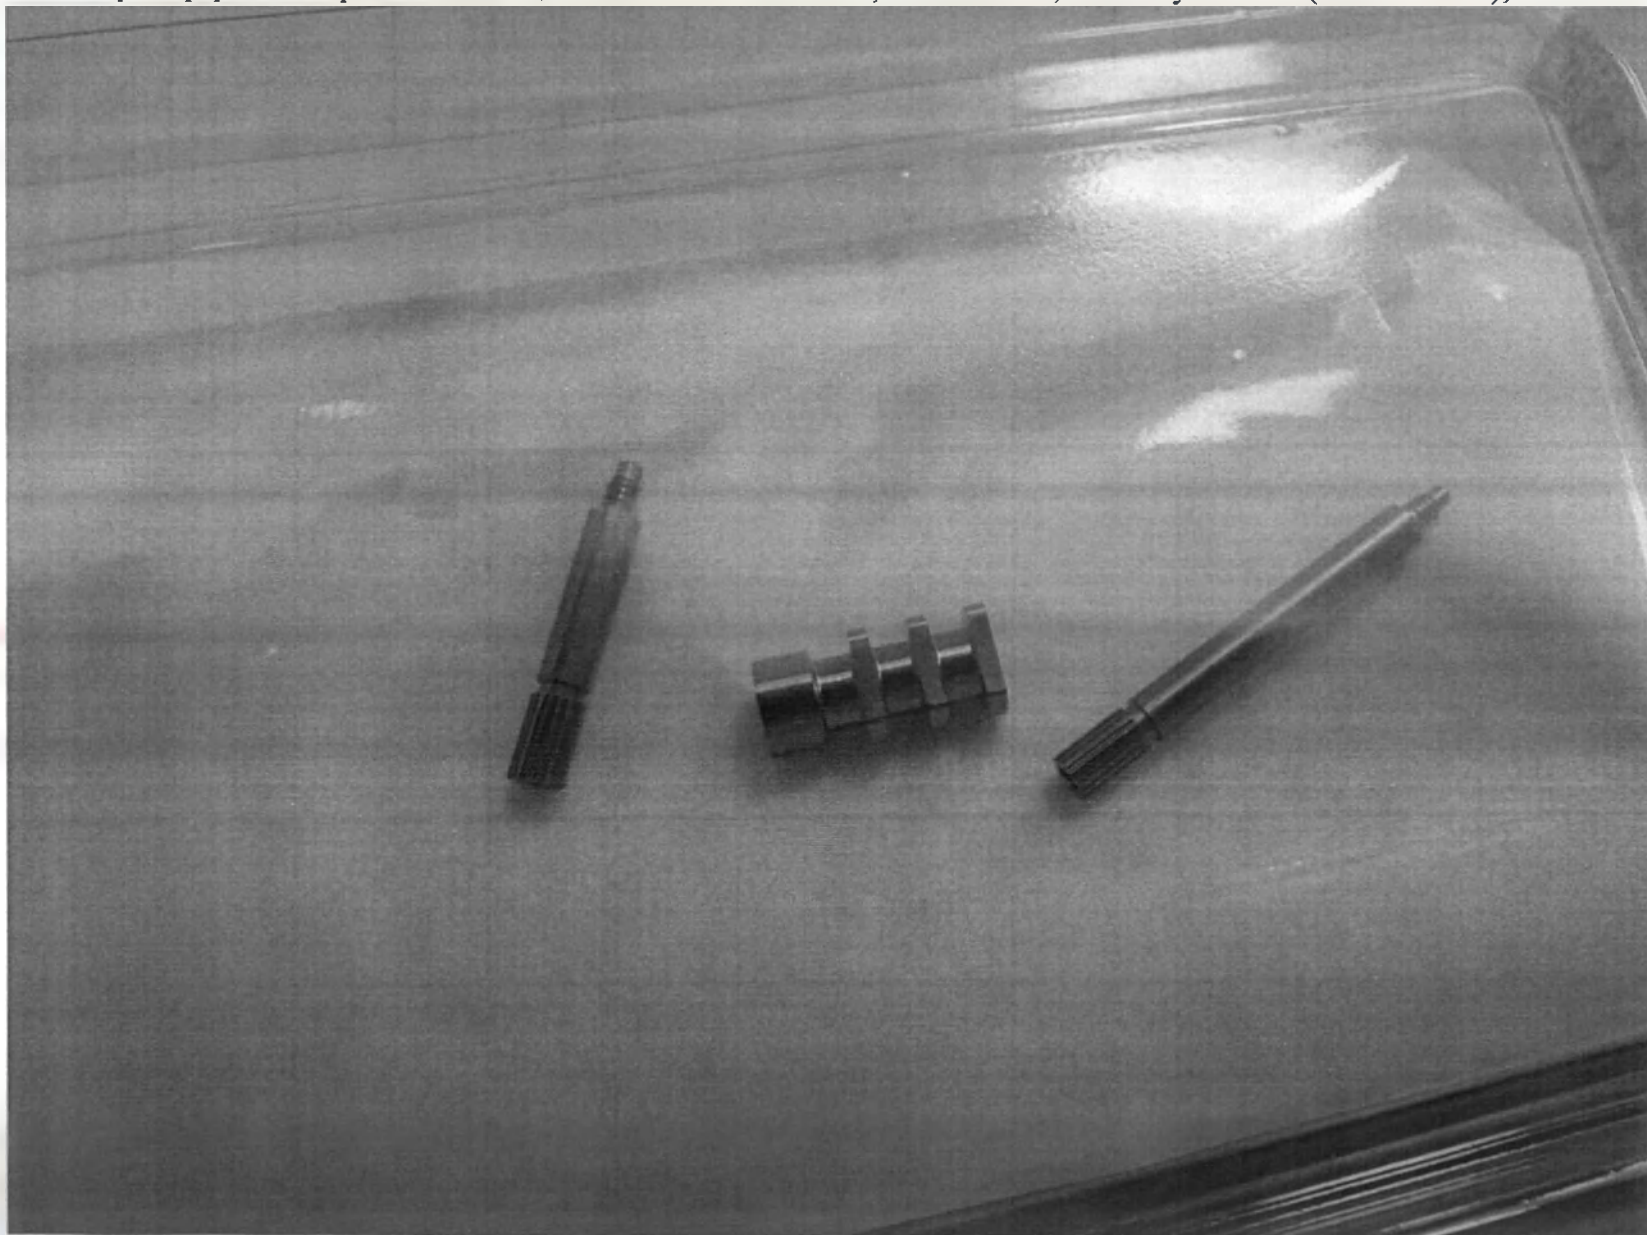

16.16. Трансфер для открытой ложки для абатментов MU Ø4.8, с 2 винтами (MUT100);

16.17. Трансфер для открытой ложки для абатментов MU Ø4.8, с 2 винтами, 4 шт. в упаковке (MUT100-4);

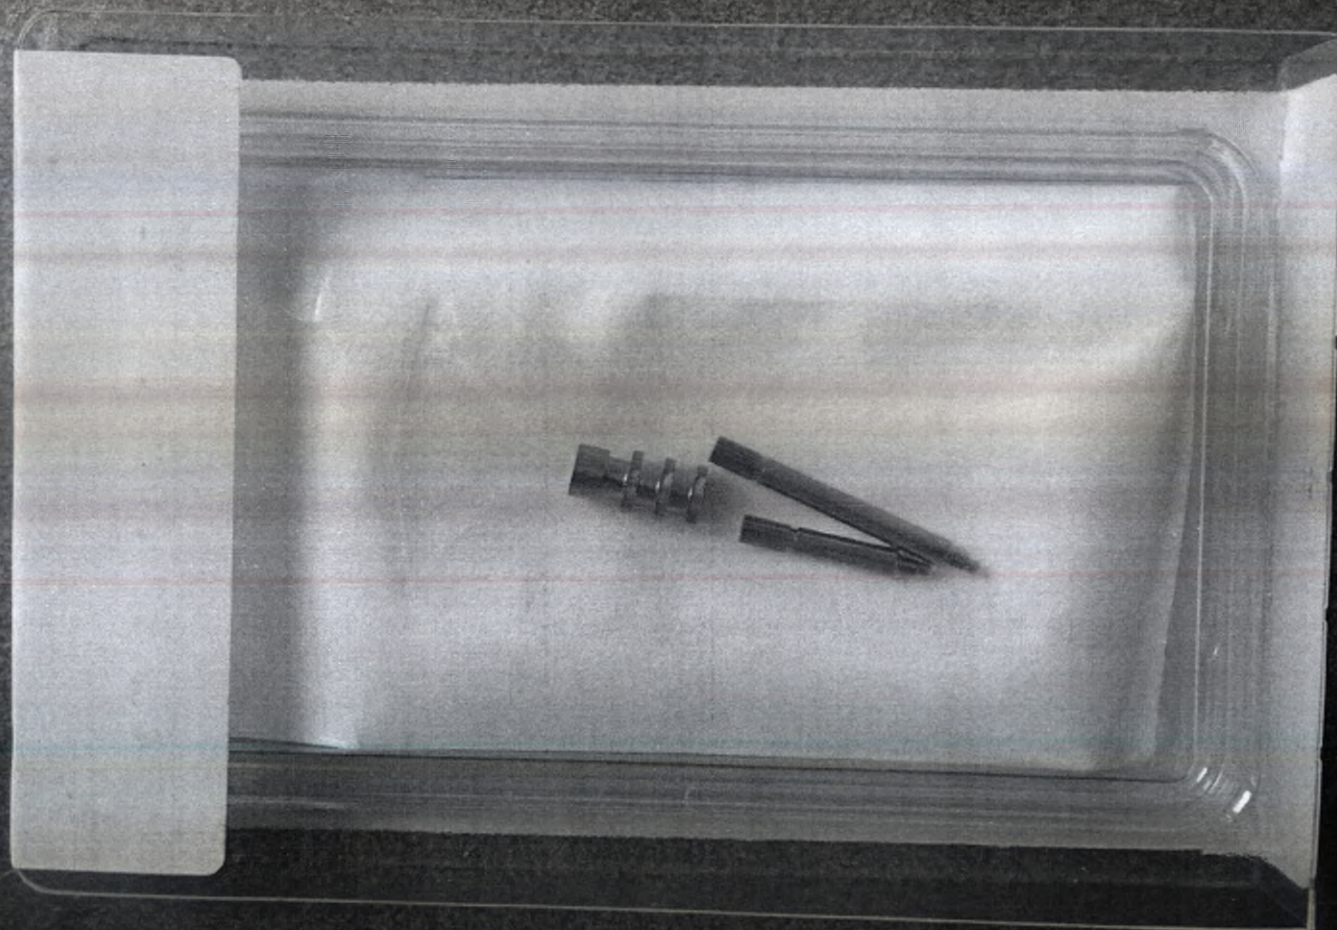


16.18. Трансфер для закрытой ложки для абатментов MU Ø4.0 (MUNT200);

16.19. Трансфер для закрытой ложки для абатментов MU Ø4.0, 4 шт. в упаковке (MUNT200-4);




16.20. Трансфер для закрытой ложки для абатментов MU Ø4.8 (MUT200);

16.21. Трансфер для закрытой ложки для абатментов MU Ø4.8, 4 шт. в упаковке (MUT200-4);

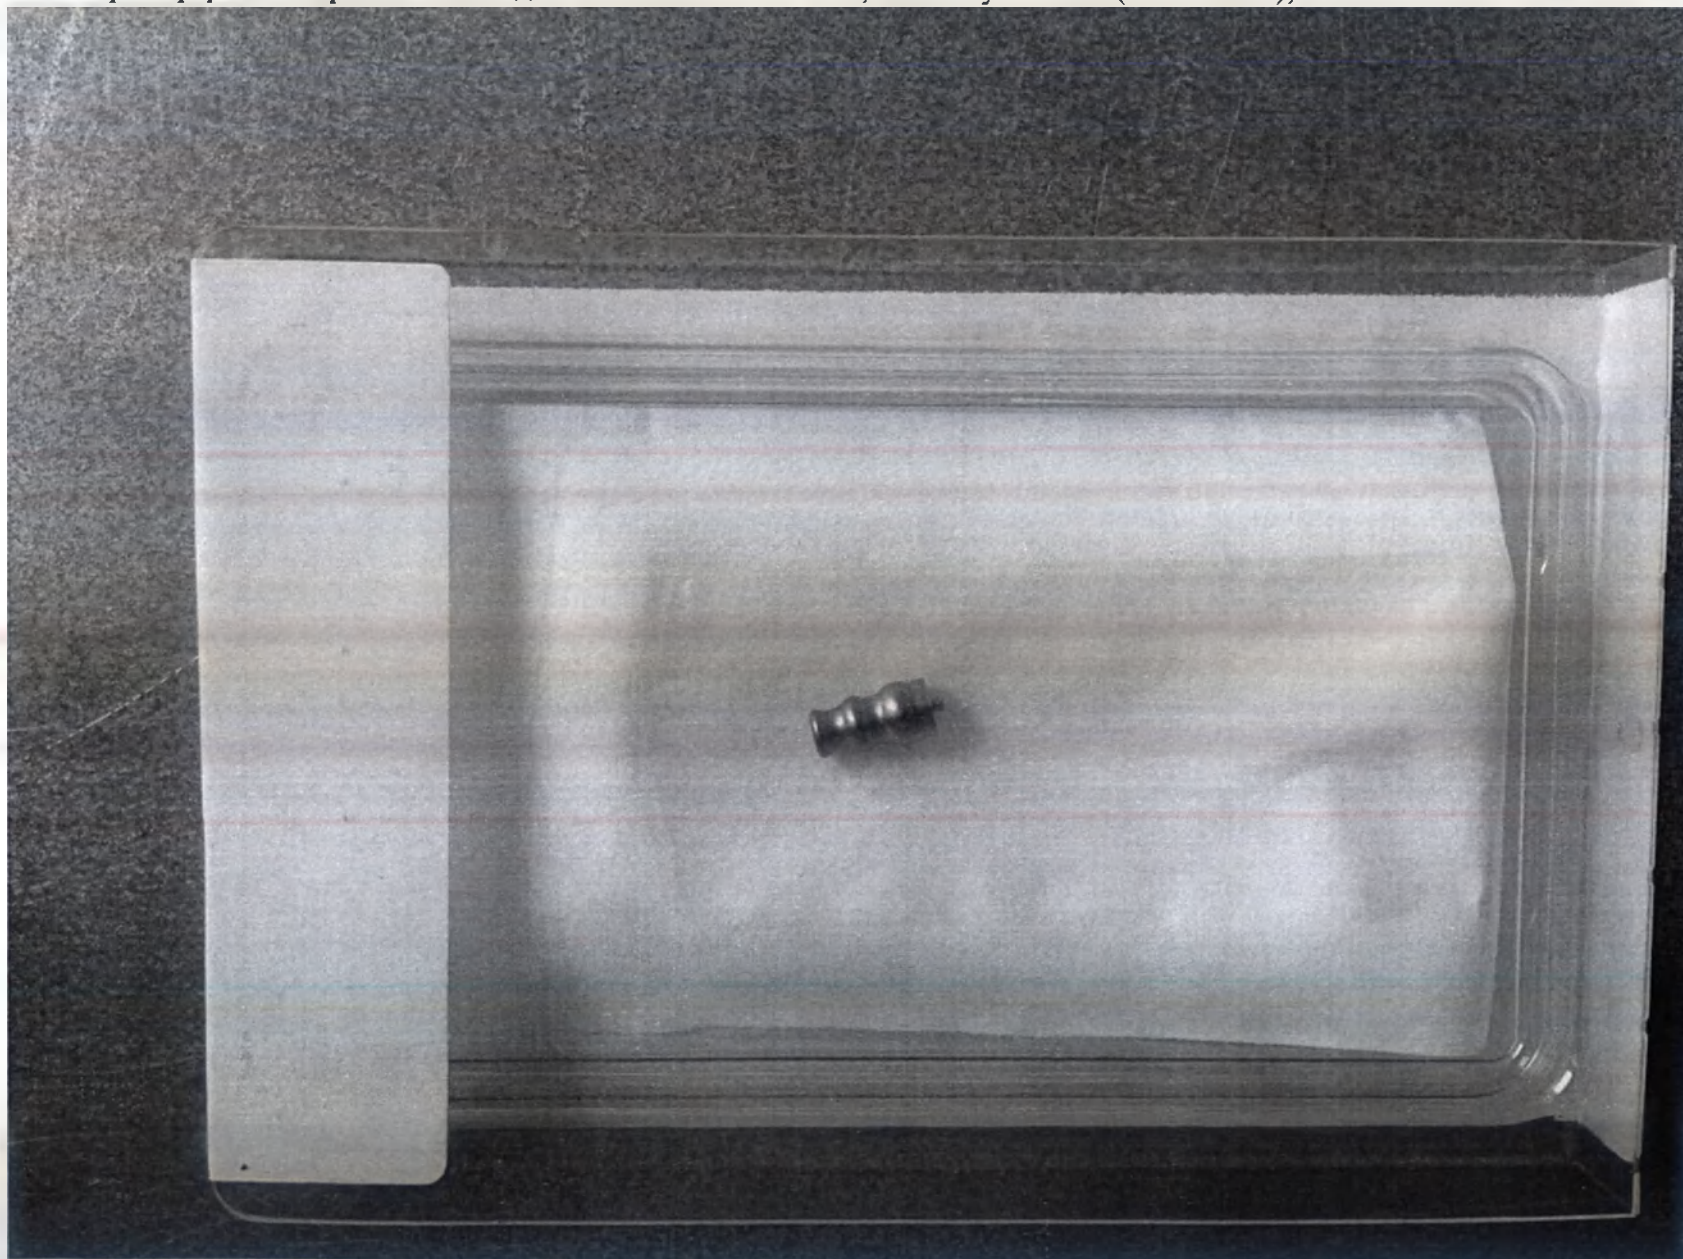


- 16.22. Модуль слепочный Ø4.0 GH1.5 (OPROFIL410);
- 16.23. Модуль слепочный Ø4.0 GH2.5 (OPROFIL420);
- 16.24. Модуль слепочный Ø4.0 GH3.5 (OPROFIL430);
- 16.25. Модуль слепочный Ø5.0 GH1.5 (OPROFIL510);
- 16.26. Модуль слепочный Ø5.0 HG2.5 (OPROFIL520);
- 16.27. Модуль слепочный Ø5.0 HG3.5 (OPROFIL530).

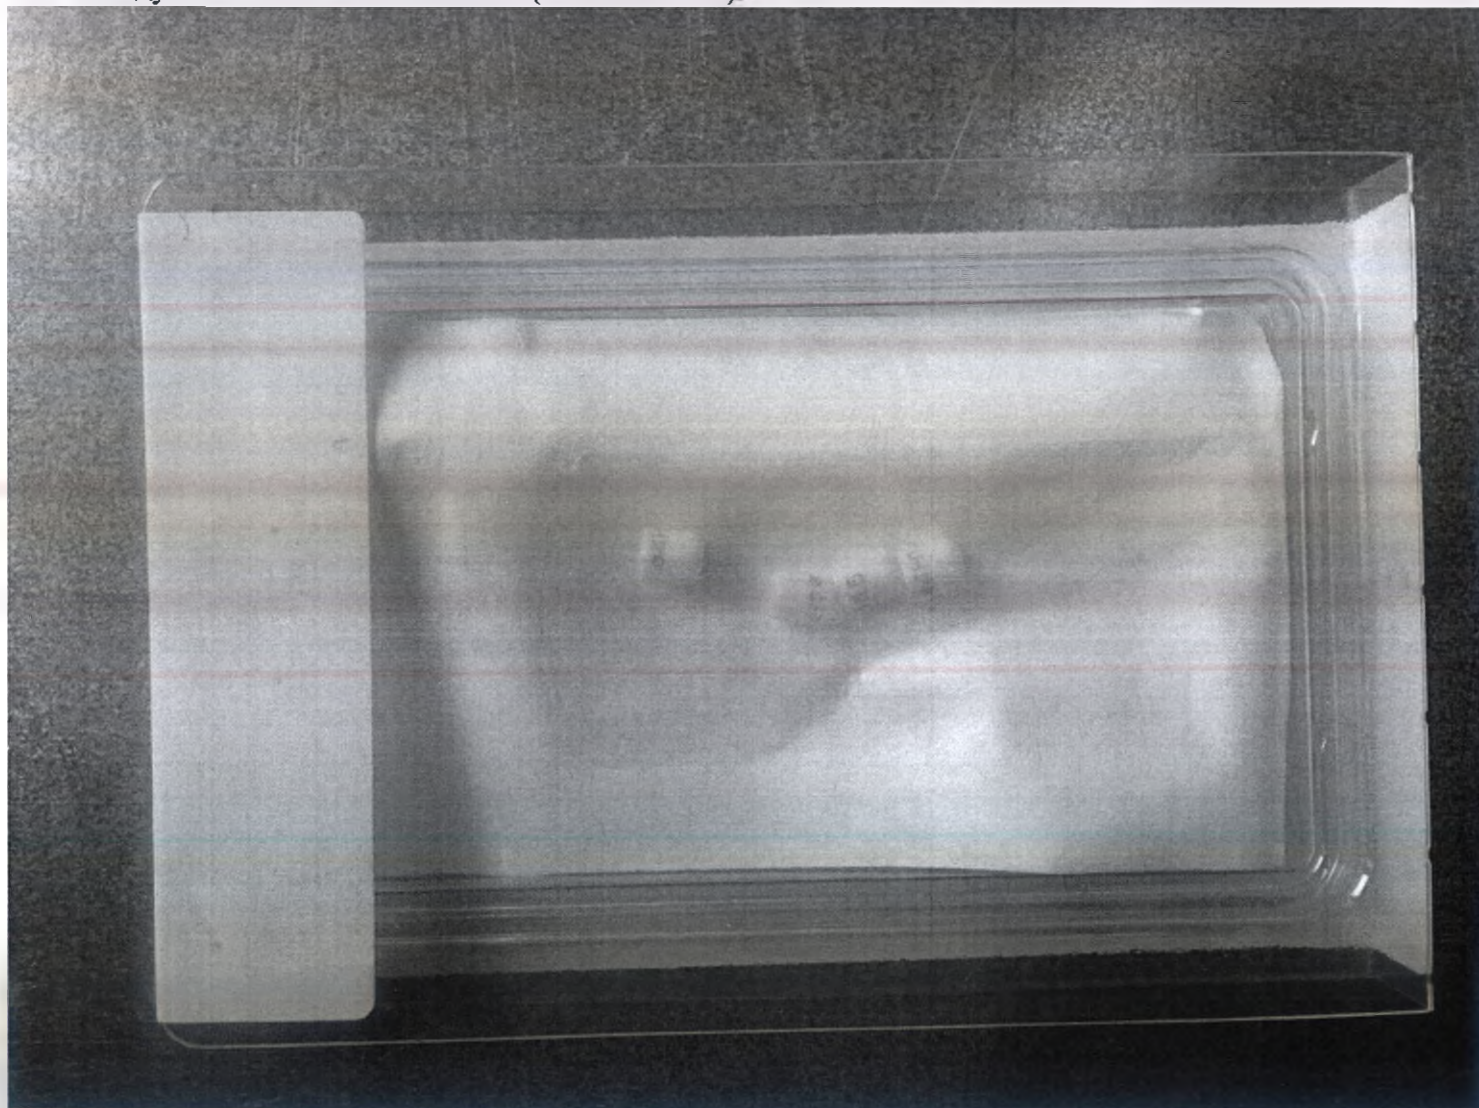


**17. Аналог имплантата лабораторный:**

17.1. Аналог имплантата Axiom 2.8 (OPIA028);

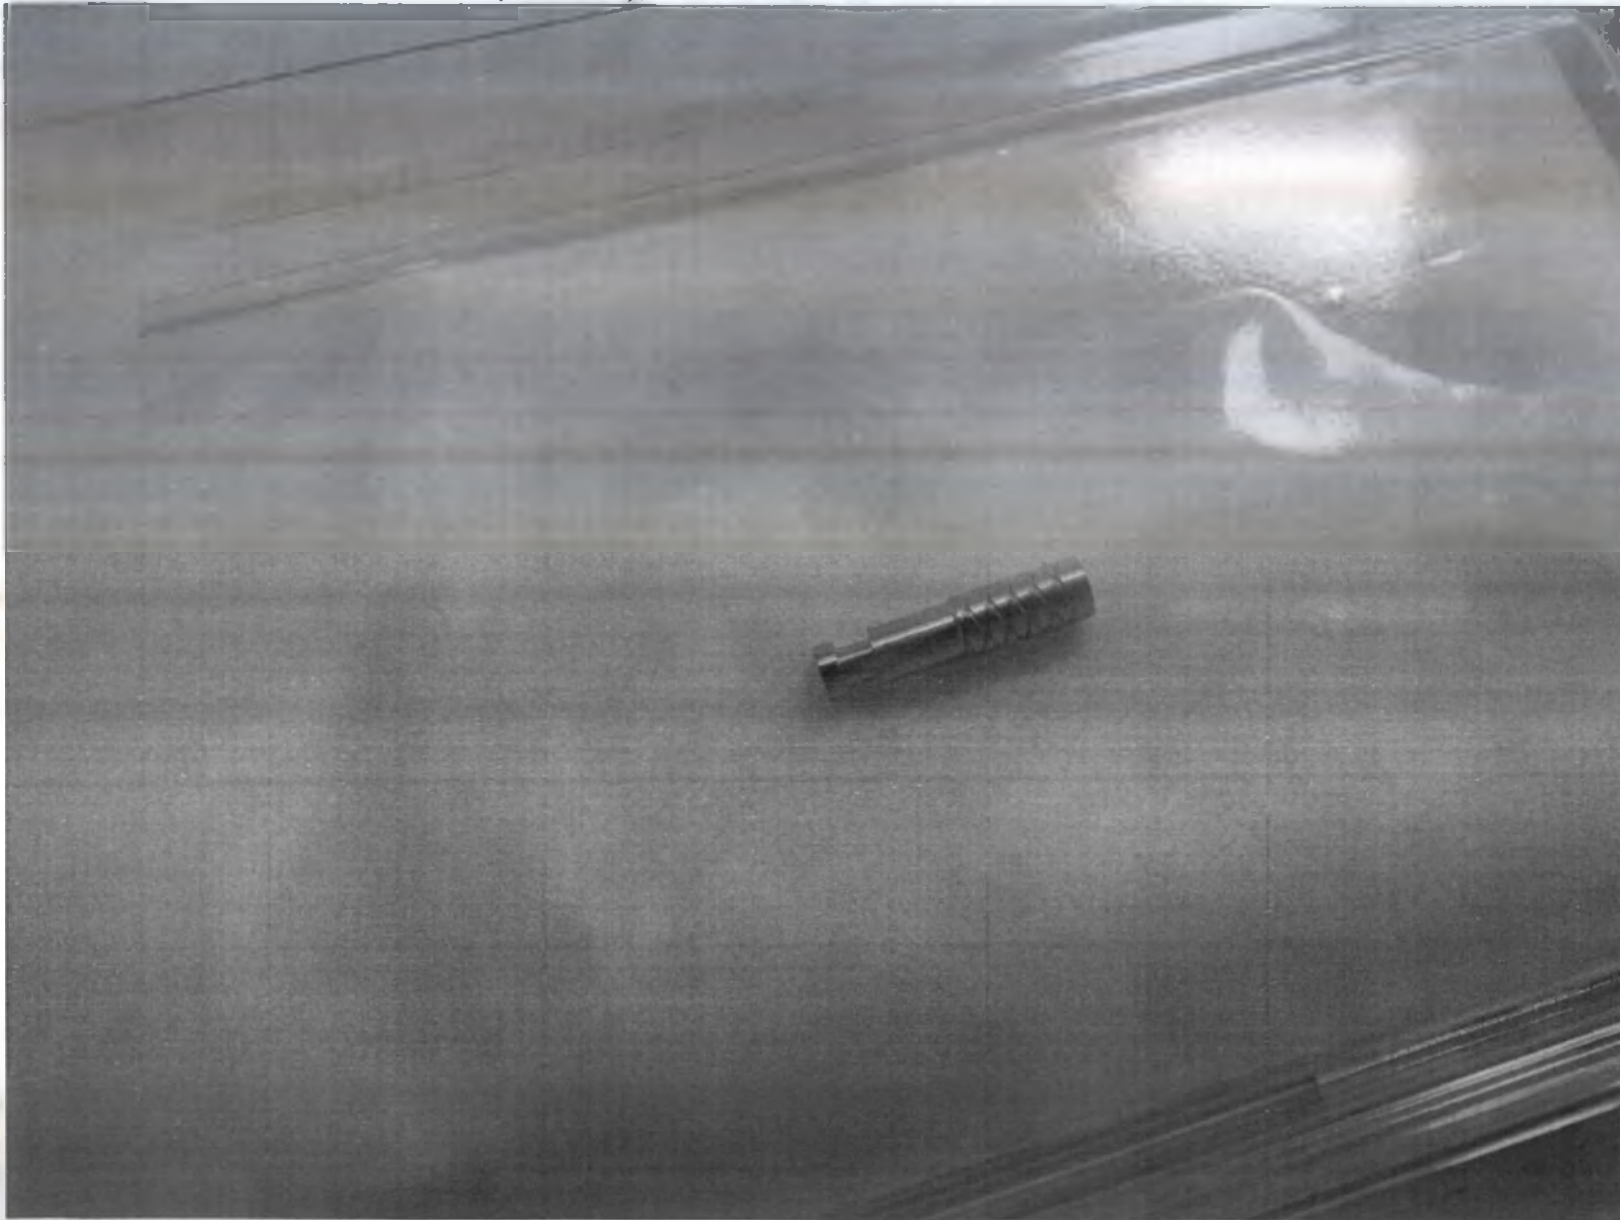

17.2. Аналог имплантата, с винтом (OPIA100);

17.3. Аналог имплантата, с винтом, 4 шт. в упаковке (OPIA100-4).

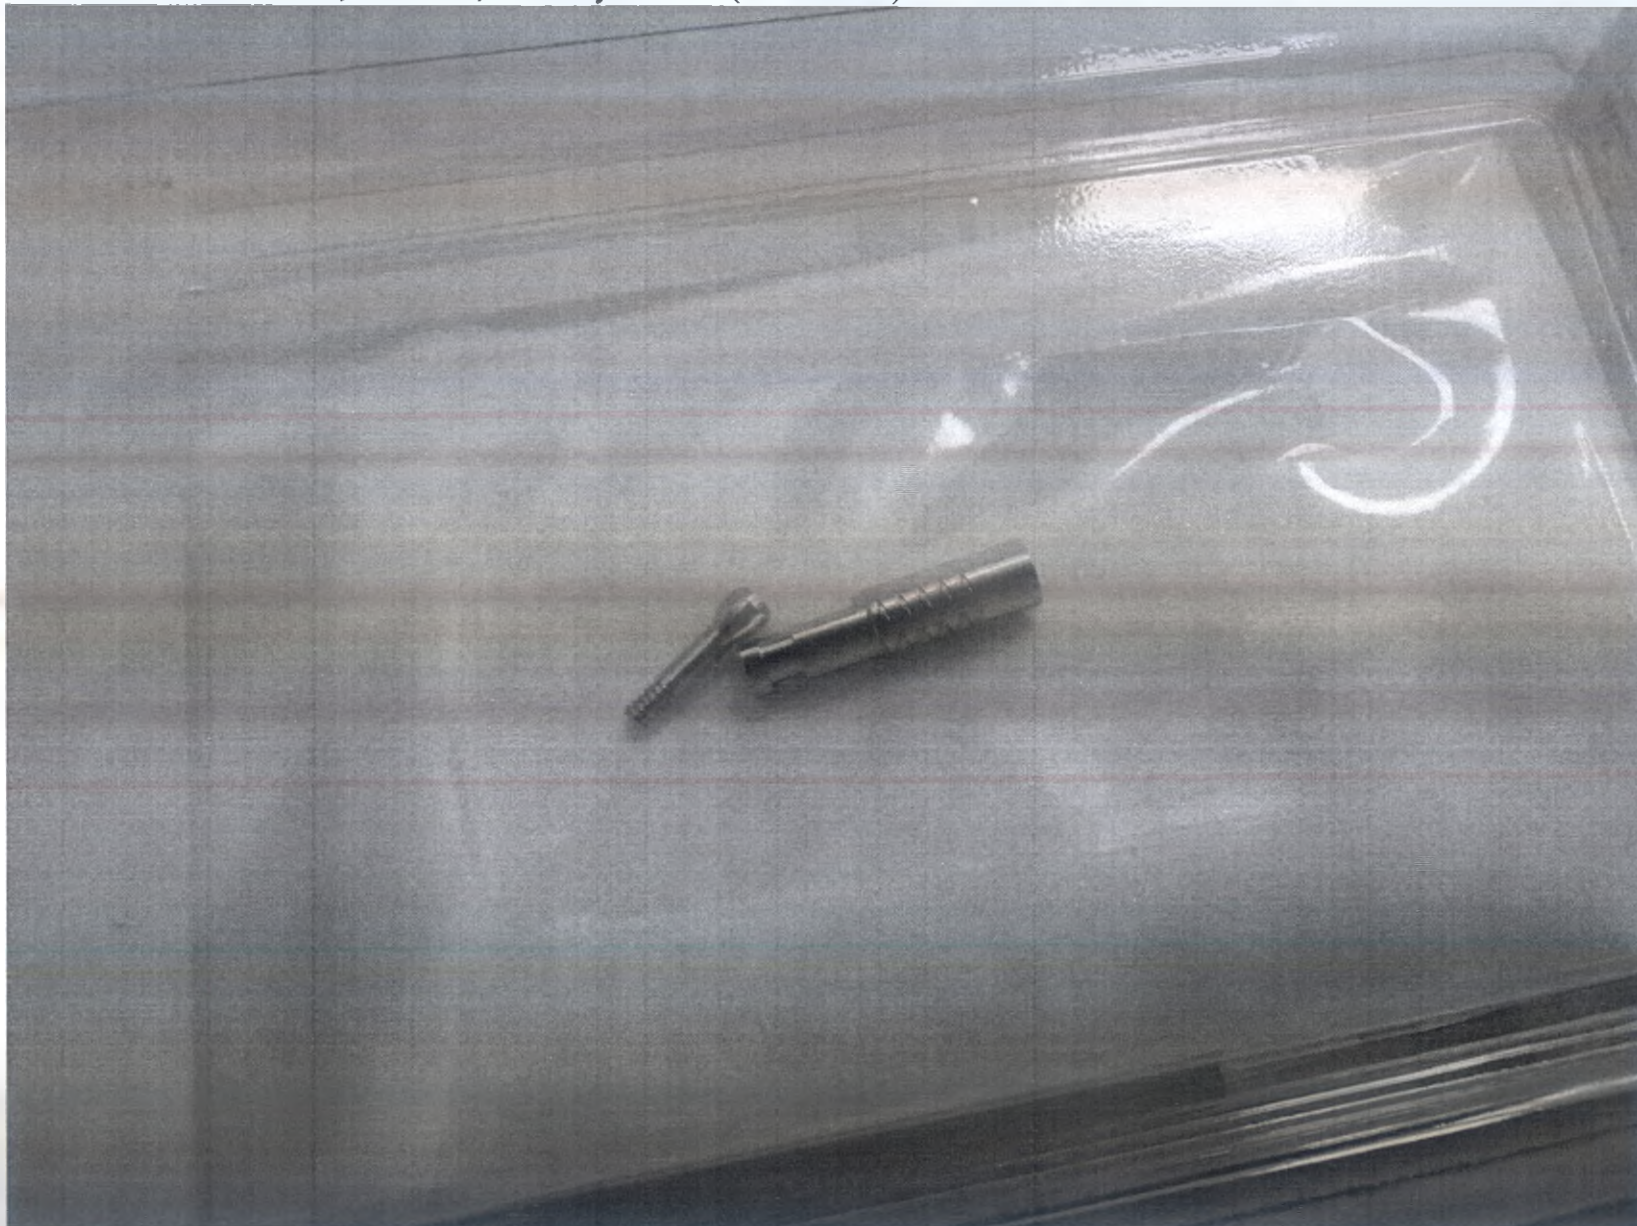

18. Аналог абатмента лабораторный:

18.1 Аналог абатмента (OPAT028);



18.2 Аналог абатмента LOCATOR, 4 шт. в упаковке (OPLA600);



- 18.3 Аналог стандартного абатмента Ø3.4 H4 (OPSA304);
- 18.4 Аналог стандартного абатмента Ø3.4 H6 (OPSA306);
- 18.5 Аналог стандартного абатмента Ø4.0 H4 (OPSA404);
- 18.6 Аналог стандартного абатмента Ø4.0 H6 (OPSA406);
- 18.7 Аналог стандартного абатмента Ø5.0 H4 (OPSA504);
- 18.8 Аналог стандартного абатмента Ø5.0 H6 (OPSA506);
- 18.9 Аналог стандартного абатмента Ø6.0 H4 (OPSA604);
- 18.10 Аналог стандартного абатмента Ø6.0 H6 (OPSA606);



18.11 Аналог абатмента MU Ø4.8, с винтом (MUA100);

18.12 Аналог абатмента MU Ø4.8, с винтом, 4 шт. в упаковке (MUA100-4);



18.13 Аналог абатмента MU Ø4.0, с винтом (MUNA100);

18.14 Аналог абатмента MU Ø4.0, с винтом, 4 шт. в упаковке (MUNA100-4);




18.15 Аналог абатмента MU Ø4.0, с 2 винтами (MUNPAC110);




18.16 Аналог абатмента MU Ø4.8 защитный (MUA200);

18.17 Аналог абатмента MU Ø4.8 защитный, 4 шт. в упаковке (MUA200-4);

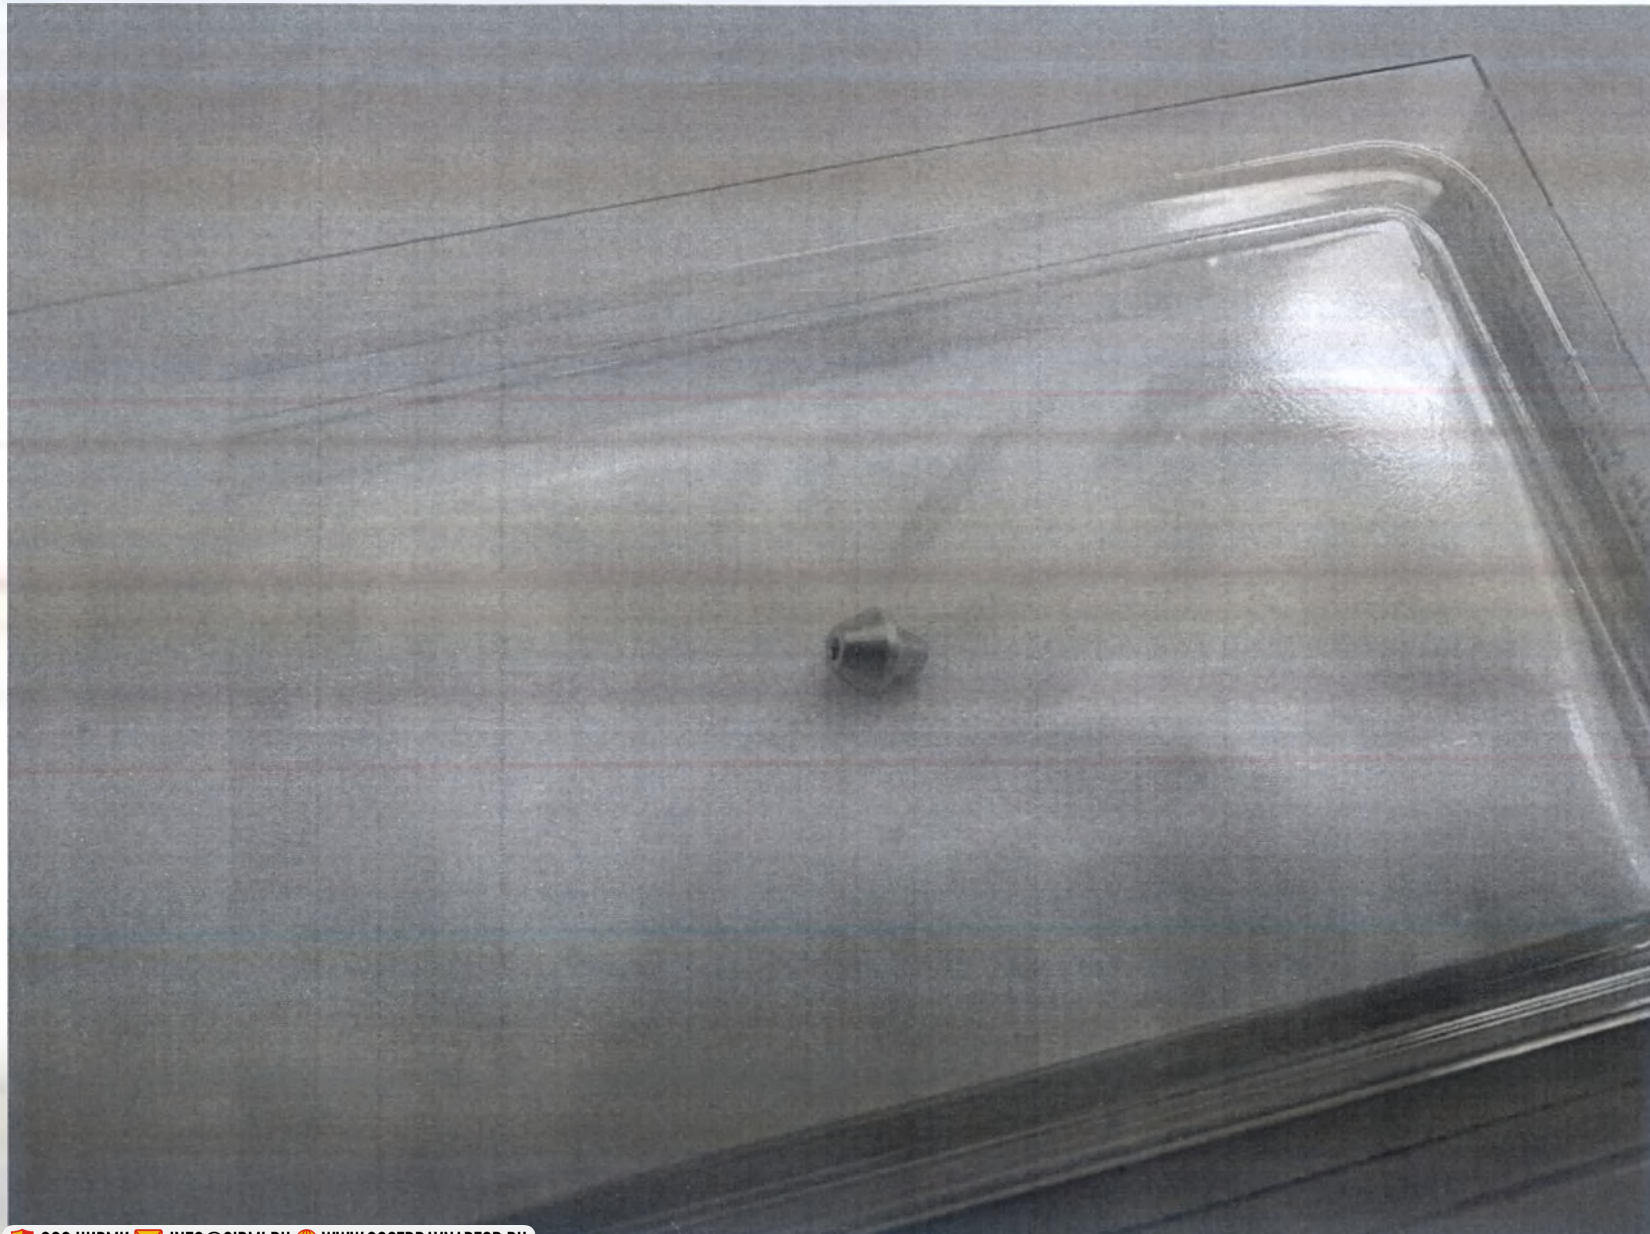


18.18 Аналог абатмента MU Ø4.0 защитный (MUNA200);

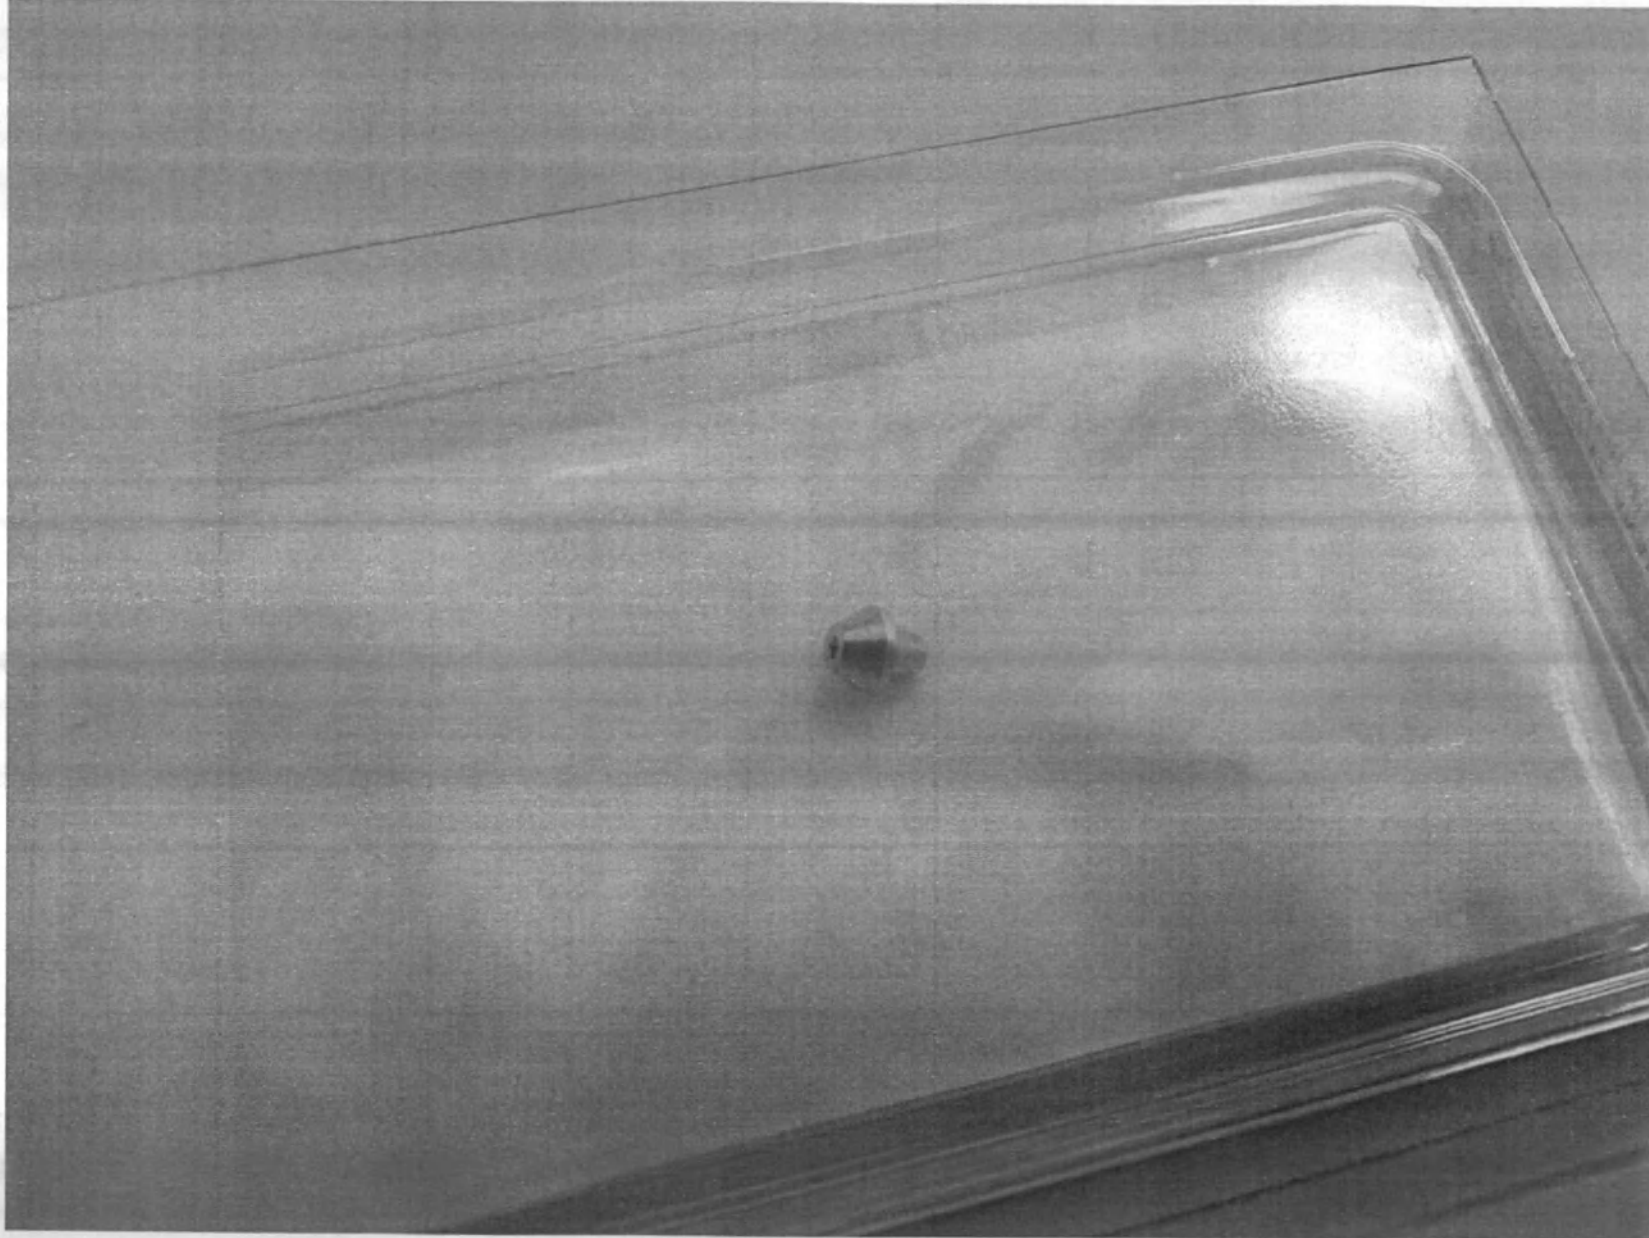


- 18.19 Аналог абатмента планировочный угловой 7° h0 (OPAF00-7);
- 18.20 Аналог абатмента планировочный угловой 7° H1 (OPAF01-7);
- 18.21 Аналог абатмента планировочный угловой 7° H2 (OPAF02-7);
- 18.22 Аналог абатмента планировочный угловой 7° H3 (OPAF03-7);
- 18.23 Аналог абатмента планировочный угловой 7° H4 (OPAF04-7);




- 18.24 Аналог абатмента планировочный угловой 15° Н0 (ОРАФ001);
- 18.25 Аналог абатмента планировочный угловой 15° Н1 (ОРАФ011);
- 18.26 Аналог абатмента планировочный угловой 15° Н2 (ОРАФ021);
- 18.27 Аналог абатмента планировочный угловой 15° Н3 (ОРАФ031);
- 18.28 Аналог абатмента планировочный угловой 15° Н4 (ОРАФ041);

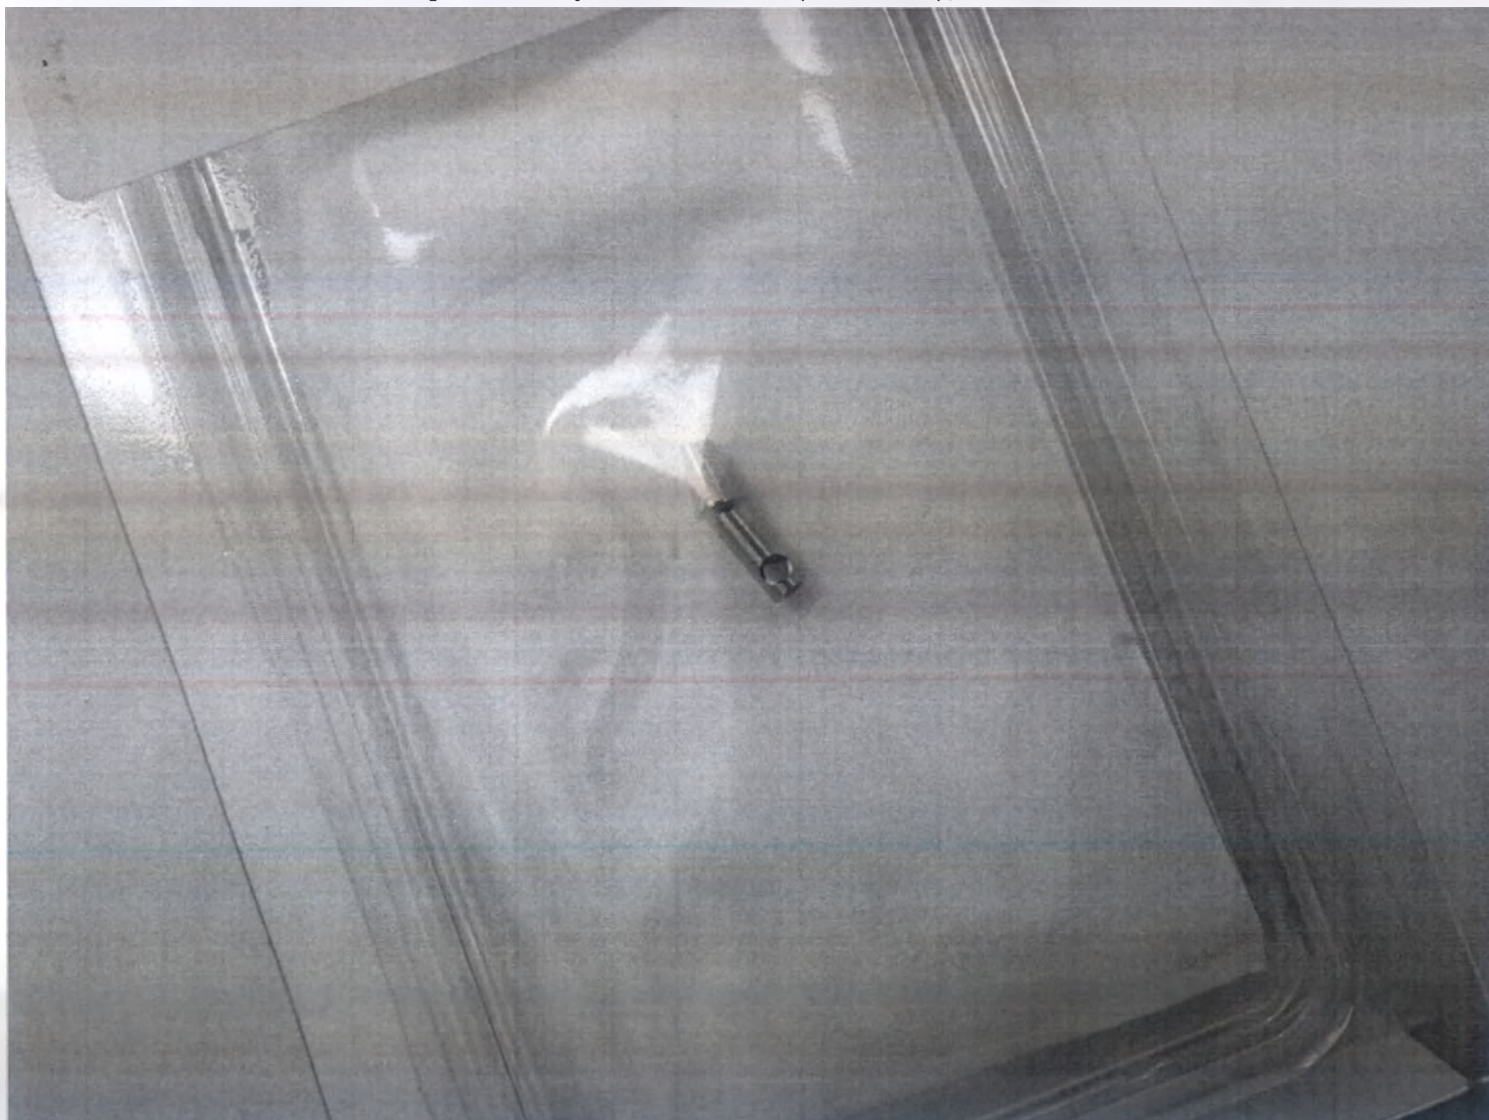


- 18.29 Аналог абатмента планировочный угловой 23° Н0 (ОРАФ002);
- 18.30 Аналог абатмента планировочный угловой 23° Н1 (ОРАФ012);
- 18.31 Аналог абатмента планировочный угловой 23° Н2 (ОРАФ022);
- 18.32 Аналог абатмента планировочный угловой 23° Н3 (ОРАФ032);
- 18.33 Аналог абатмента планировочный угловой 23° Н4 (ОРАФ042);

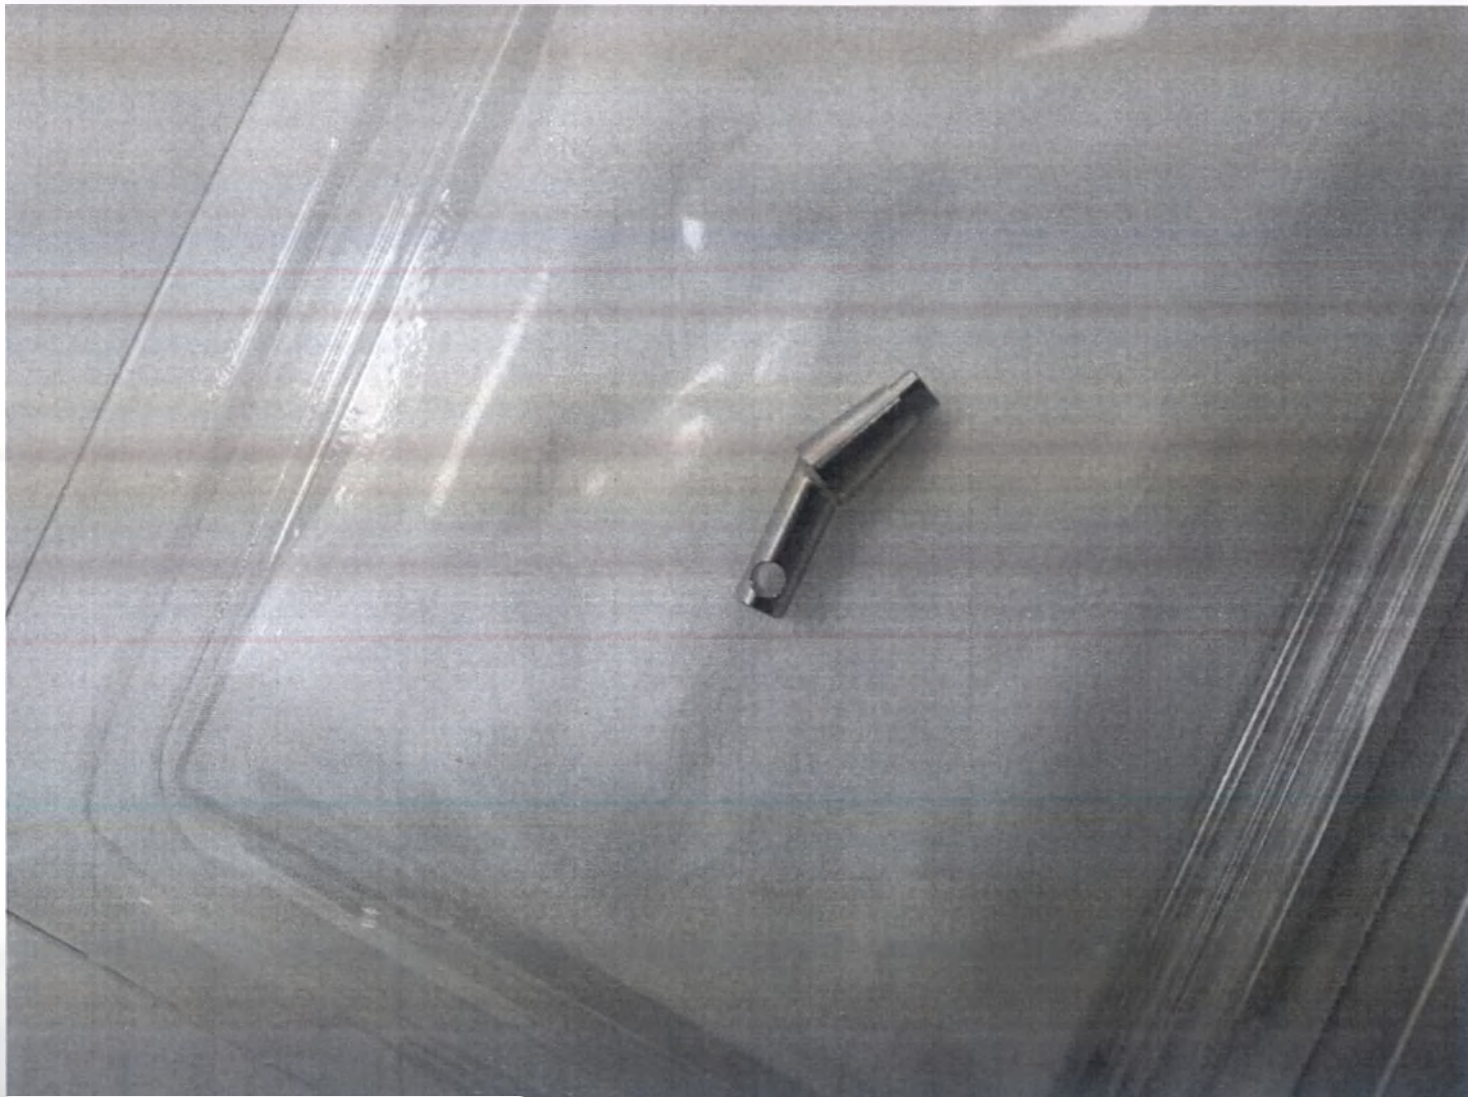


- 18.34 Аналог абатмента планировочный прямой 0° Н1 (ОРАФ210);
- 18.35 Аналог абатмента планировочный прямой 0° Н2.5 (ОРАФ220);
- 18.36 Аналог абатмента планировочный прямой 0° Н4.0 (ОРАФ240);
- 18.37 Аналог абатмента планировочный прямой 0° Н5.5 (ОРАФ250);

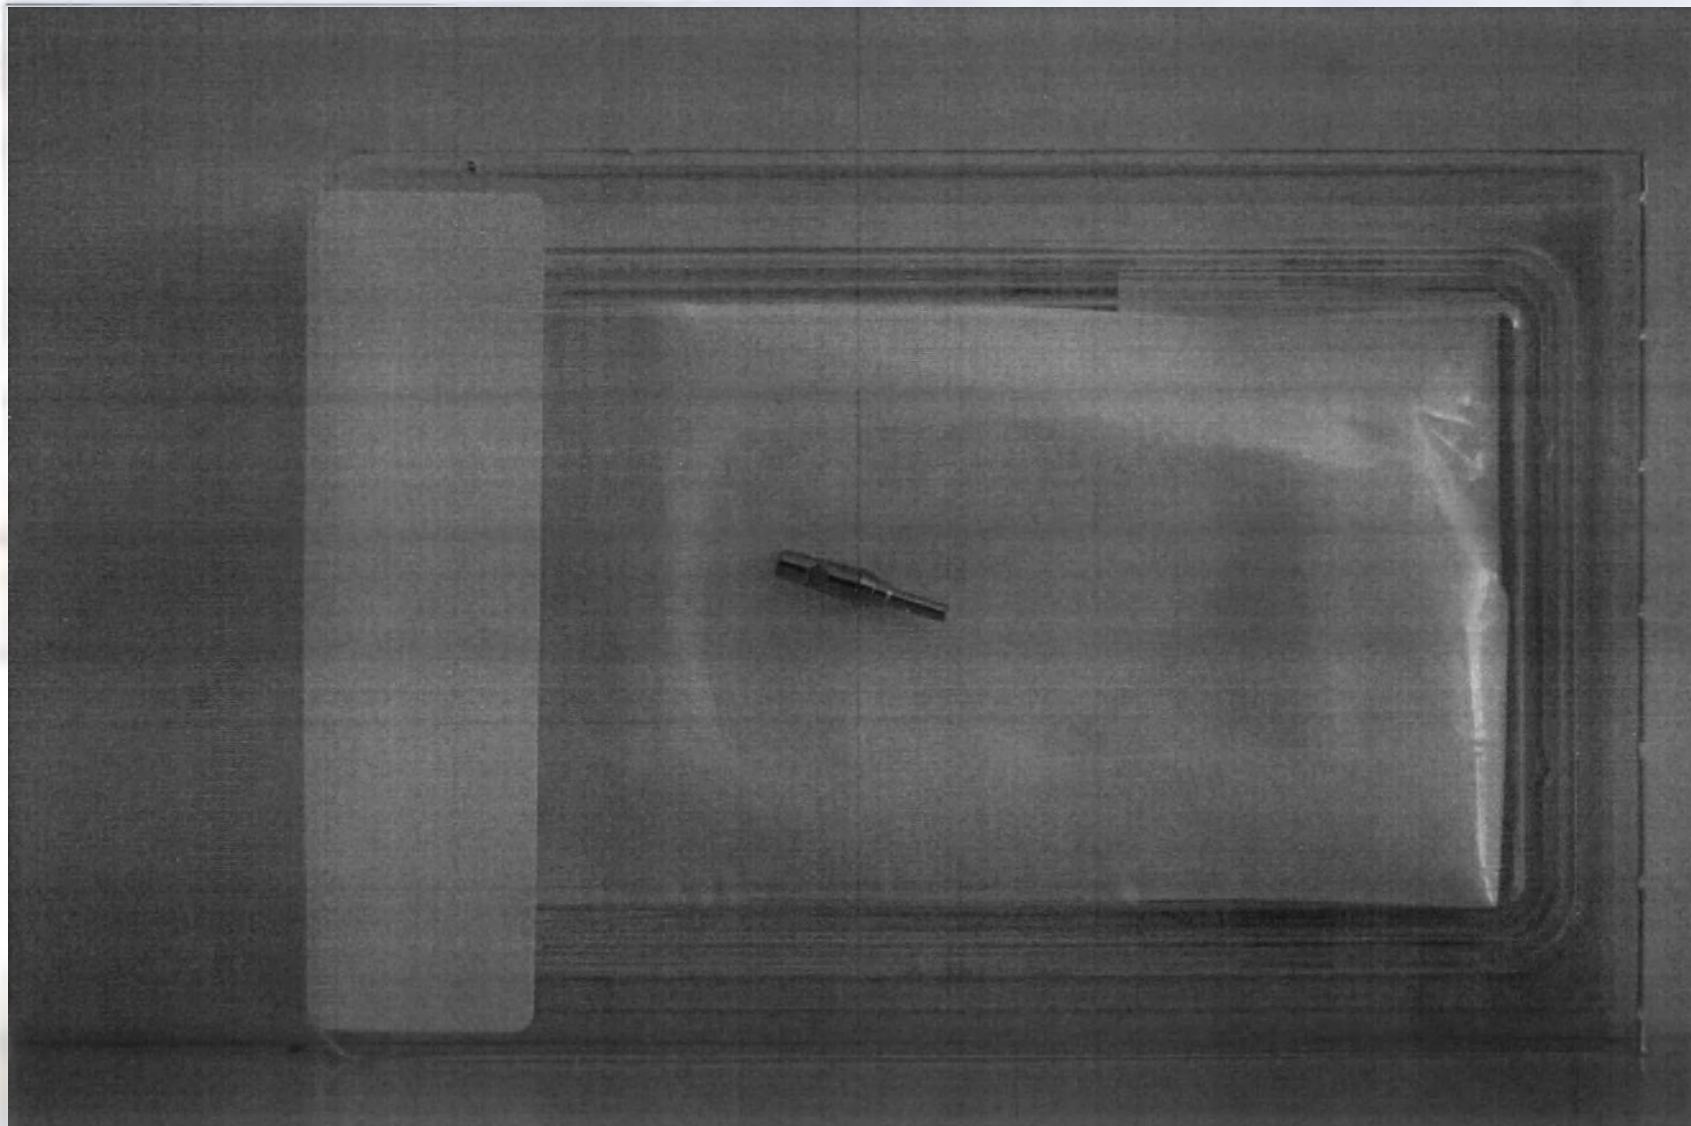


- 18.38 Аналог абатмента планировочный угловой 7° Н1 (ОРАФ211);
- 18.39 Аналог абатмента планировочный угловой 7° Н2.5 (ОРАФ221);
- 18.40 Аналог абатмента планировочный угловой 7° Н4.0 9 (ОРАФ241);
- 18.41 Аналог абатмента планировочный угловой 7° Н5.5 (ОРАФ251);

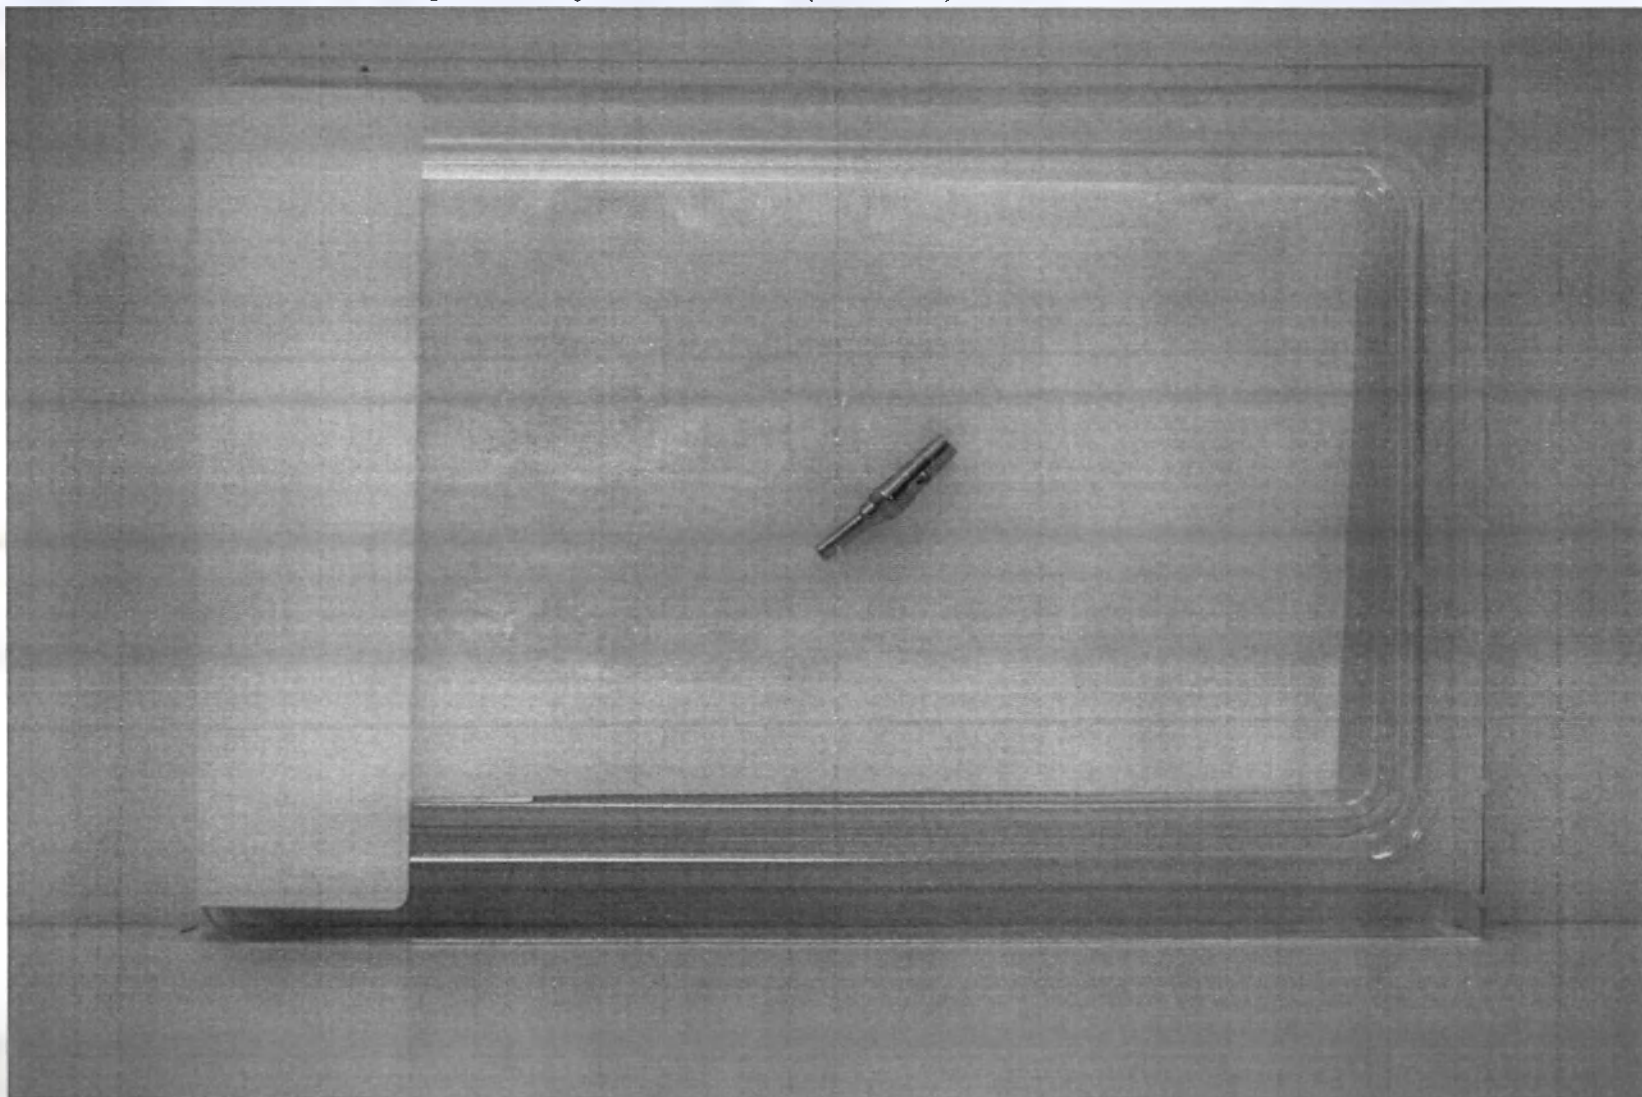

- 18.42 Аналог абатмента планировочный угловой 15° H1 (OPAF212);
- 18.43 Аналог абатмента планировочный угловой 15° H2.5 (OPAF222);
- 18.44 Аналог абатмента планировочный угловой 15° H4.0 (OPAF242);
- 18.45 Аналог абатмента планировочный угловой 15° H5.5 (OPAF252);

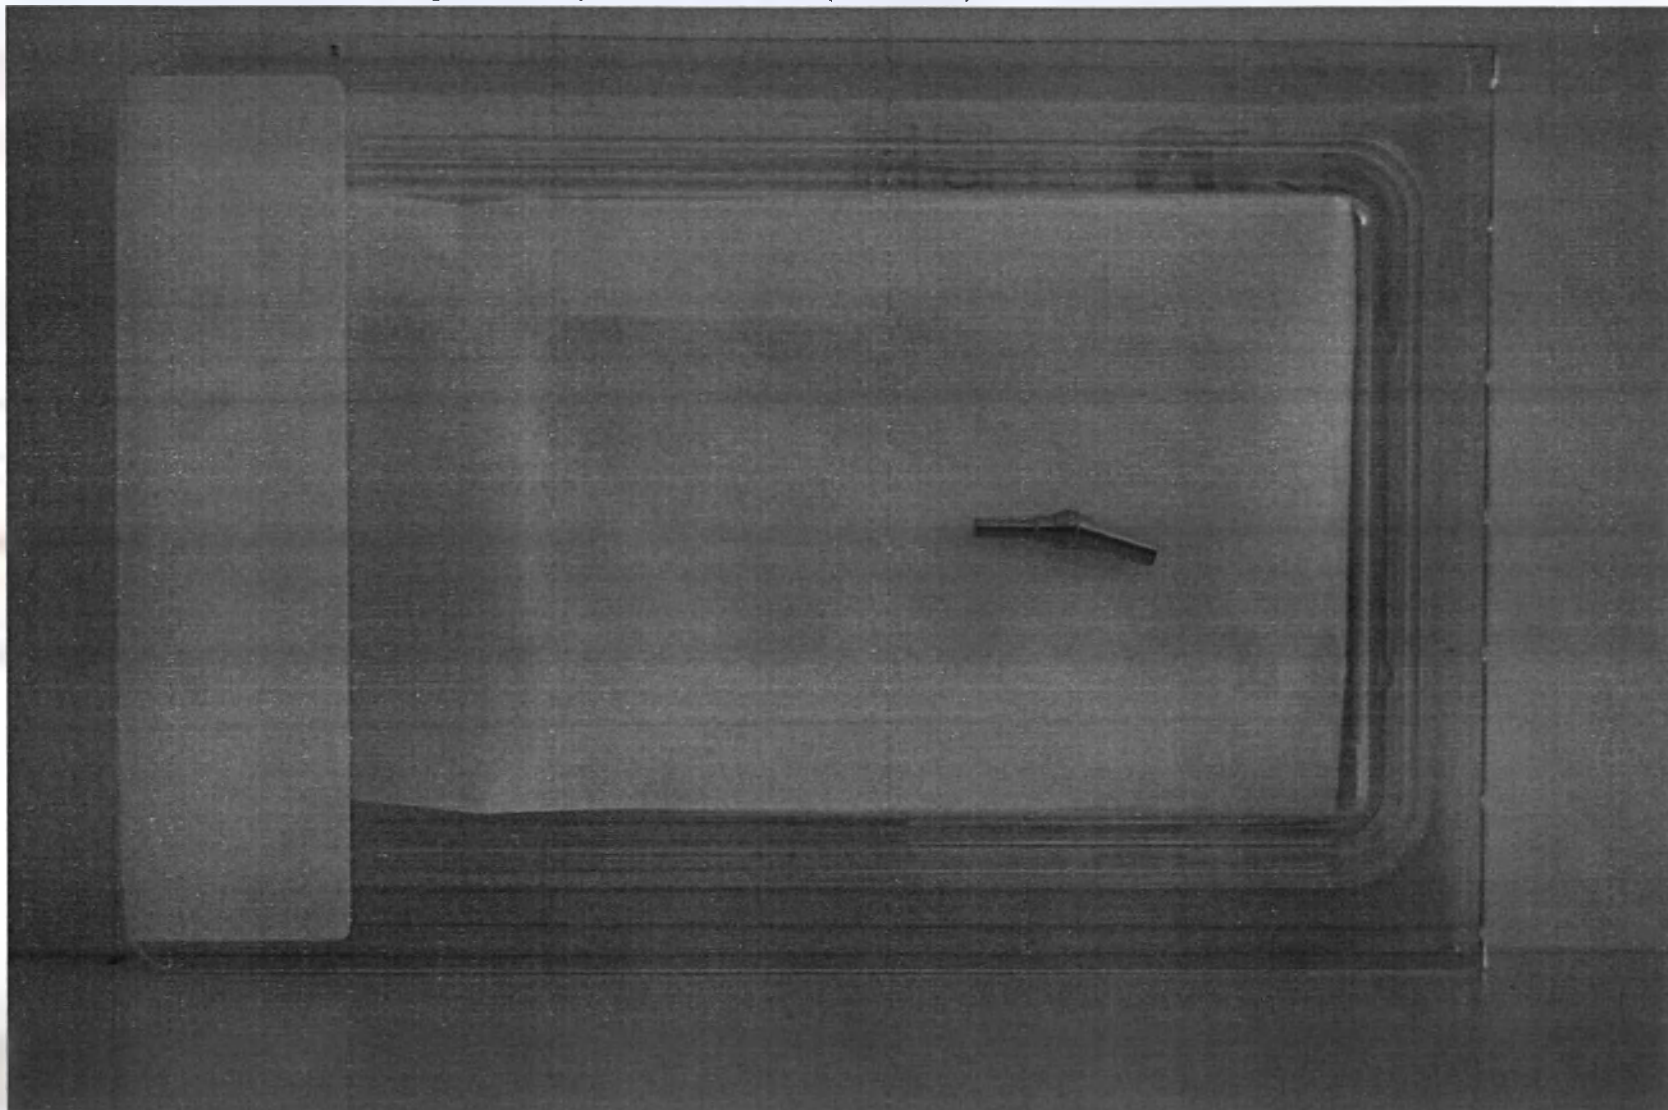


- 18.46 Аналог абатмента планировочный угловой 23° Н1 (ОРАФ213);
- 18.47 Аналог абатмента планировочный угловой 23° Н2.5 (ОРАФ223);
- 18.48 Аналог абатмента планировочный угловой 23° Н4.0 (ОРАФ243);
- 18.49 Аналог абатмента планировочный угловой 23° Н5.5 (ОРАФ253);

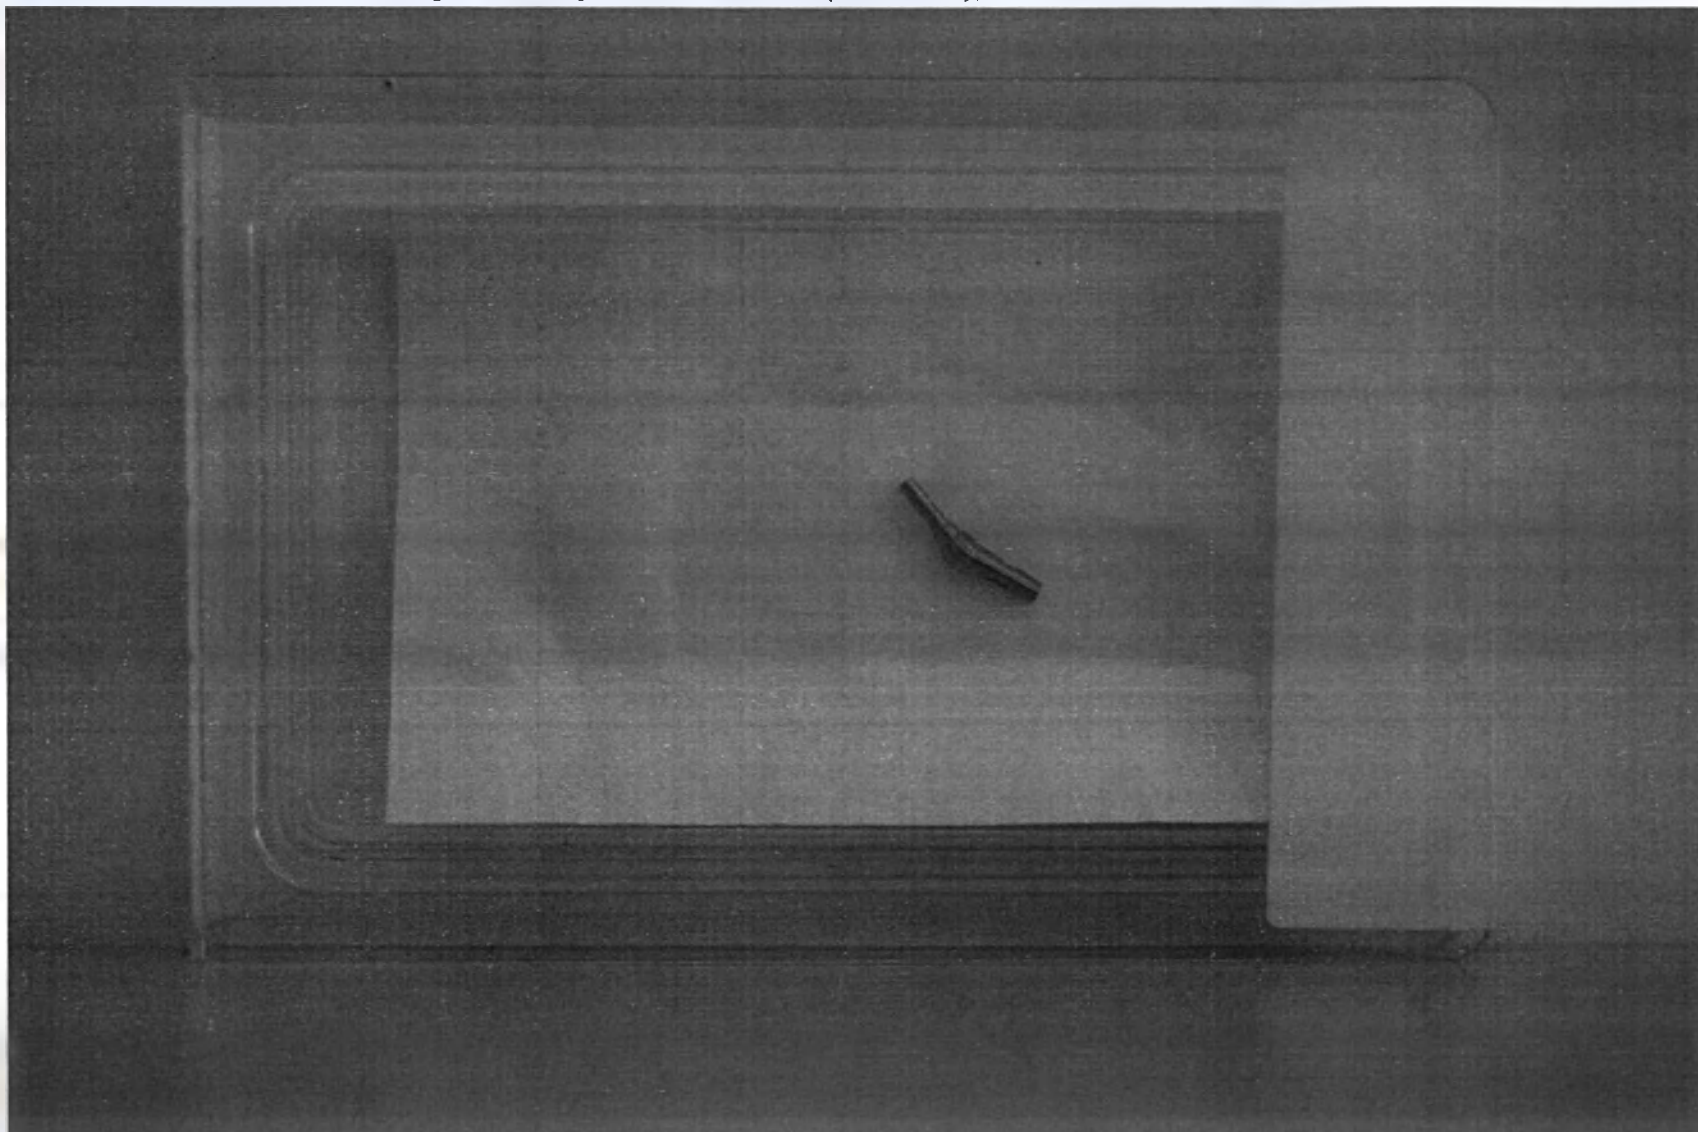

- 18.50 Аналог абатмента планировочный прямой h0 H6 (OPSF006);
- 18.51 Аналог абатмента планировочный прямой h1 H6 (OPSF016);
- 18.52 Аналог абатмента планировочный прямой h2 H6 (OPSF026);
- 18.53 Аналог абатмента планировочный прямой h3 H6 (OPSF036);
- 18.54 Аналог абатмента планировочный прямой h4 H6 (OPSF046);



18.55 Аналог абатмента для сканирования для имплантата AXIOM REG/PX, с винтом (152-27-SAA).

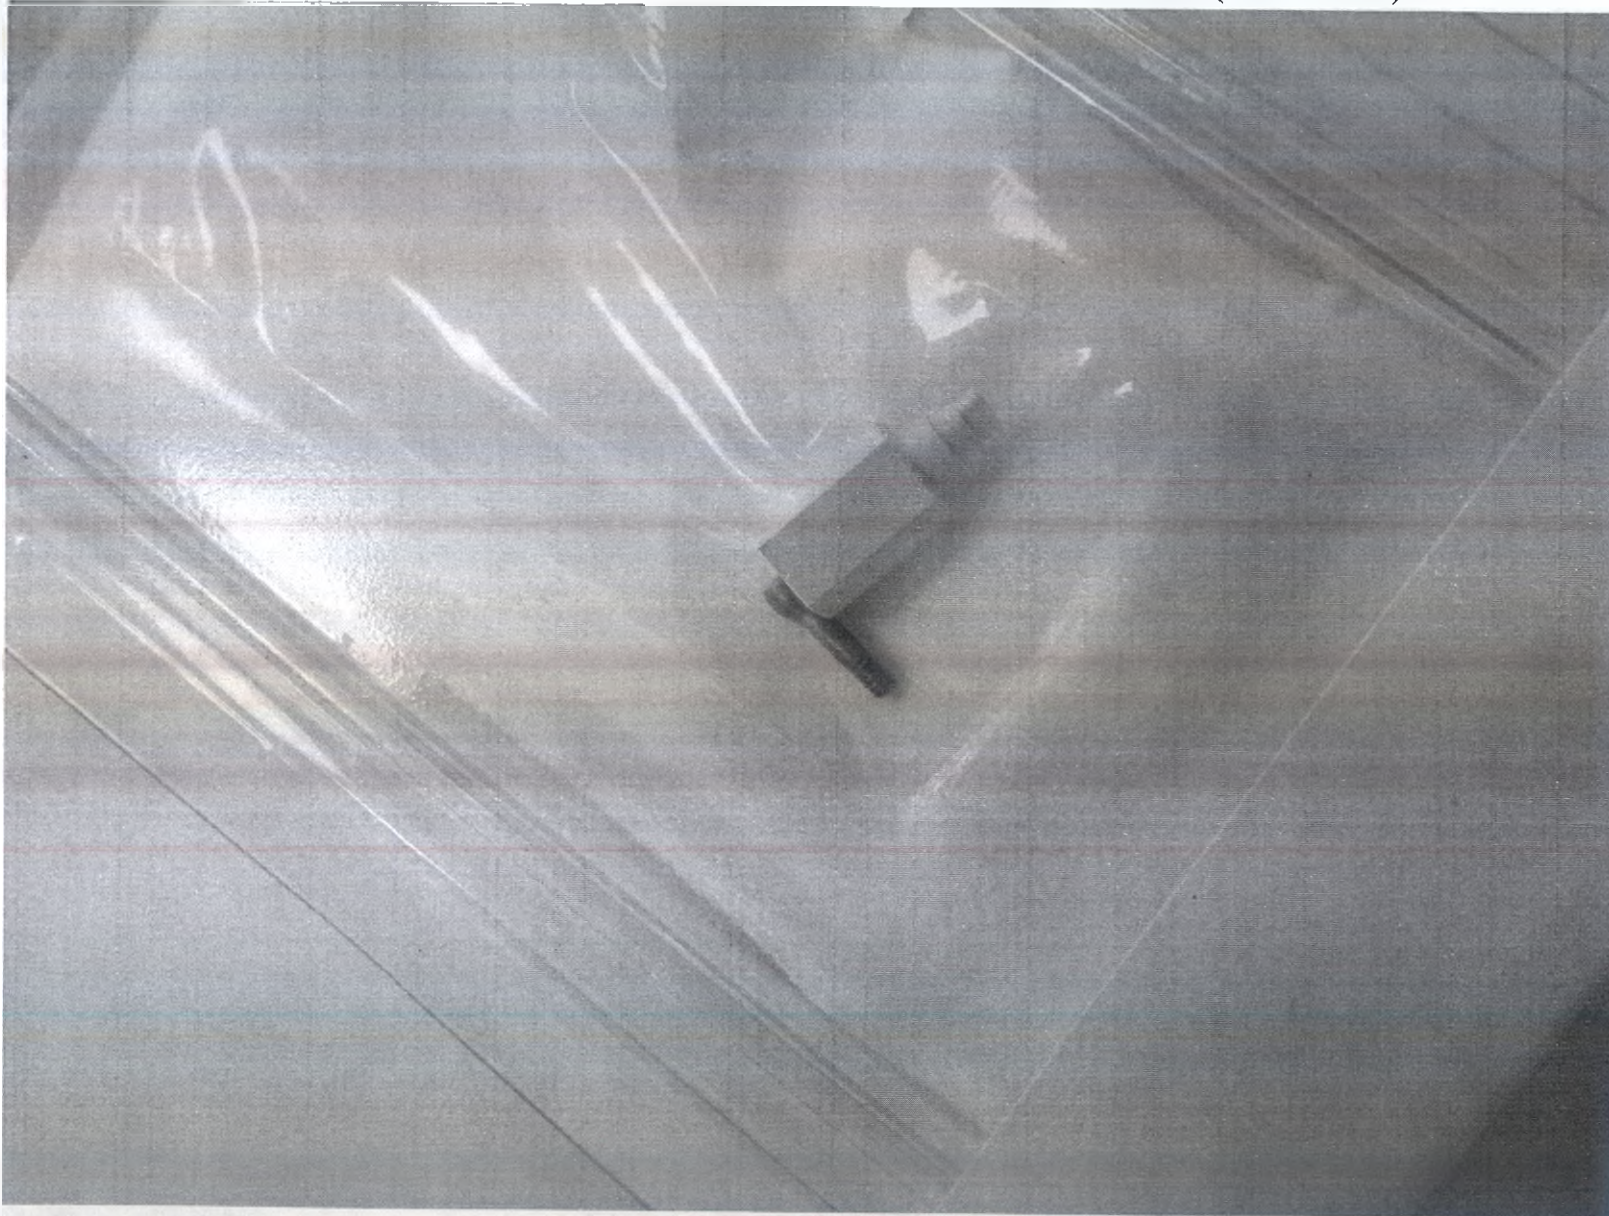


**19. Удлинитель для инструмента:**  
**19.1. Удлинитель для мандрели (INEXM);**



## 20. Лоток:


### 20.1. Лоток для ограничителей сверл (INKITOPDSV)

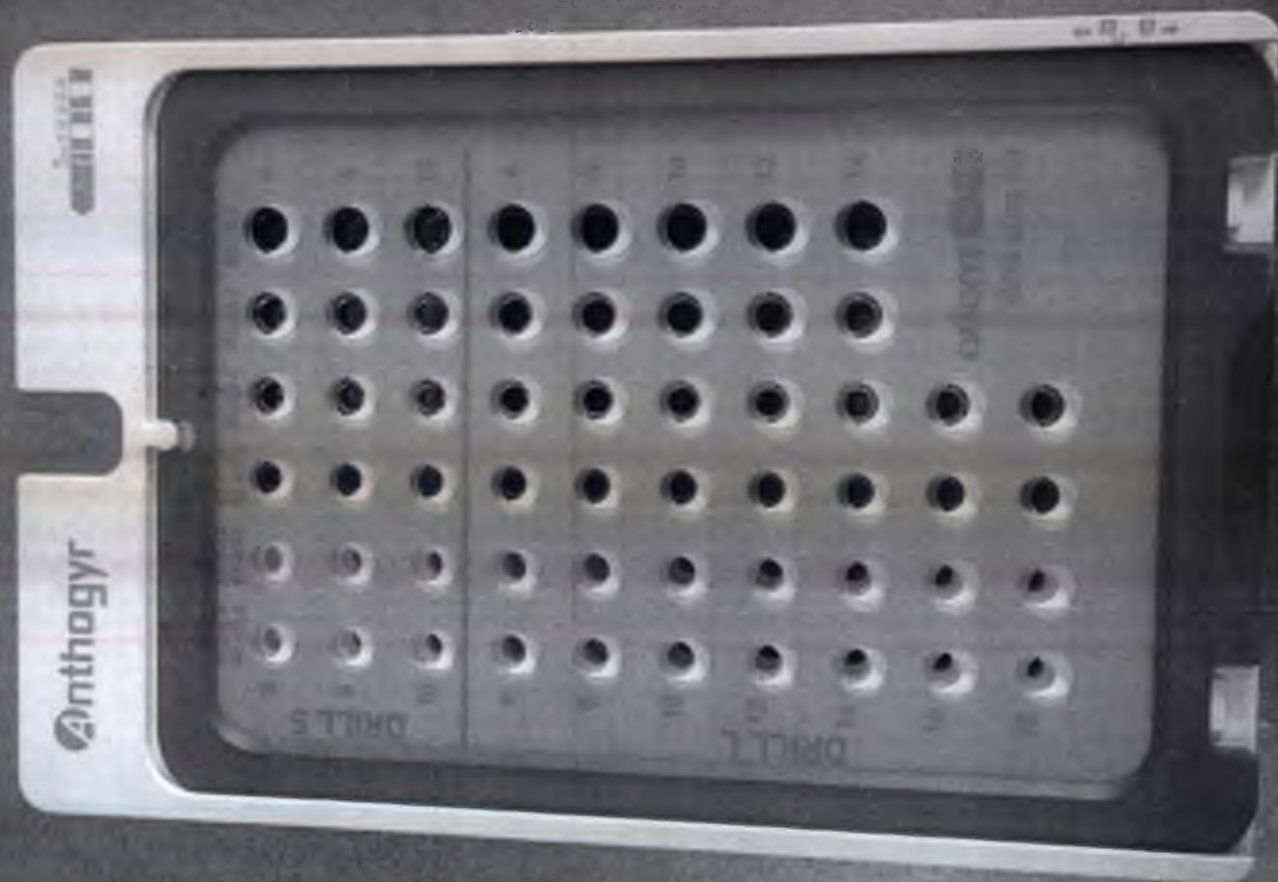

20.2. Лоток для набора хирургического (INMODOP28V)




20.3. Лоток для набора ортопедического (INMODOPPV)

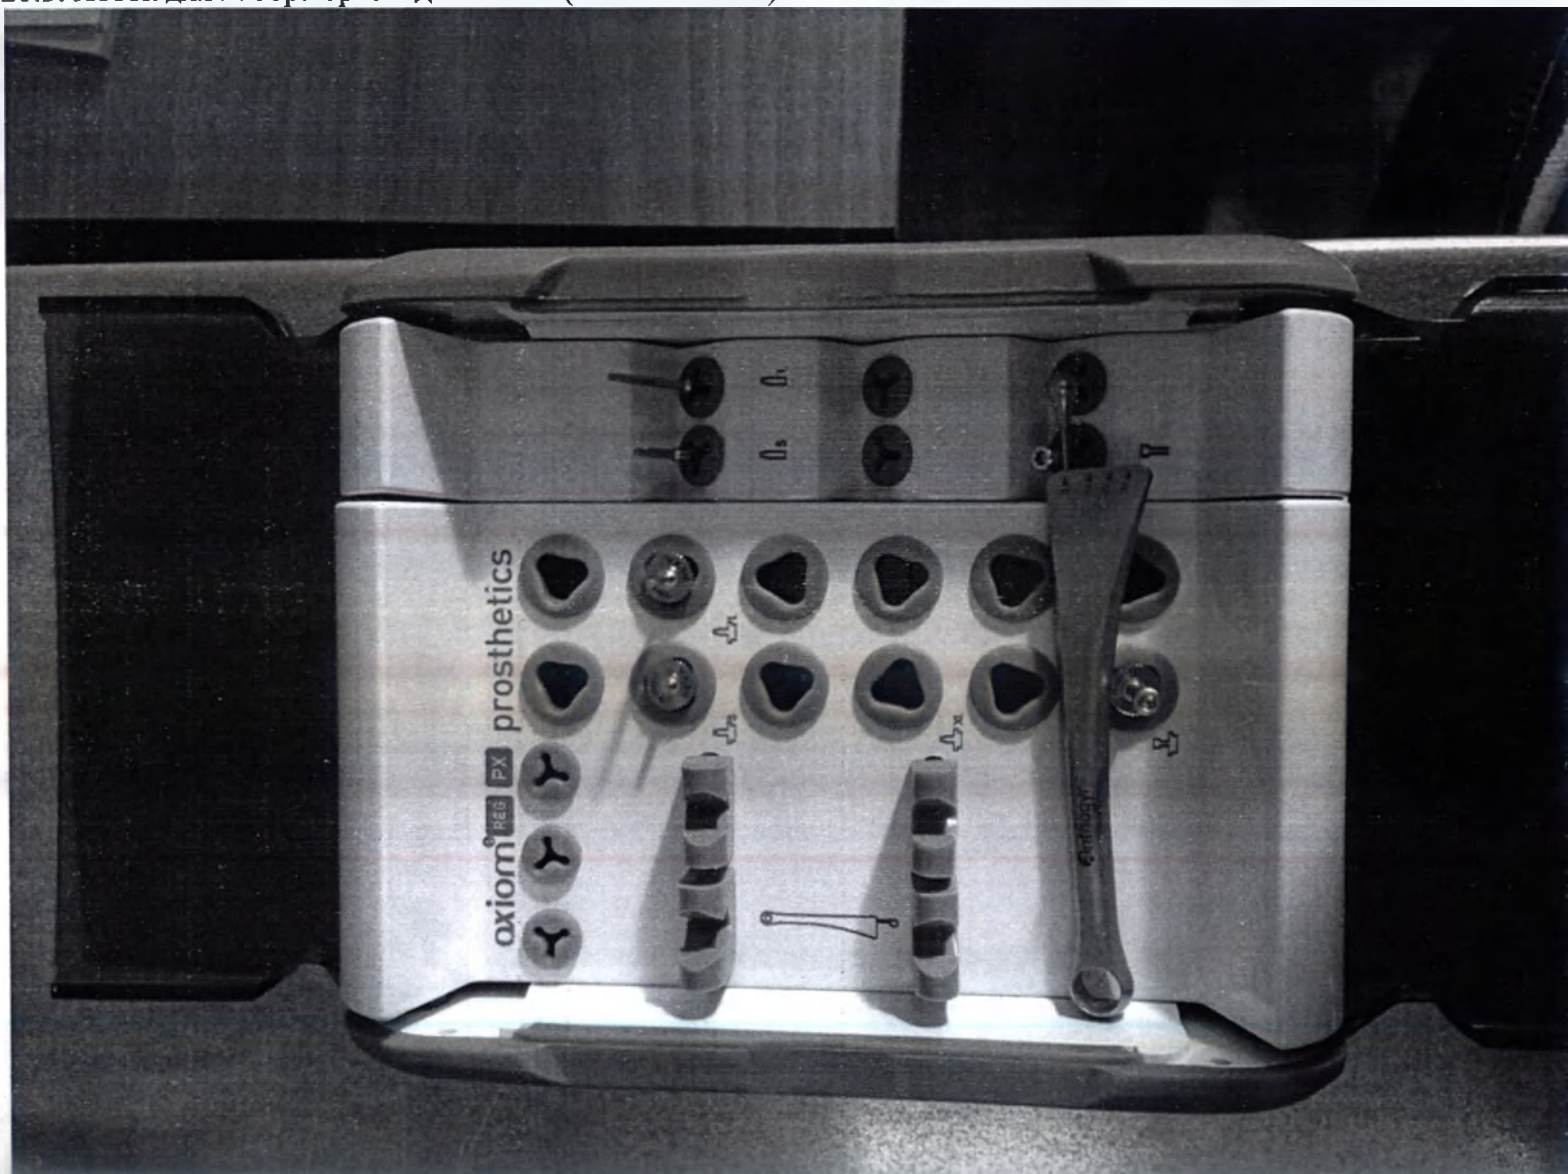

20.4. Лоток для набора хирургического (INMODOPS2V)



20.6. Лоток для набор вспомогательного AXIOM REG/PX (INMODOPSAKV)

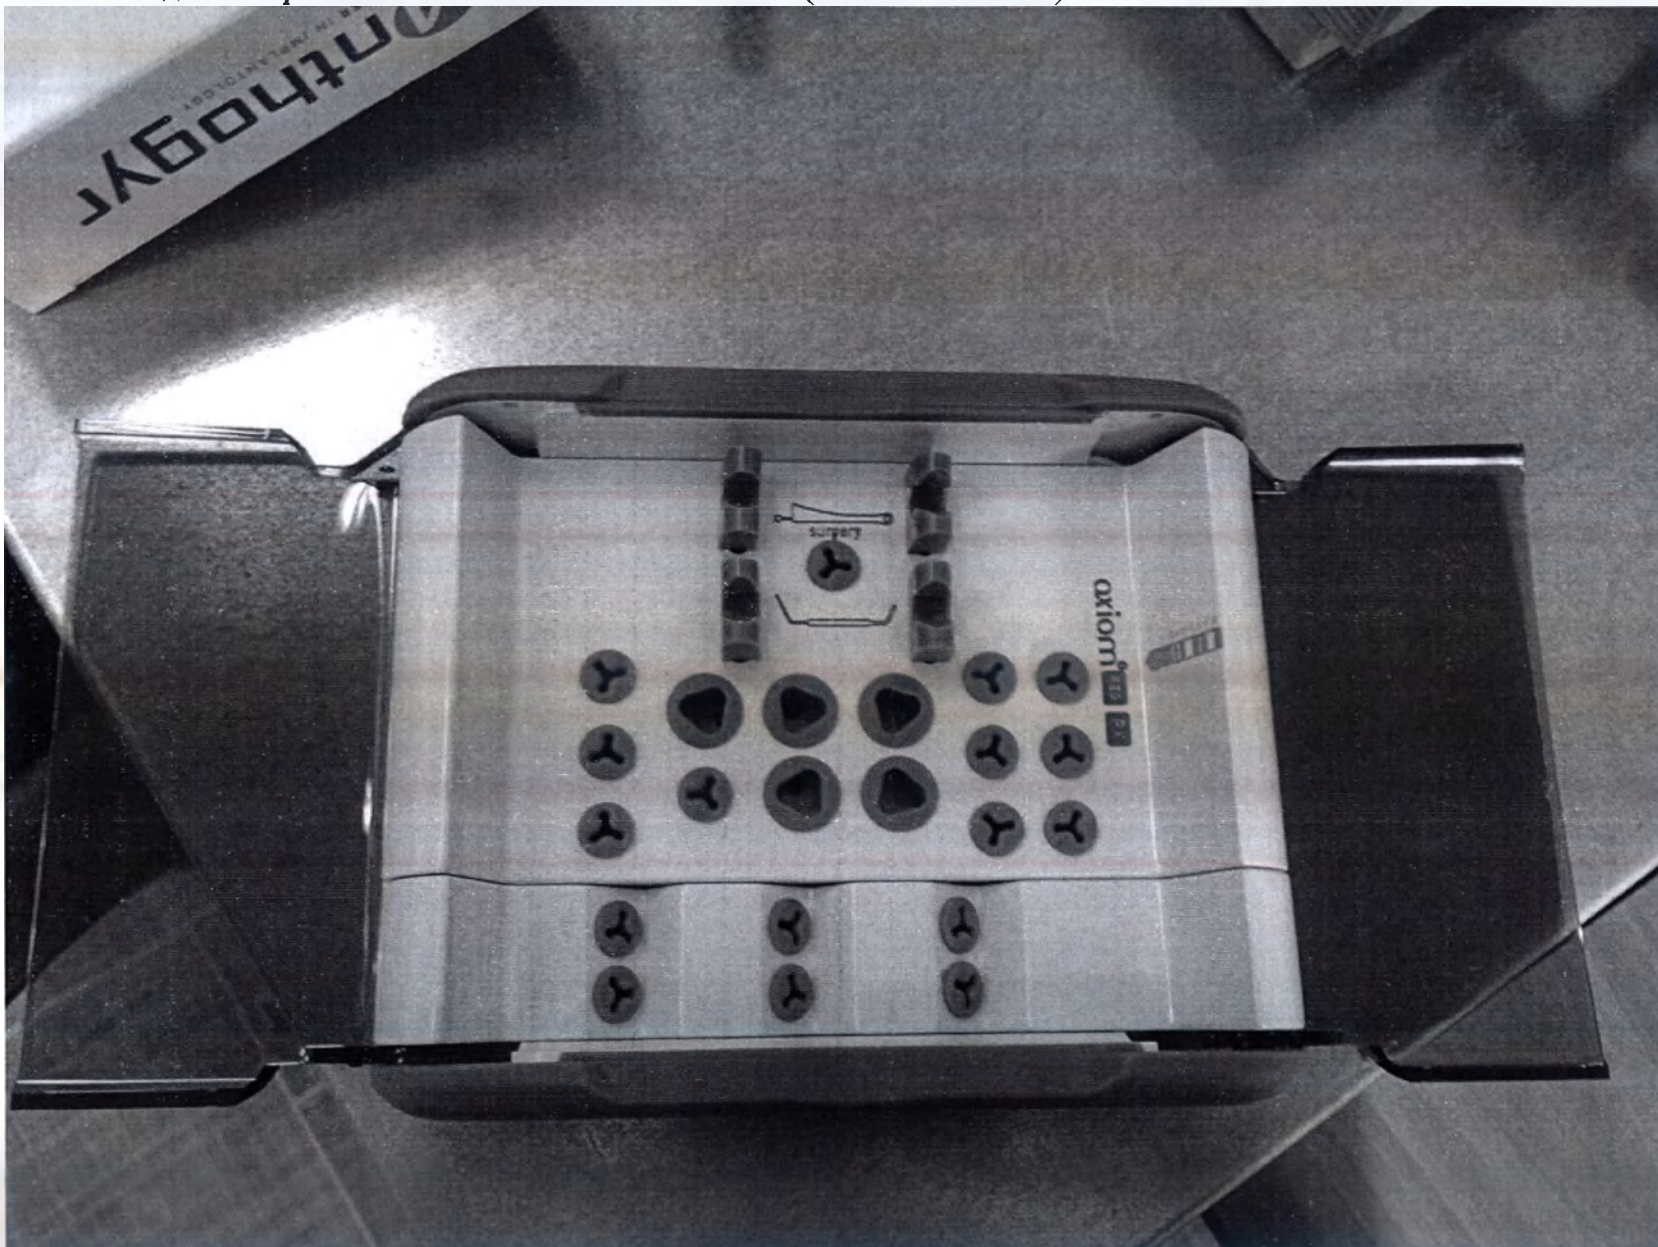


## 21. Калибровочный шаблон:

### 21.1 Калибровочный шаблон (OPFC\_NOT);


## Film de Calibrage X-Ray Template

**axiom<sup>®</sup> REG**

Ø 3.4

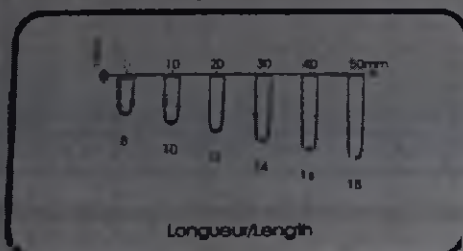


Ø 4.0

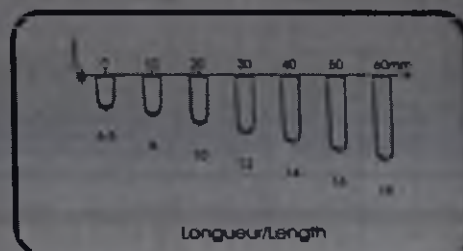


Ech / Scale  
1.0 : 1

Ø 4.6

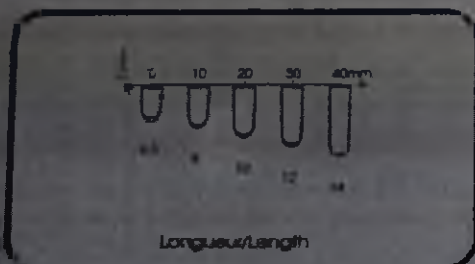

Ø 5.2

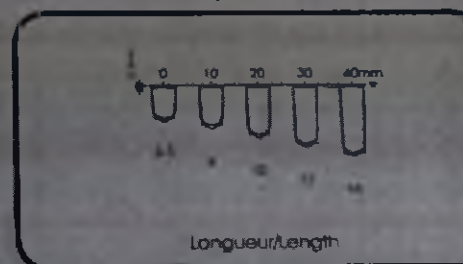

0 mm  
10 mm  
20 mm  
30 mm

Pointe last  
Dét bottom

La ligne horizontale correspond au niveau juto creux  
The horizontal line corresponds to the juto creased level

CE 0459

Préparation des films de calibrage : 14-17  
For more details on film de calibrage techniques  
(impression, étirage, déchirure)

Préparation of the calibrating film : 14-17  
Do not use the calibration film if it is damaged  
(print quality, tear...)

Ce document ne doit pas être reproduit  
This document must not be copied

**Anthogyr**


74700 SALLANCHES - FRANCE  
Phone : +33(0)4 50 88 02 37  
Fax : +33(0)4 50 83 78 80  
www.anthogyr.com

21.2 Калибровочный шаблон для имплантатов 2.8 (OPFC28\_NOT);


# Film de Calibrage X-Ray Template

## axiom<sup>®</sup> 2.8


Ech / Scale 1.0:1

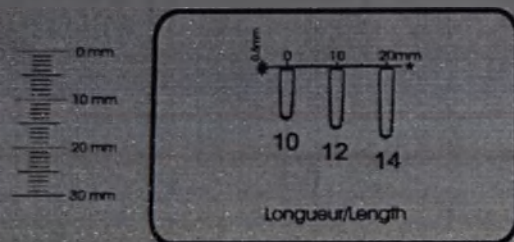

Ech / Scale 1.3:1

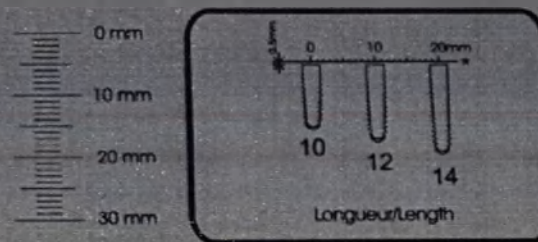

Ech / Scale 1.7:1

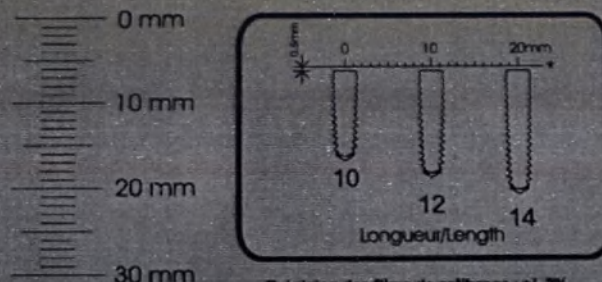

Pointe foret  
Dill bottom

\* La ligne horizontale correspond au niveau justo-cristal  
The horizontal line corresponds to the justo-cristal level

OPFC28\_NOT - 8818-01



Précision des films de calibrage : +/- 2%  
Ne pas utiliser un film de calibrage détérioré  
(impression altérée, déchirure, ...)

Precision of the calibrating film : +/- 2%  
Do not use the calibration film if it is damaged  
(poor print quality, tear...)

Ce document ne doit pas être reproduit.  
This document must not be copied.

### Anthogyr

74700 SALLANCHES - FRANCE

Phone : +33(0)4 50 58 02 37

Fax : +33(0)4 50 93 78 60

www.anthogyr.com

Film de Calibrage  
X-Ray Template

Ech / Scale  
1.7 : 1

**axiom<sup>®</sup> PX**

Ø 3.4

Ø 4.6

Ø 4.0

Ø 5.2

Pointe foret  
Dell bottom

Précision des films de calibrage :  $\pm 0.2\%$   
Ne pas utiliser un film de calibrage défectueux  
(impression altérée, déchirure, ...)

Accuracy of the calibration film :  $\pm 0.2\%$   
Do not use the calibration film if it is damaged  
(color print quality, tear, ...)

Ce document ne doit pas être reproduit.  
This document must not be copied.

\* La ligne horizontale correspond au niveau juxta-crânial  
The horizontal line corresponds to the juxta-crânial level

CE 0459


**Anthogyr**

74700 SALLANCHES - FRANCE  
Phone : +33(0)4 58 58 82 37  
Fax : +33(0)4 58 58 75 40  
www.anthogyr.com


# Film de Calibrage X-Ray Template

axiom® PX

Ø 3.4

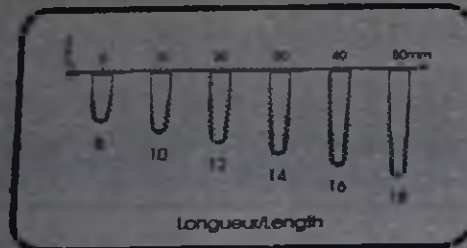

Ø 4.6

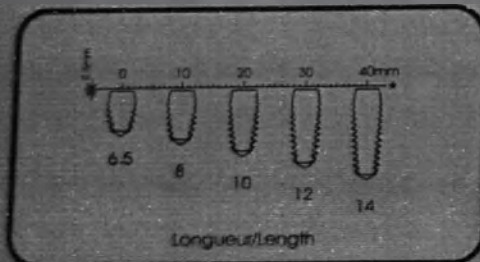

Ech / Scale  
1.3 : 1

0 mm


10 mm

20 mm


30 mm

Pointe force  
Dell (center)

Ø 4.0

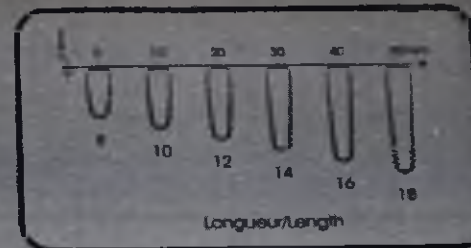

Ø 5.2

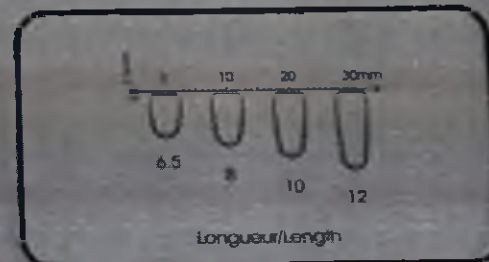

\* La ligne horizontale correspond au niveau Judo-Ortop  
The horizontal line corresponds to the Judo-Ortop level

CE 0450

Precision des films de calibrage : +/- 2%  
Ne pas utiliser un film de calibrage détérioré  
(impression altérée, déchirure...)

Precision of the calibration : +/- 2%  
Do not use the calibration film if it is damaged  
(poor print quality, tear...).

Ce document ne doit pas être reproduit.  
This document must not be copied.

Anthogyr

74700 SALLANCHES - FRANCE

Phone : +33(0)4 50 58 02 37


Fax : +33(0)4 50 93 78 63

www.anthogyr.com

# Film de Calibrage X-Ray Template


axiom<sup>®</sup> PX

Ø 3.4

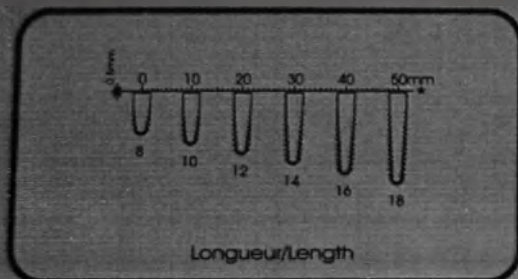


Ech / Scale  
1.0 : 1


Ø 4.0

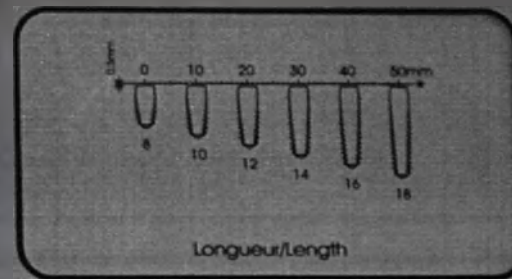

Ø 4.6

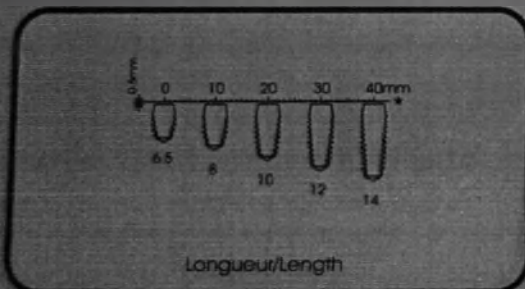

Ø 5.2

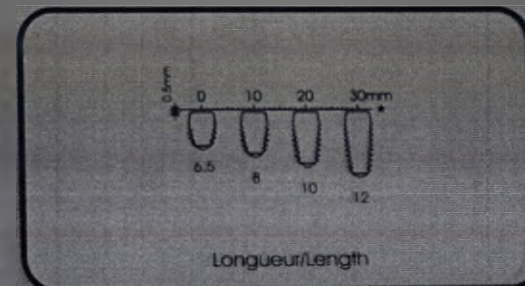

0 mm  
10 mm  
20 mm  
30 mm

Pointe front  
Dall bottom

\* La ligne horizontale correspond au niveau justo-dental  
The horizontal line corresponds to the justo-dental line

Précision des films de calibrage : ± 2%  
Ne pas utiliser un film de calibrage défectueux  
(impression altérée, déchirure).

Precision of the calibrating film : ± 2%  
Do not use the calibrating film if it is damaged  
(color print quality, tear).

Ce document ne doit pas être reproduit.  
This document must not be copied.

CE 0459

**Anthogyr**

74700 SALLANCHES - FRANCE  
Phone : +33(0)4 50 58 02 37  
Fax : +33(0)4 50 53 78 60  
www.anthogyr.com

Прошито и пронумеровано

166 лист

Ген.директор

