

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшков

2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для определения СА 15-3 на анализаторах иммунохимических серии
Atellica (Atellica IM CA 15-3)»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикас Инк.»,
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

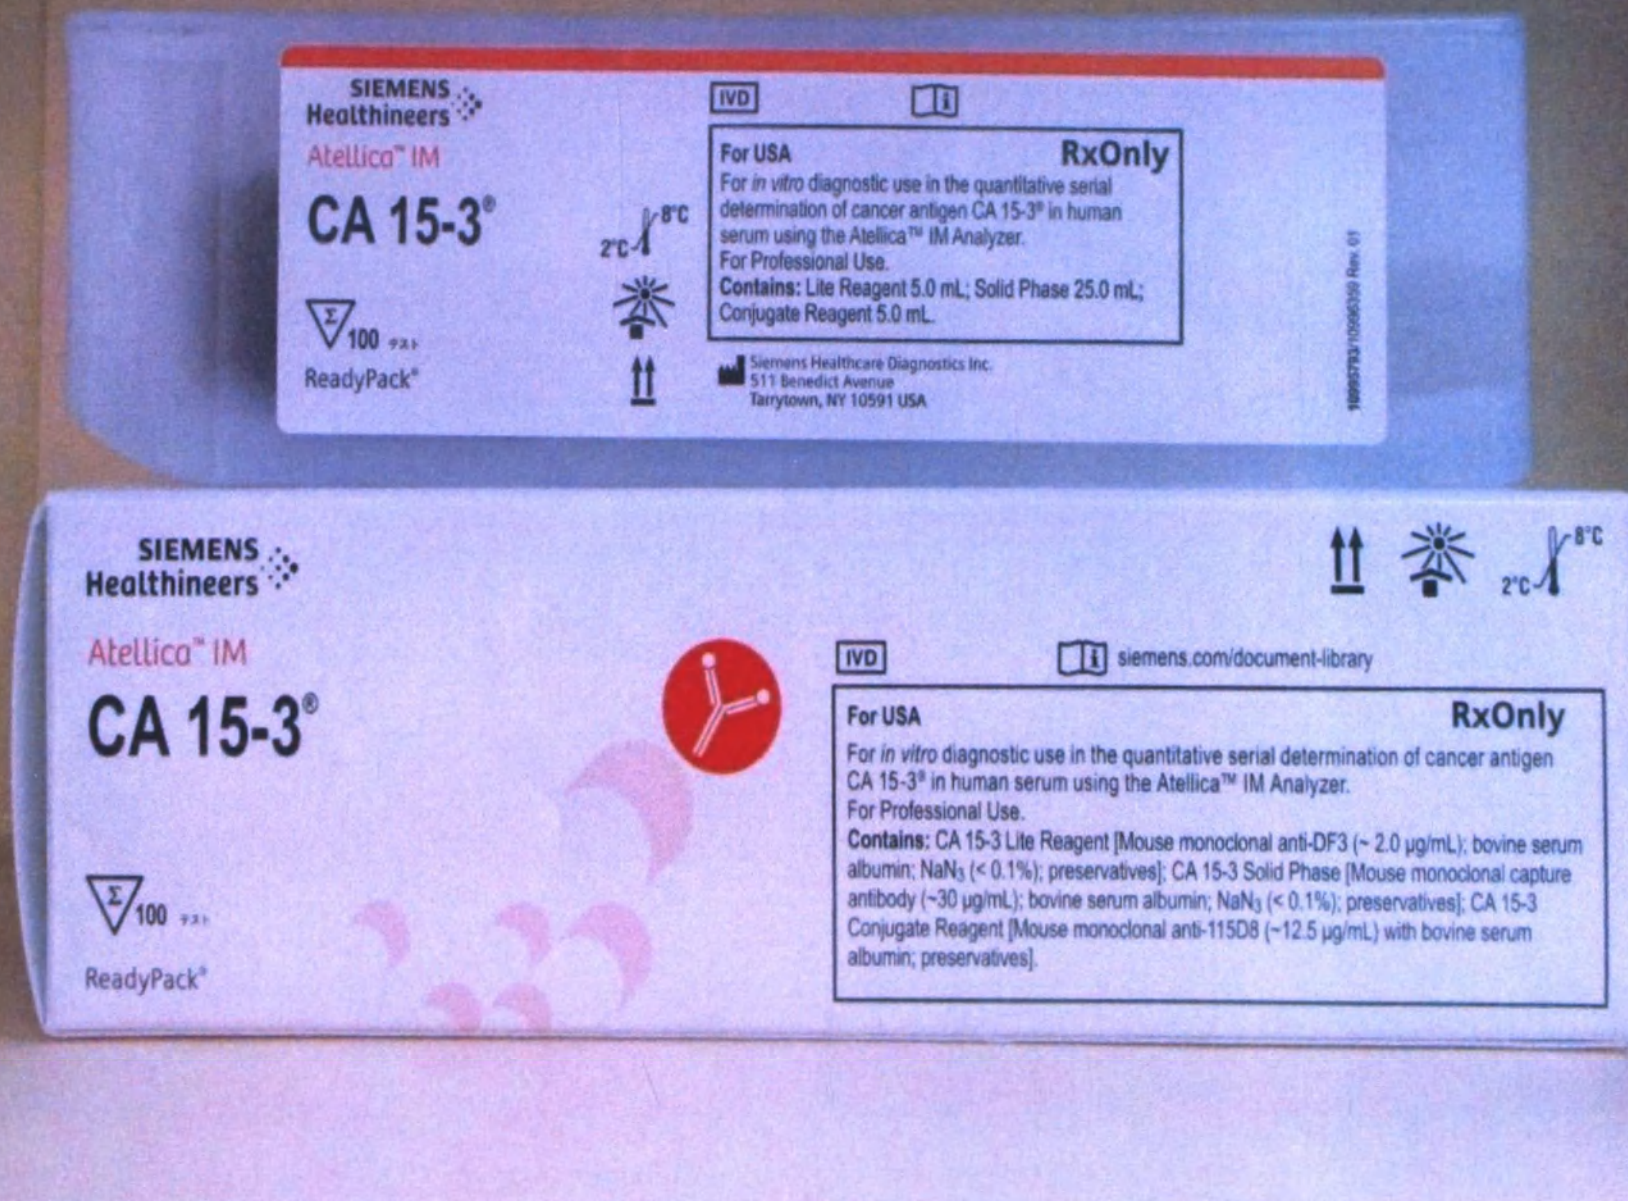


Рисунок 1. Набор реагентов для определения CA 15-3 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 15-3). Фасовка 100 тестов. Общий вид

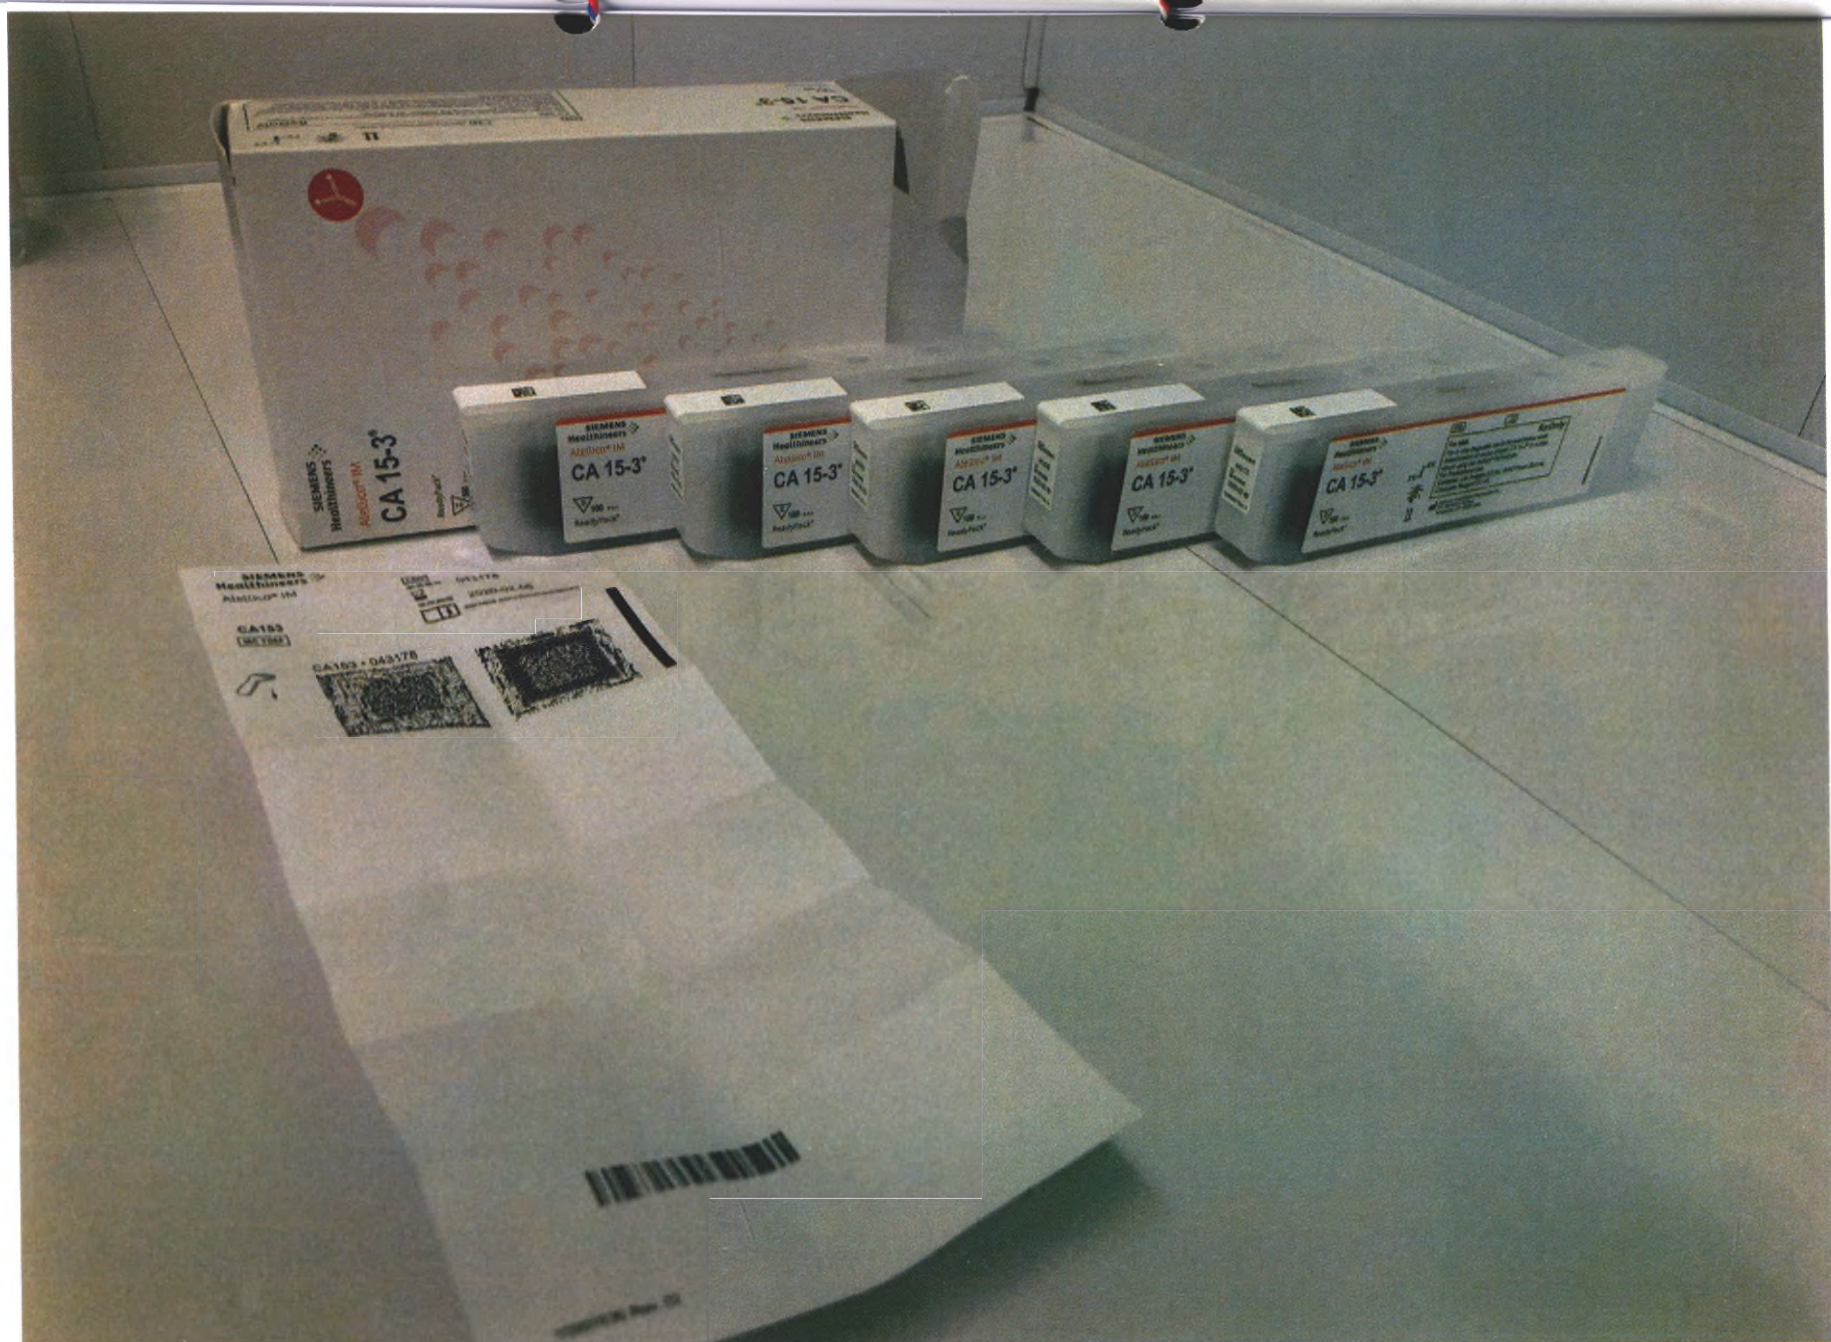


Рисунок 2. Набор реагентов для определения CA 15-3 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 15-3). Фасовка 500 тестов. Общий вид

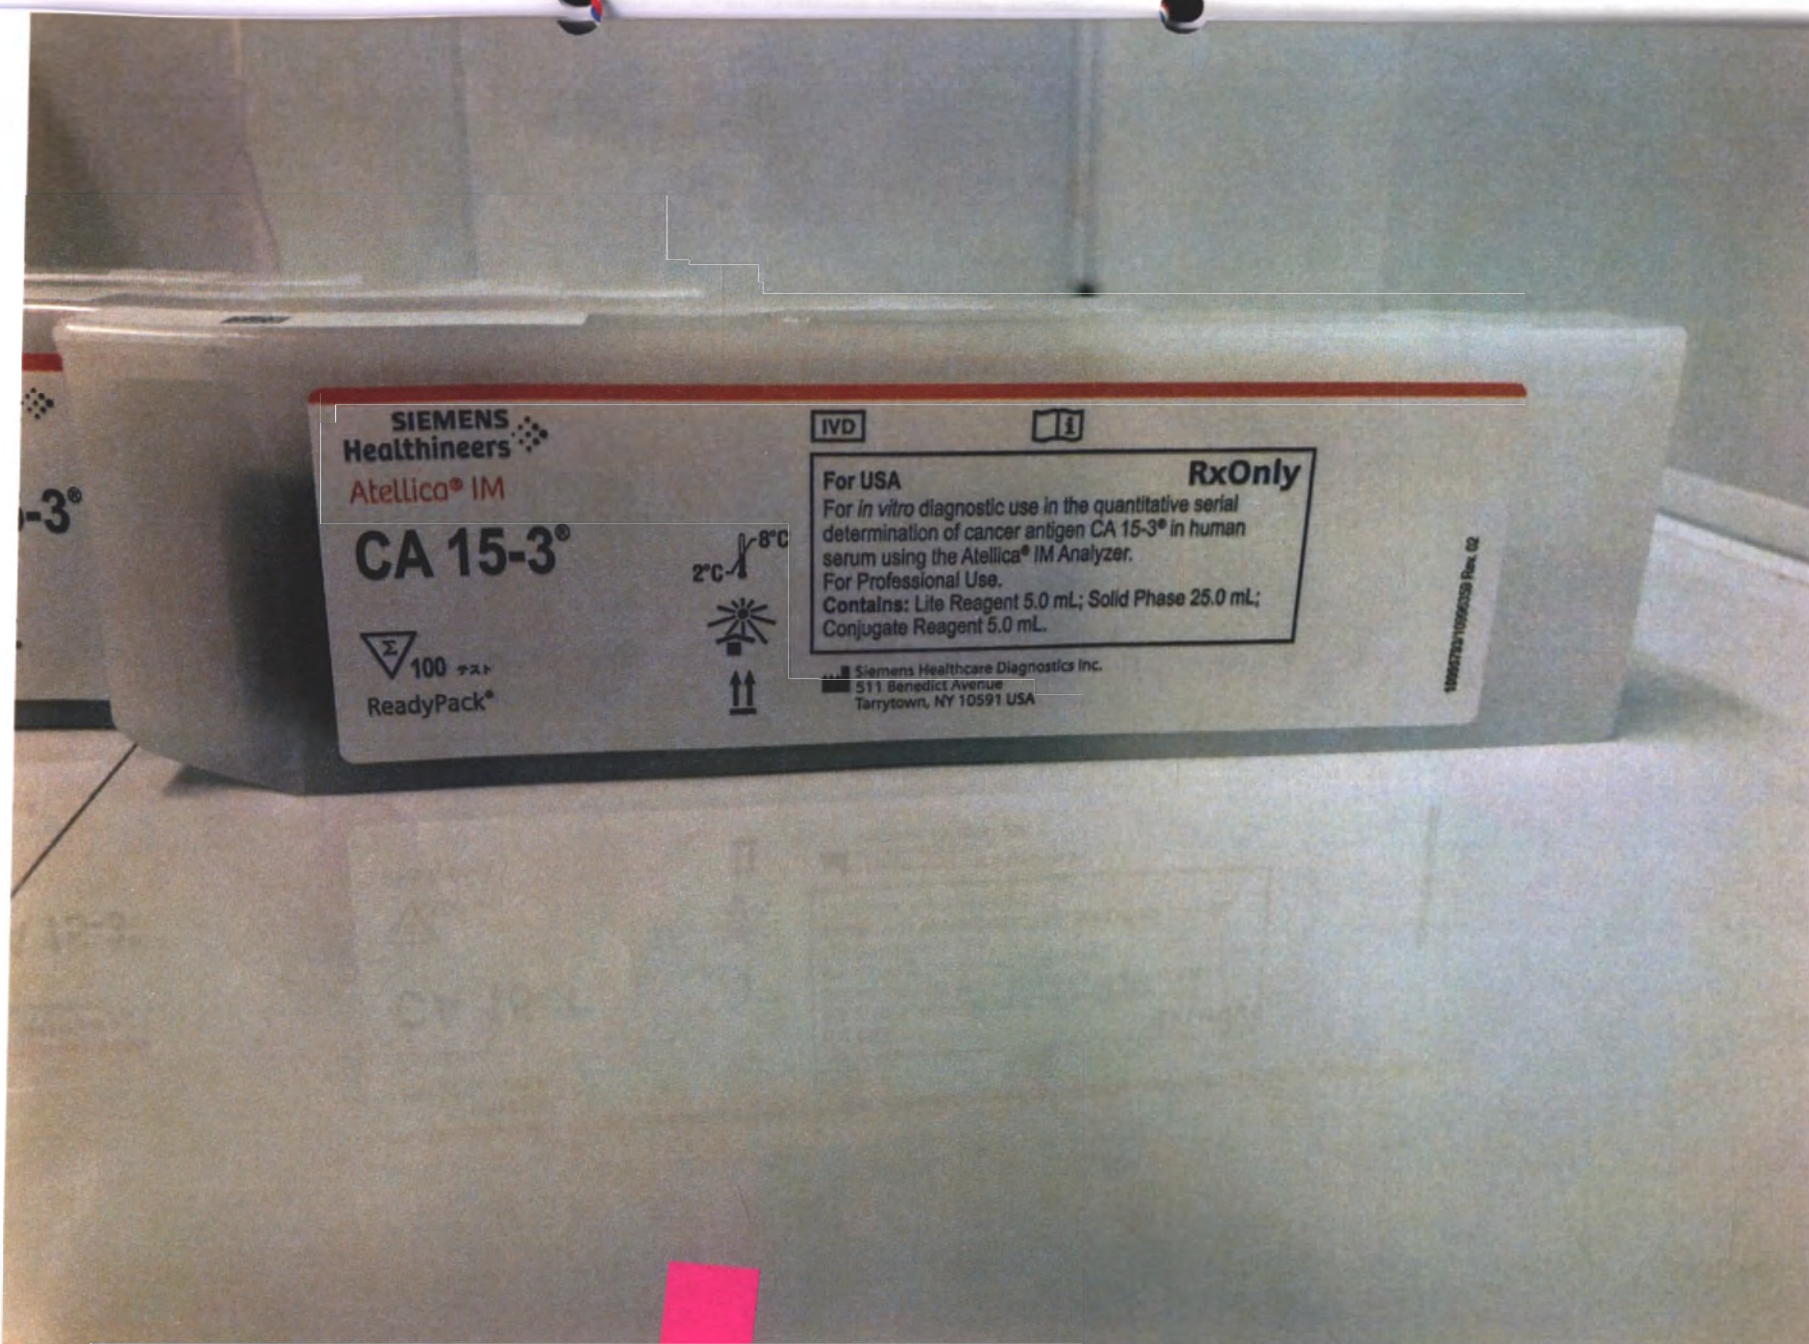


Рисунок 3. Набор реагентов для определения CA 15-3 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 15-3): Первичный реагент Atellica IM CA 15-3

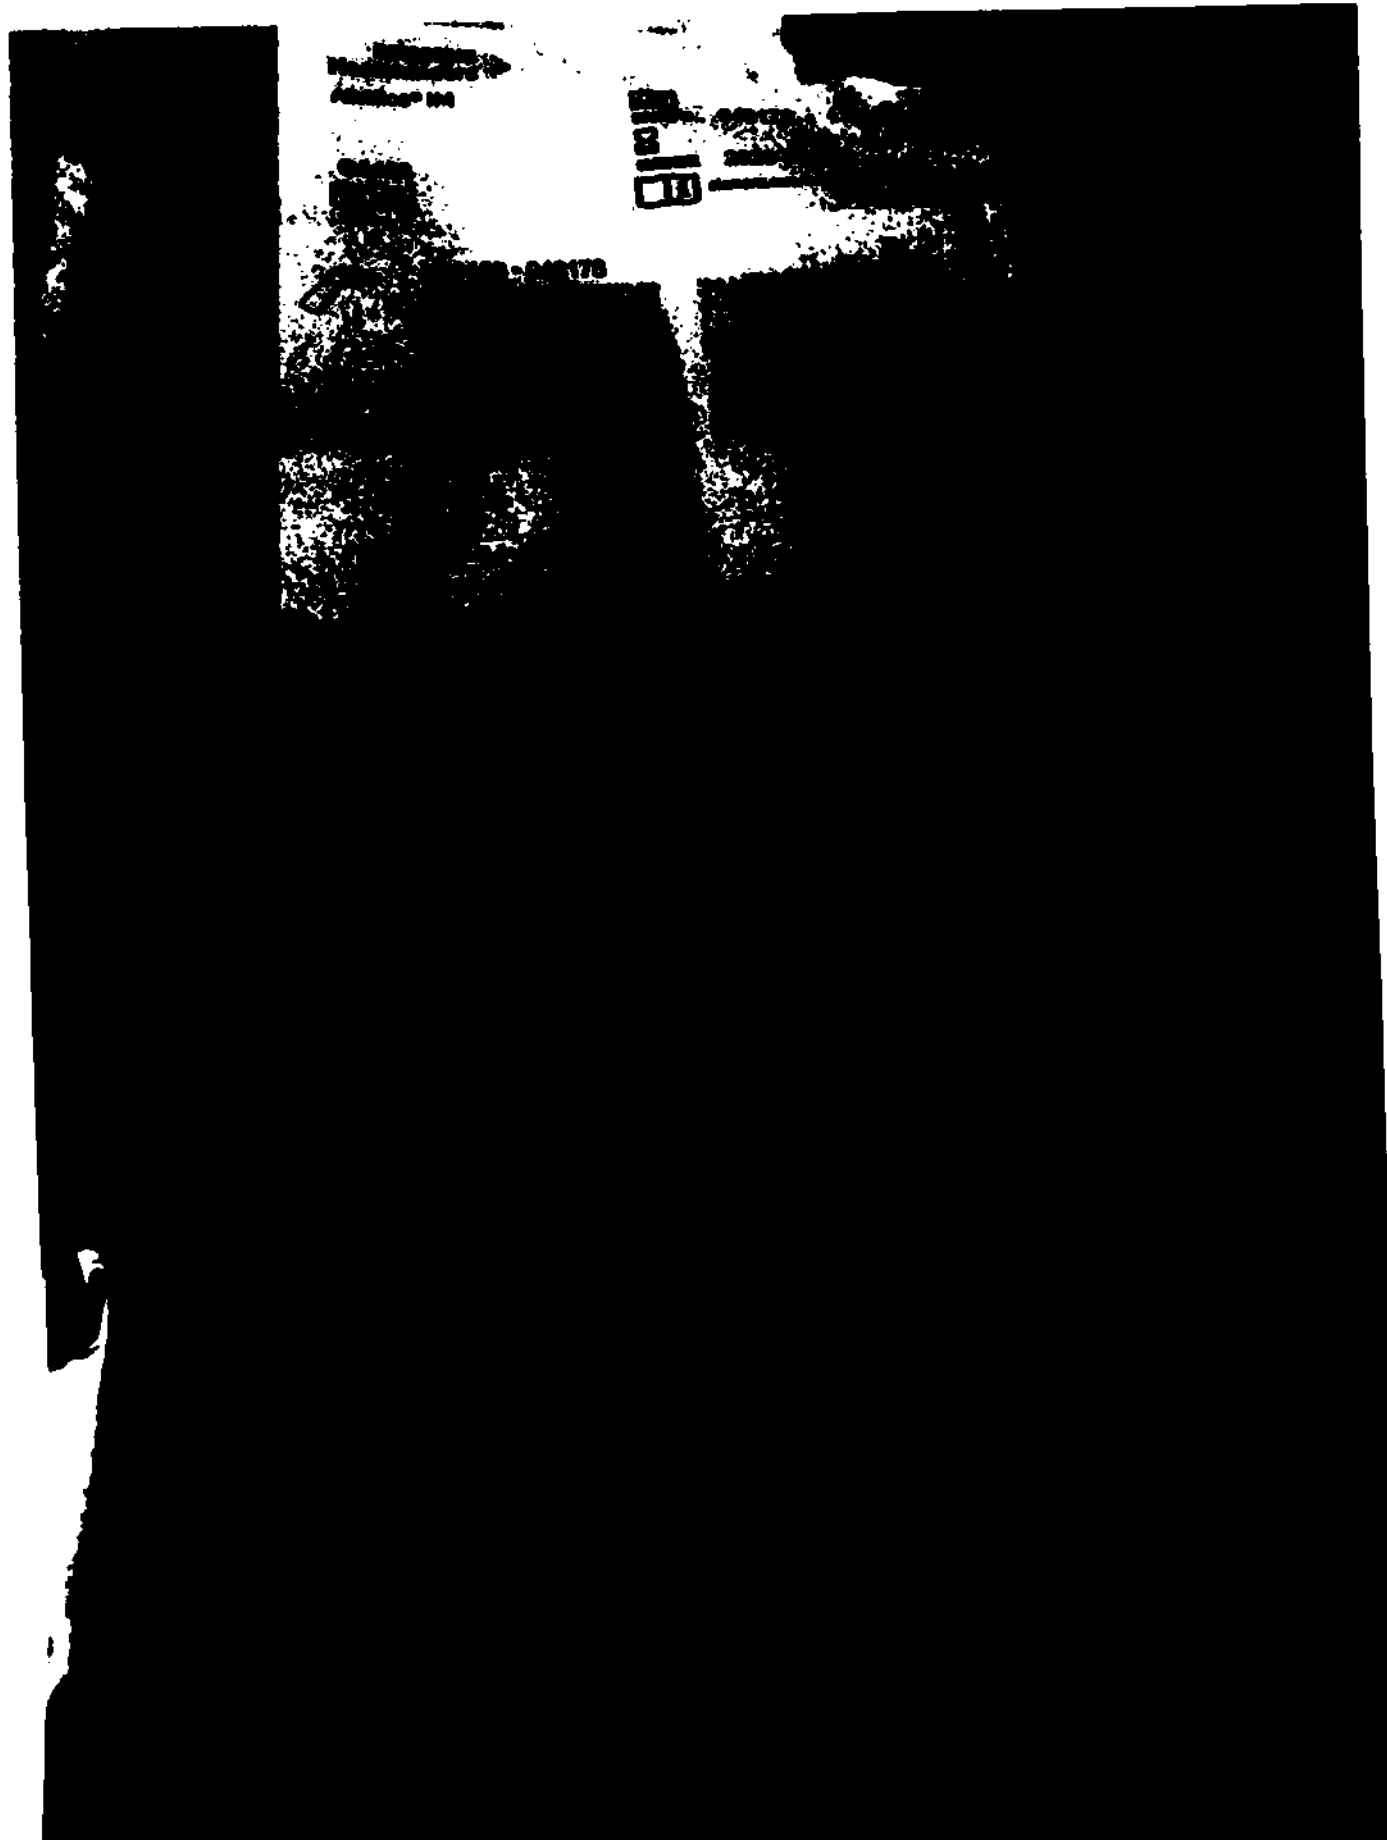


Рисунок 4. Набор реагентов для определения СА 15-3 на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 15-3): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM CA 15-3

Всего прошито и пронумеровано 5 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

