


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.



Фотографические изображения изделия:

Кассета с реагентами для количественного определения углеводного антигена 19-9 (carbohydrate antigen 19-9 (CA19-9)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики *in vitro*
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.»), Китай

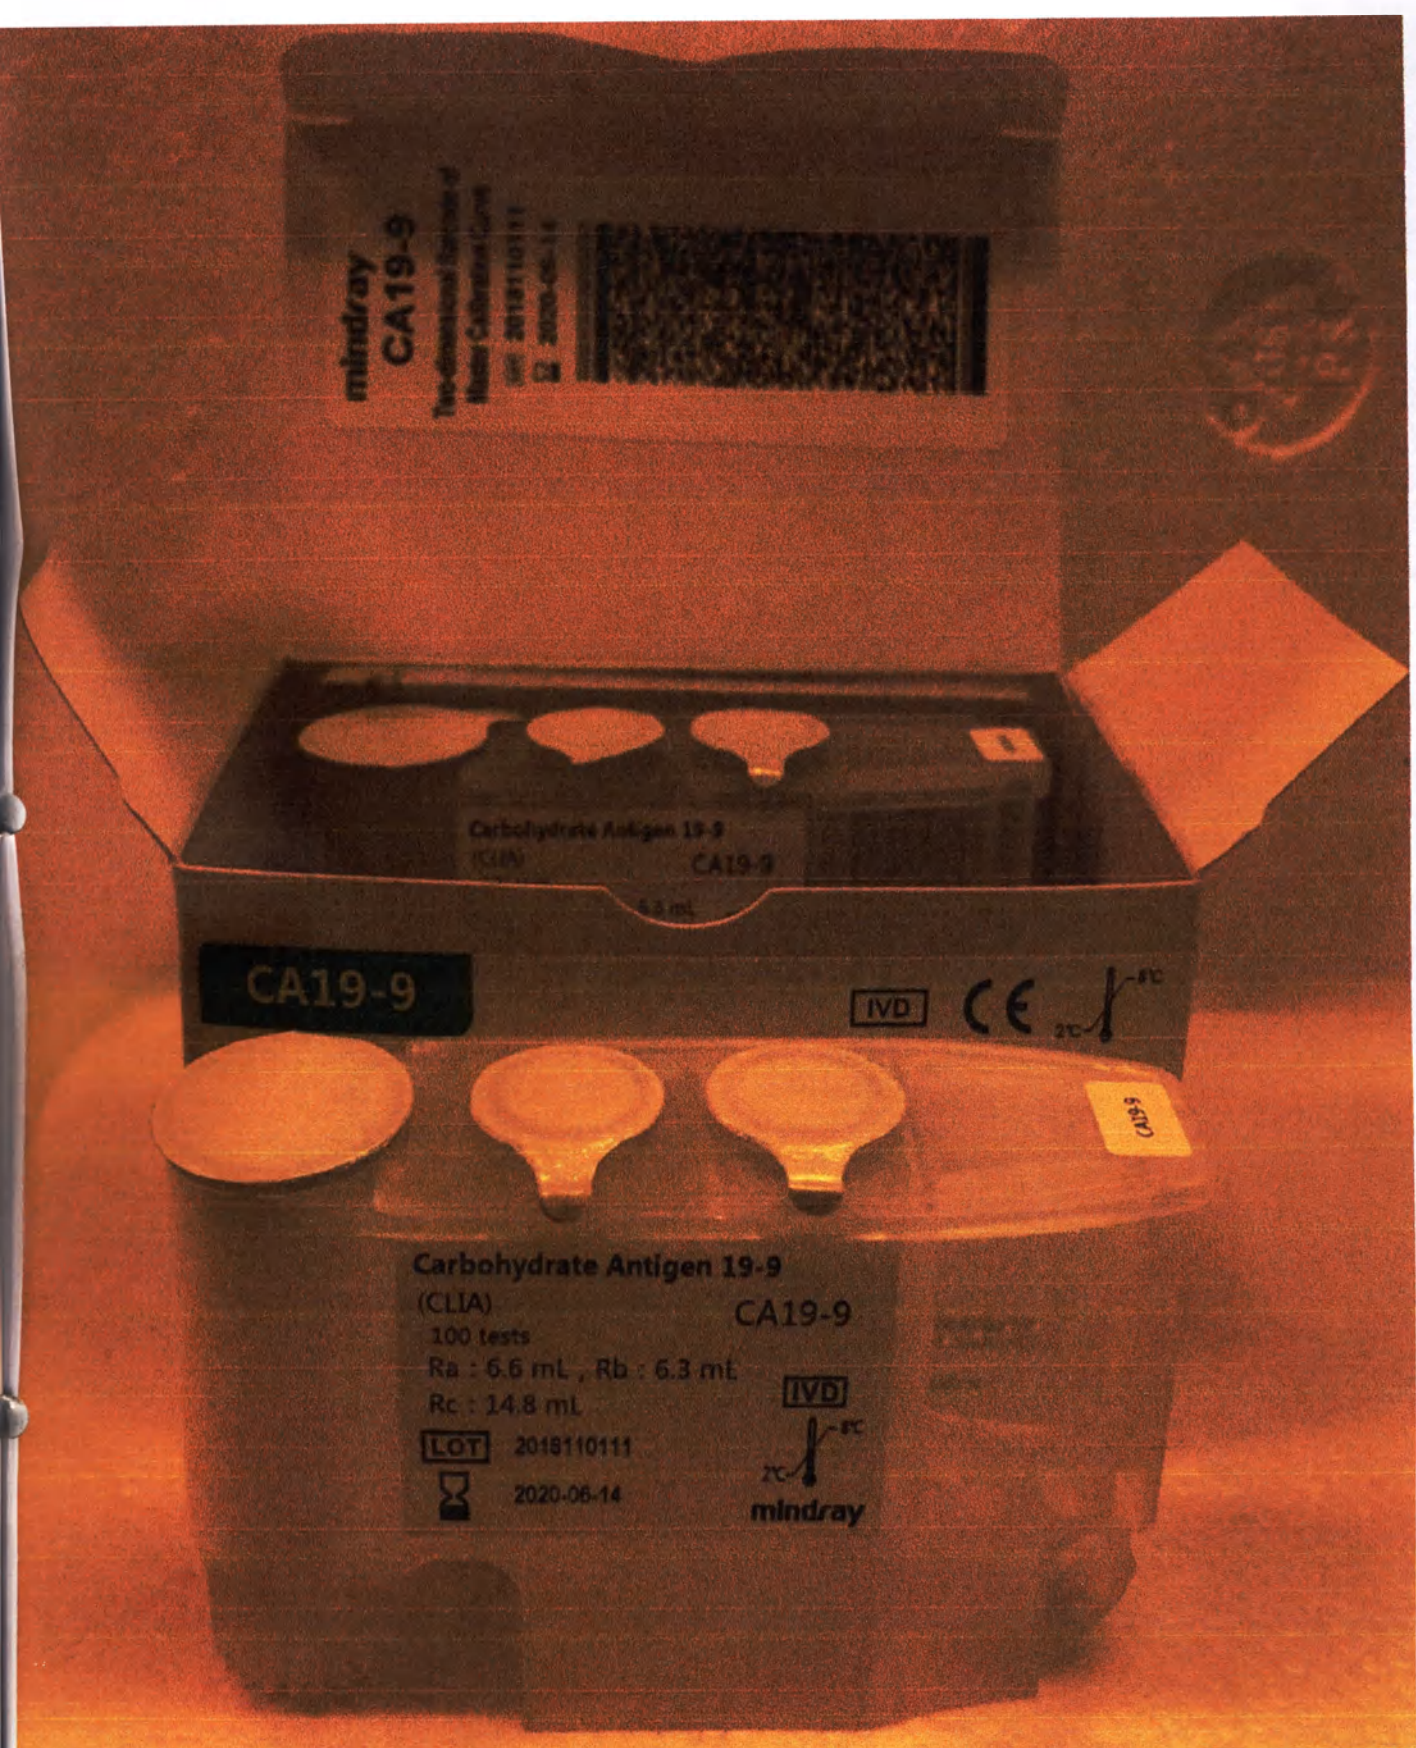

общий вид медицинского изделия (Кассета с реагентами для количественного определения углеводного антигена 19-9 (carbohydrate antigen 19-9 (CA19-9)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, в варианте исполнения CA19-9112 (2 x 100 тестов))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 2 листа (-ов)

Генеральный Директор _____ Носова Т.А.
М.П.

