


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.




23 апреля 2020 г.

Фотографические изображения изделия:

Материал контрольный Tumor Marker Multi Control для контроля качества
количественного определения опухолевых маркеров в клиническом образце
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд.»), Китай

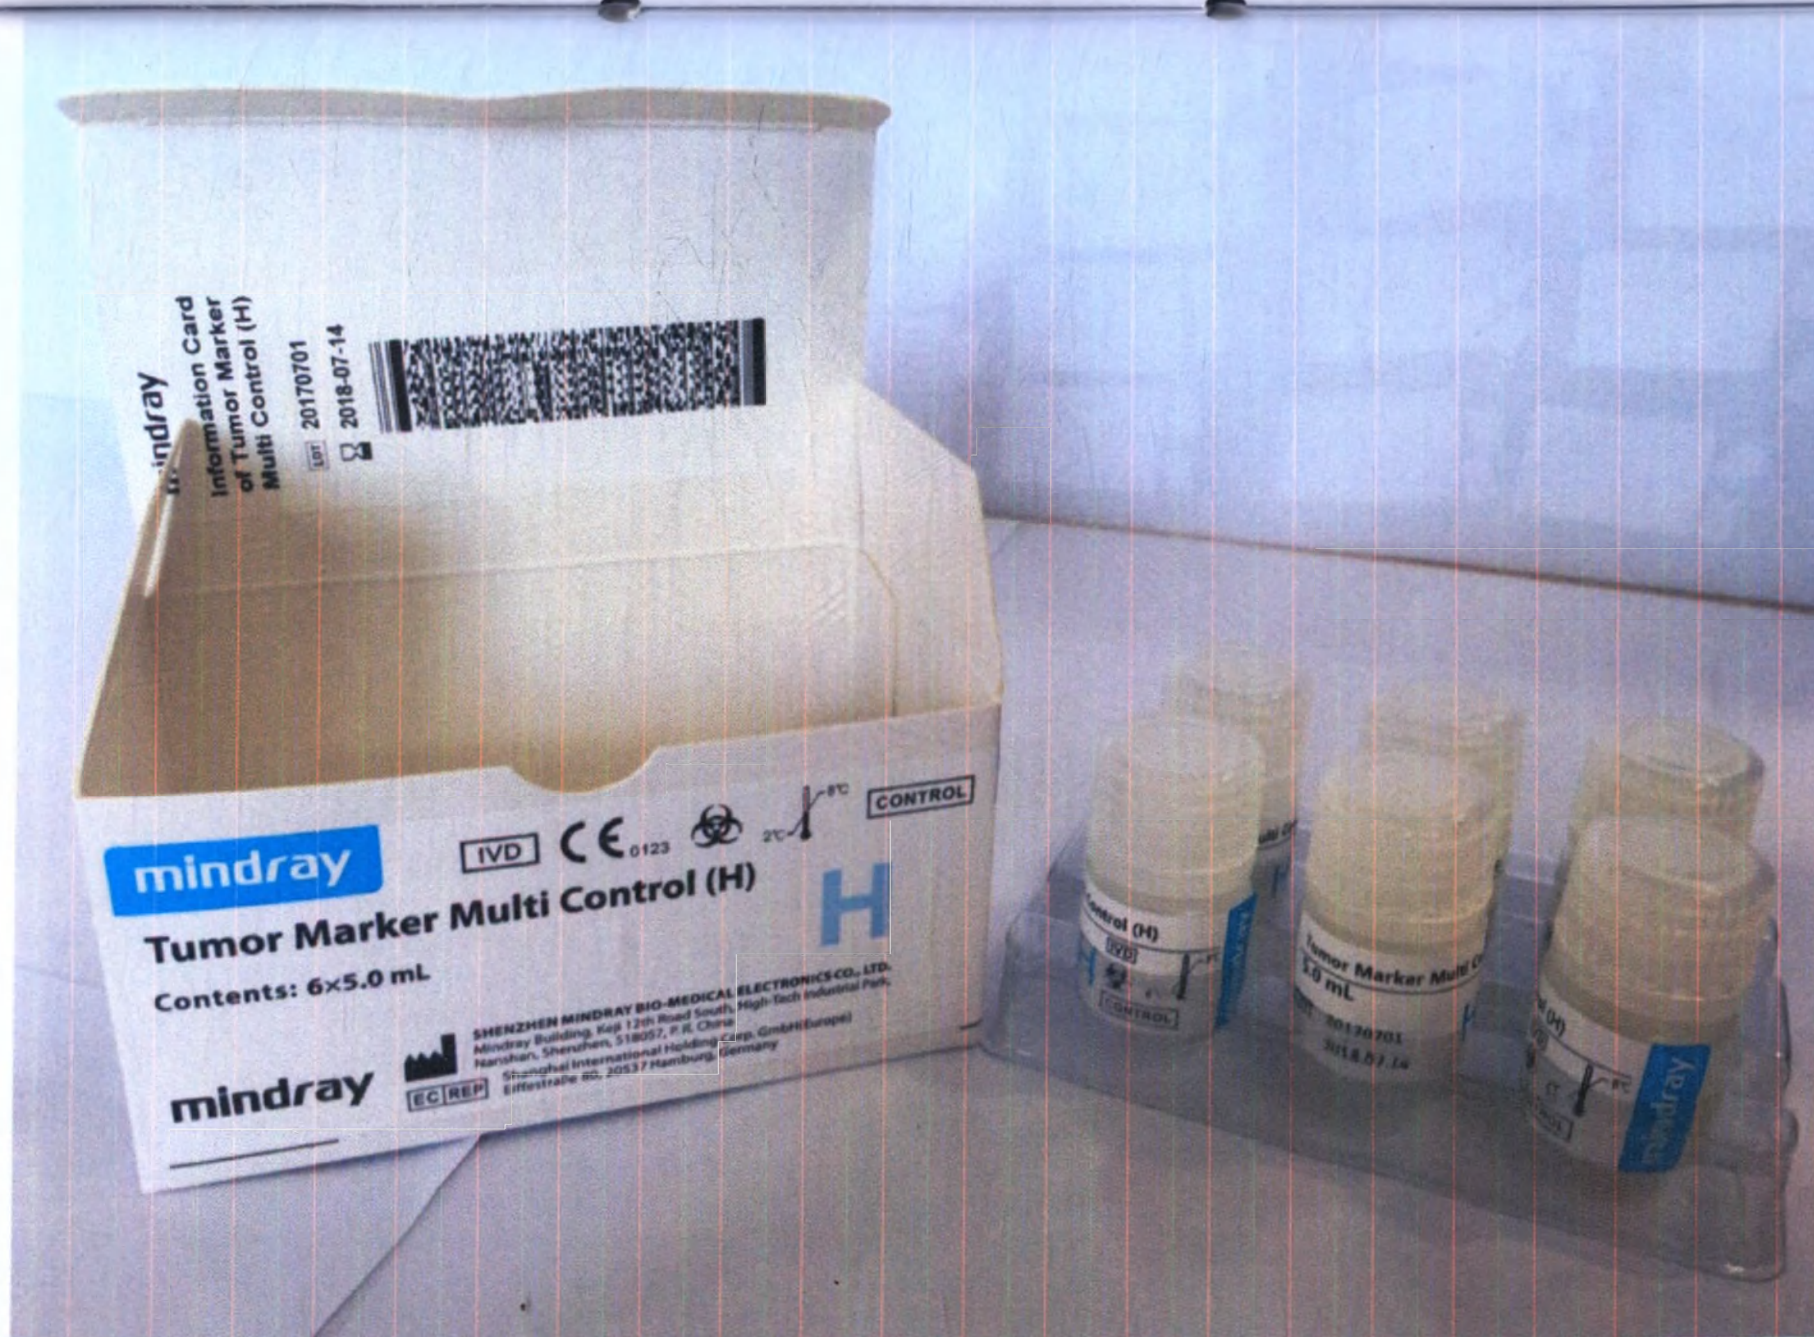

Общий вид медицинского изделия (Материал контрольный Tumor Marker Multi Control для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, в варианте исполнения: Материал контрольный Tumor Marker Multi Control (H), 6 флаконов по 5,0 мл)

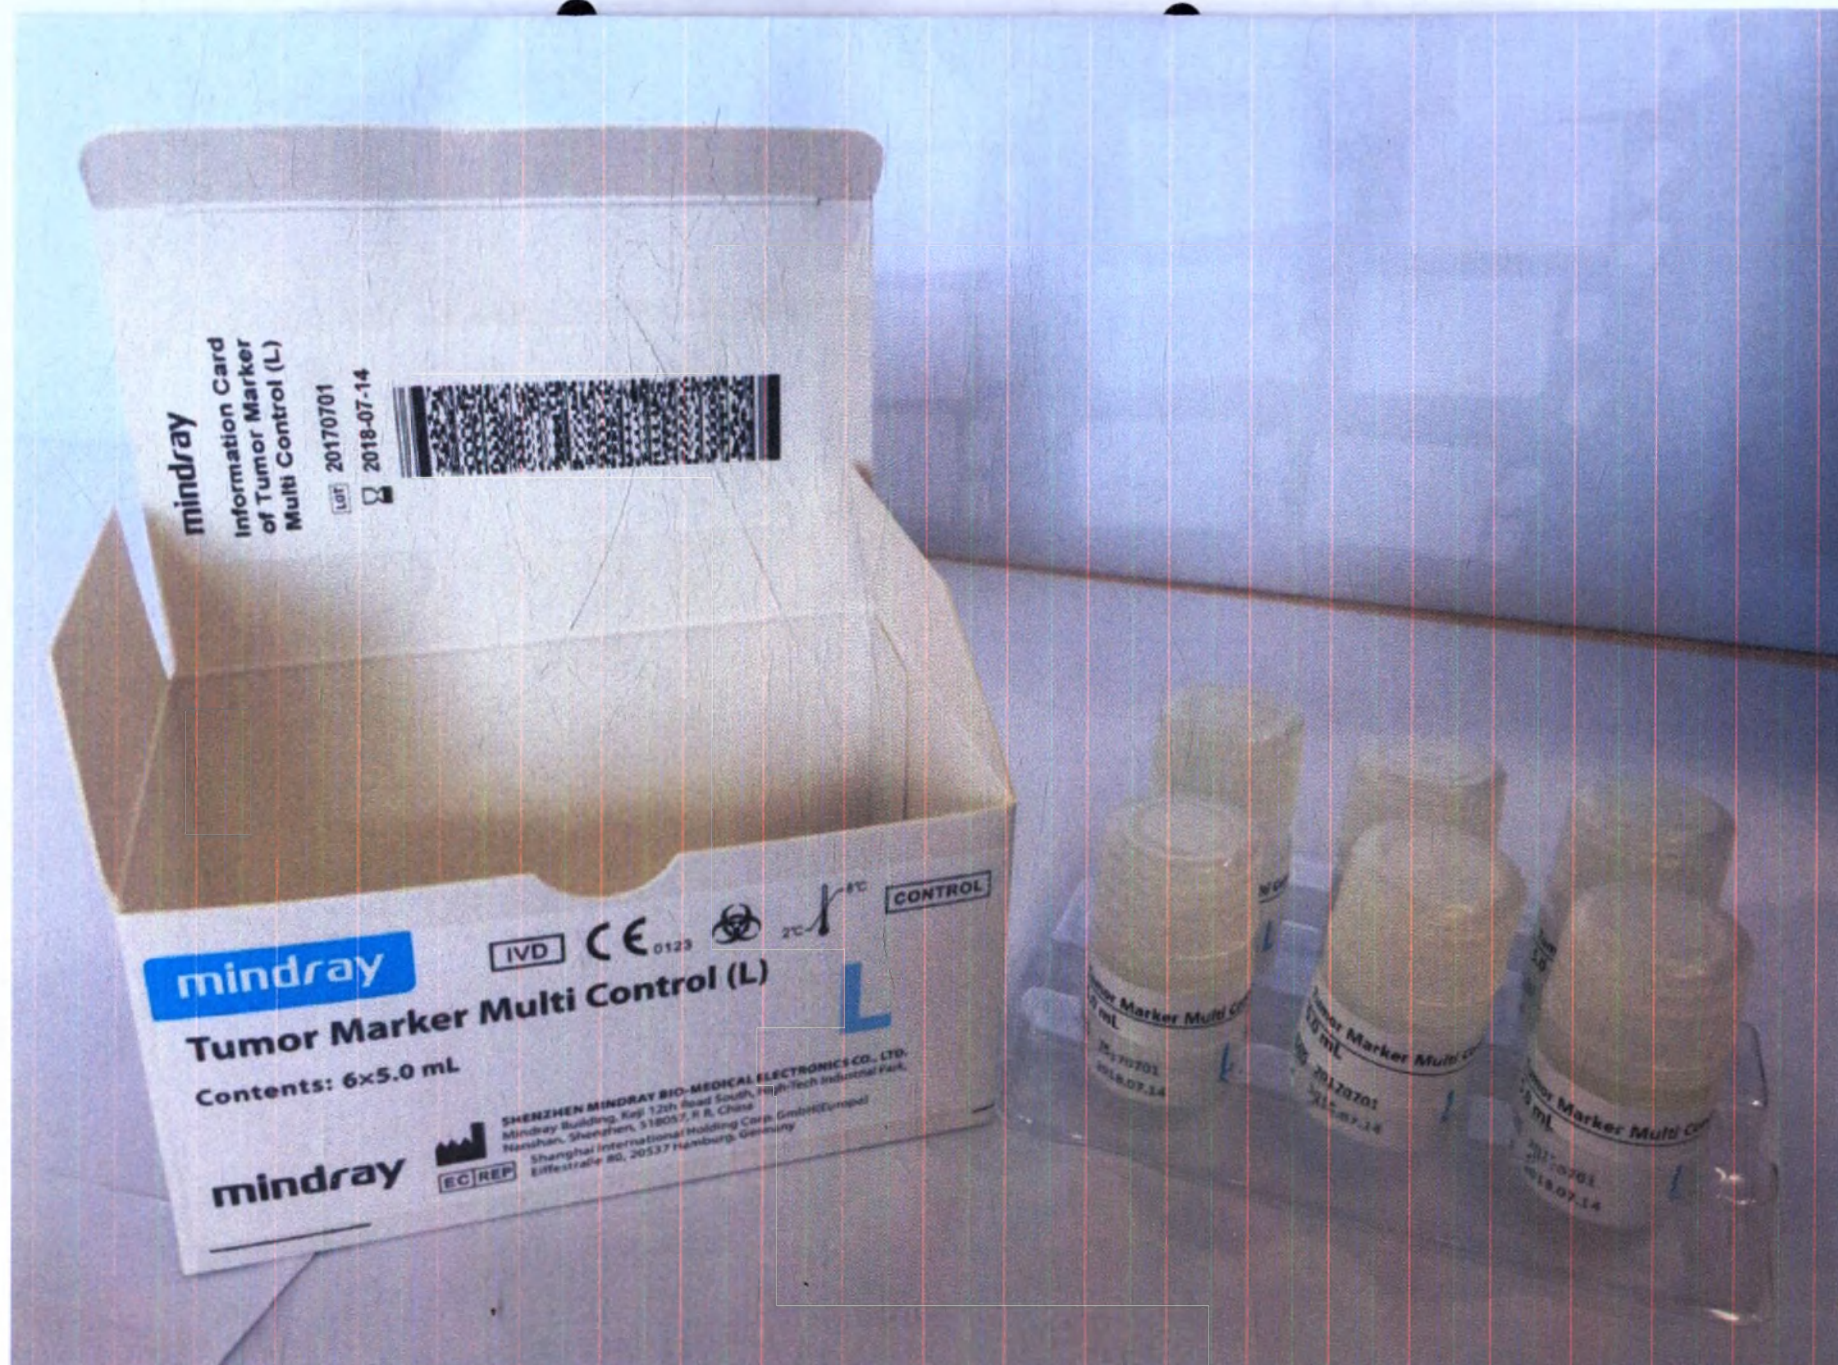

Материал контрольный Tumor Marker Multi Control для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на автоматизированном анализаторе CL для диагностики in vitro, в варианте исполнения: Материал контрольный Tumor Marker Multi Control (L), 6 флаконов по 5,0 мл)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 3 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А.
М.П.

