


Фотографические изображения

Абатмент SS,



производства «Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.), Корея


1

Защитный колпачок


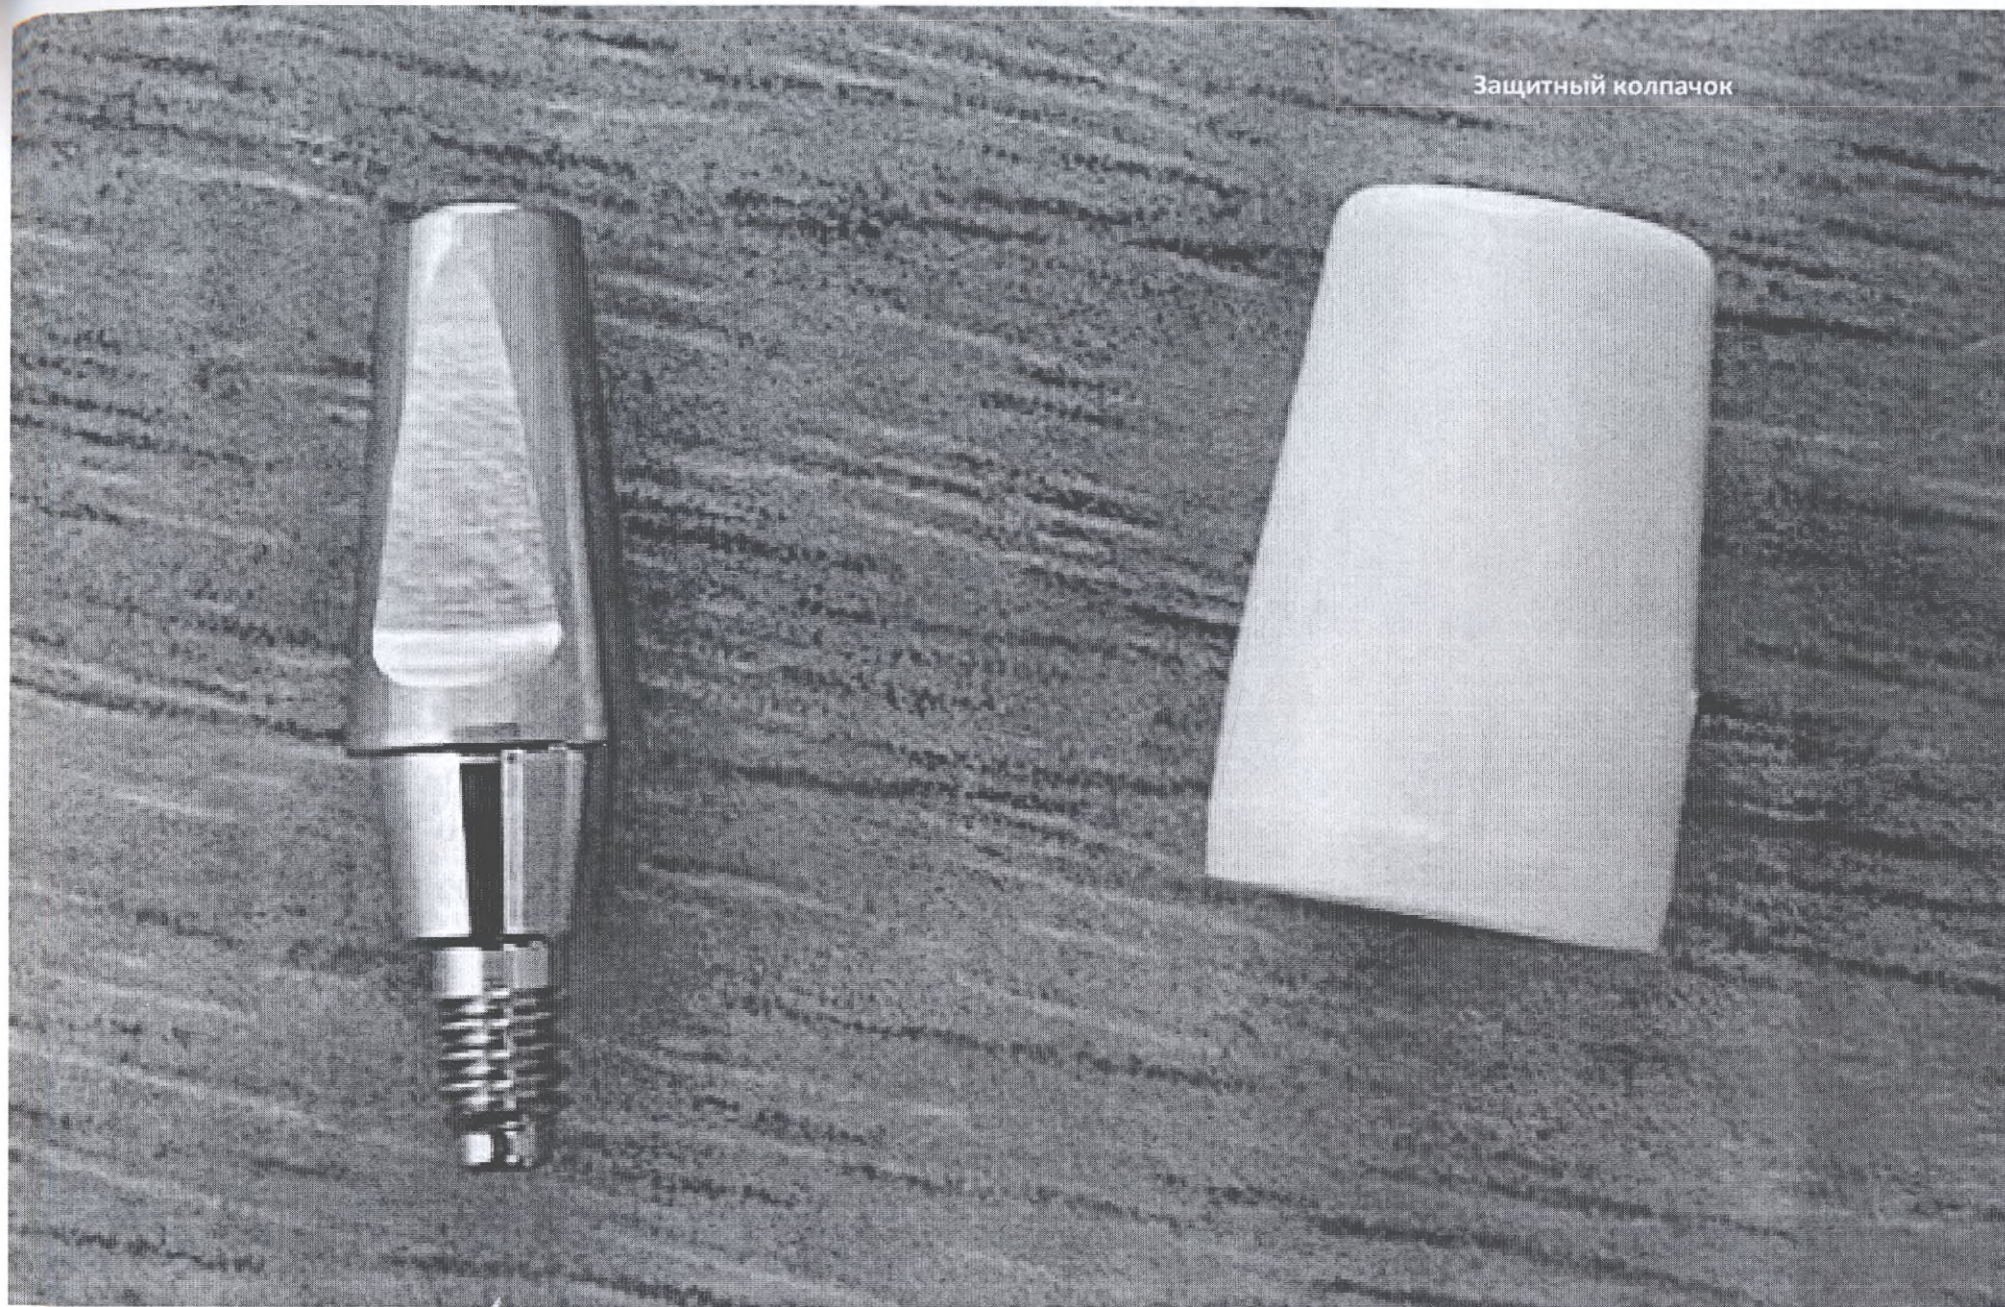


Защитный колпачок

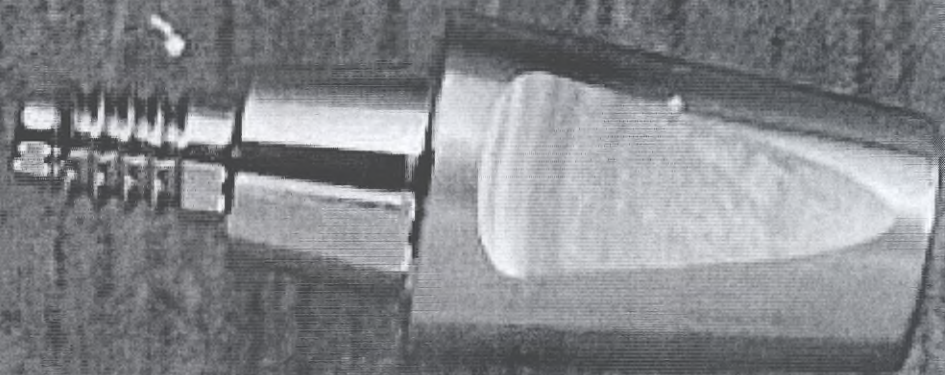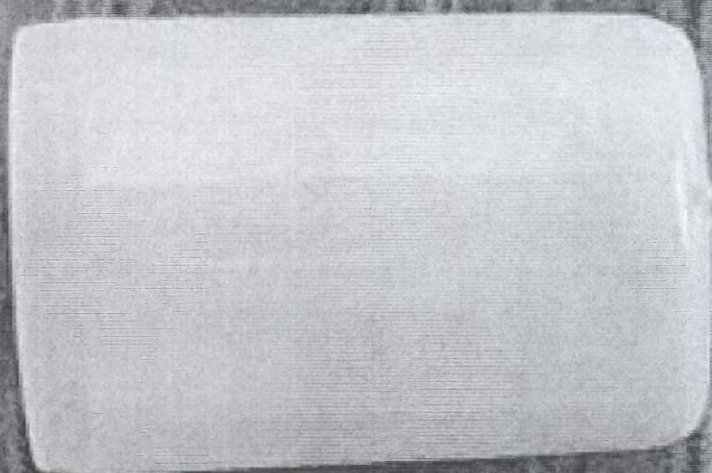


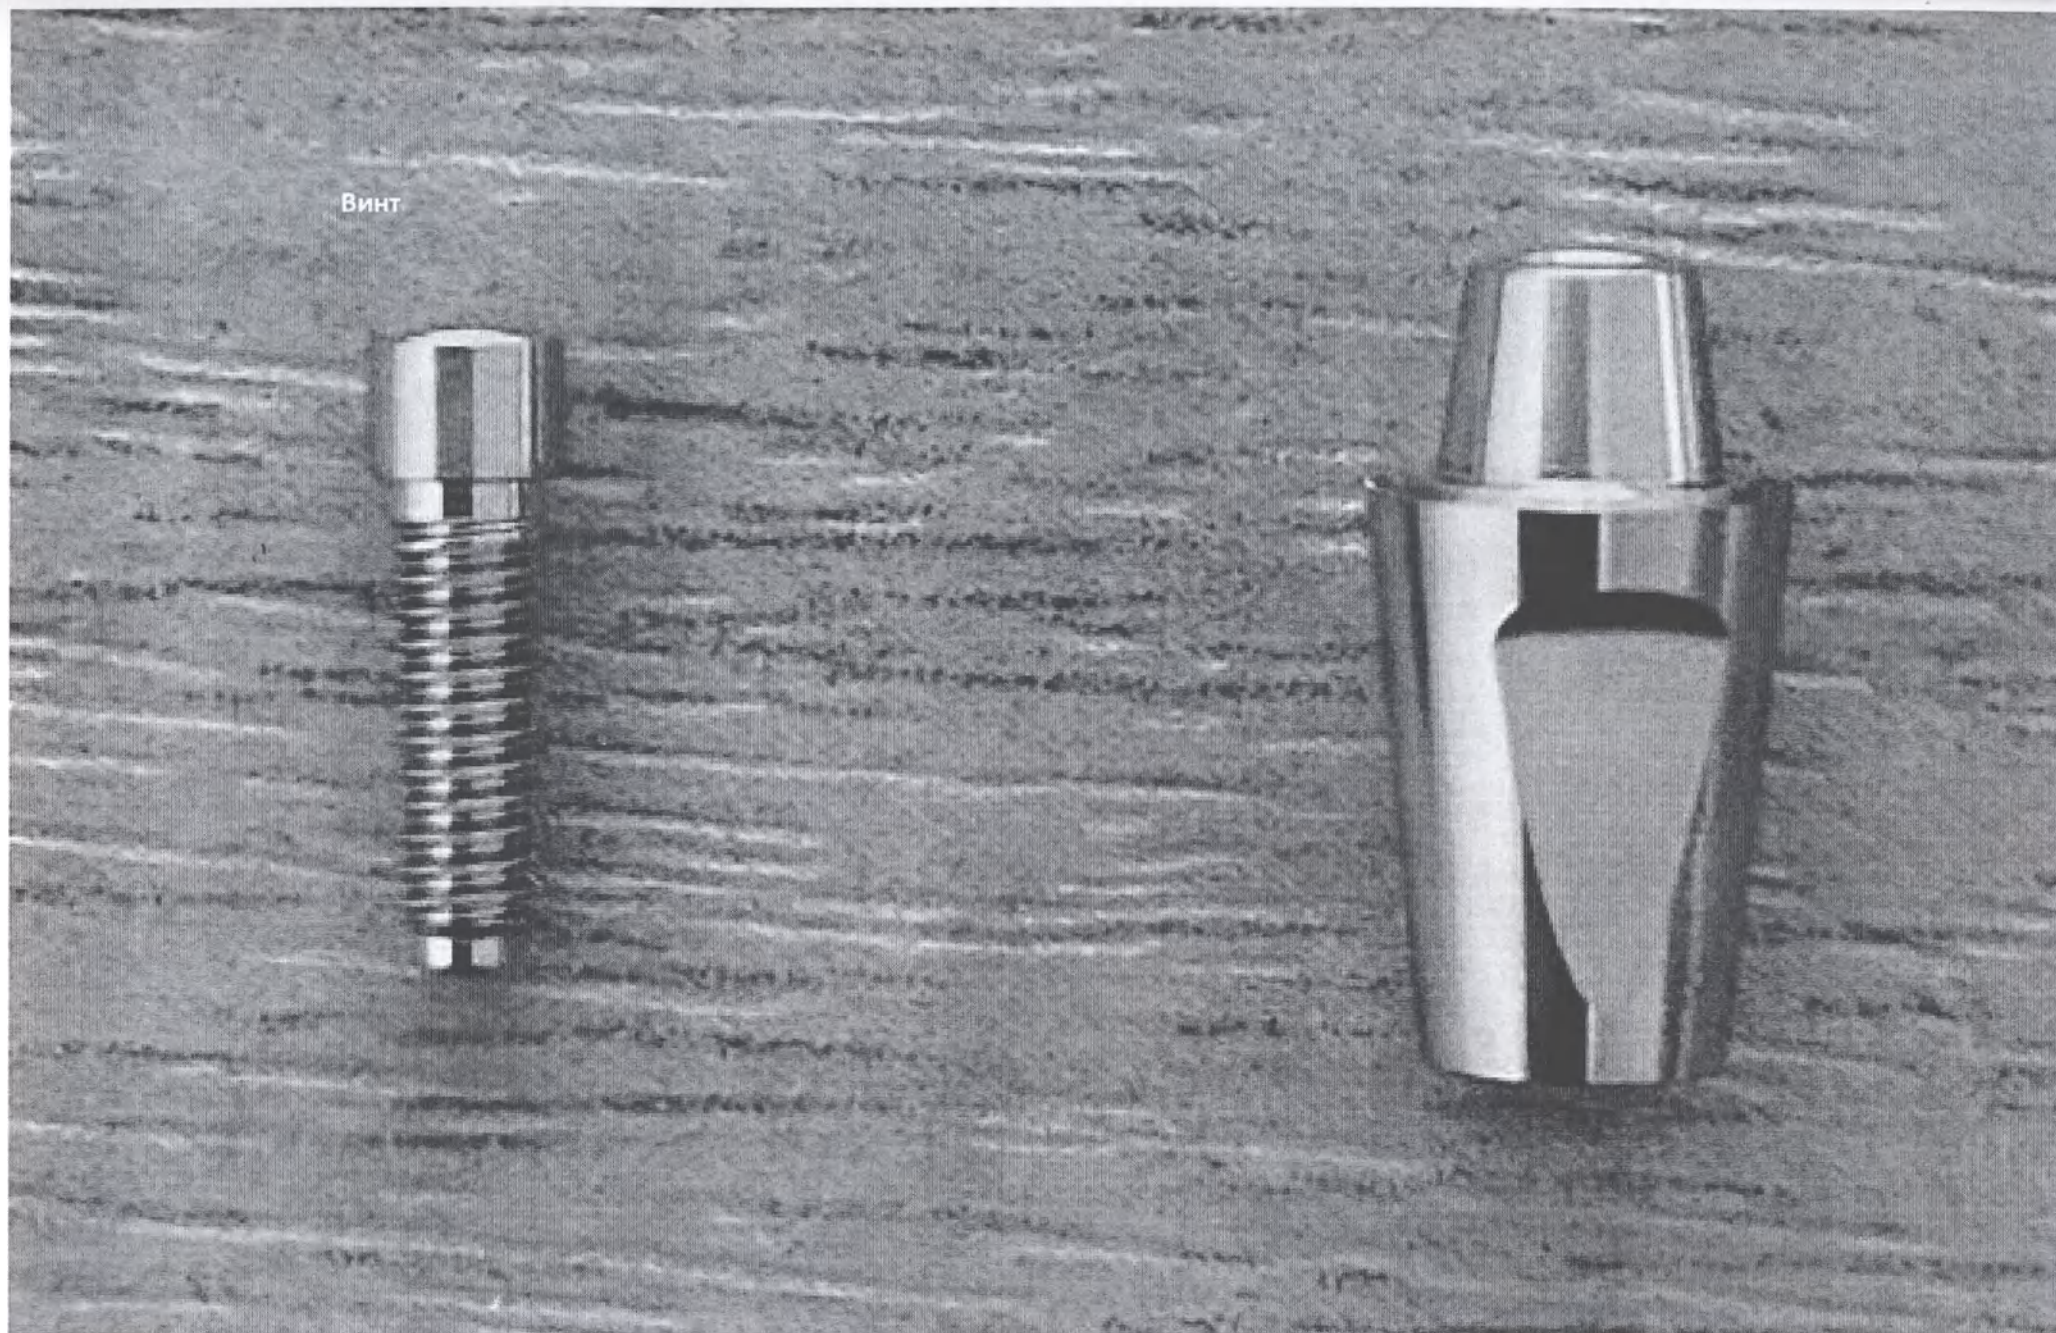



Винт

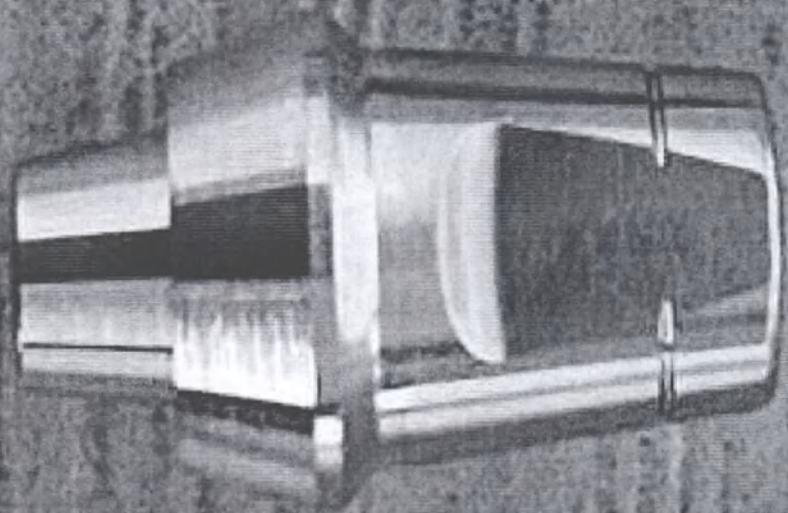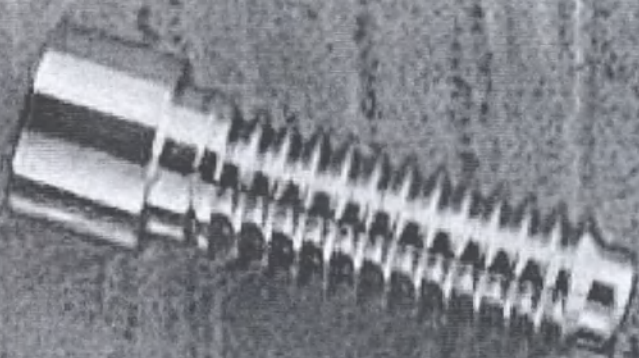


5. Абатмент ComOcta Milling с винтом, варианты исполнения отличаются размерами

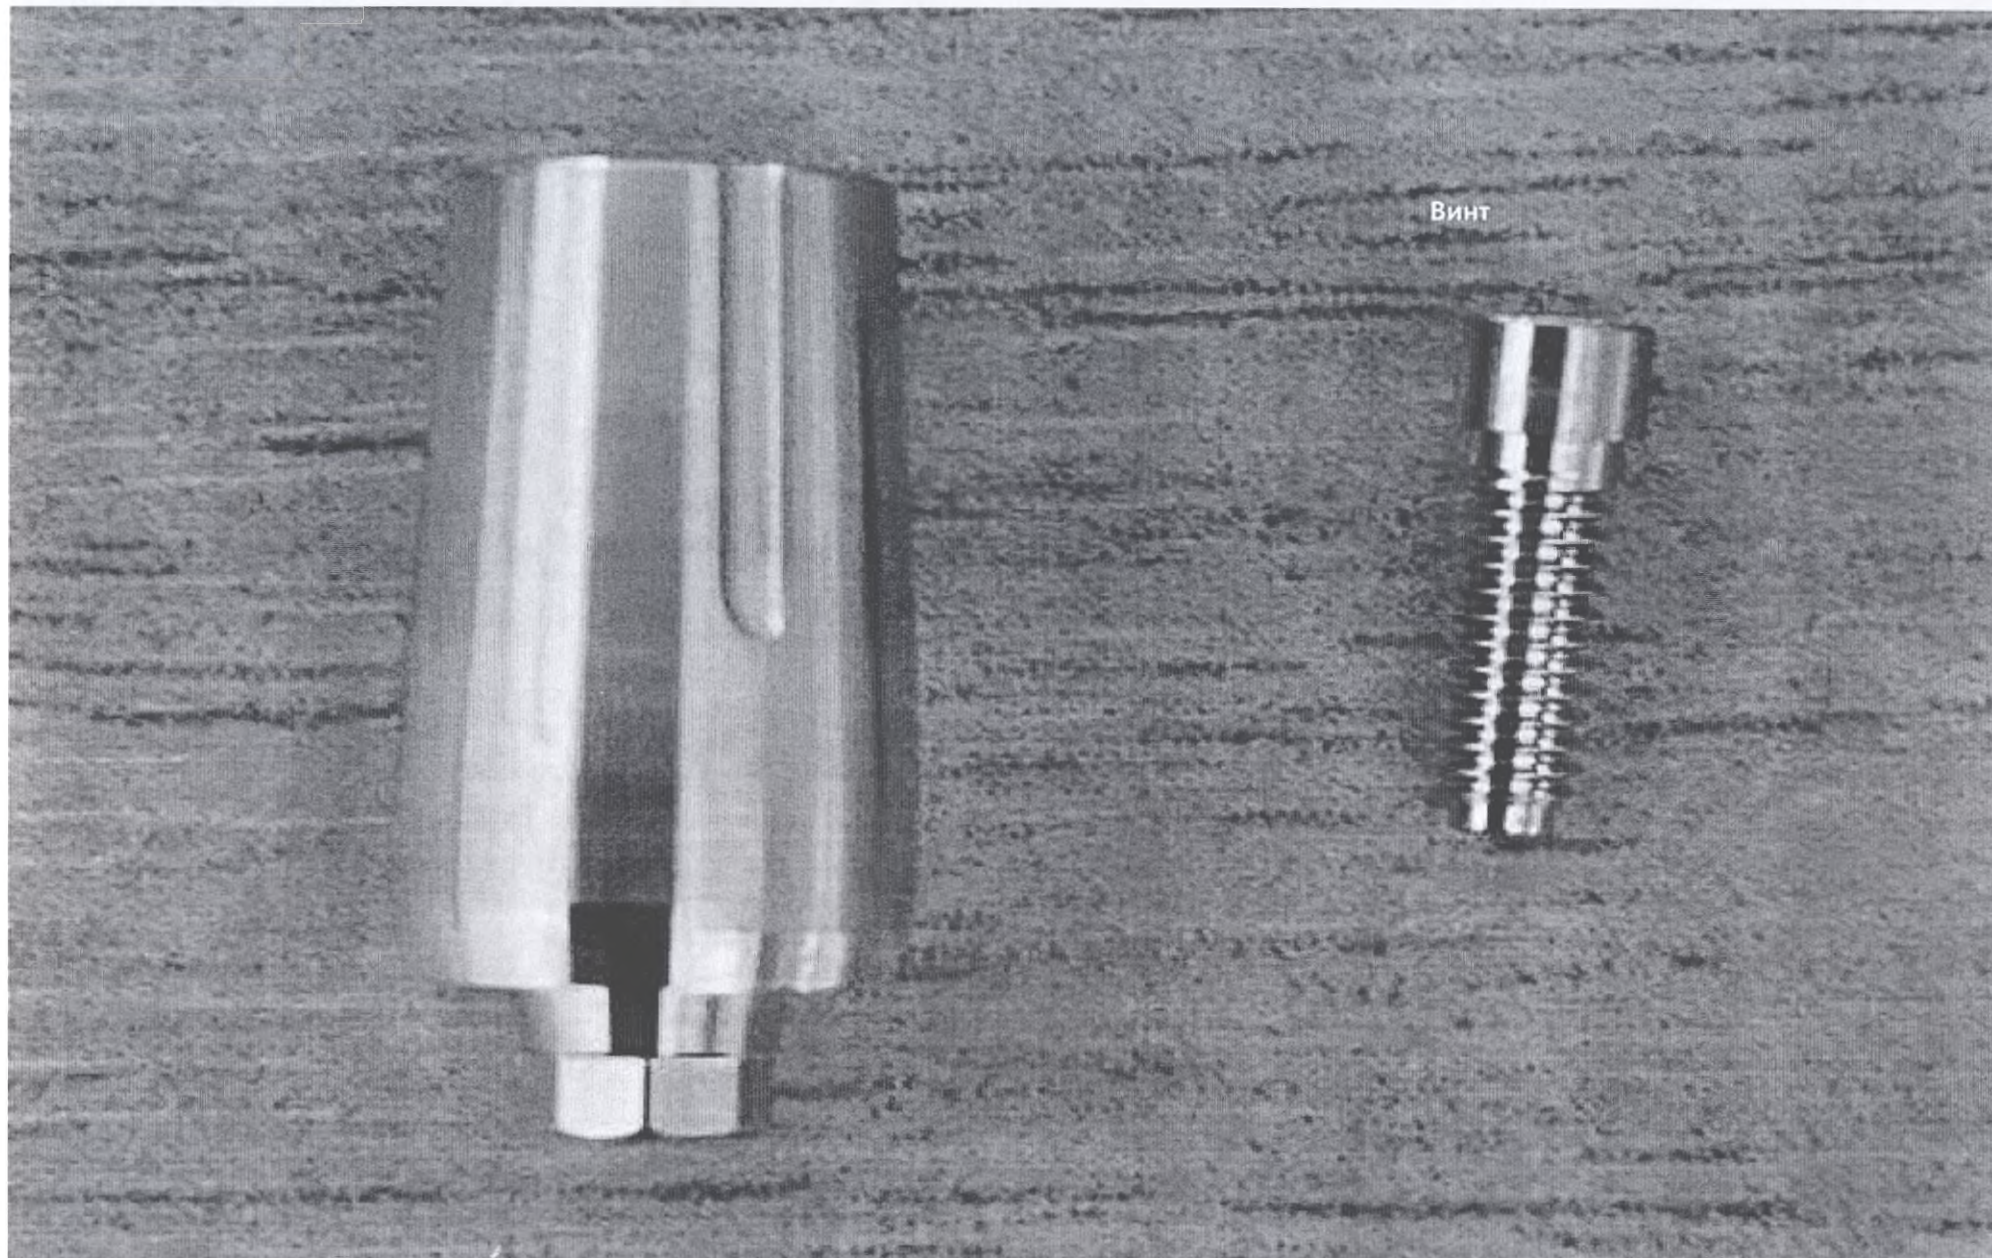


ВИНТ

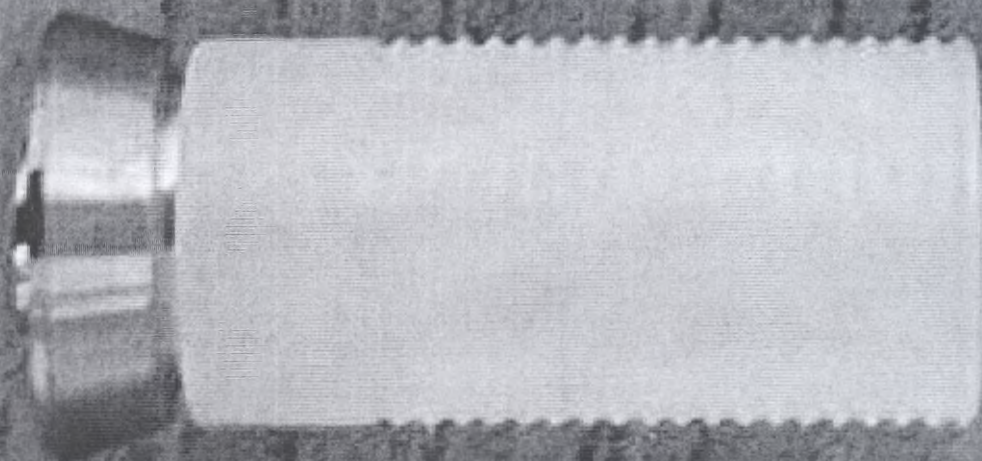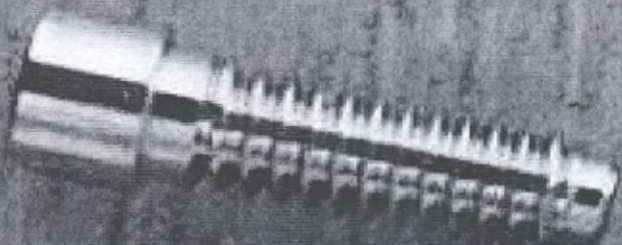


ВИНТ

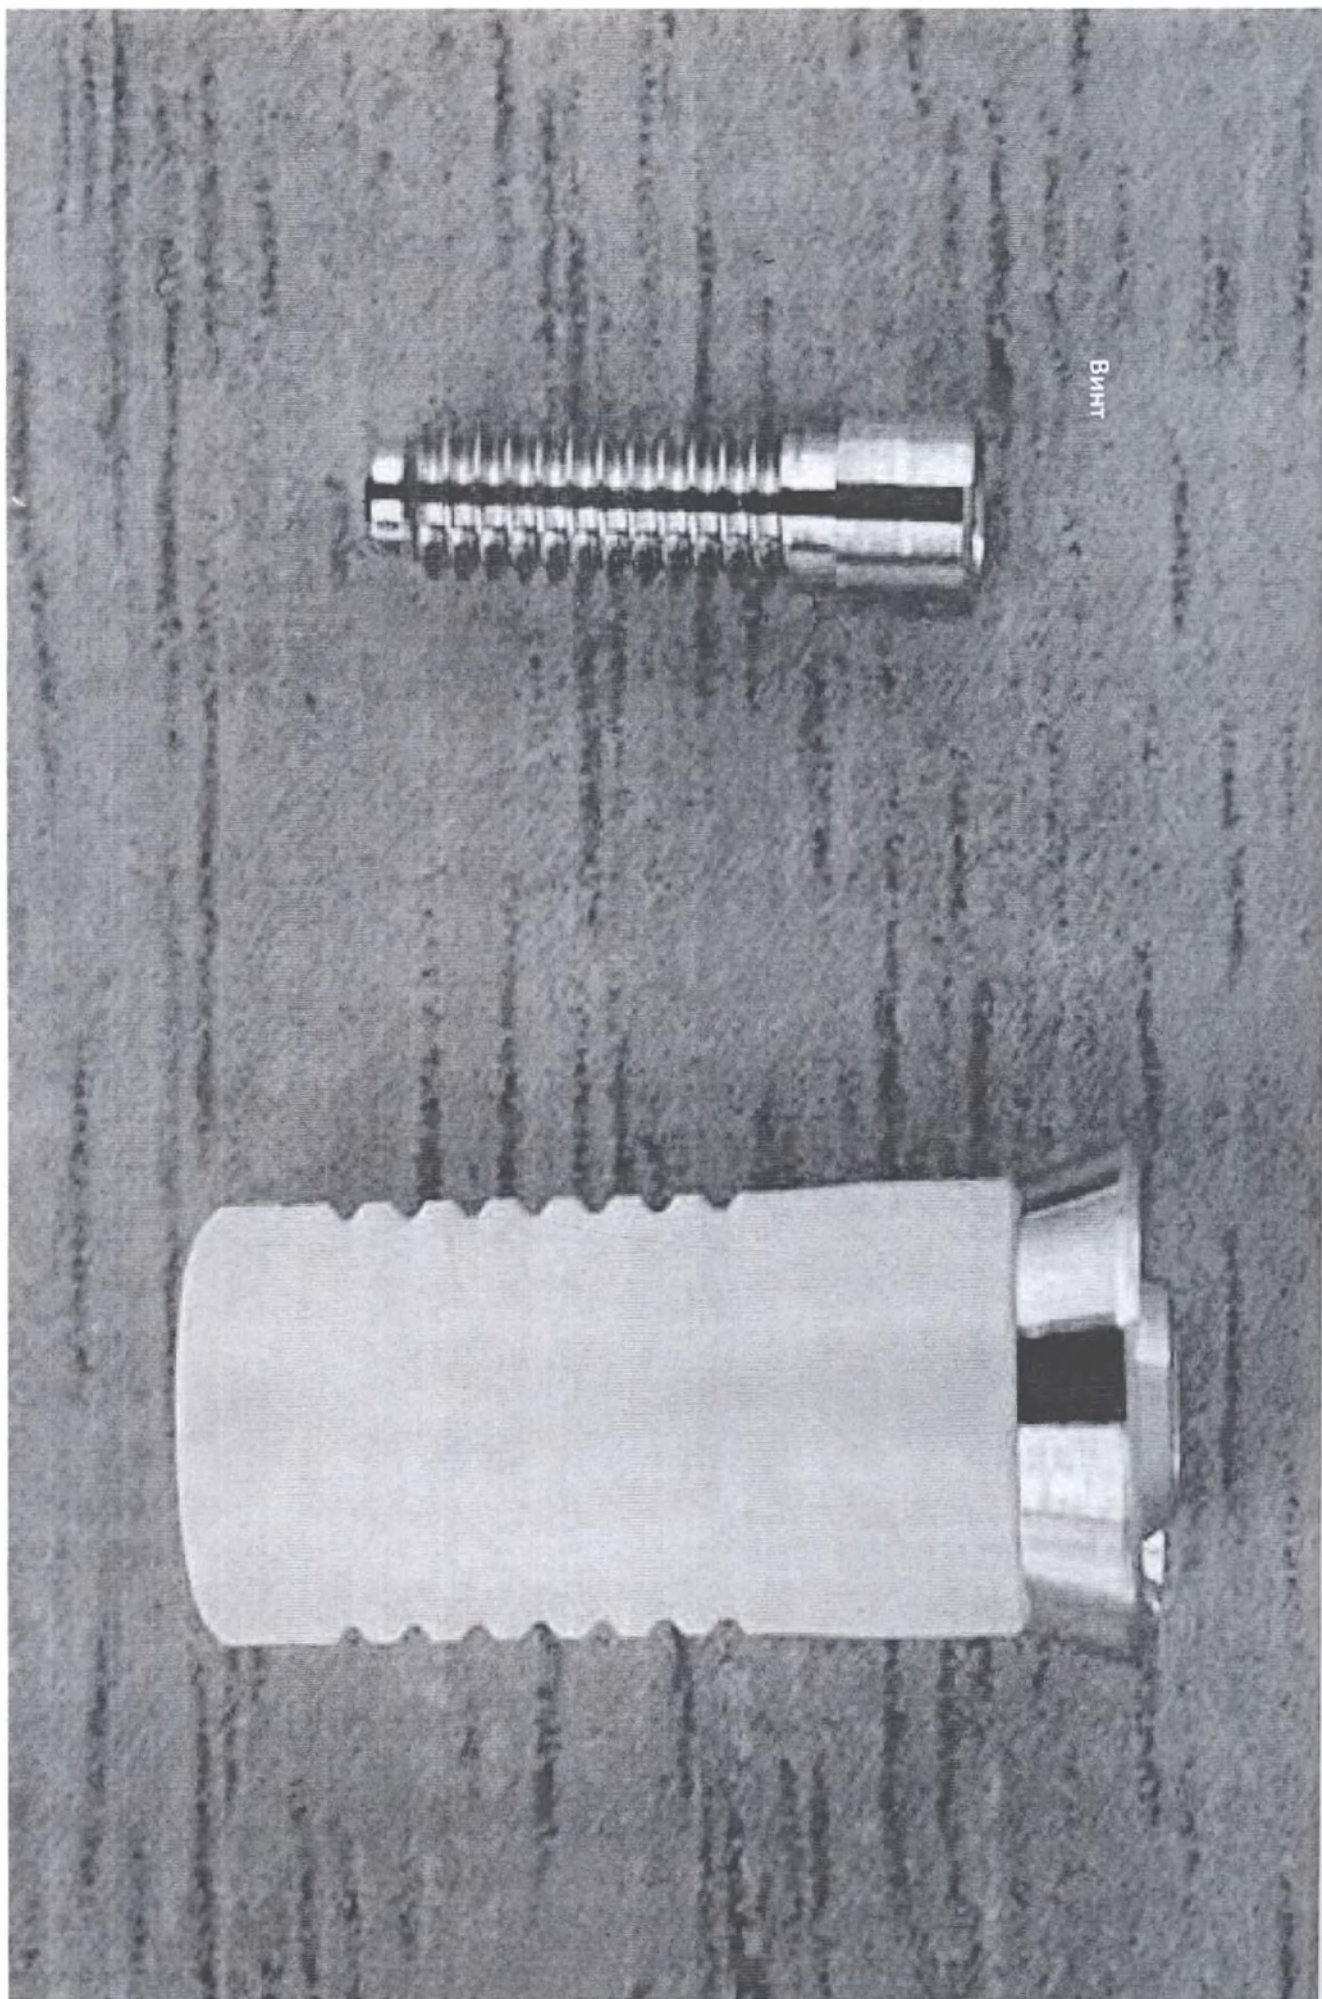


ВИНТ

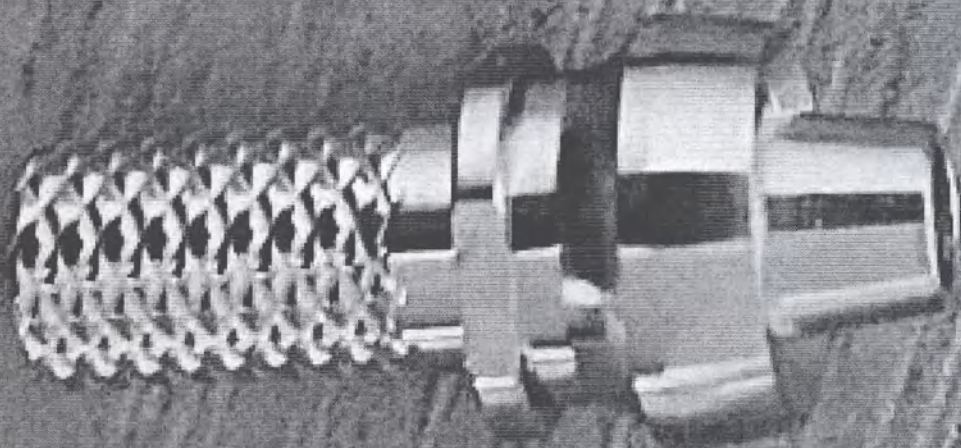


ВНТ

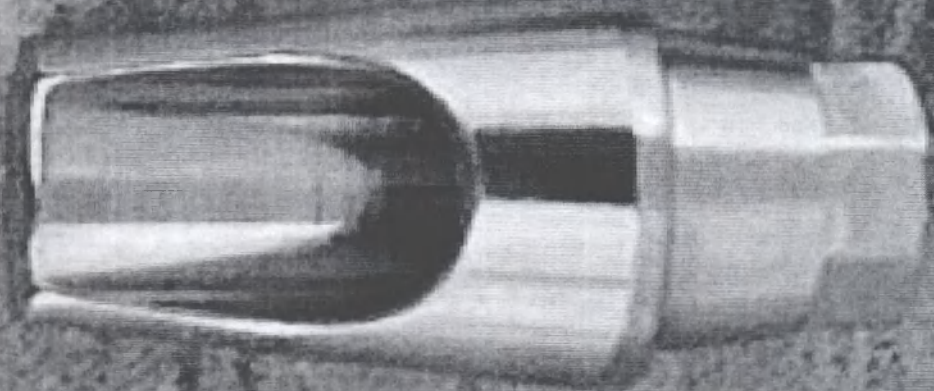

10. Абатмент Оста, варианты исполнения отличаются размерами

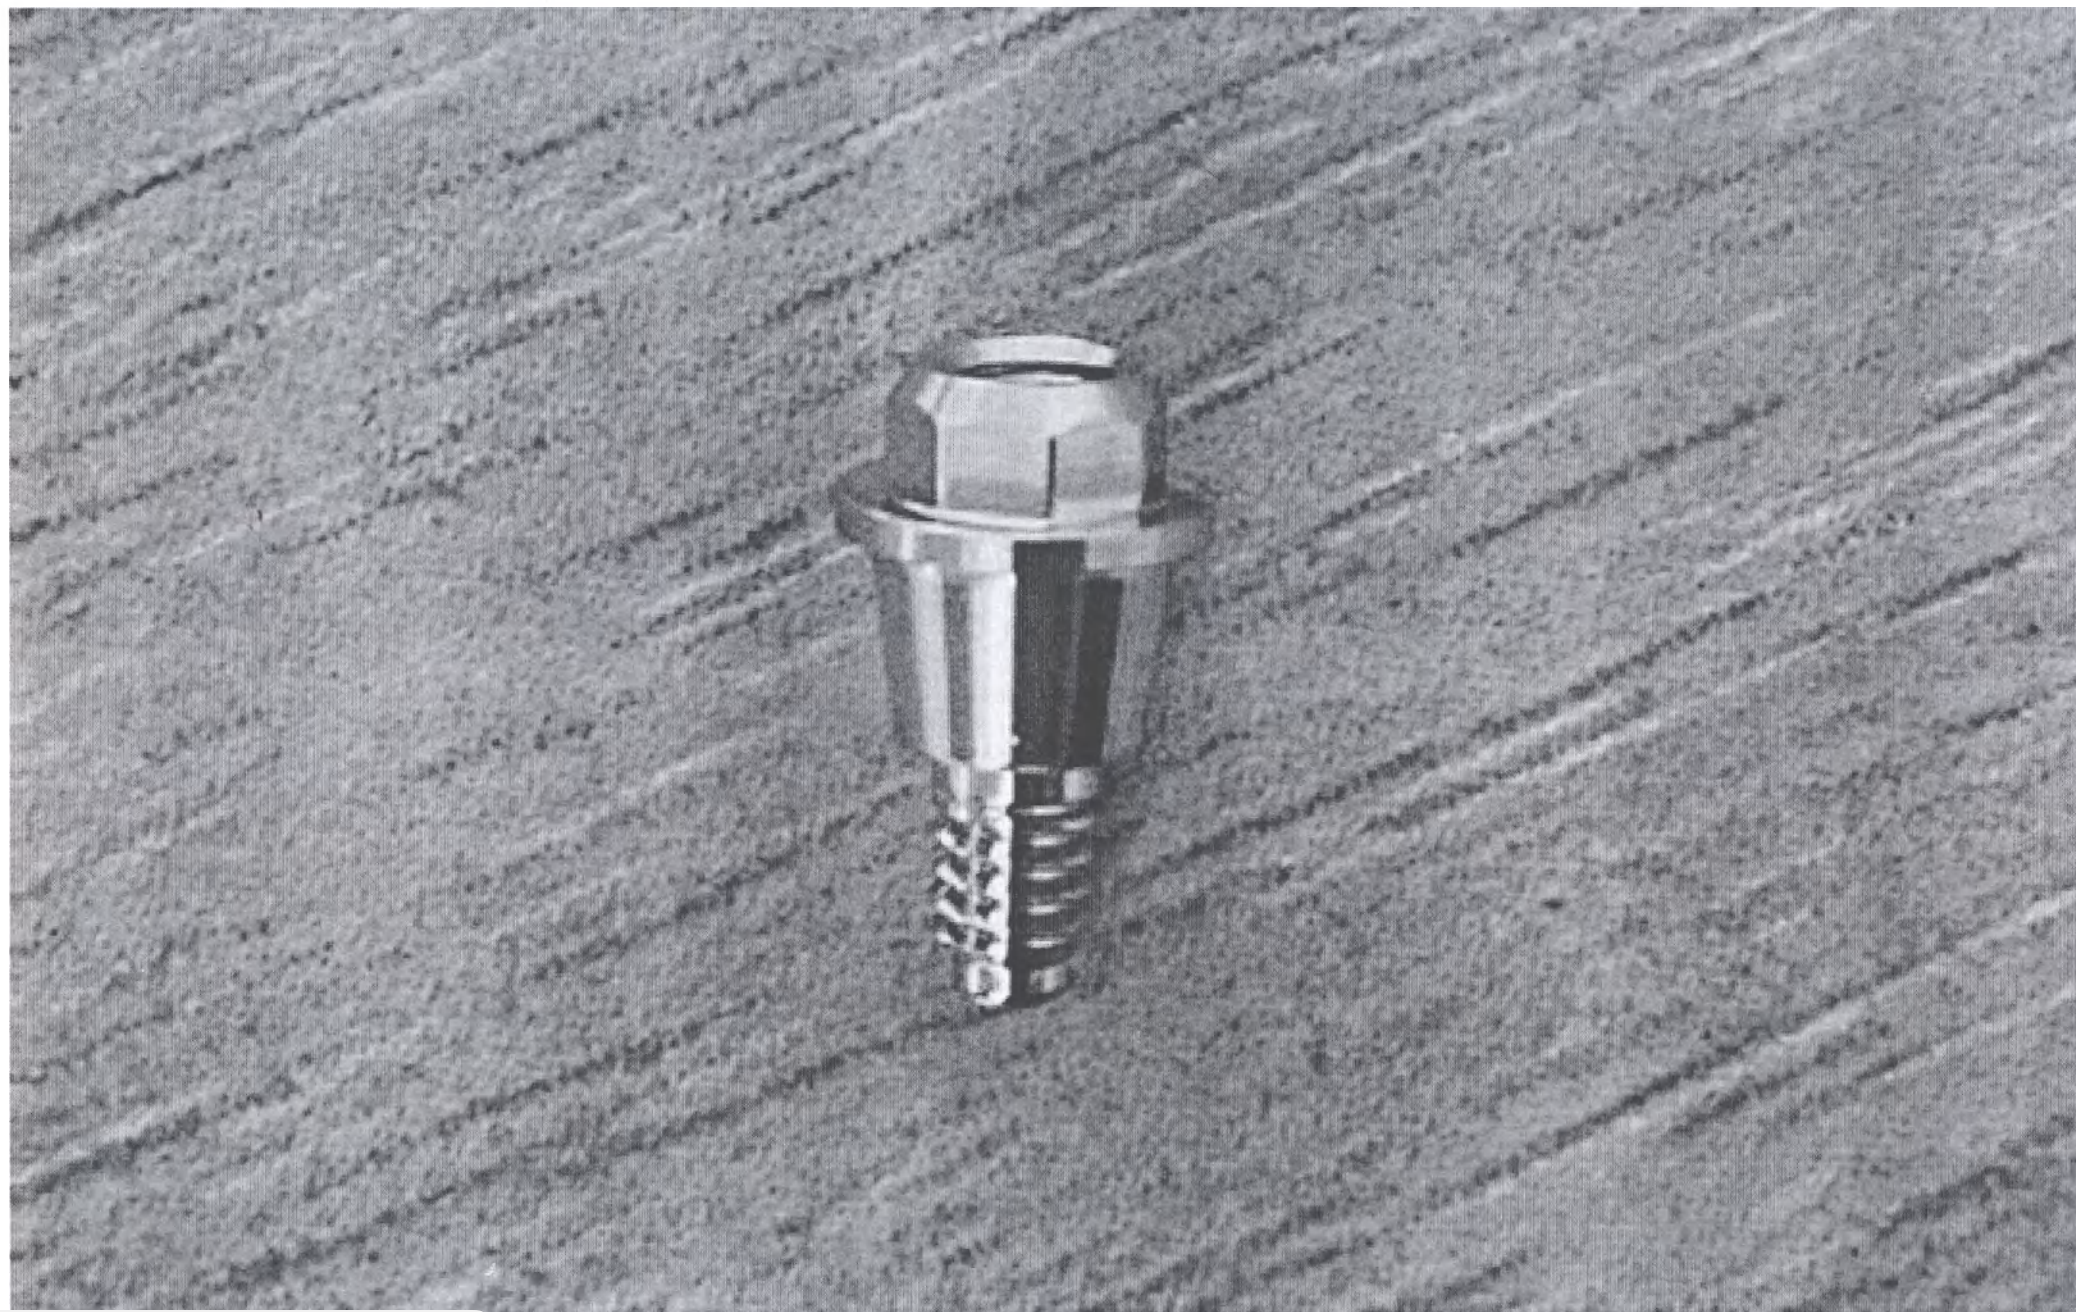

11. Аббатмент O-ring, варианты исполнения отличаются размерами

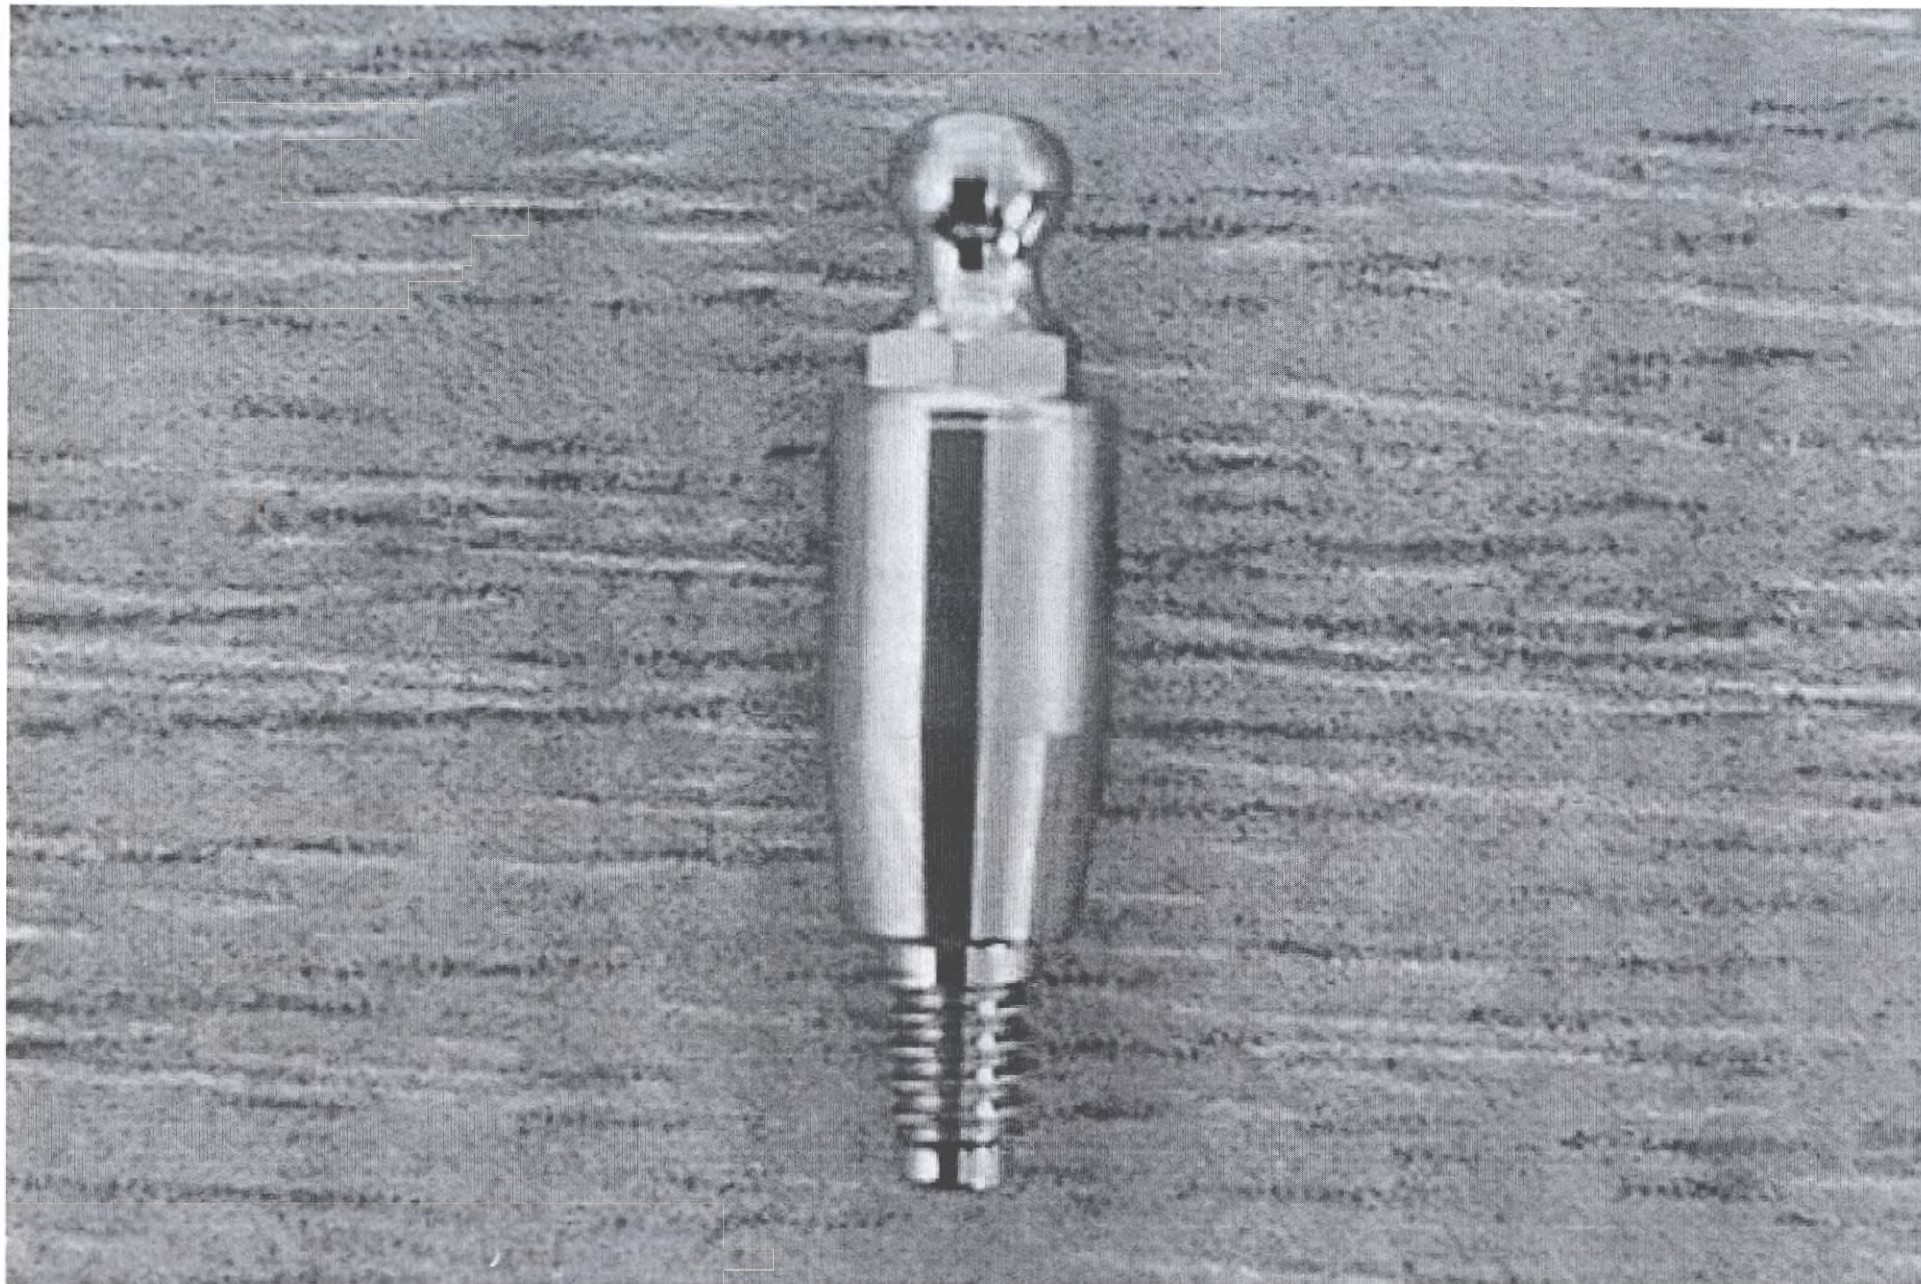

재사용 금지

22AC8C

SS O-ring
Abutment



Platform 4.8(Ø)
4.0mmIG/HI
모델명 : SSRA400
품목명 :
치과용임플란트상부구조물
포장단위 : 1개
제조번호 : PSA19B064
제조(수입)업허가번호 : 제116호
품목허가번호 : 제인06-550호
제조년월일 : 2019-02-11

"일회용" 의료기기



PSA19B0640011

OSSTEM[®]
IMPLANT

Storage Condition: Dry place at room temperature
Instruction: Refer to Manual

Manufacturer: OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.
66-ye, Binsong-ro 513beon-gil, Binsong-gu, Busan, Korea
TEL: 82-51-850-2500 FAX: 82-51-861-4693

제조업자: 오스템임플란트(주)
부산광역시 해운대구 반송로 513번길 66-16
TEL : 051-850-2500
FAX : 051-861-4693
www.osstem.com Made in Korea

Do Not
Reuse


⊗

Caution, Consult
accompanying
Documents

⚠

조립순서: 1. 상부구조물
2. O-ring
3. 하부구조물
4. O-ring
5. 상부구조물

Первичная упаковка: Актуальна для всех вариантов исполнения

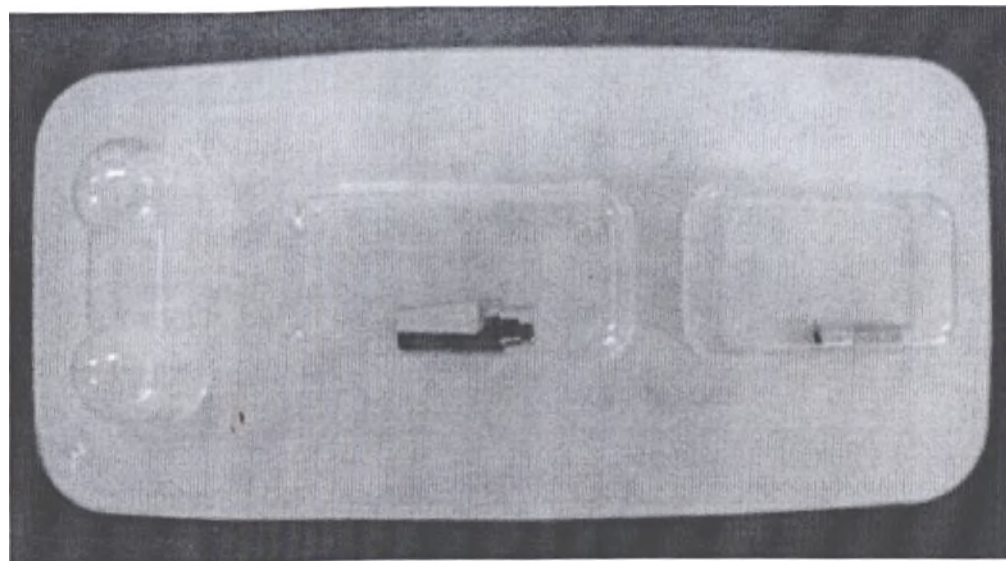



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

15 (пятнадцать) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись А. И. Г. / И. И. Г. /

« 20 » 05 20 20 г.

