

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Физиотехника»



Лапаев А.Е.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ И МАРКИРОВКИ

Ванна медицинская для проведения воздушно-углекислых, воздушно-радоновых лечебных процедур «ГЕЙЗЕР» по ТУ 32.50.21-026-76228444-2019


Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "Физиотехника", г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 23, литер А, помещение 2-Н


Адрес места производства: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», дер. Малое Карлино

1. «Ванна медицинская для проведения воздушно-углекислых, воздушно-радоновых лечебных процедур «ГЕЙЗЕР», исполнение 1-СУВ. ТУ 32.50.21-026-76228444-2019»

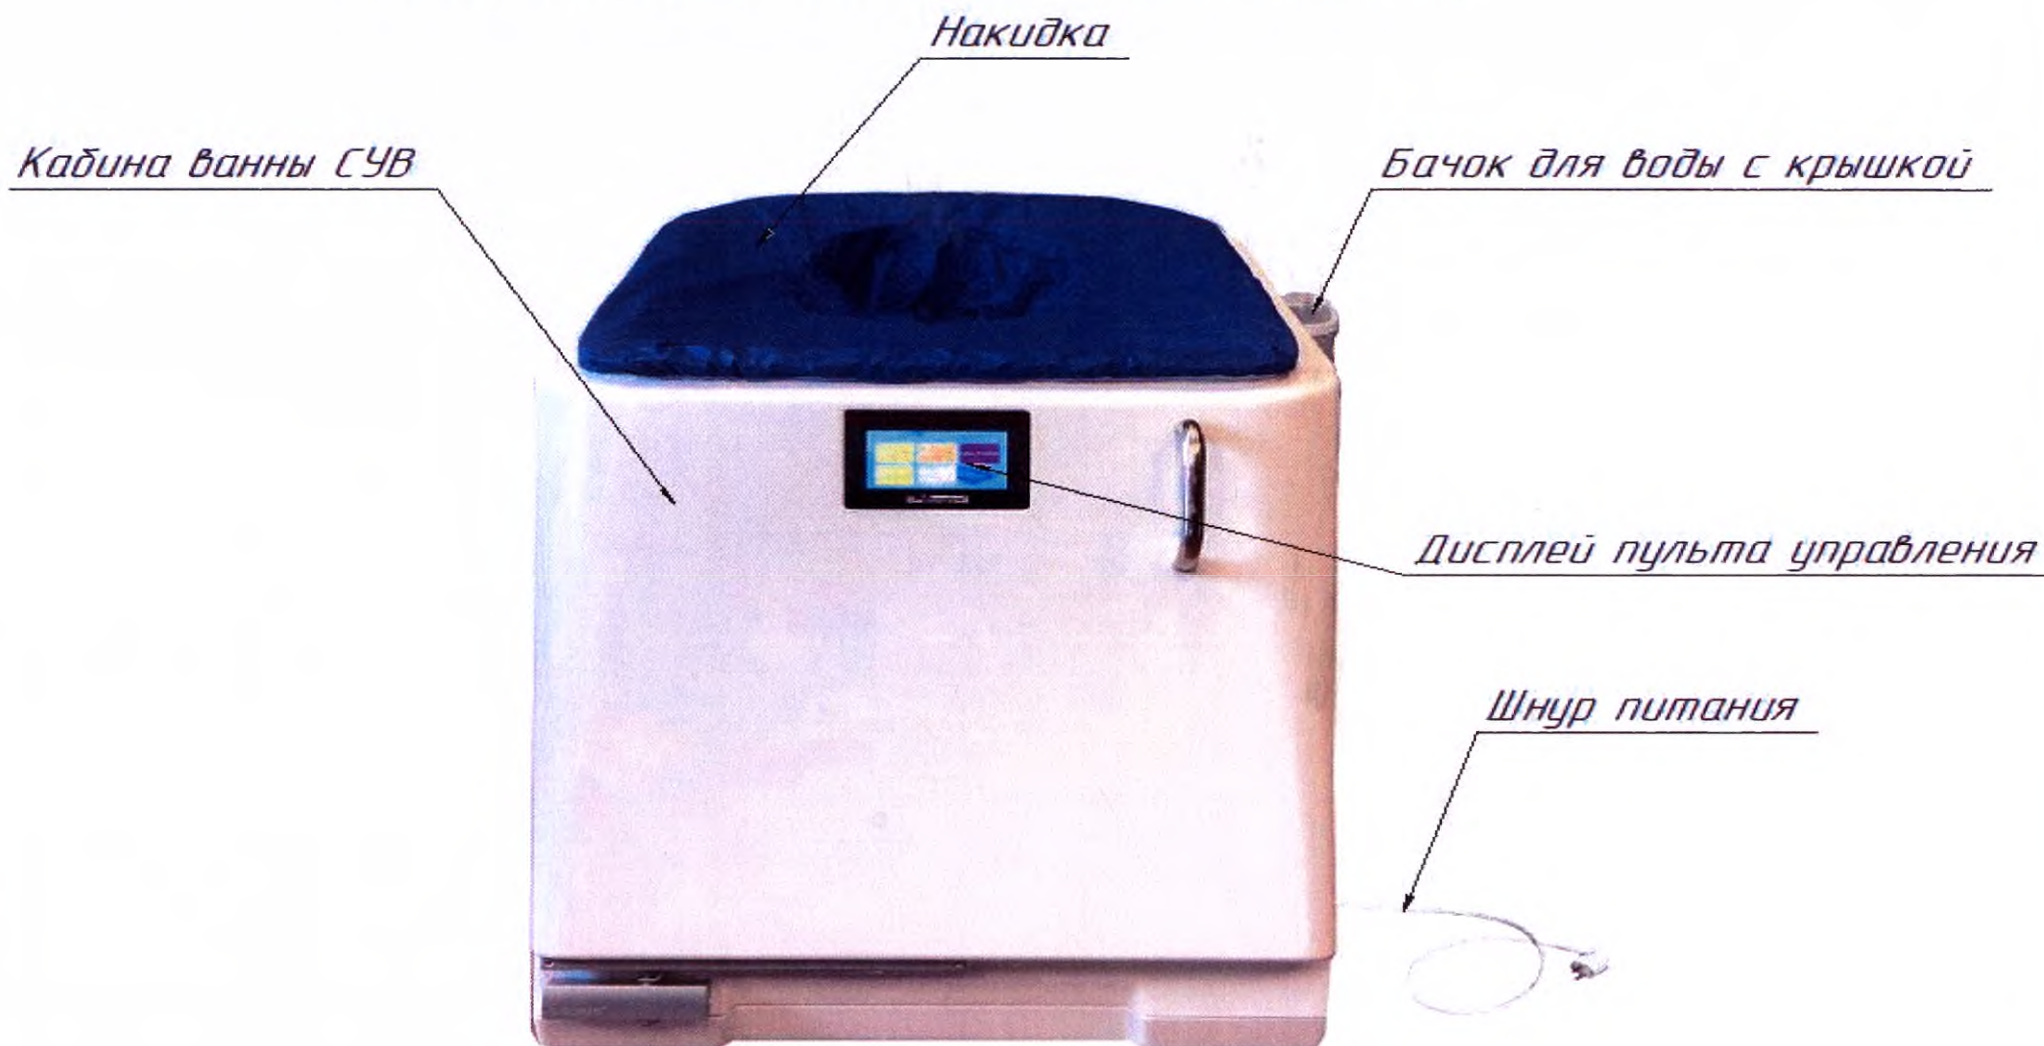

2. «Ванна медицинская для проведения воздушно-углекислых, воздушно-радоновых лечебных процедур «ГЕЙЗЕР», исполнение 2-СУВР. ТУ 32.50.21-026-76228444-2019»

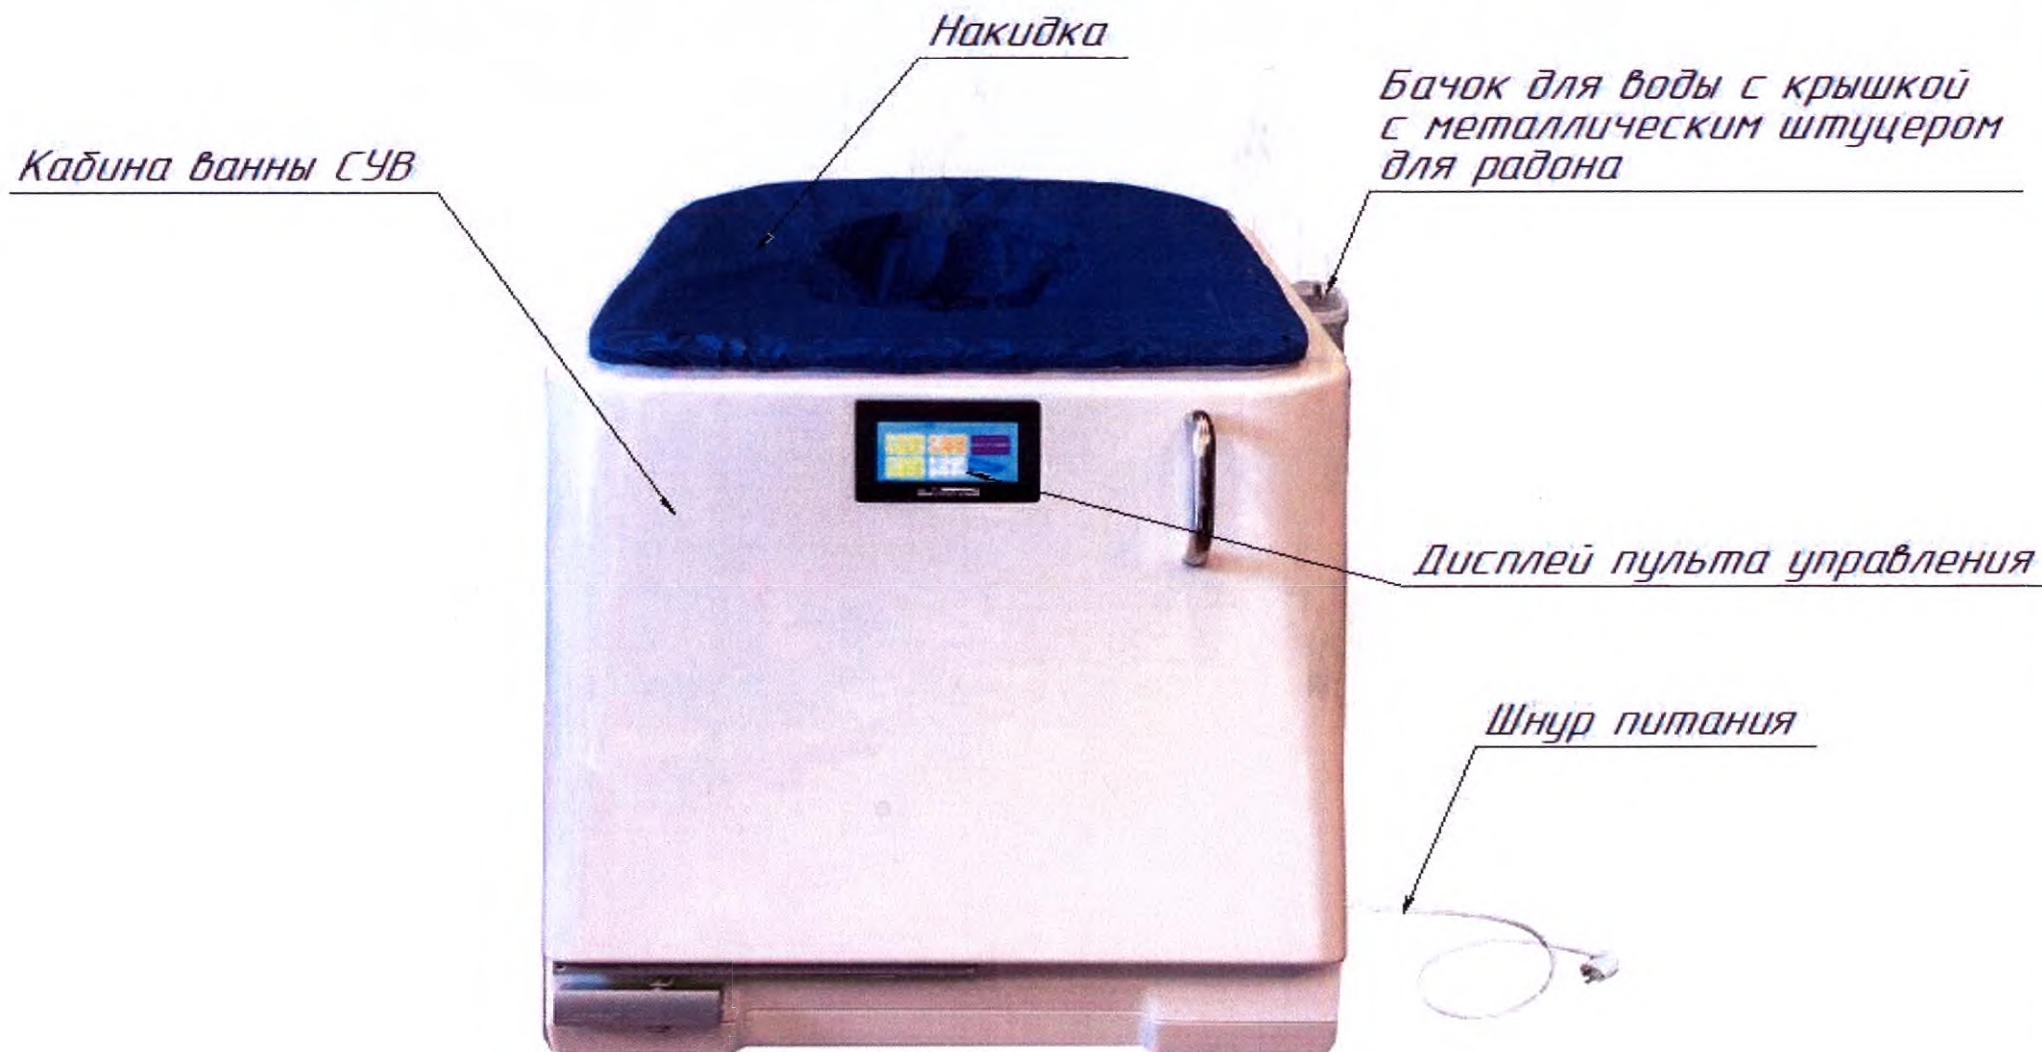


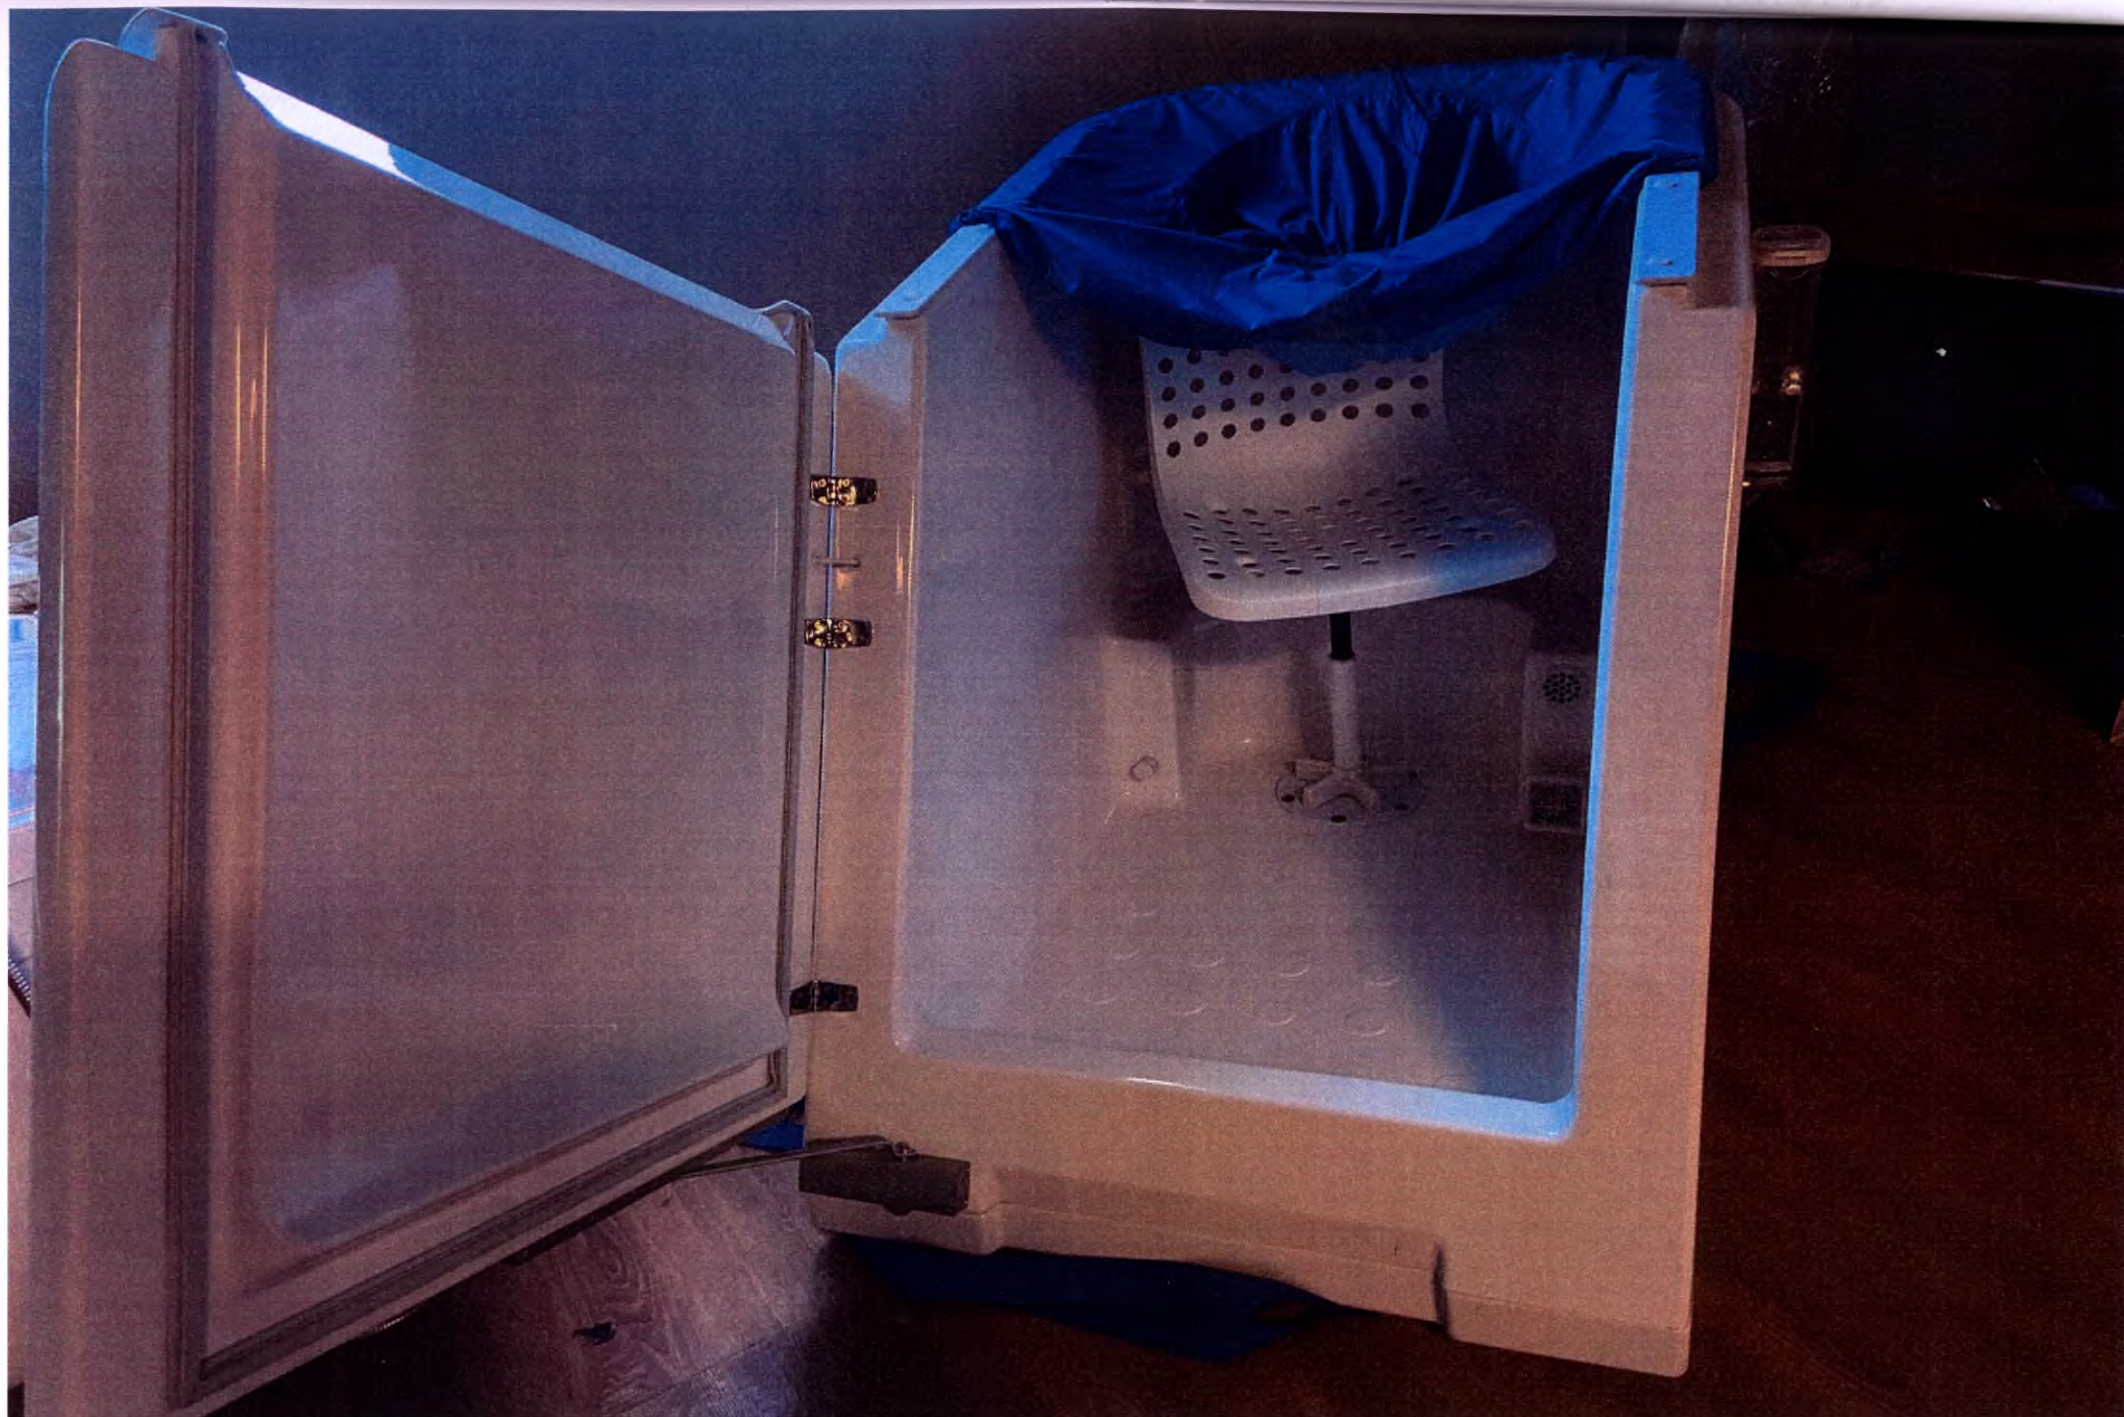




Накидка



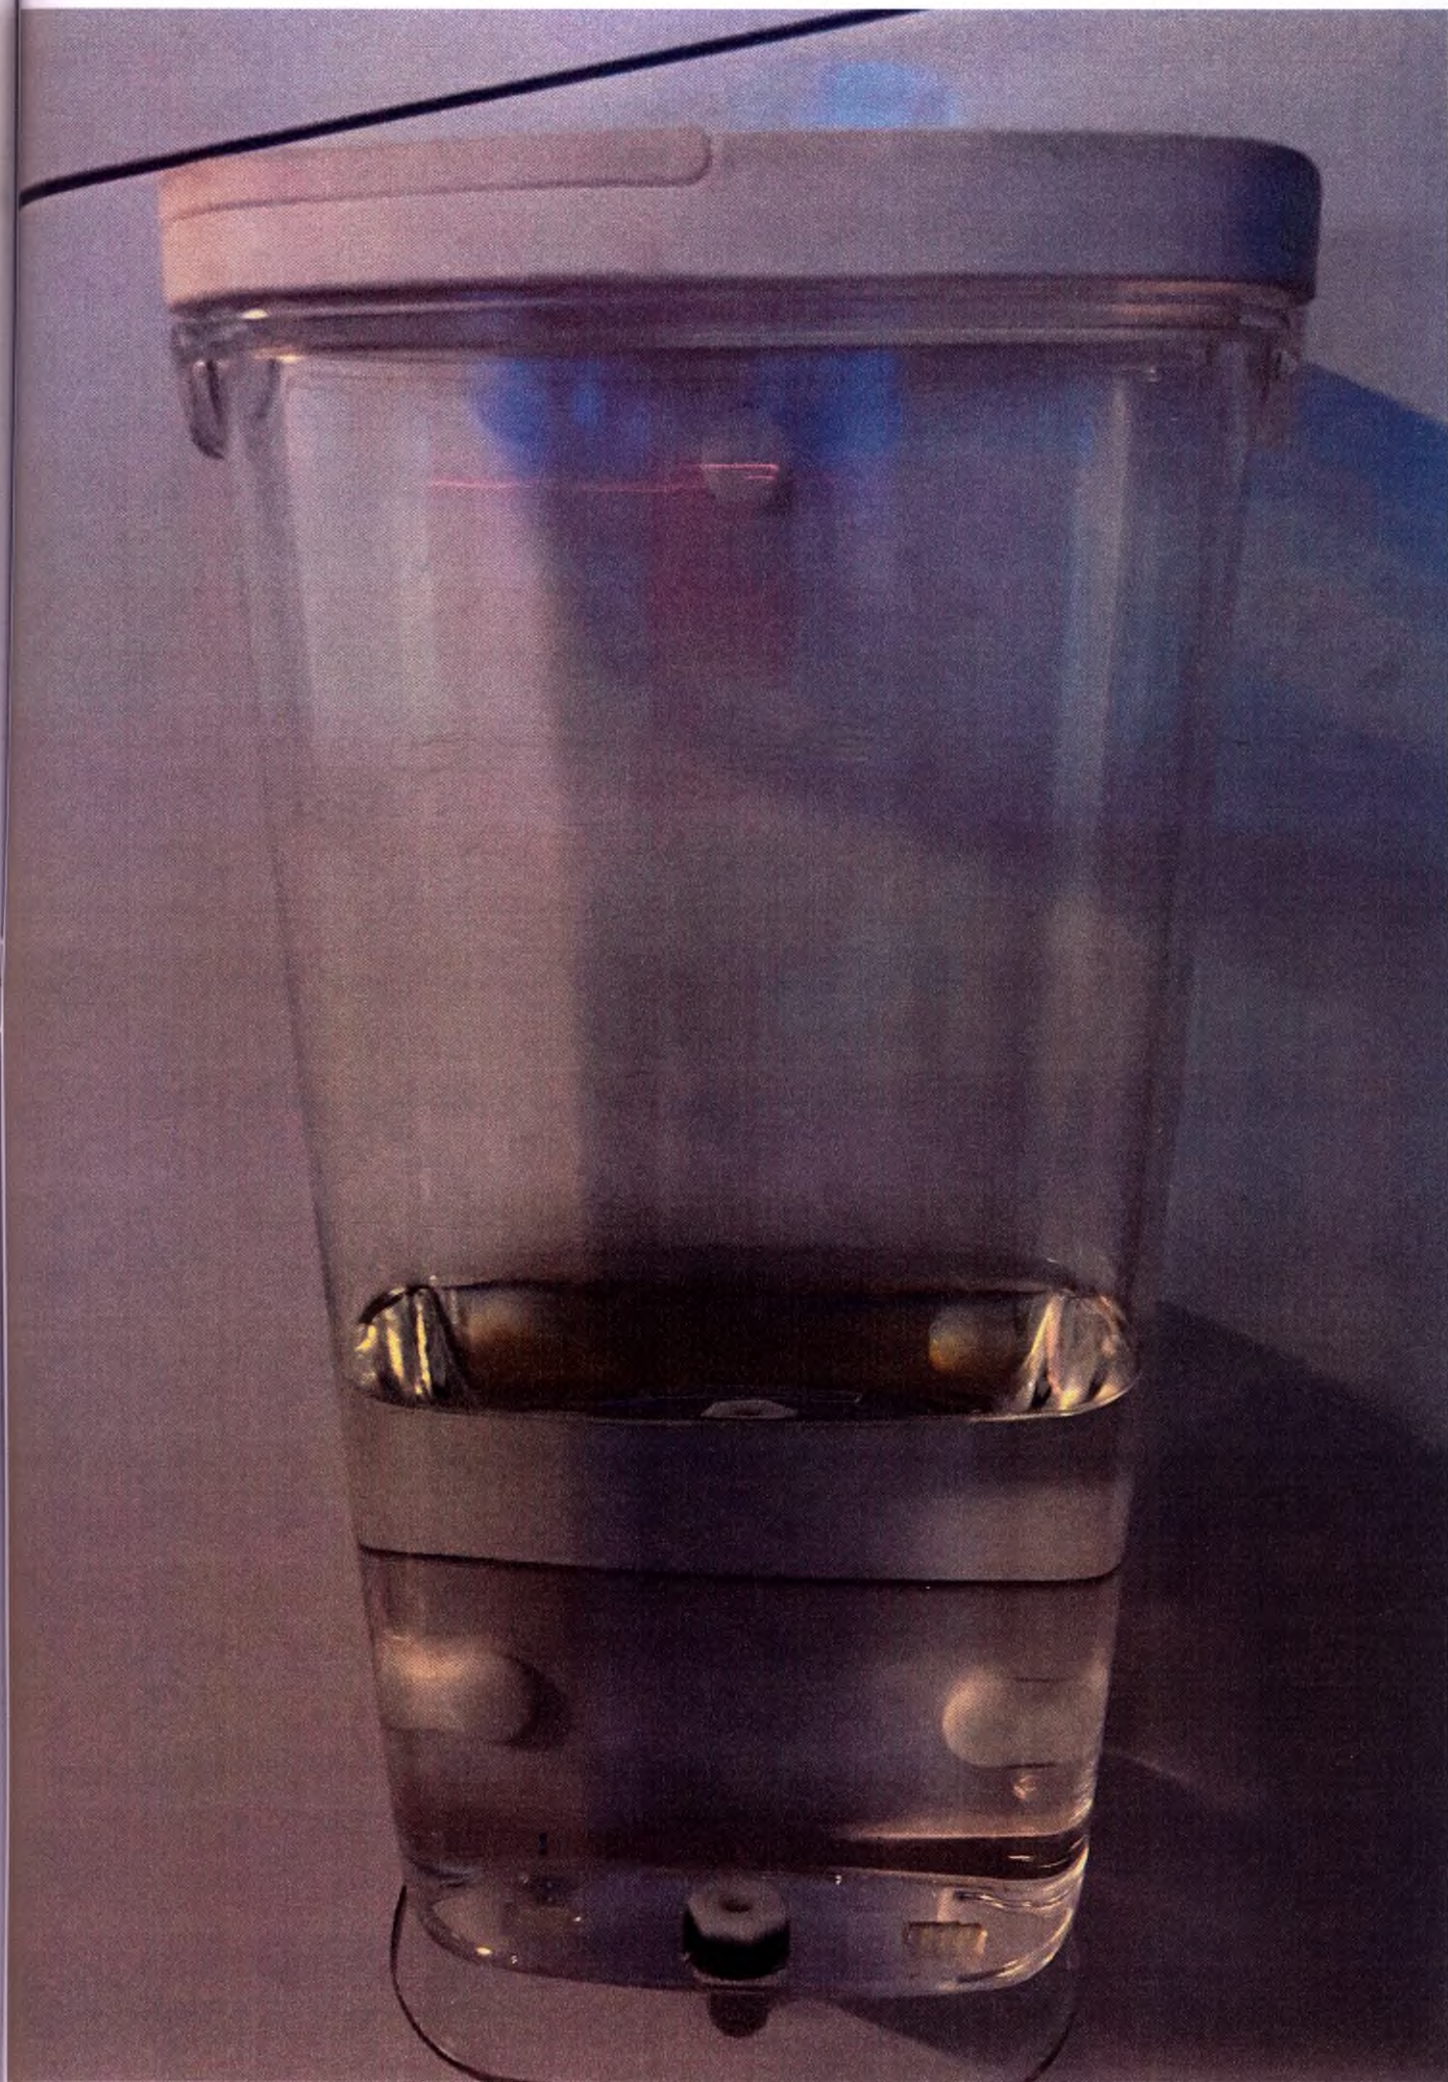

бачок для воды с крышкой

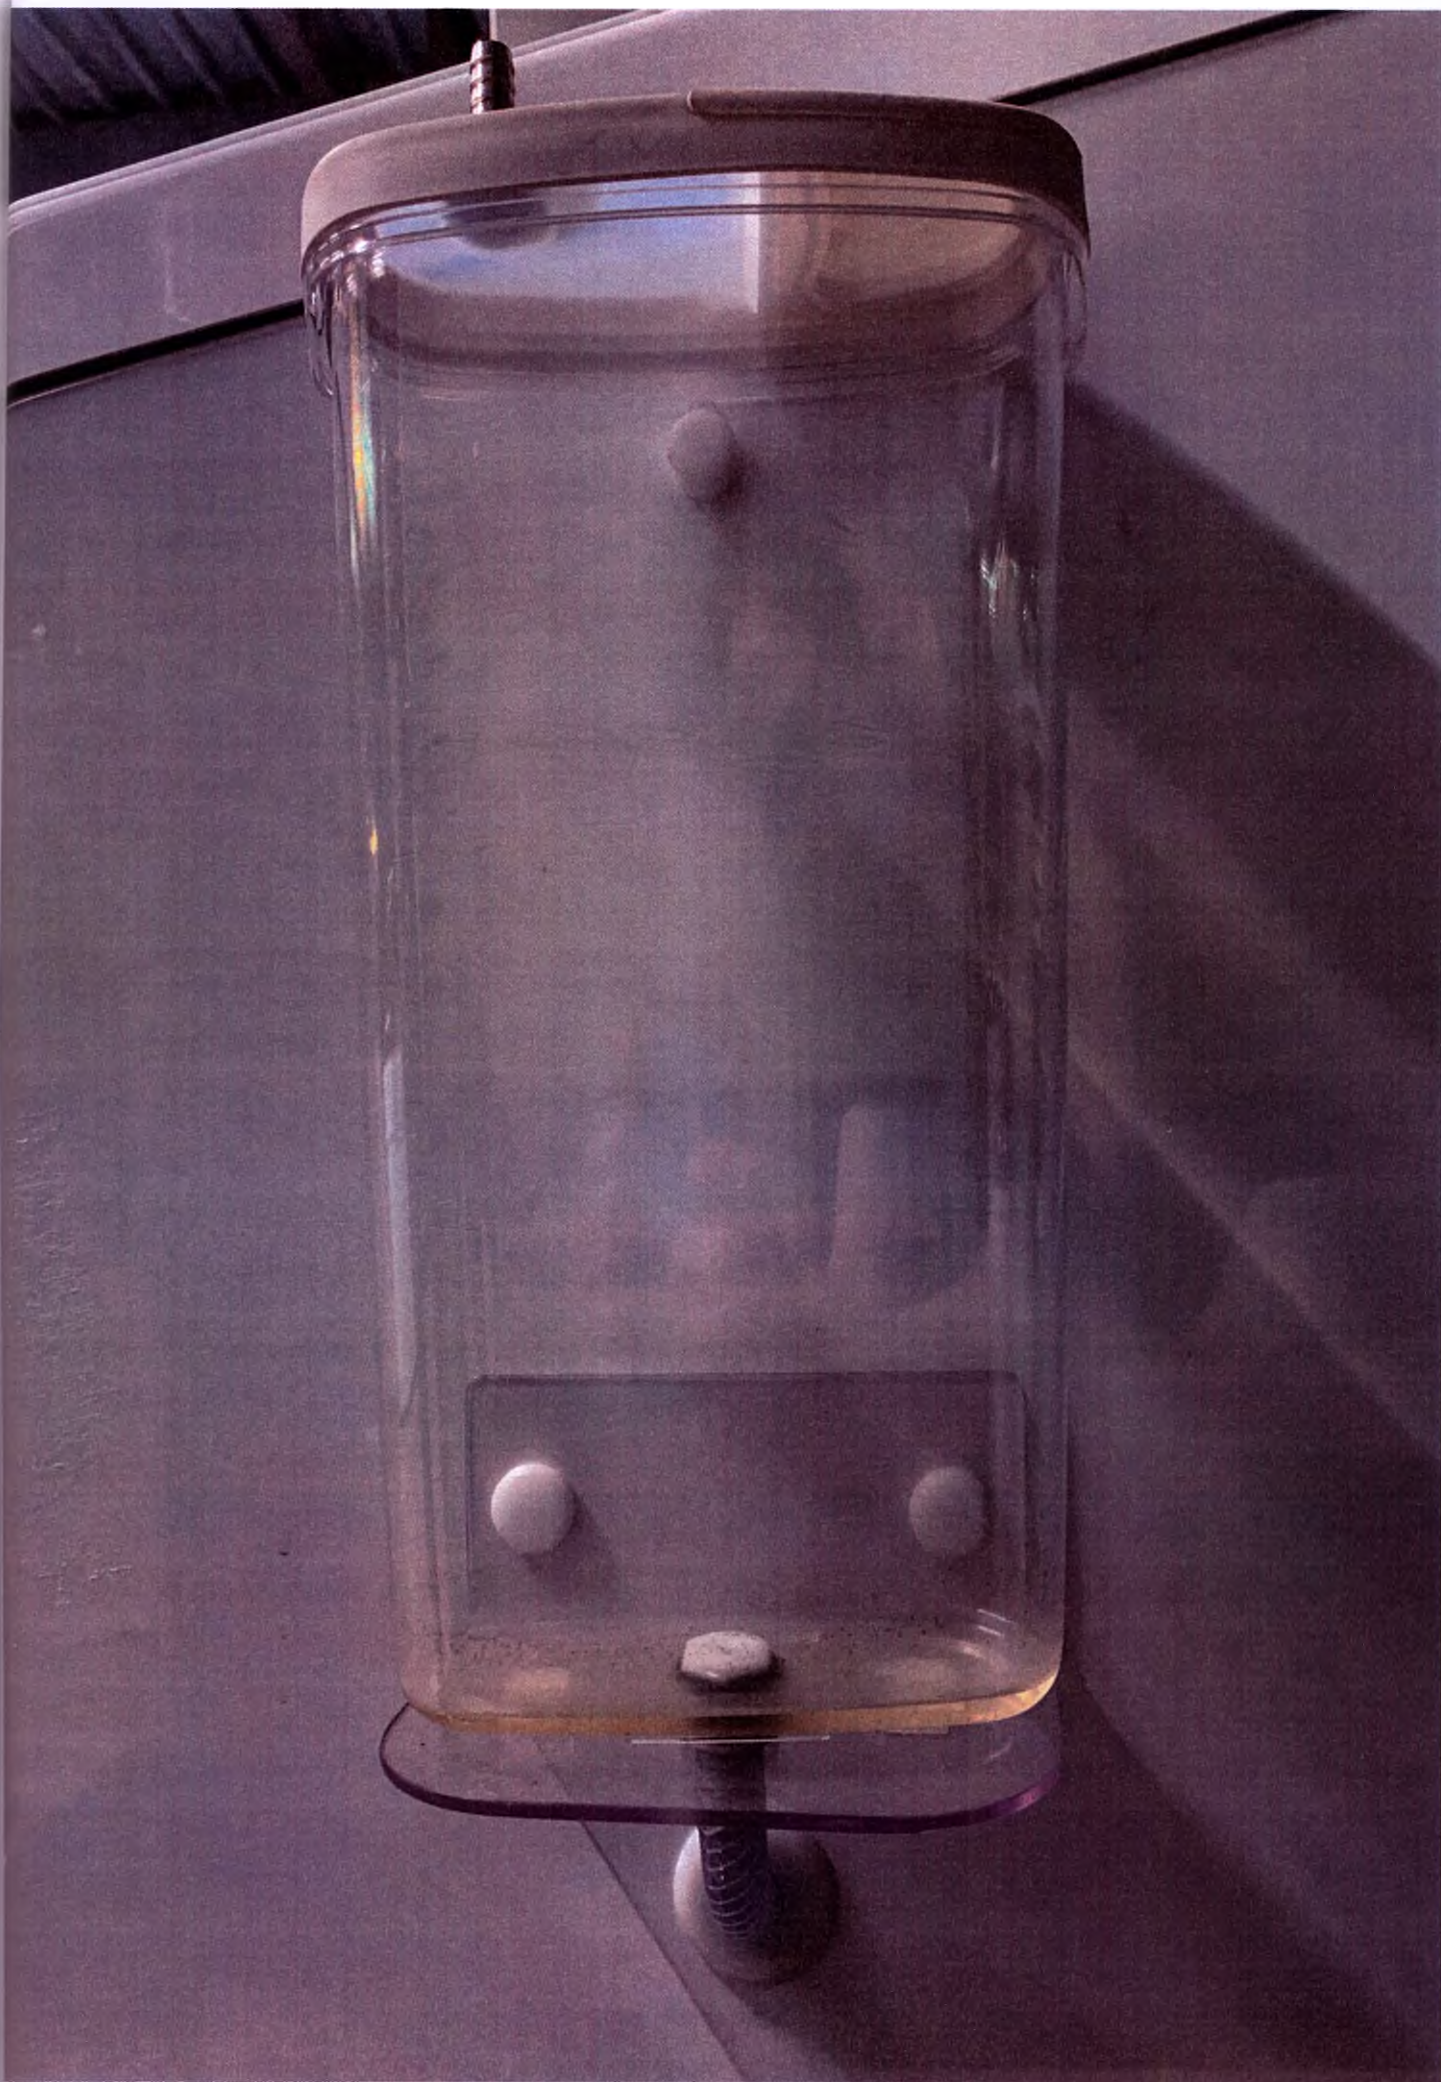

бачок для воды с крышкой с металлическим штуцером для радона







Рхуsиотесhниса

 - ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Ванна медицинская для проведения
воздушно-углекислых, воздушно-радоновых лечебных
процедур «ГЕЙЗЕР», исполнение 1-СУВ

напряжение питания и частота переменного тока

питающей сети - ~220В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 2,0

 - 001

 - 2019г (IV квартал)

ТУ 32.50.21-026-76228444-2019



Physiotecnica

 - ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Ванна медицинская для проведения
воздушно-углекислых, воздушно-радоновых лечебных
процедур «ГЕЙЗЕР», исполнение 2-СУВР

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - ~220В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 2,0

 SN - 001

 - 2019г (IV квартал)

ТУ 32.50.21-026-76228444-2019



Прошито и пронумеровано
Кол-во: 13 (включая) листа

Подпись
Ген. дир. Лапаев А.Е.

