



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ”
 серия 1

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “20” 11 2019 г.

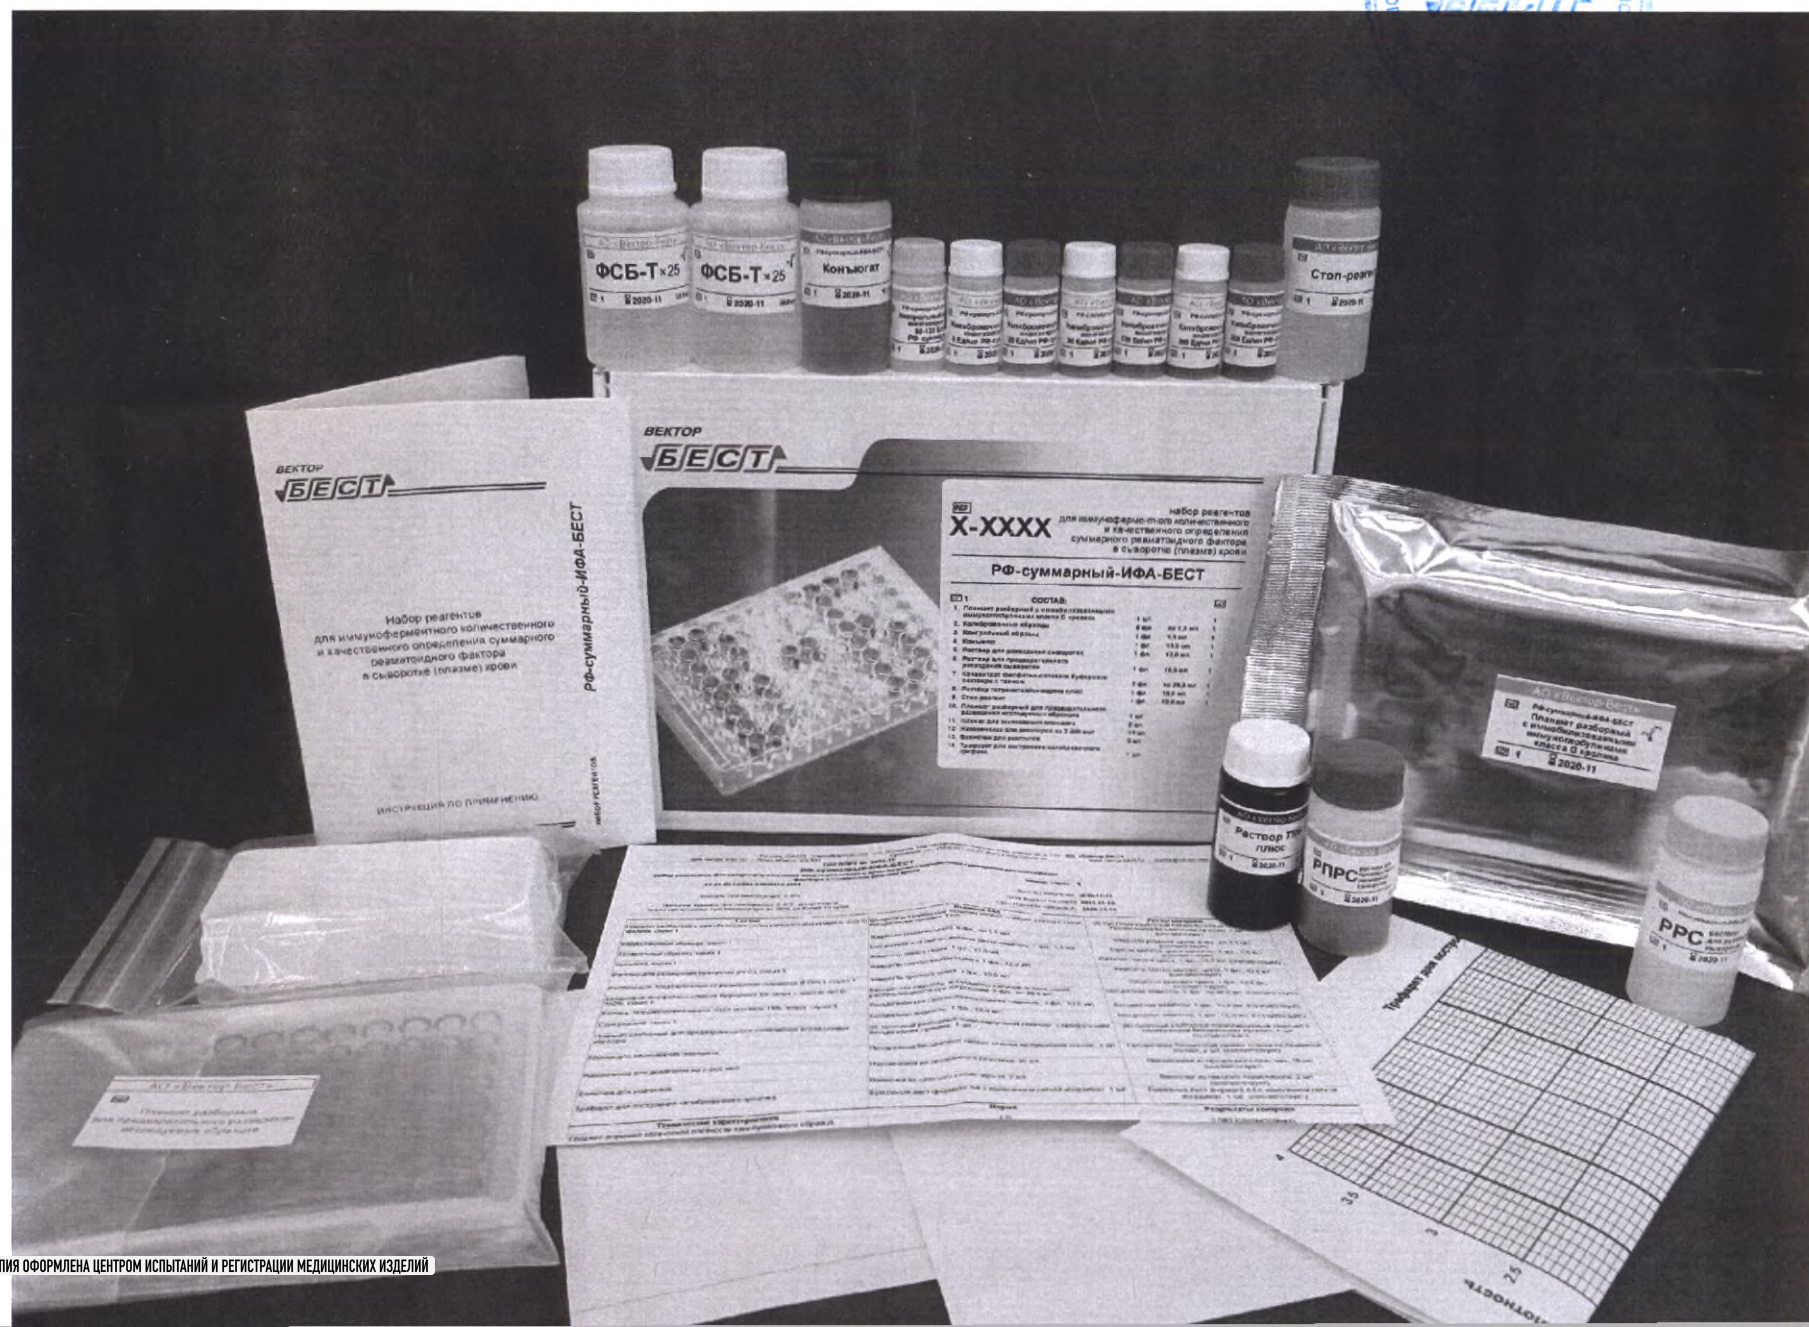



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ” №1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“20” 11 2019 г.

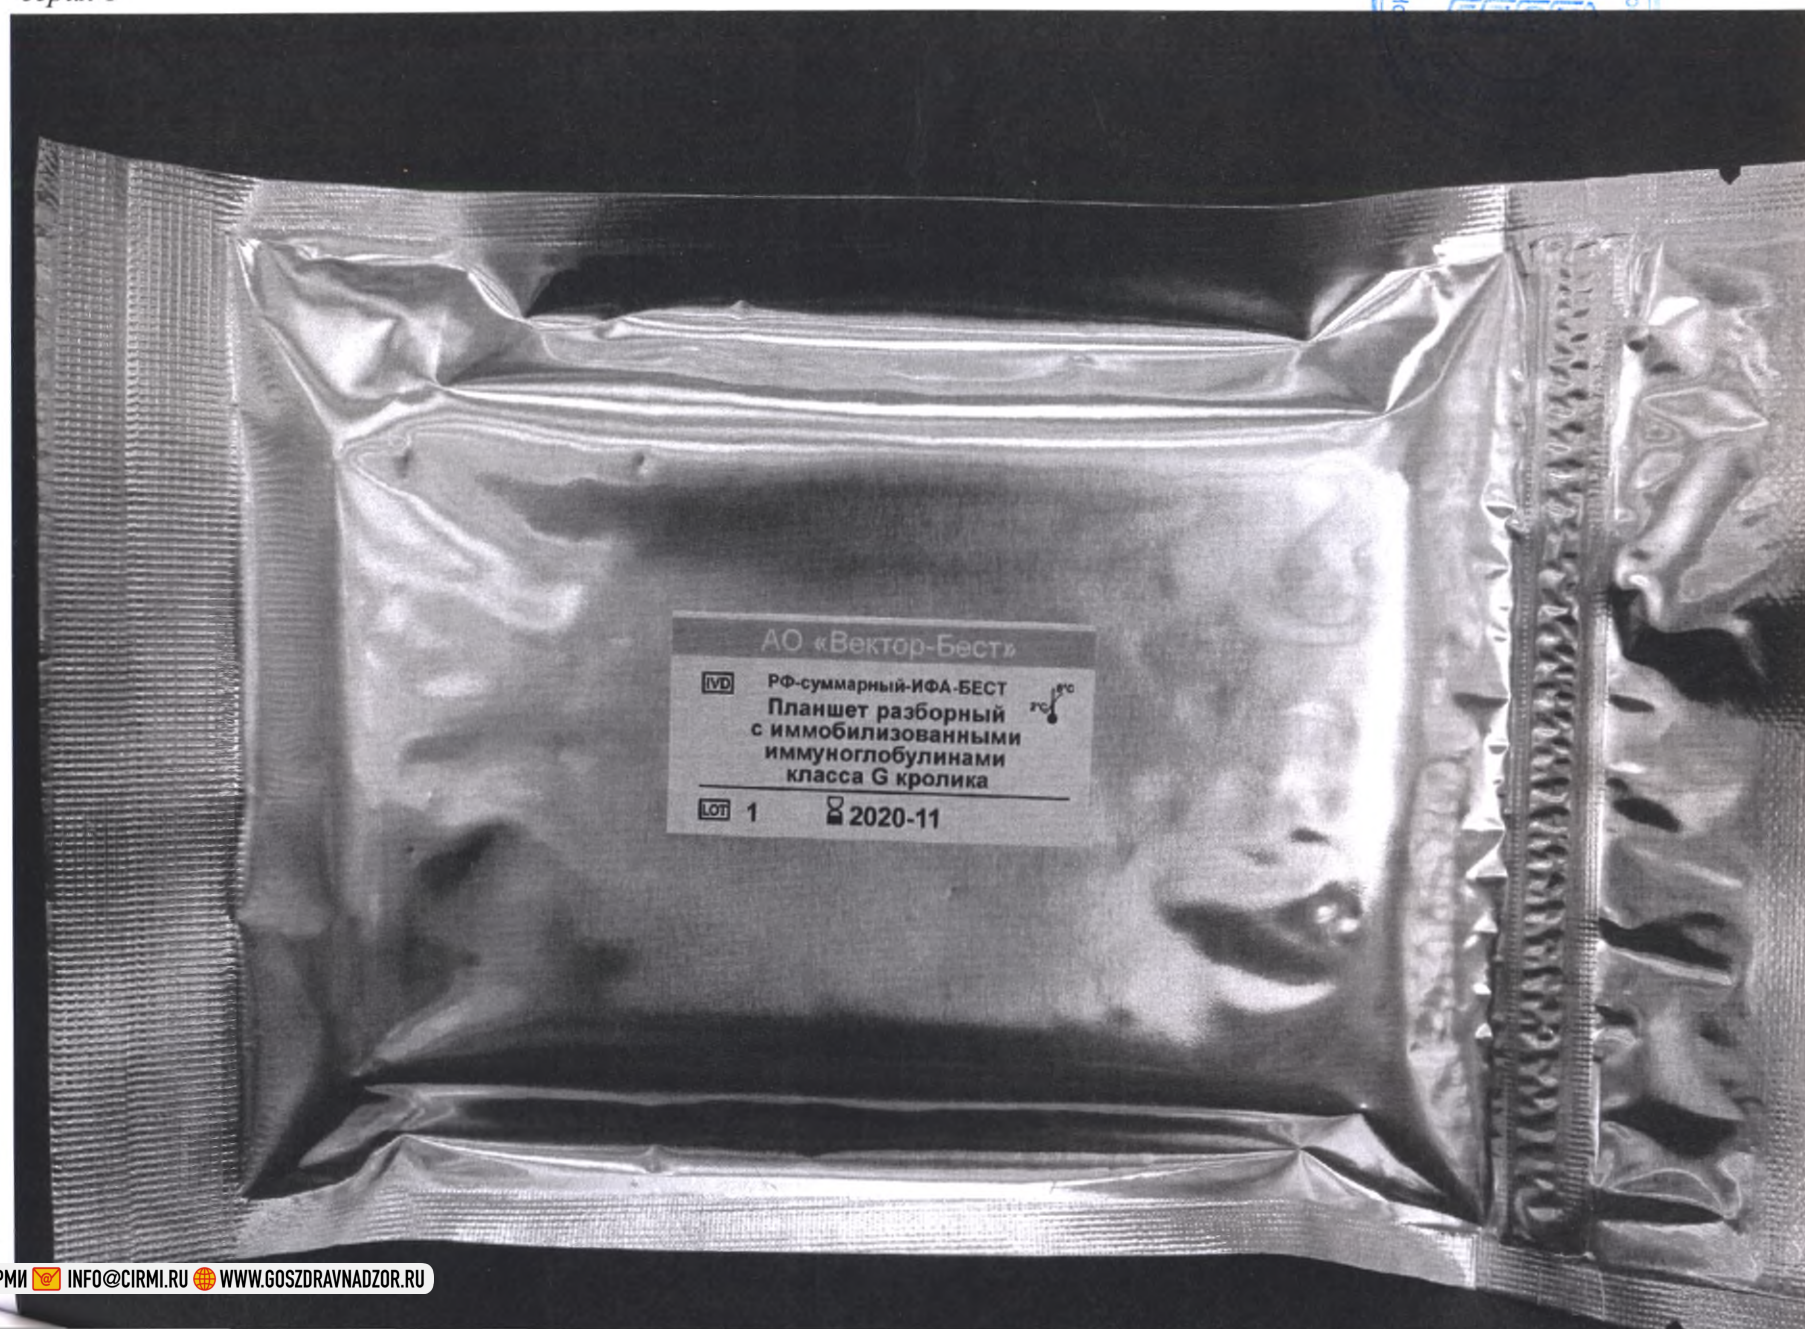



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“20” 11. 2019 г.

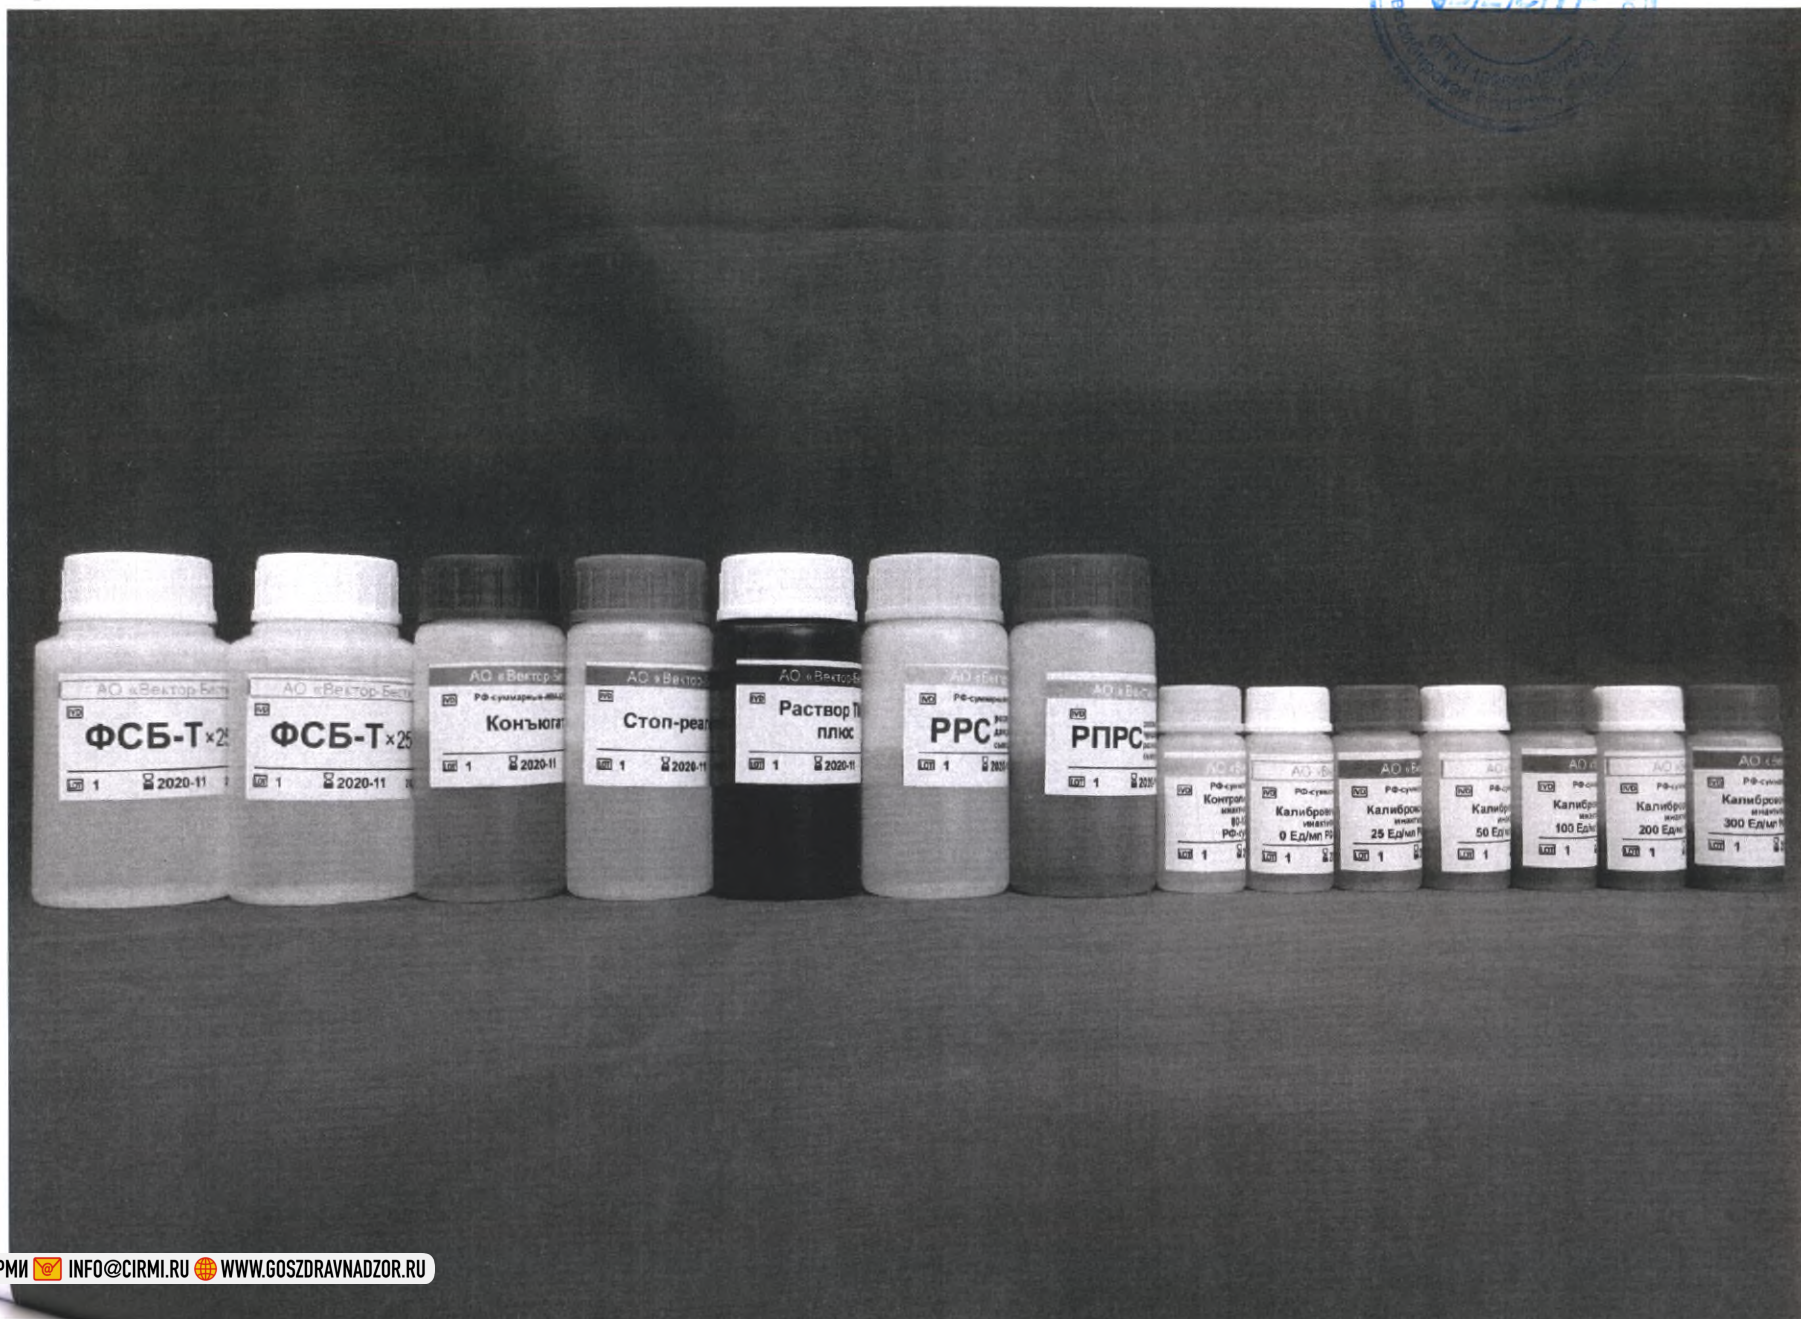


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“20” 11 2019 г.

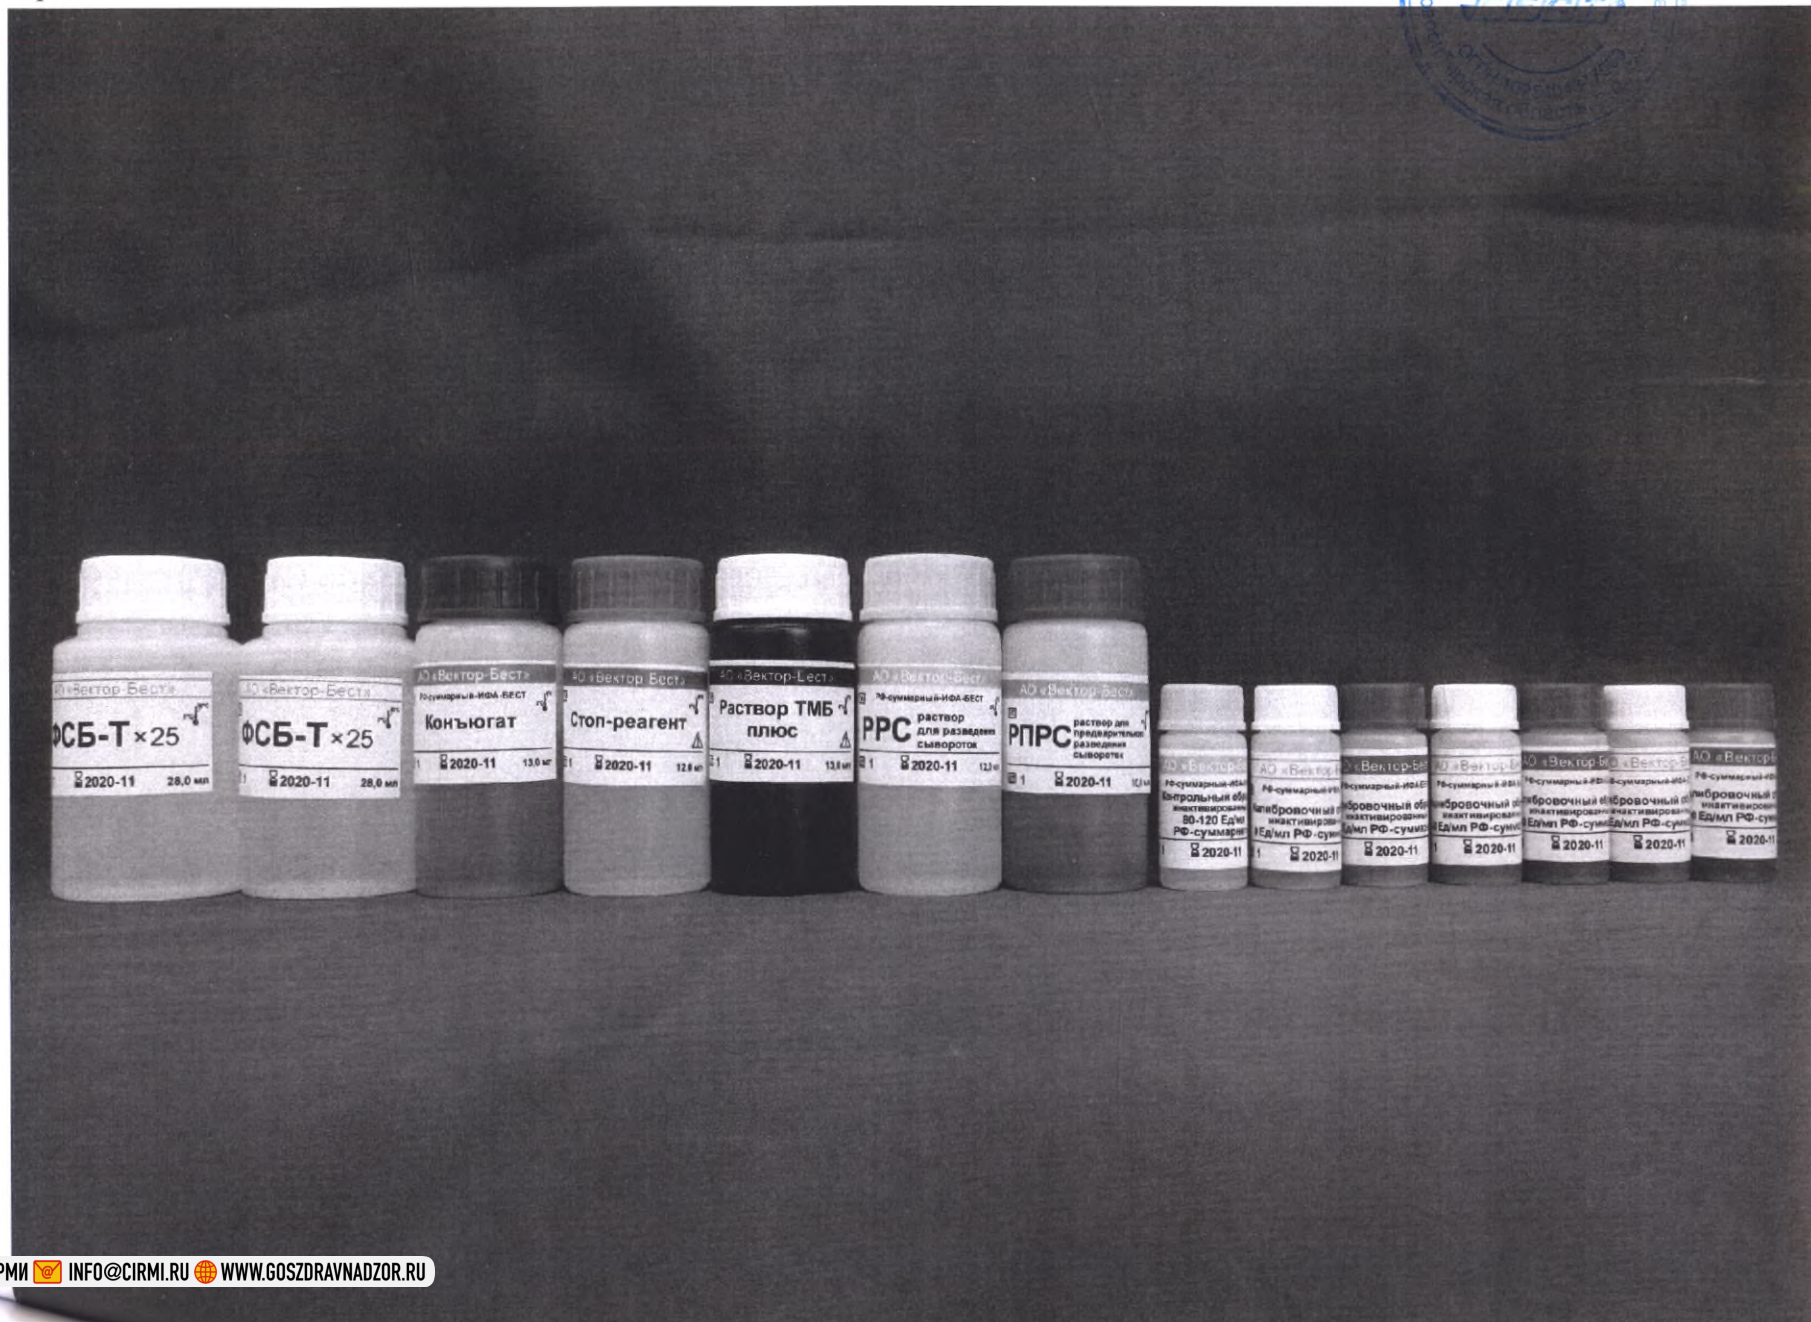


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ” № 4
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“20” 11/ 2019 г.

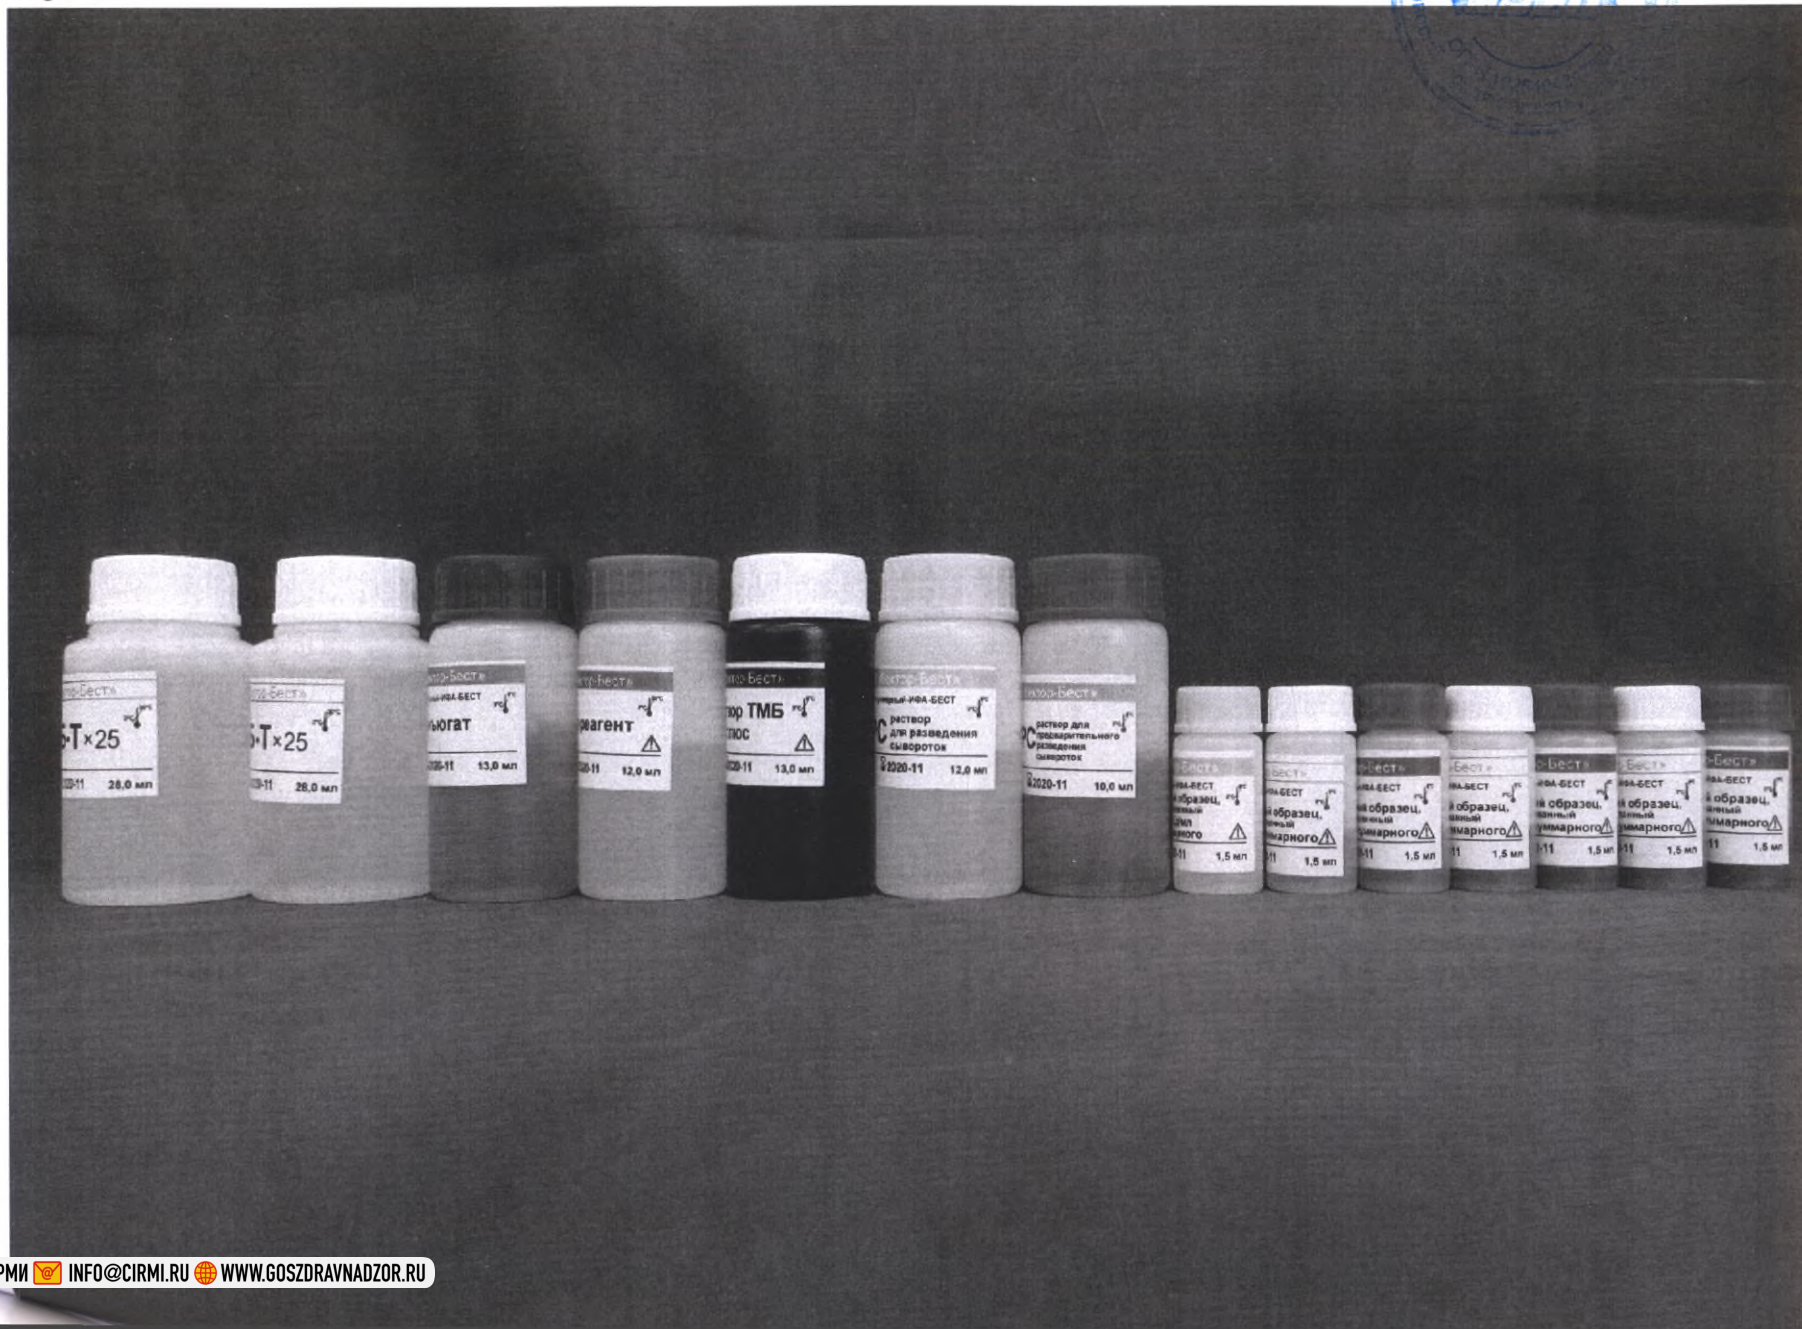


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ” № 5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов

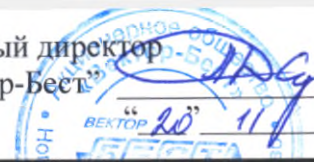


20 19 г.

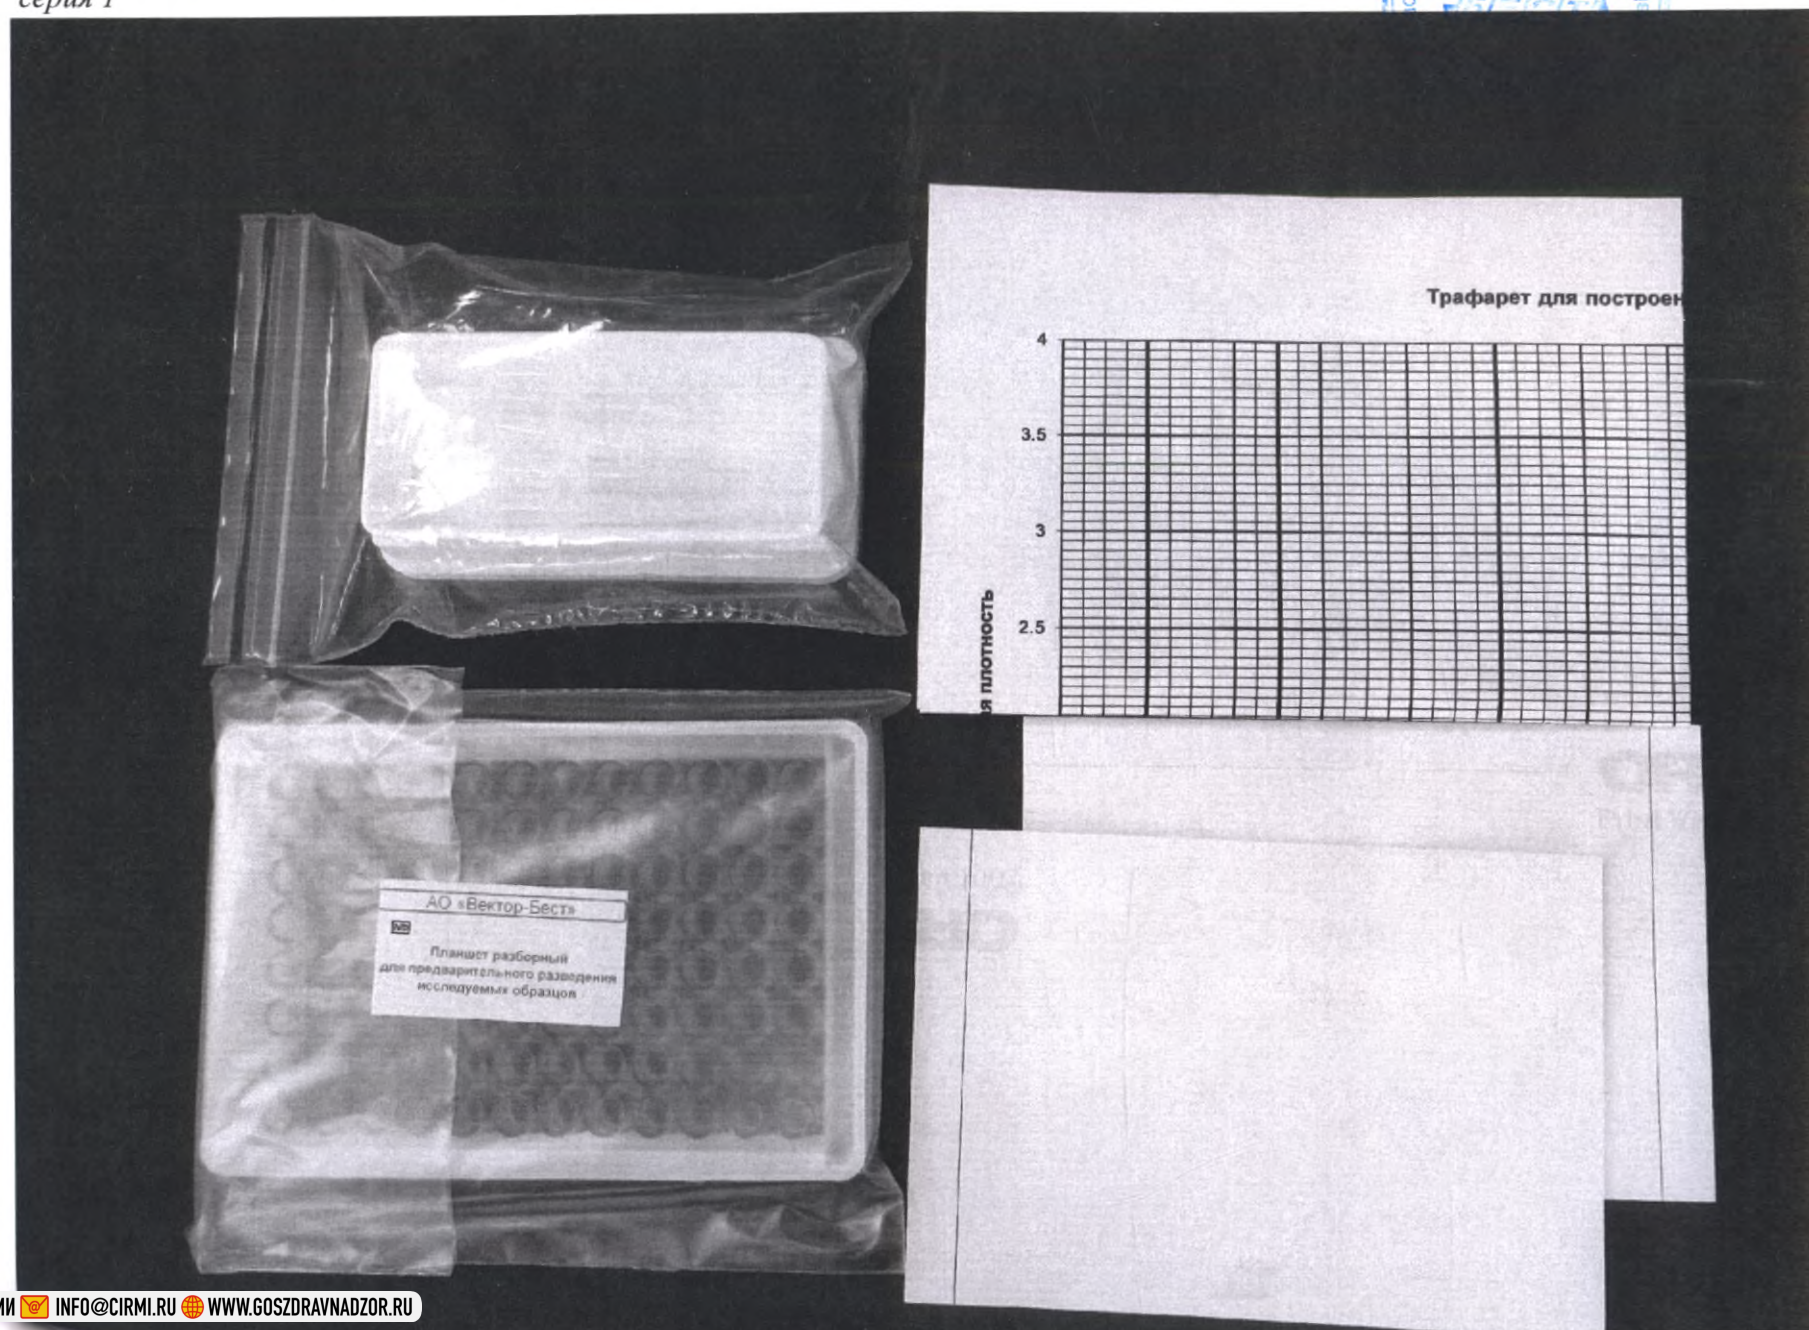



БЕКТОР

БЕСТ

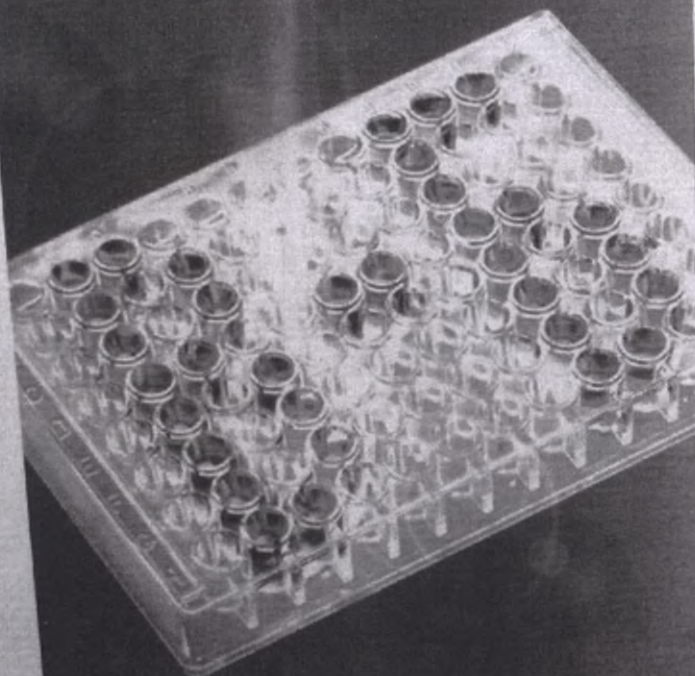

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного количественного
и качественного определения
суммарного ревматоидного фактора
в сыворотке (плазме) крови

РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ

LOT 1

СОСТАВ:

LOT


1. Планшет разборный с иммобилизованными иммуноглобулинами класса G кролика	1 шт.		1
2. Калибровочные образцы	6 фл.	по 1,5 мл	1
3. Контрольный образец	1 фл.	1,5 мл	1
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	1
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	1
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл	1
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл	1
8. Раствор тетраметилбензидина плюс	1 фл.	13,0 мл	1
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.		
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.		
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.		
13. Ванночки для реагентов	2 шт.		
14. Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"20" 11 2019 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ" №3
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"20" 11 20 19 г.



АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ”
 серия 2

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” *М.Д. Хусаинов*
 “20” 11 2019 г.

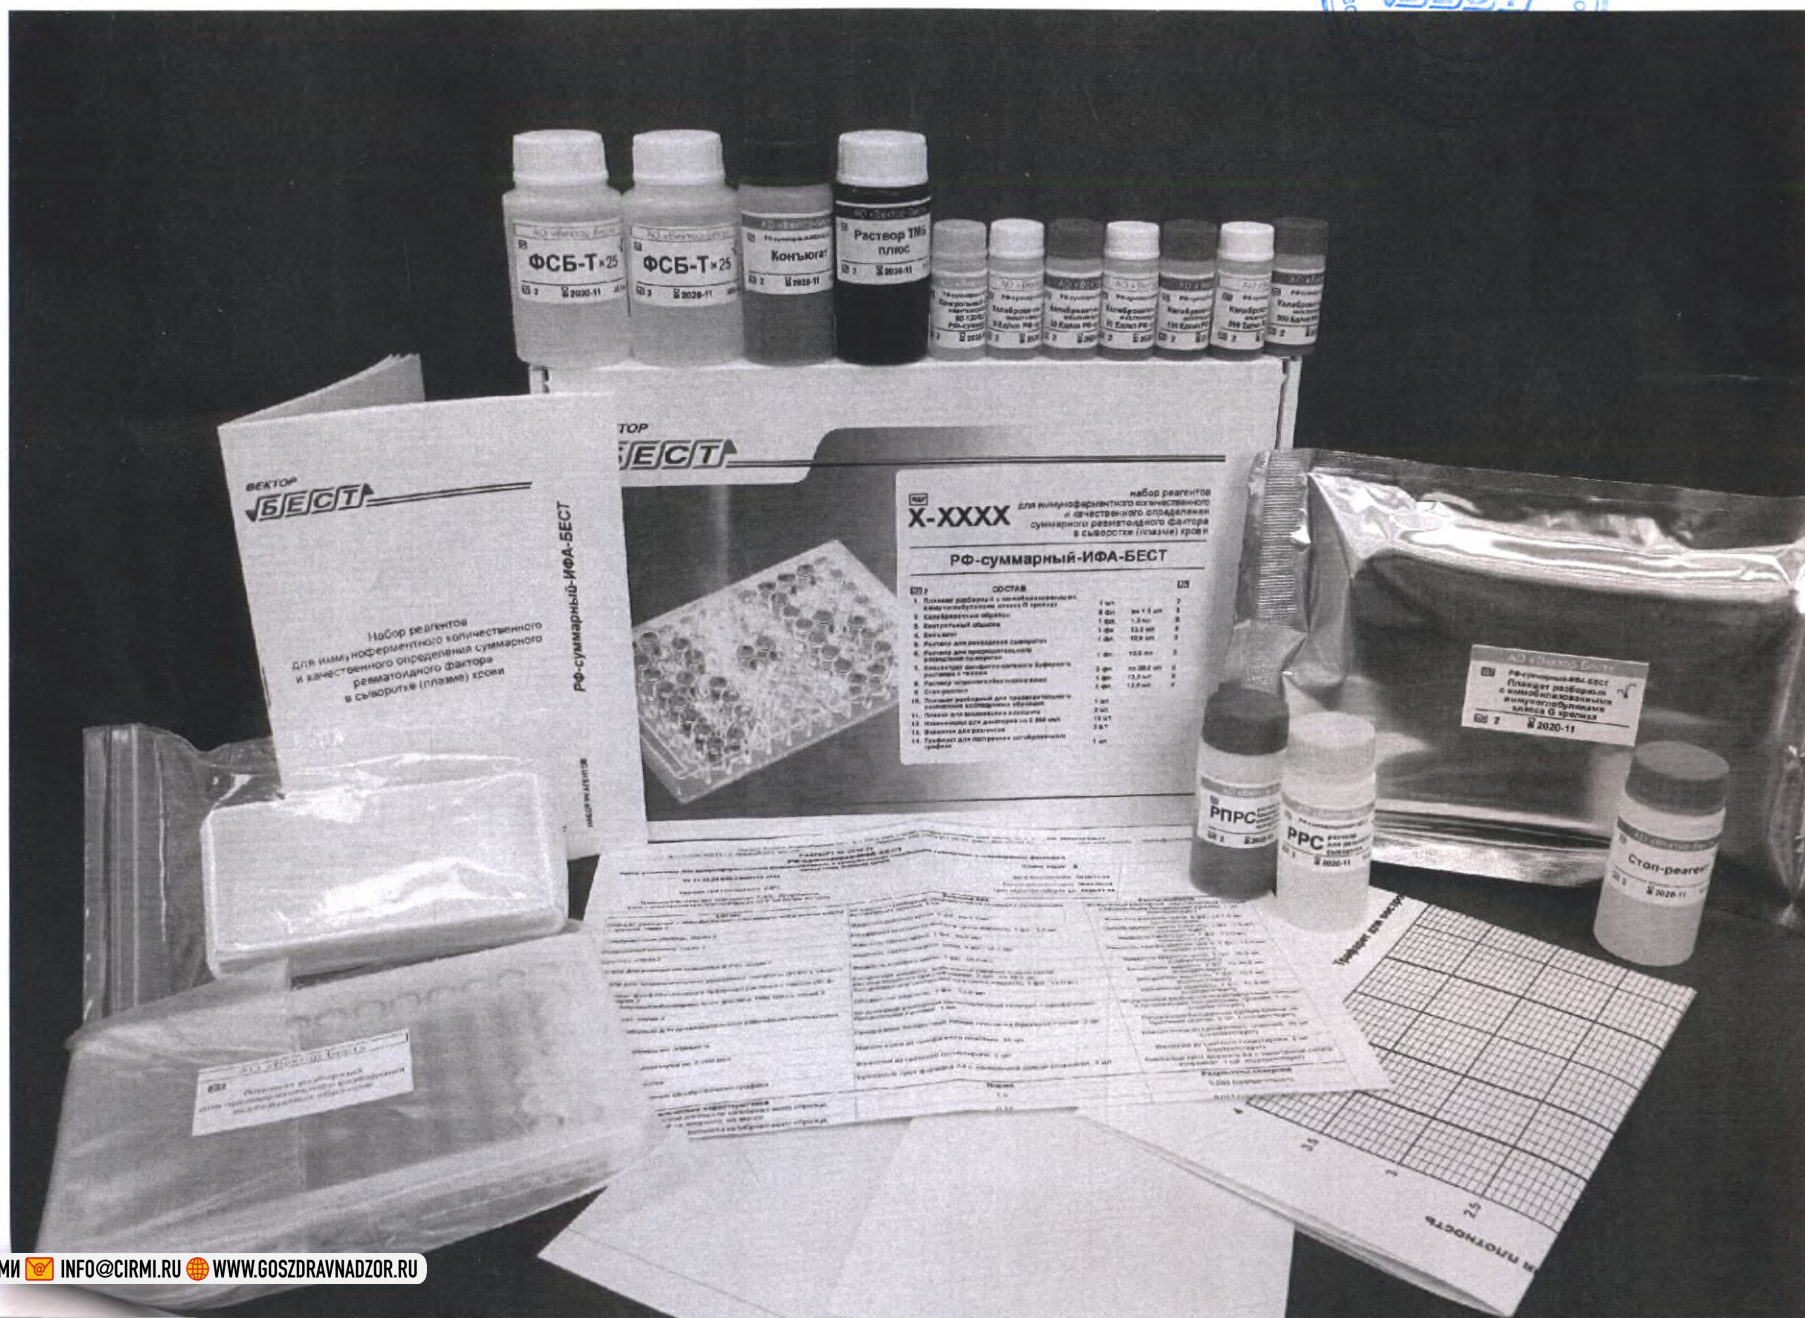


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ” №1
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“20” 11 2019 г.

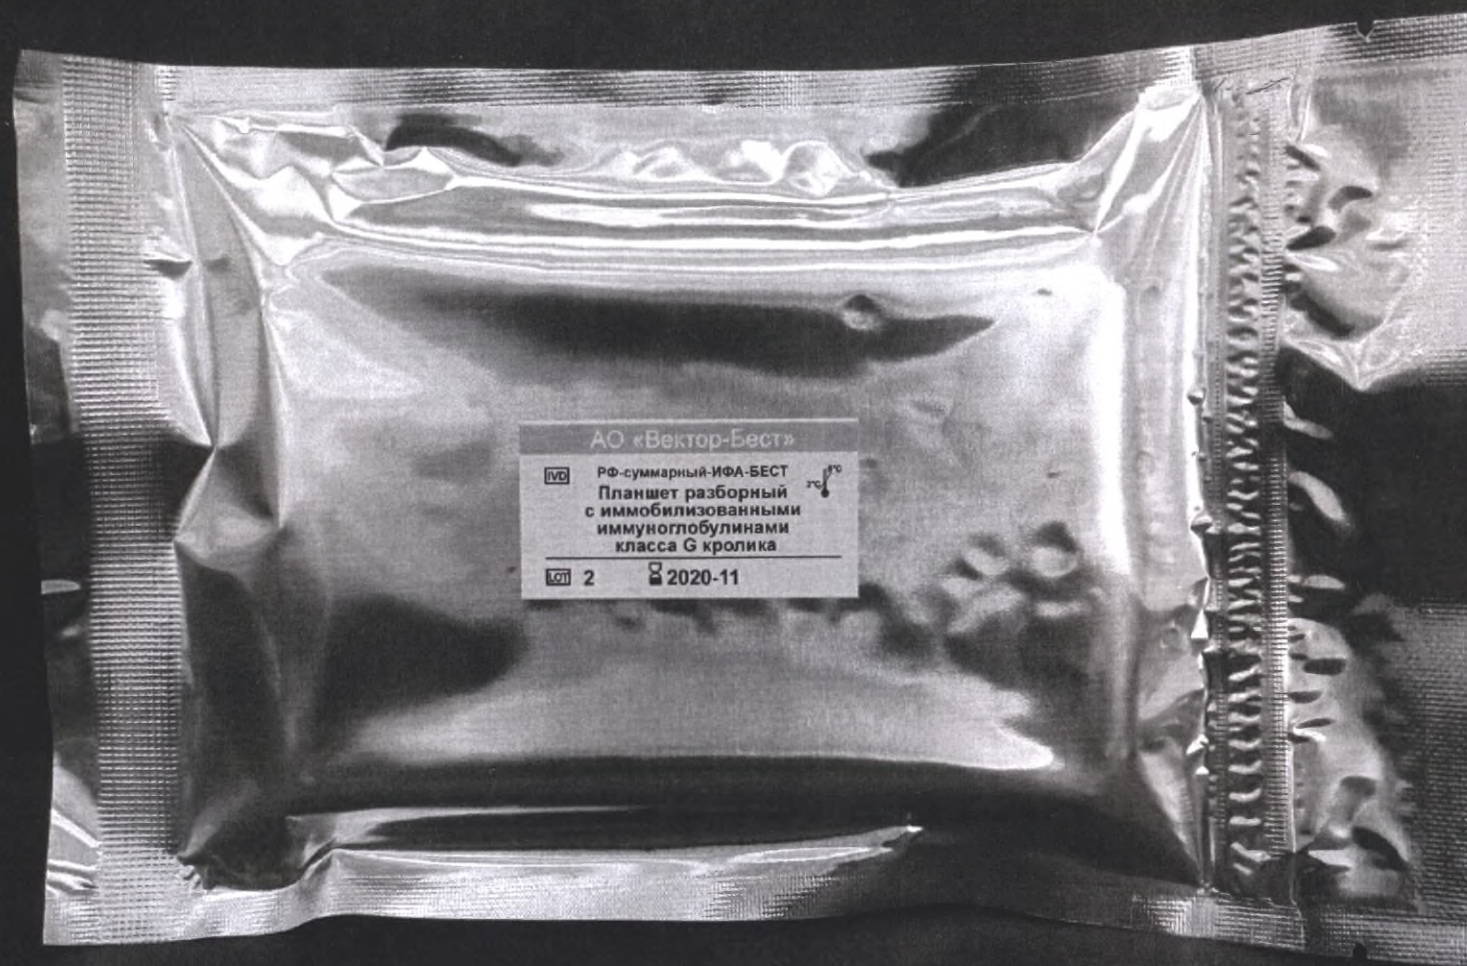

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“20” “11” 2019 г.

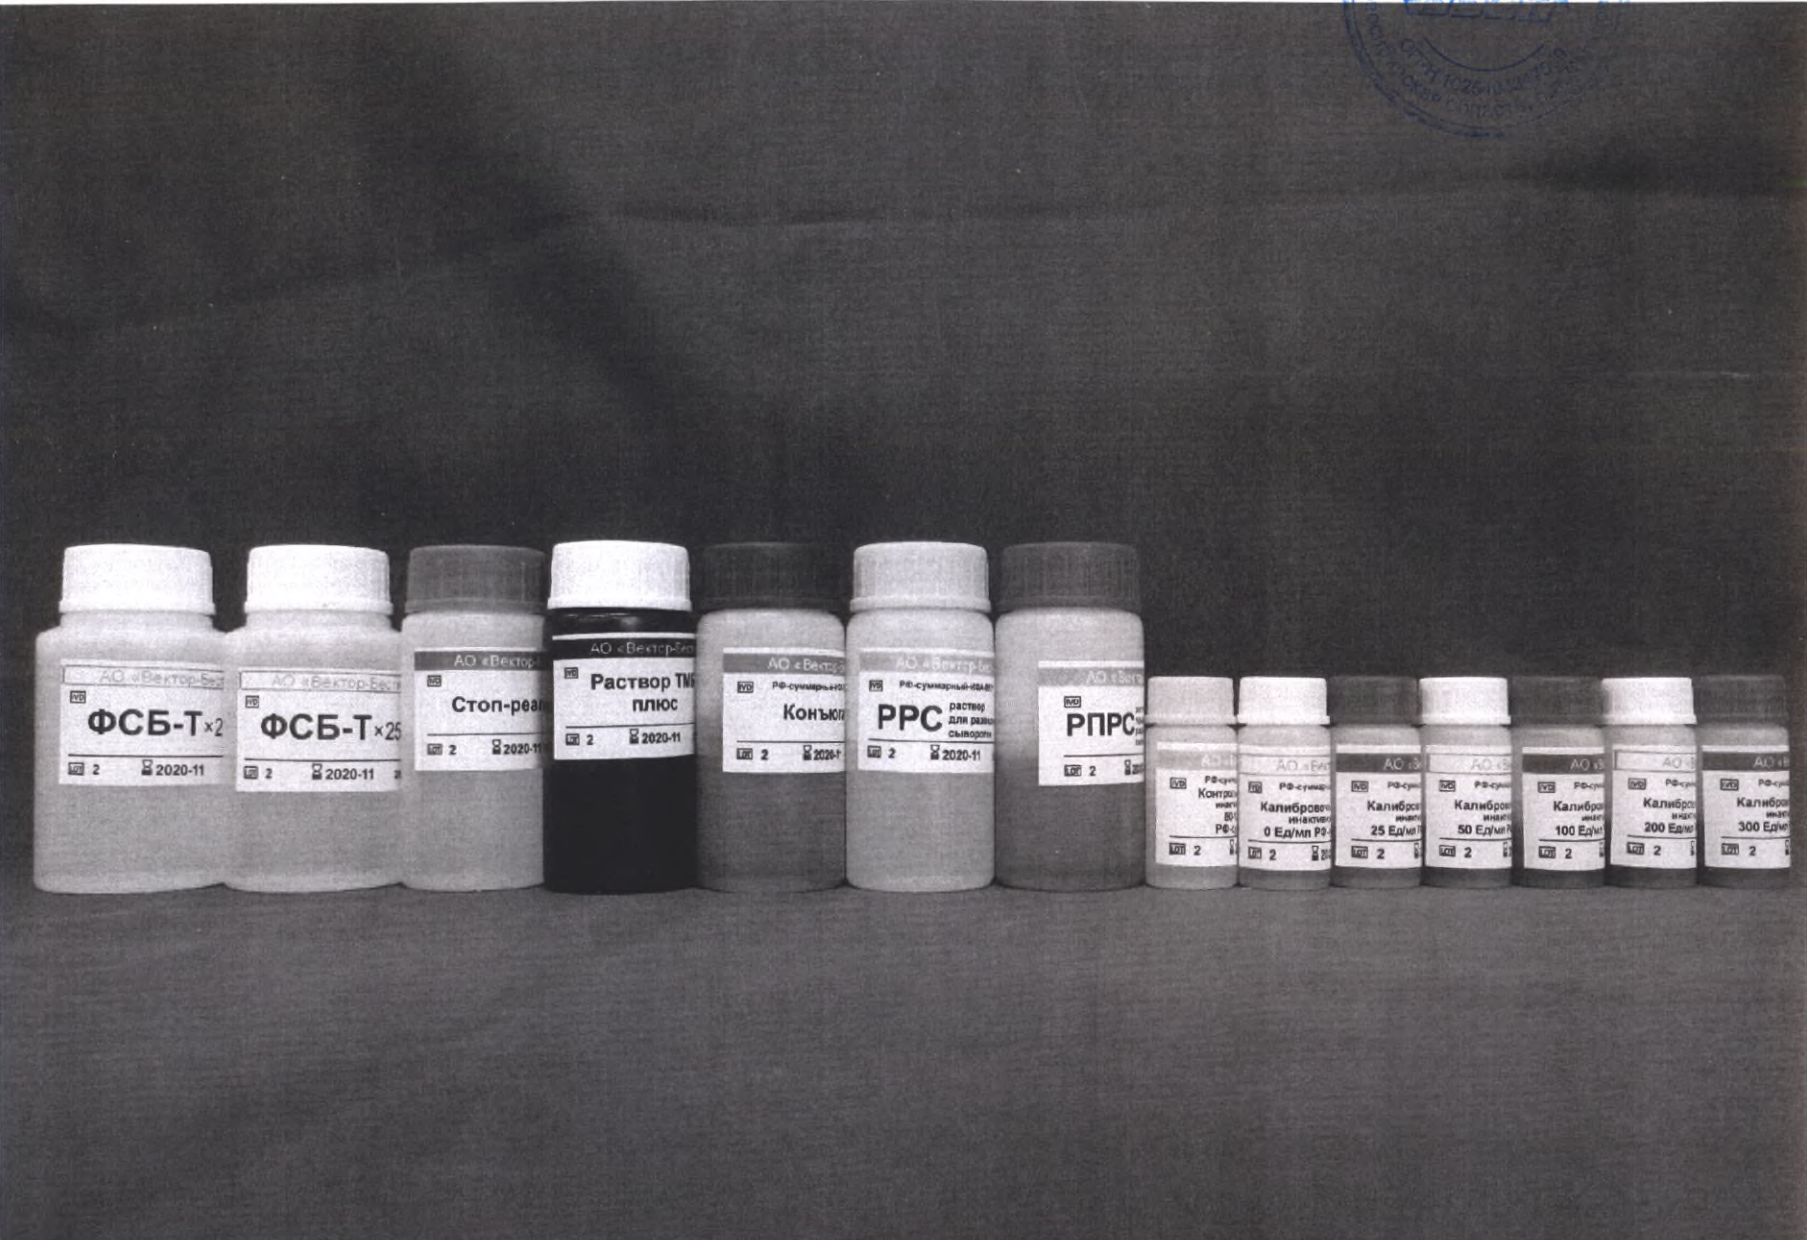

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“ 30 ” 4/ 20 19 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ" № 4
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"20" 11 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ" № 5
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" _____ М.Д. Хусаинов
"20" "11" 2019 г.

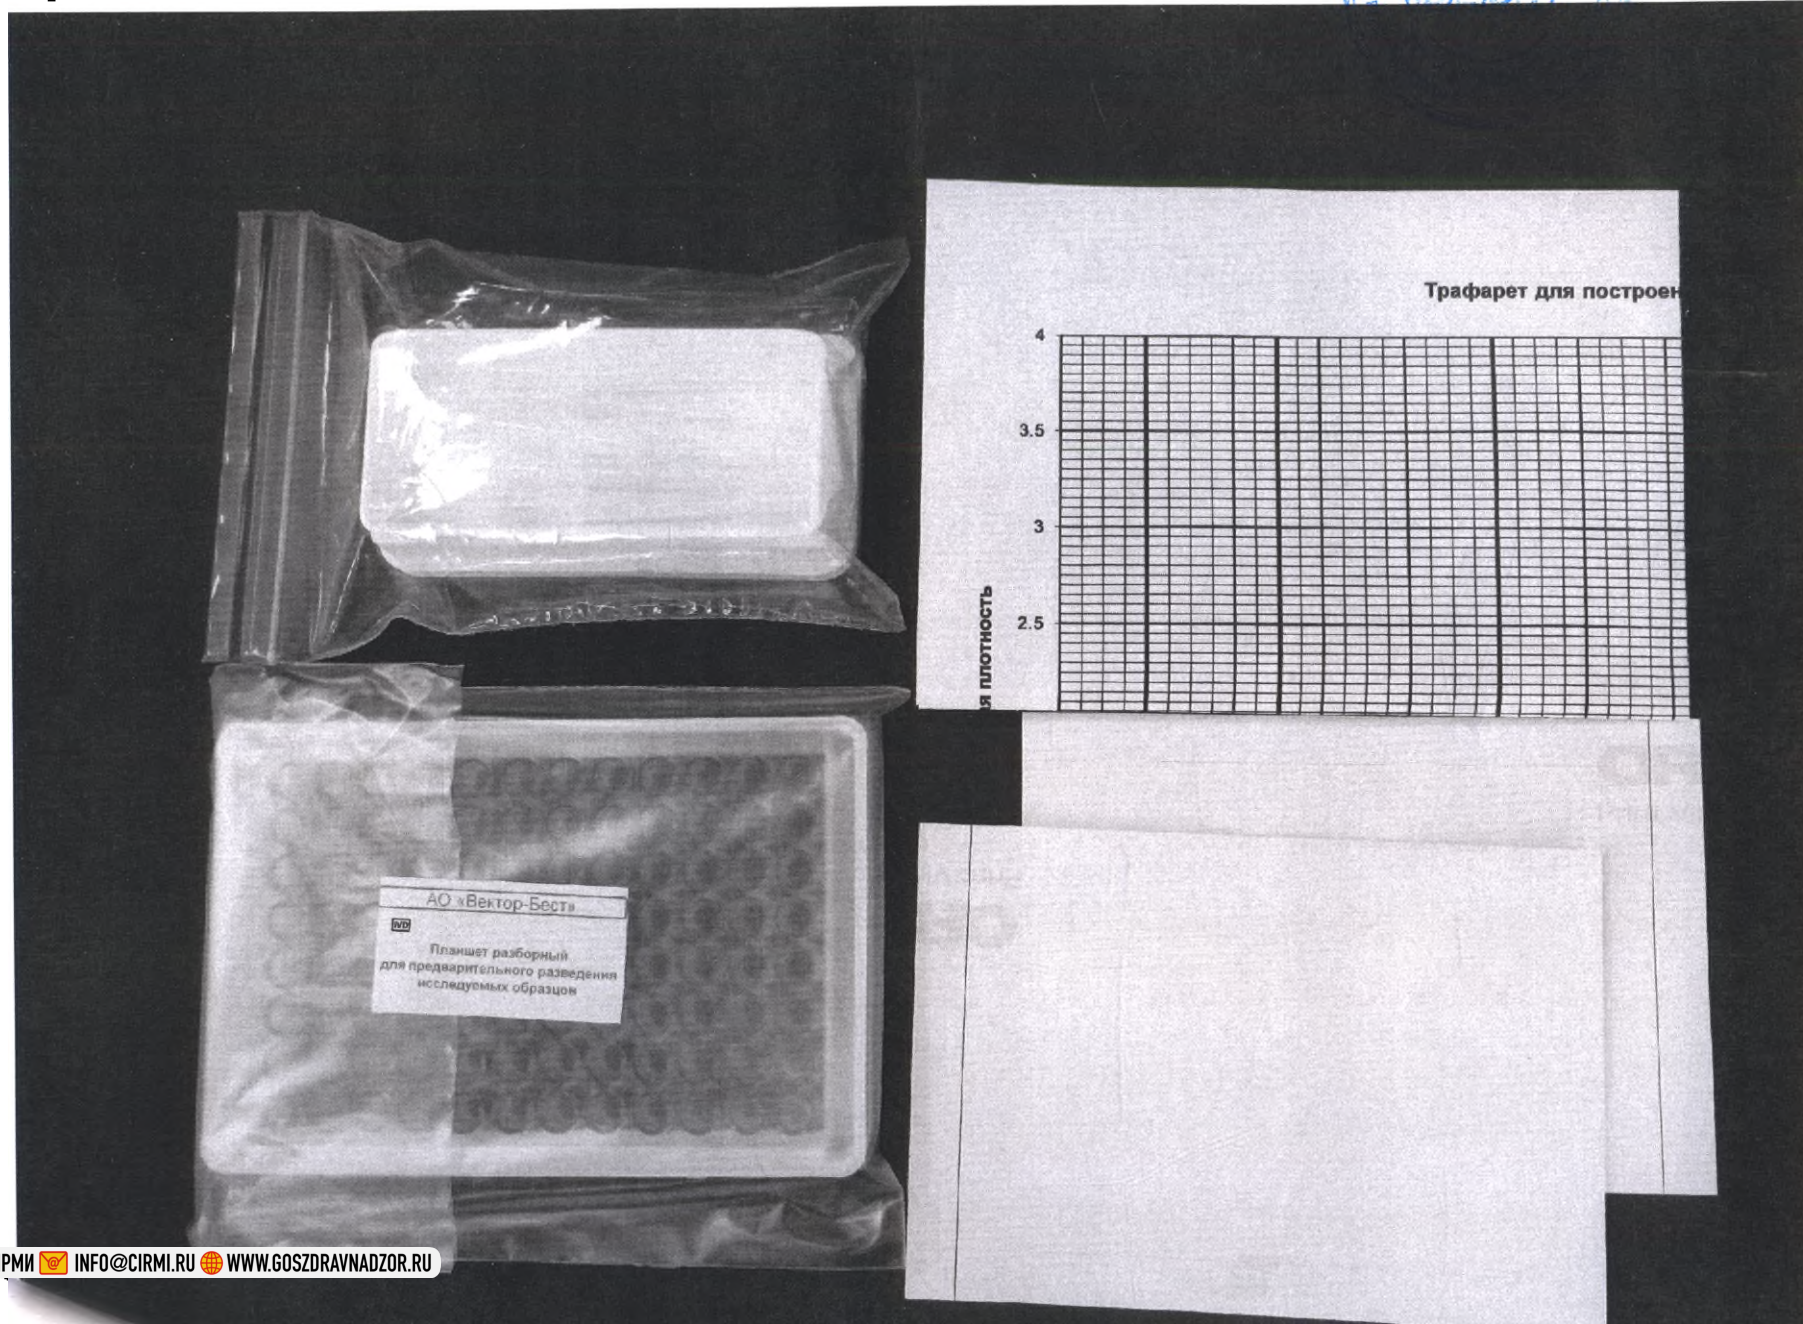


"10" 11 2019 г.



BEKTOP

БЕСТ

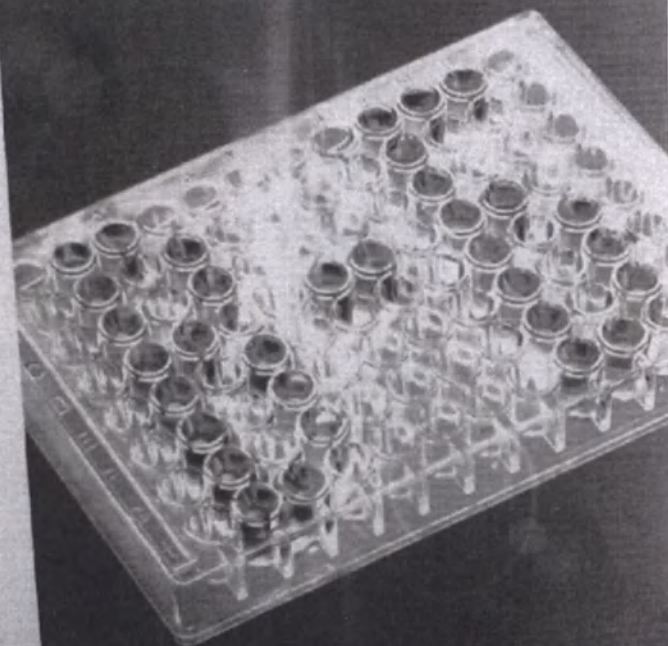

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного количественного
и качественного определения
суммарного ревматоидного фактора
в сыворотке (плазме) крови

РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ

LOT 2


СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными иммуноглобулинами класса G кролика	1 шт.	2
2. Калибровочные образцы	6 фл. по 1,5 мл	2
3. Контрольный образец	1 фл. 1,5 мл	2
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	2
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	2
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	2
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2
8. Раствор тетраметилбензидина плюс	1 фл. 13,0 мл	2
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	2
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.	
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.	
13. Ванночки для реагентов	2 шт.	
14. Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"20" 11 2019 г.

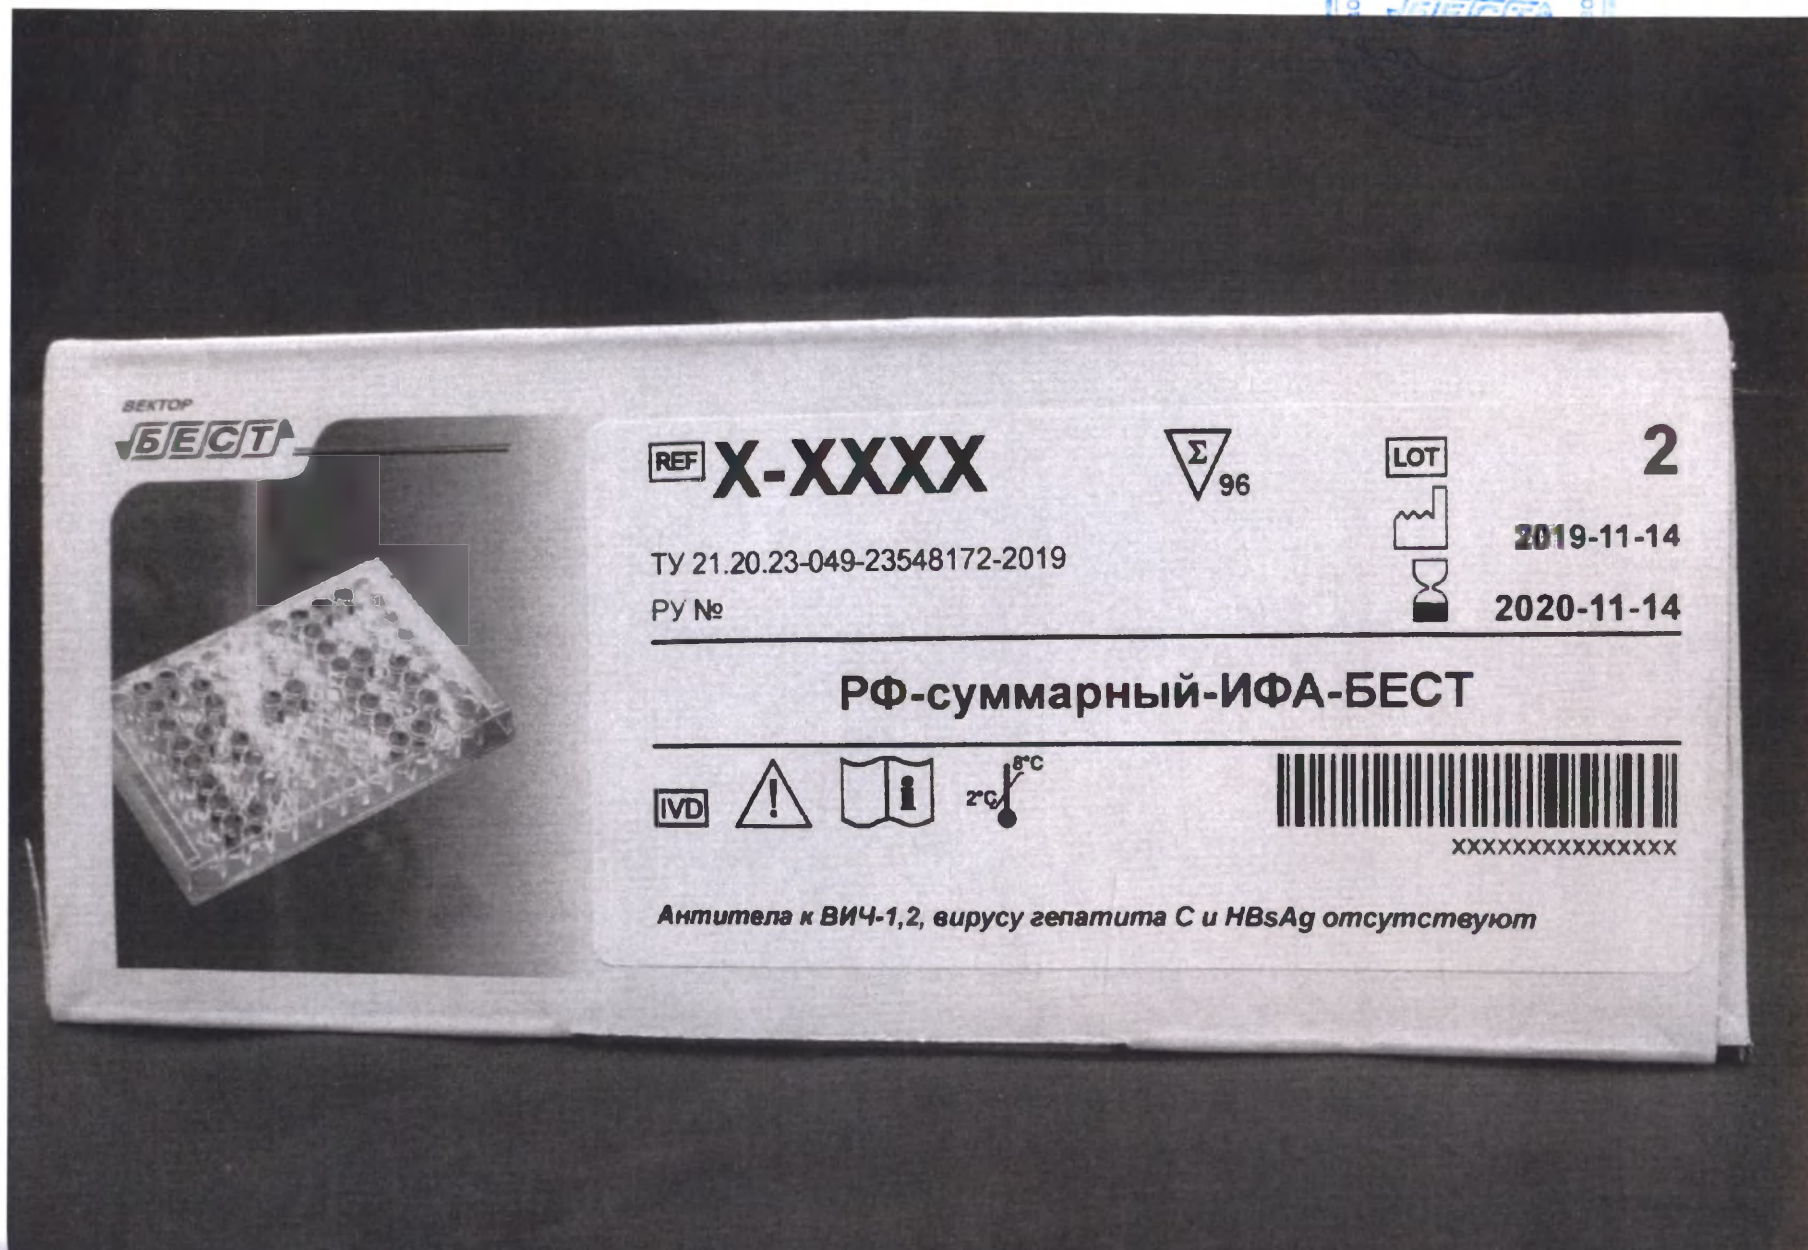

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РФ-суммарный-ИФА-БЕСТ" №3
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"20" 11 2019 г.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,

тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru