

Фотографии медицинского изделия:

**«Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» по ТУ РЕПС.941119.001
с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)»**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Детектор» (ООО «Гамма-Детектор»)

- Список фото:**
- 1. Фотография общего вида медицинского изделия «Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)» - Рабочая часть длиной 100 мм**
 - 2. Фотография подставки для беспроводного зарядного устройства РЕПС.941119.001-02**
 - 3. Фото общего вида состава медицинского изделия «Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)» - Рабочая часть длиной 100 мм**
 - 4. Фотография беспроводного зарядного устройства Rombica Neo Q1 в комплекте с кабелем питания**
 - 5. Фотография беспроводного зарядного устройства Buro Q5 в комплекте с кабелем питания**
 - 6. Фотография беспроводного зарядного устройства DEXP Q5 Qi в комплекте с кабелем питания**
 - 7. Фотография сетевого зарядного устройства SAMSUNG EP-TA12**
 - 8. Фотография потребительской упаковки (кейс)**

Рисунок 1 Фото общего вида медицинского изделия «Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)» - Рабочая часть длиной 100 мм



Рисунок 2. Фото подставки для беспроводного зарядного устройства РЕПС.941119.001-02

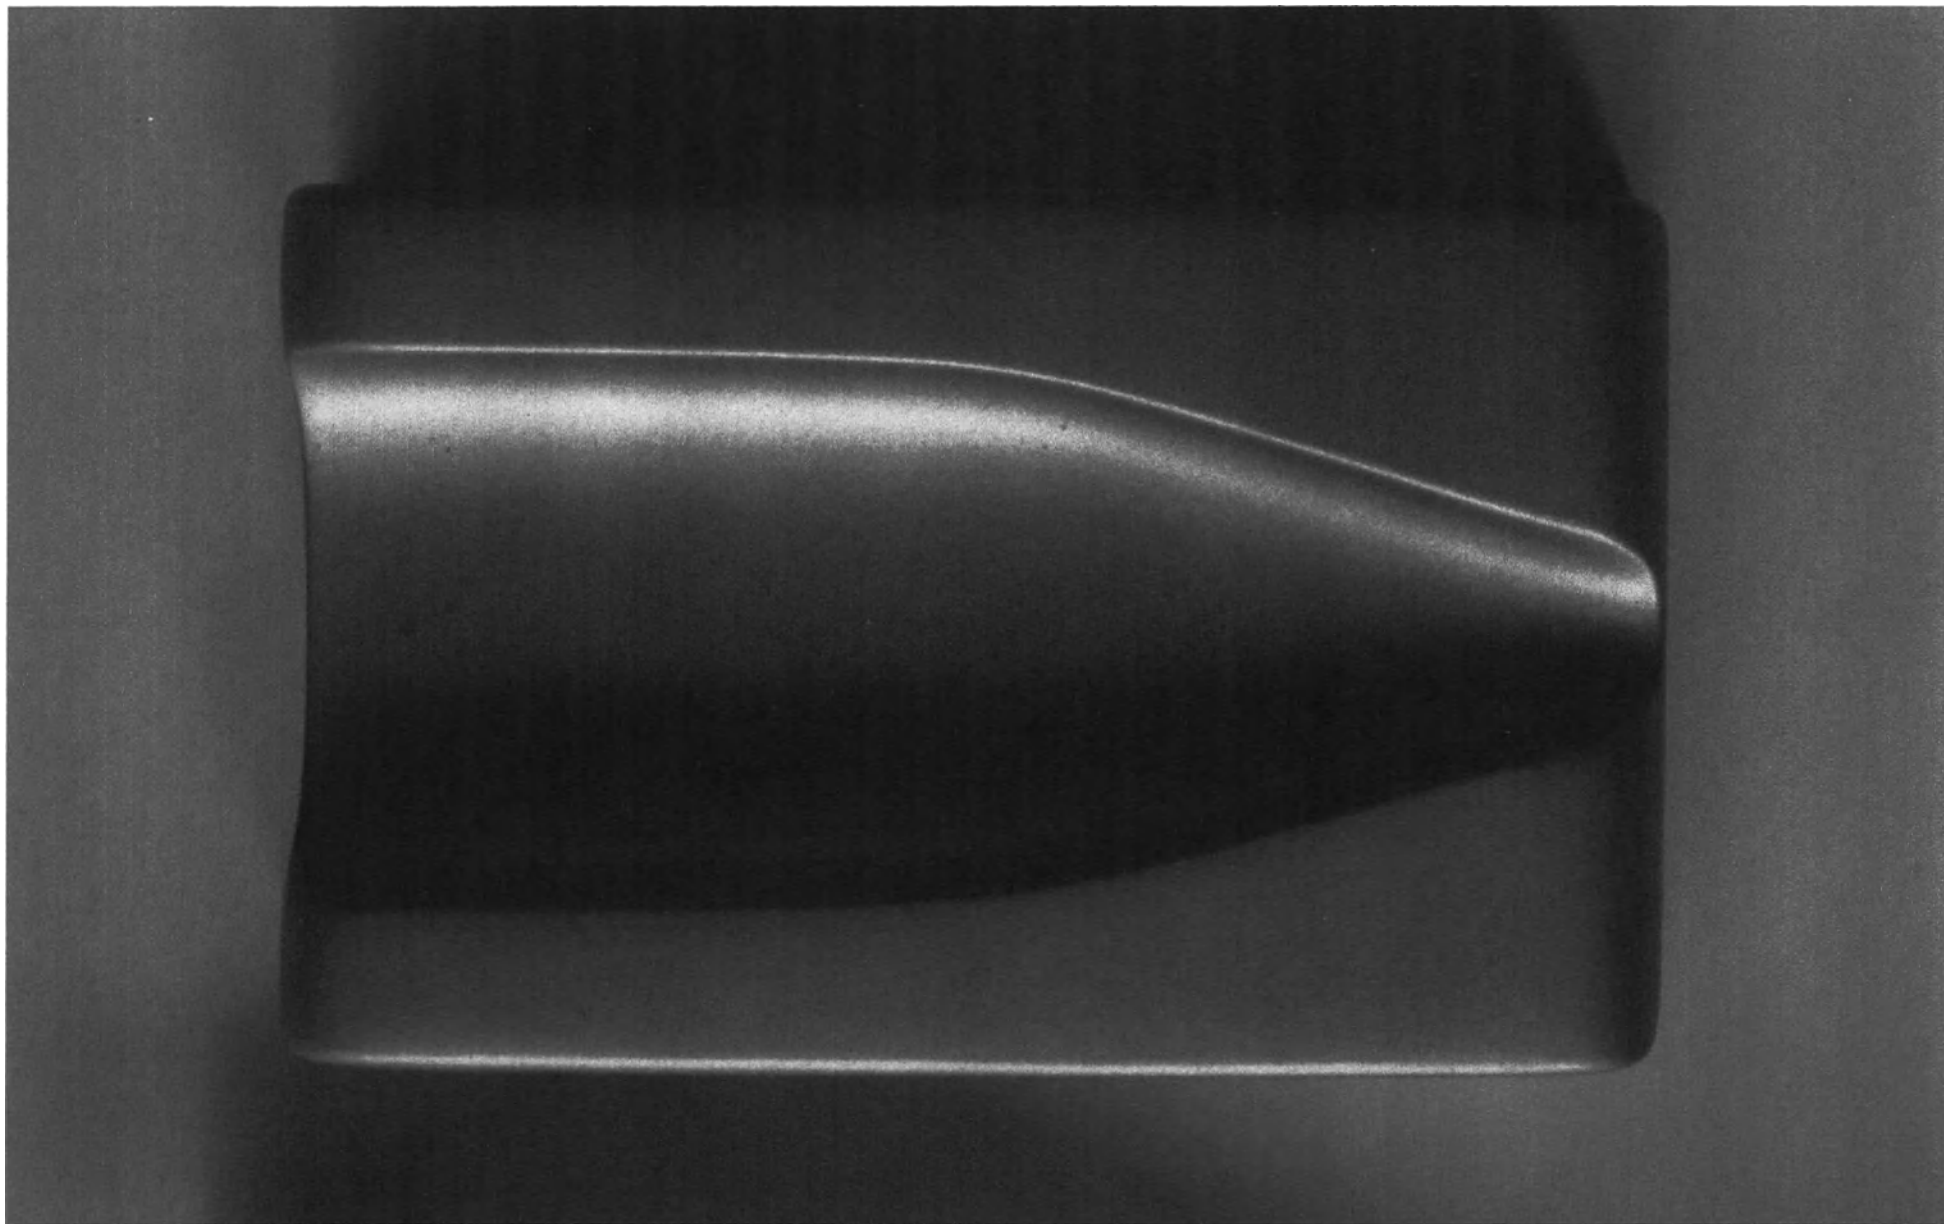


Рисунок 3 Фото общего вида состава медицинского изделия «Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)» - Рабочая часть длиной 100 мм

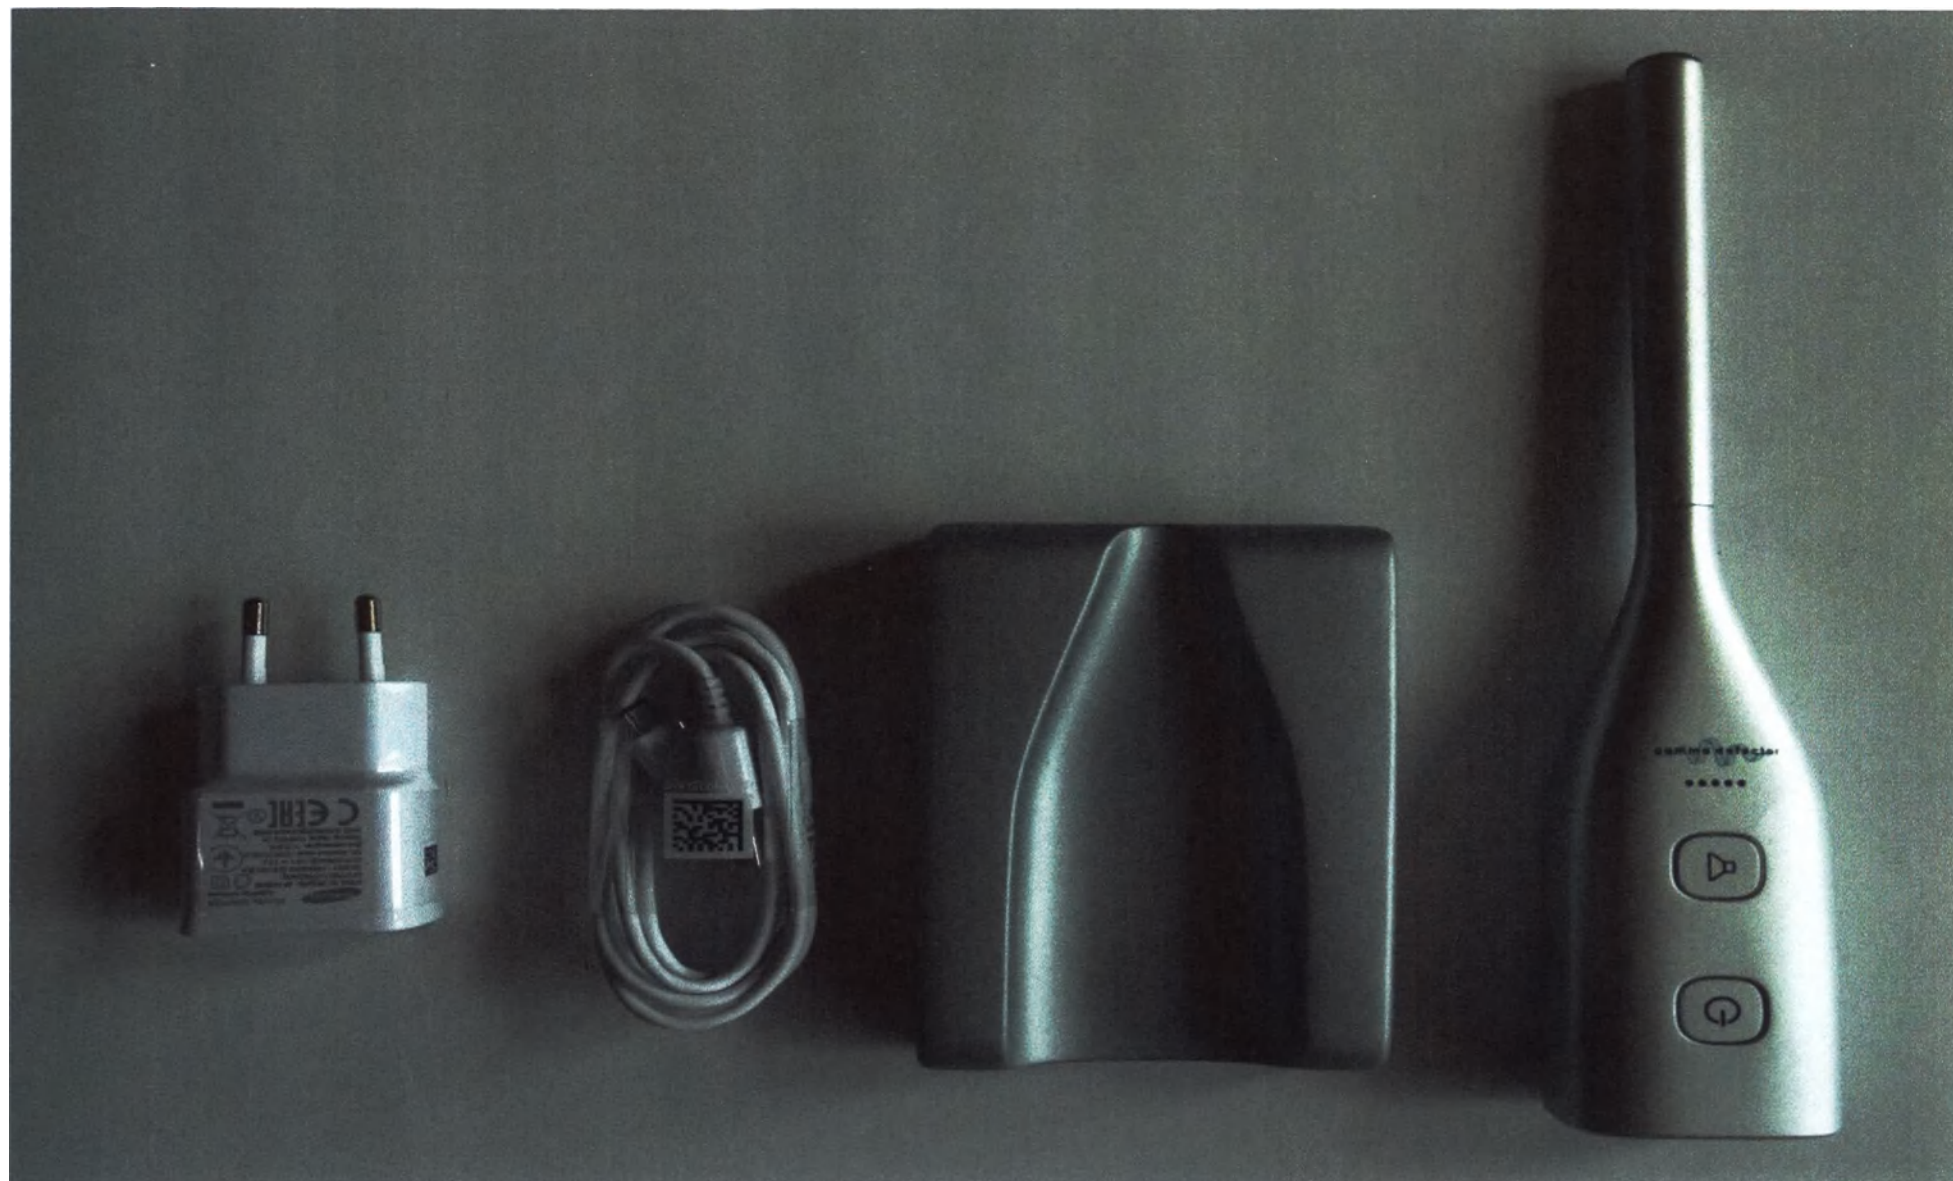


Рисунок 4. Фото беспроводного зарядного устройства Rombica Neo Q1 в комплекте с кабелем питания



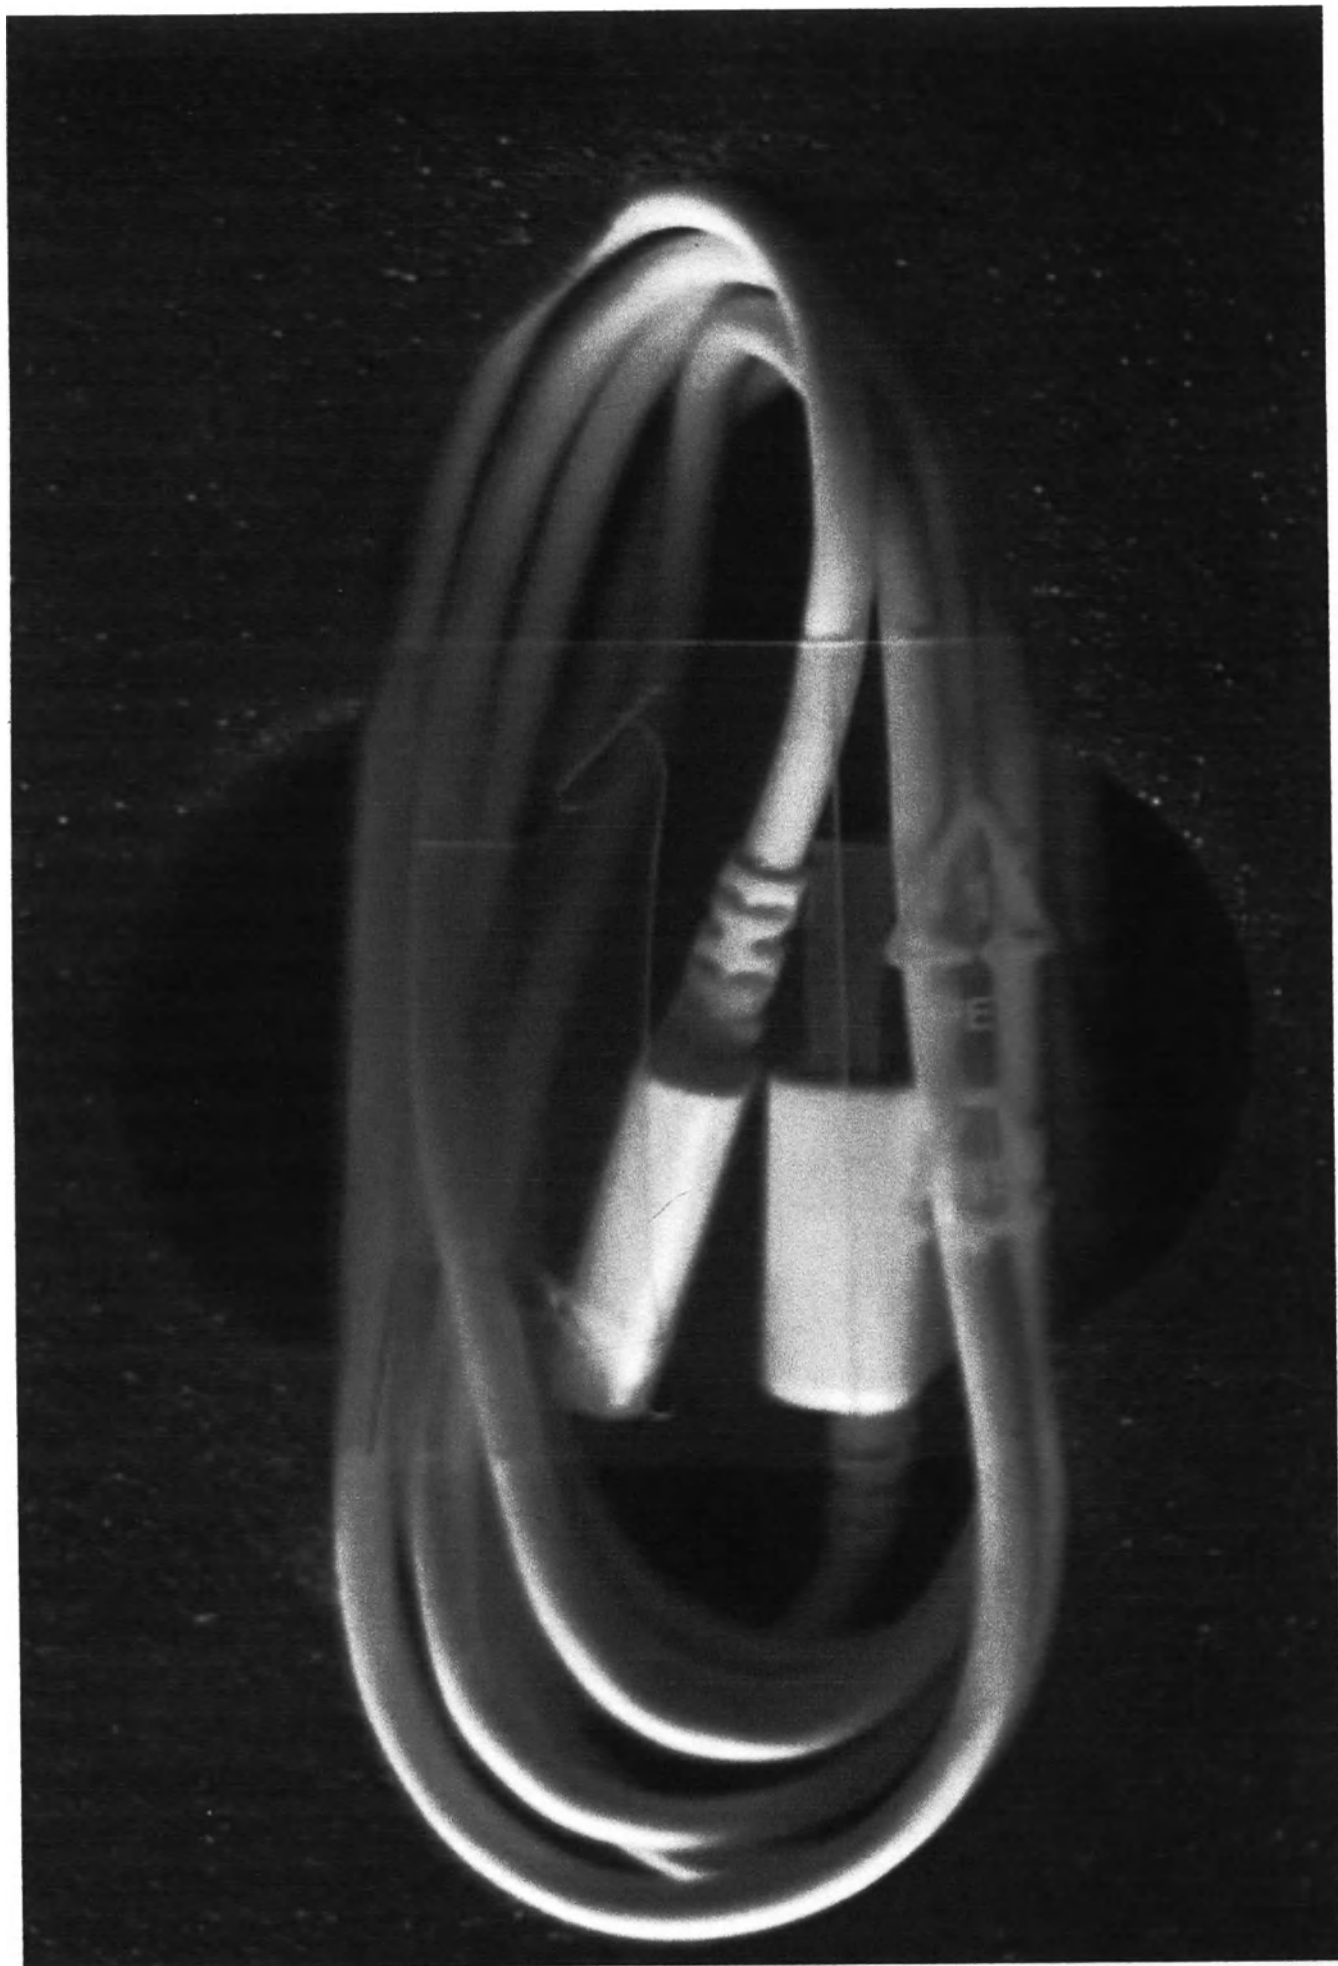


Рисунок 5. Фото беспроводного зарядного устройства Виро Q5 в комплекте с кабелем питания





Рисунок 6. Фото беспроводного зарядного устройства DEXP Q5 Qi в комплекте с кабелем питания





Рисунок 7. Фото сетевого зарядного устройства SAMSUNG EP-TA12

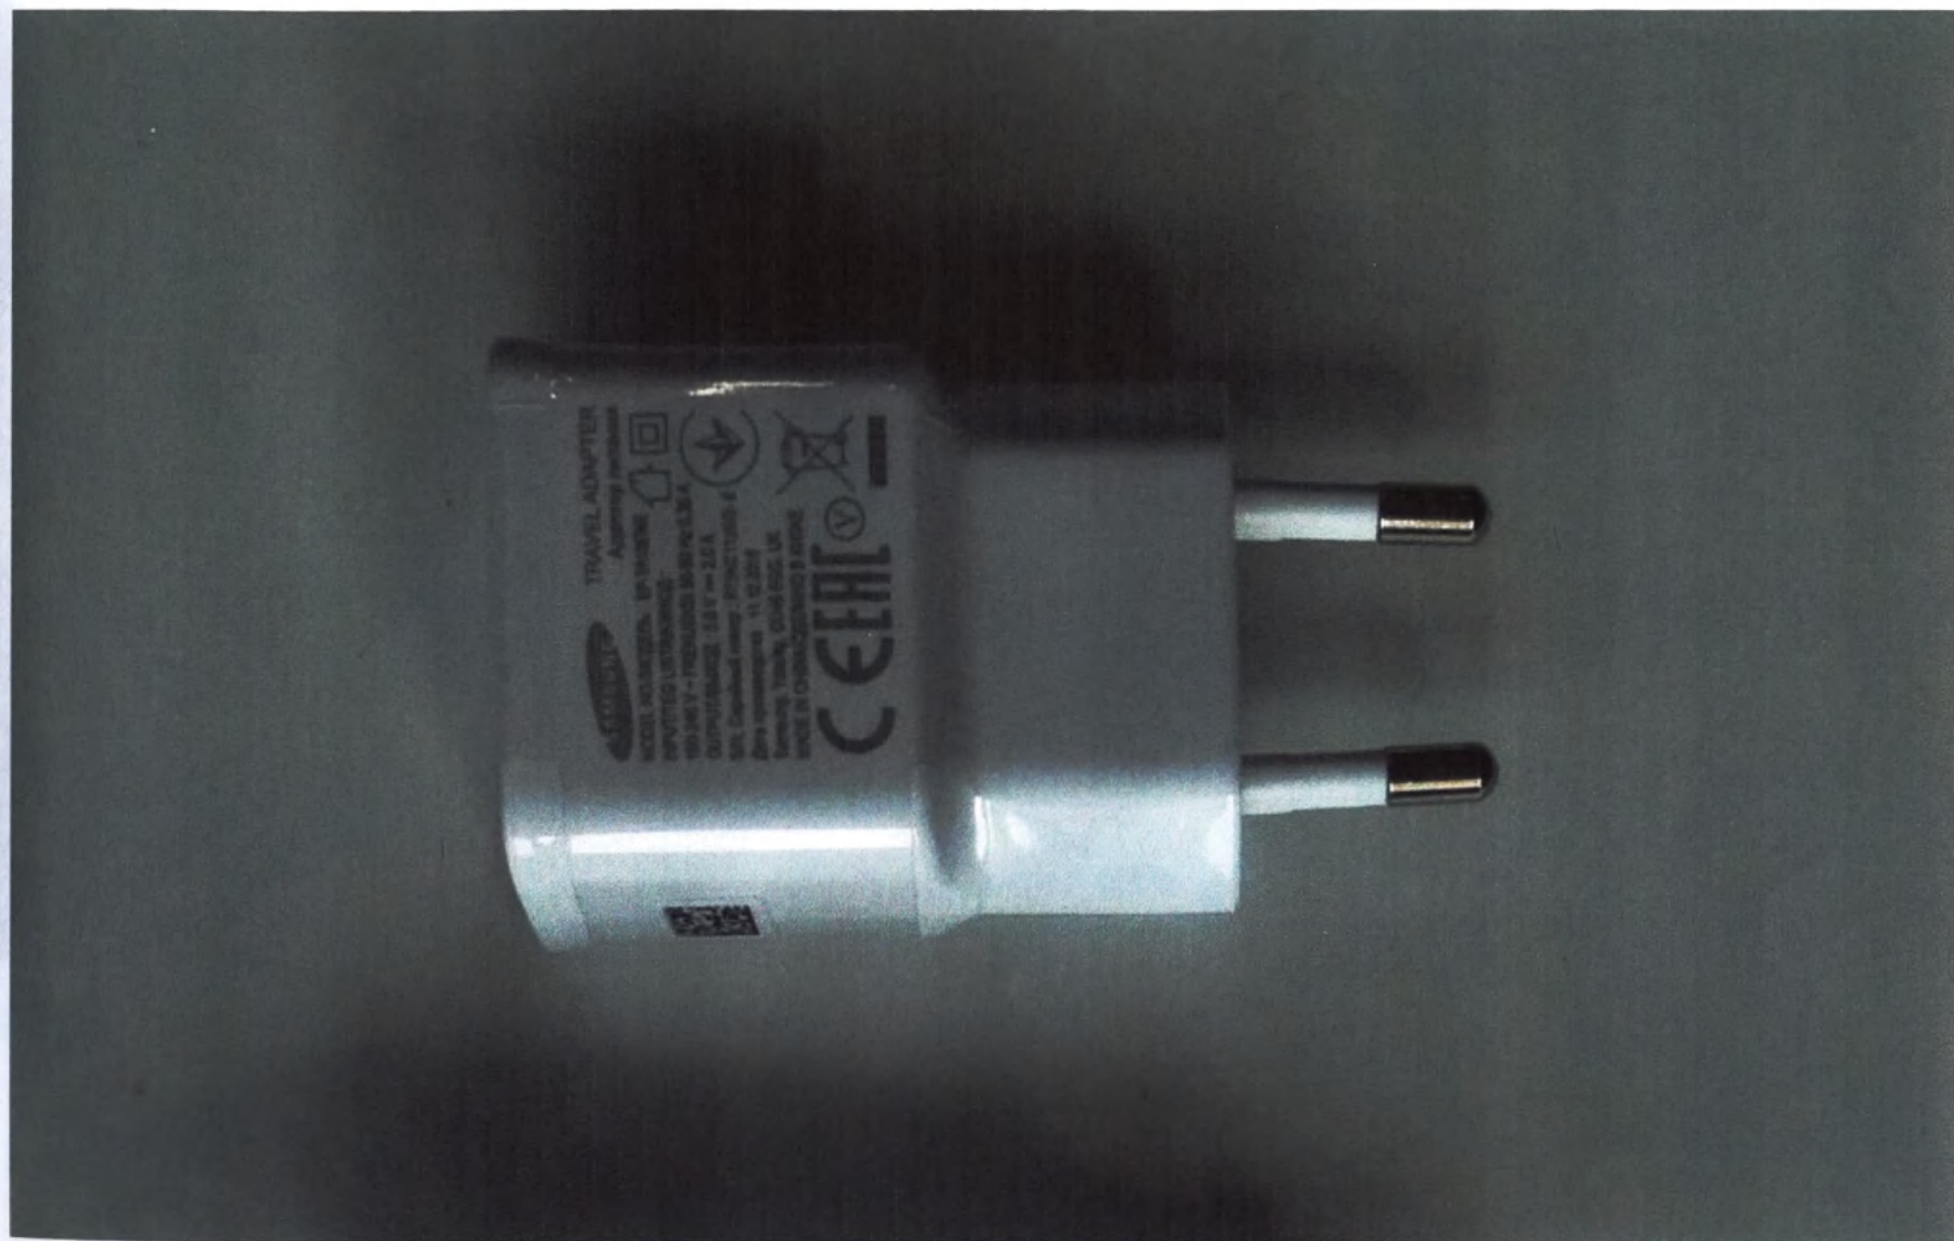


Рисунок 8. Фото потребительской упаковки (кейс).



Пилуцкий Н.В.
(Подпись, Ф.И.О.)

Дата «04» 04 2020



**Фотографические изображения макетов маркировки для медицинского изделия:
«Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» по ТУ РЕПС.941119.001
с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)»**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Детектор» (ООО «Гамма-Детектор»)

- Список фото:**
1. Фотографическое изображение макета маркировки «Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)» - Рабочая часть 100 мм
 2. Фотографическое изображение макета маркировки «Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)» - Рабочая часть 250 мм
 3. Фотографическое изображение макета маркировки «Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)» - Рабочая часть 500 мм
 4. Фотографическое изображение макета маркировки - потребительской упаковки (кейс)
 5. Фотографическое изображение макета маркировки - транспортной упаковки

Рисунок 1. Фотографическое изображение макета маркировки «Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм) - Рабочая часть 100 мм

Прибор радионуклидной диагностики «Гамма-детектор»

с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)
Рабочая часть длиной 100 мм

ООО «Гамма-детектор»
РЕПС.941119.001.TU

Год изготовления 20_____

Серийный номер _____



Рисунок 2. Фотографическое изображение макета маркировки «Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм) - Рабочая часть 250 мм

Прибор радионуклидной диагностики «Гамма-детектор»

с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)
Рабочая часть длиной 250 мм

ООО «Гамма-детектор»
РЕПС.941119.001.TU

Год изготовления 20_____

Серийный номер _____

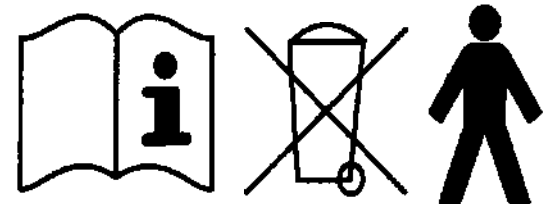


Рисунок 3. Фотографическое изображение макета маркировки «Прибора радионуклидной диагностики «Гамма-детектор» с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)» - Рабочая часть 500 мм

Прибор радионуклидной диагностики «Гамма-детектор»

с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)
Рабочая часть длиной 500 мм

ООО «Гамма-детектор»
РЕПС.941119.001.TU

Год изготовления 20_____

Серийный номер _____



Рисунок 4. Фотографическое изображение макета маркировки - потребительской упаковки (кейс)


Прибор радионуклидной диагностики
«Гамма-детектор»
с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)
РЕПС.941119.001.TU
ООО «Гамма-детектор»

Год изготовления 20_____

Серийный номер _____

Регистрационное удостоверение _____

Сделано в России

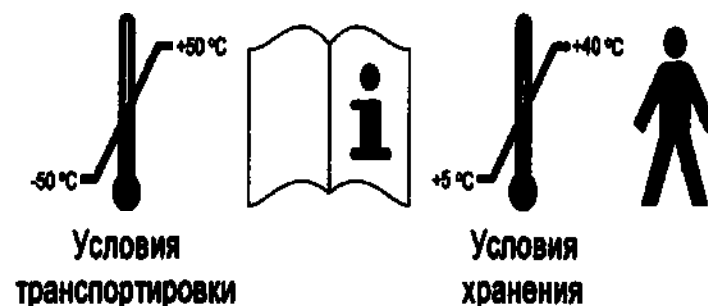

Прибор радионуклидной диагностики «Гамма-детектор»

с рабочей частью длиной от 100 до 500 мм (шаг 50 мм)

РЕПС.941119.001.ТУ
ООО «Гамма-детектор»

г. Ростов-на-Дону, пр-т Театральный, 85, офис 11 «Г»

Количество изделий _____

Год изготовления 20 _____

Масса брутто _____



Протокол № 1
(Подпись, Ф.И.О.)
Дата « 30 » 04 2016

