










«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

 М.Д. Хусаинов
2020 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М
к вирусу герпеса человека 6 типа методом “захвата” в сыворотке (плазме) крови
(NHV-6-IgM-ИФА-БЕСТ)**

1. Образцы этикеток на компоненты набора “NHV-6-IgM-ИФА-БЕСТ”

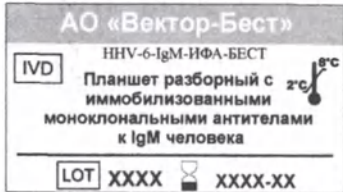Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека	
Положительный контрольный образец (K+)	
Отрицательный контрольный образец (K-)	
Конъюгат	
Раствор для разведения сывороток (PPC)	
Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	

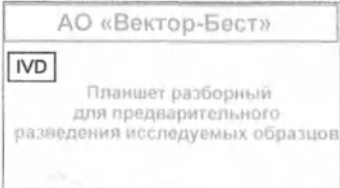Наименование компонента	Этикетка
Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	

2. Образцы этикеток на коробке набора “HHV-6-IgM-ИФА-БЕСТ”

2.1. Верхняя этикетка.

REF	набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу герпеса человека 6 типа методом “захвата” в сыворотке (плазме) крови	
X-XXXX		
HHV-6-IgM-ИФА-БЕСТ		
LOT XXXX	Состав:	LOT
1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека 1 шт. xxxx 2. Положительный контрольный образец 1 фл., 1,5 мл xxxx 3. Отрицательный контрольный образец 1 фл., 3,0 мл xxxx 4. Конъюгат 1 фл., 13,0 мл xxxx 5. Раствор для разведения сывороток 1 фл., 12,0 мл xxxx 6. Раствор для предварительного разведения сывороток 1 фл., 10,0 мл xxxx 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином 2 фл. по 28,0 мл xxxx 8. Раствор тетраметилбензидина 1 фл., 13,0 мл xxxx 9. Стоп-реагент 1 фл., 12,0 мл xxxx 10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов 1 шт. 11. Пленки для заклеивания планшета 2 шт. 12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл 16 шт. 13. Ванночки для реагентов 2 шт.		

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 96	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-098-23548172-2020 РУ №			XXXX-XX-XX	XXXX-XX-XX
HHV-6-IgM-ИФА-БЕСТ				
IVD			 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<i>Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют</i>				

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»



М.Ю. Рукавишников


«03» 08 2020 г.

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»

Масяго А.В. Масяго

03 02 2020 г.





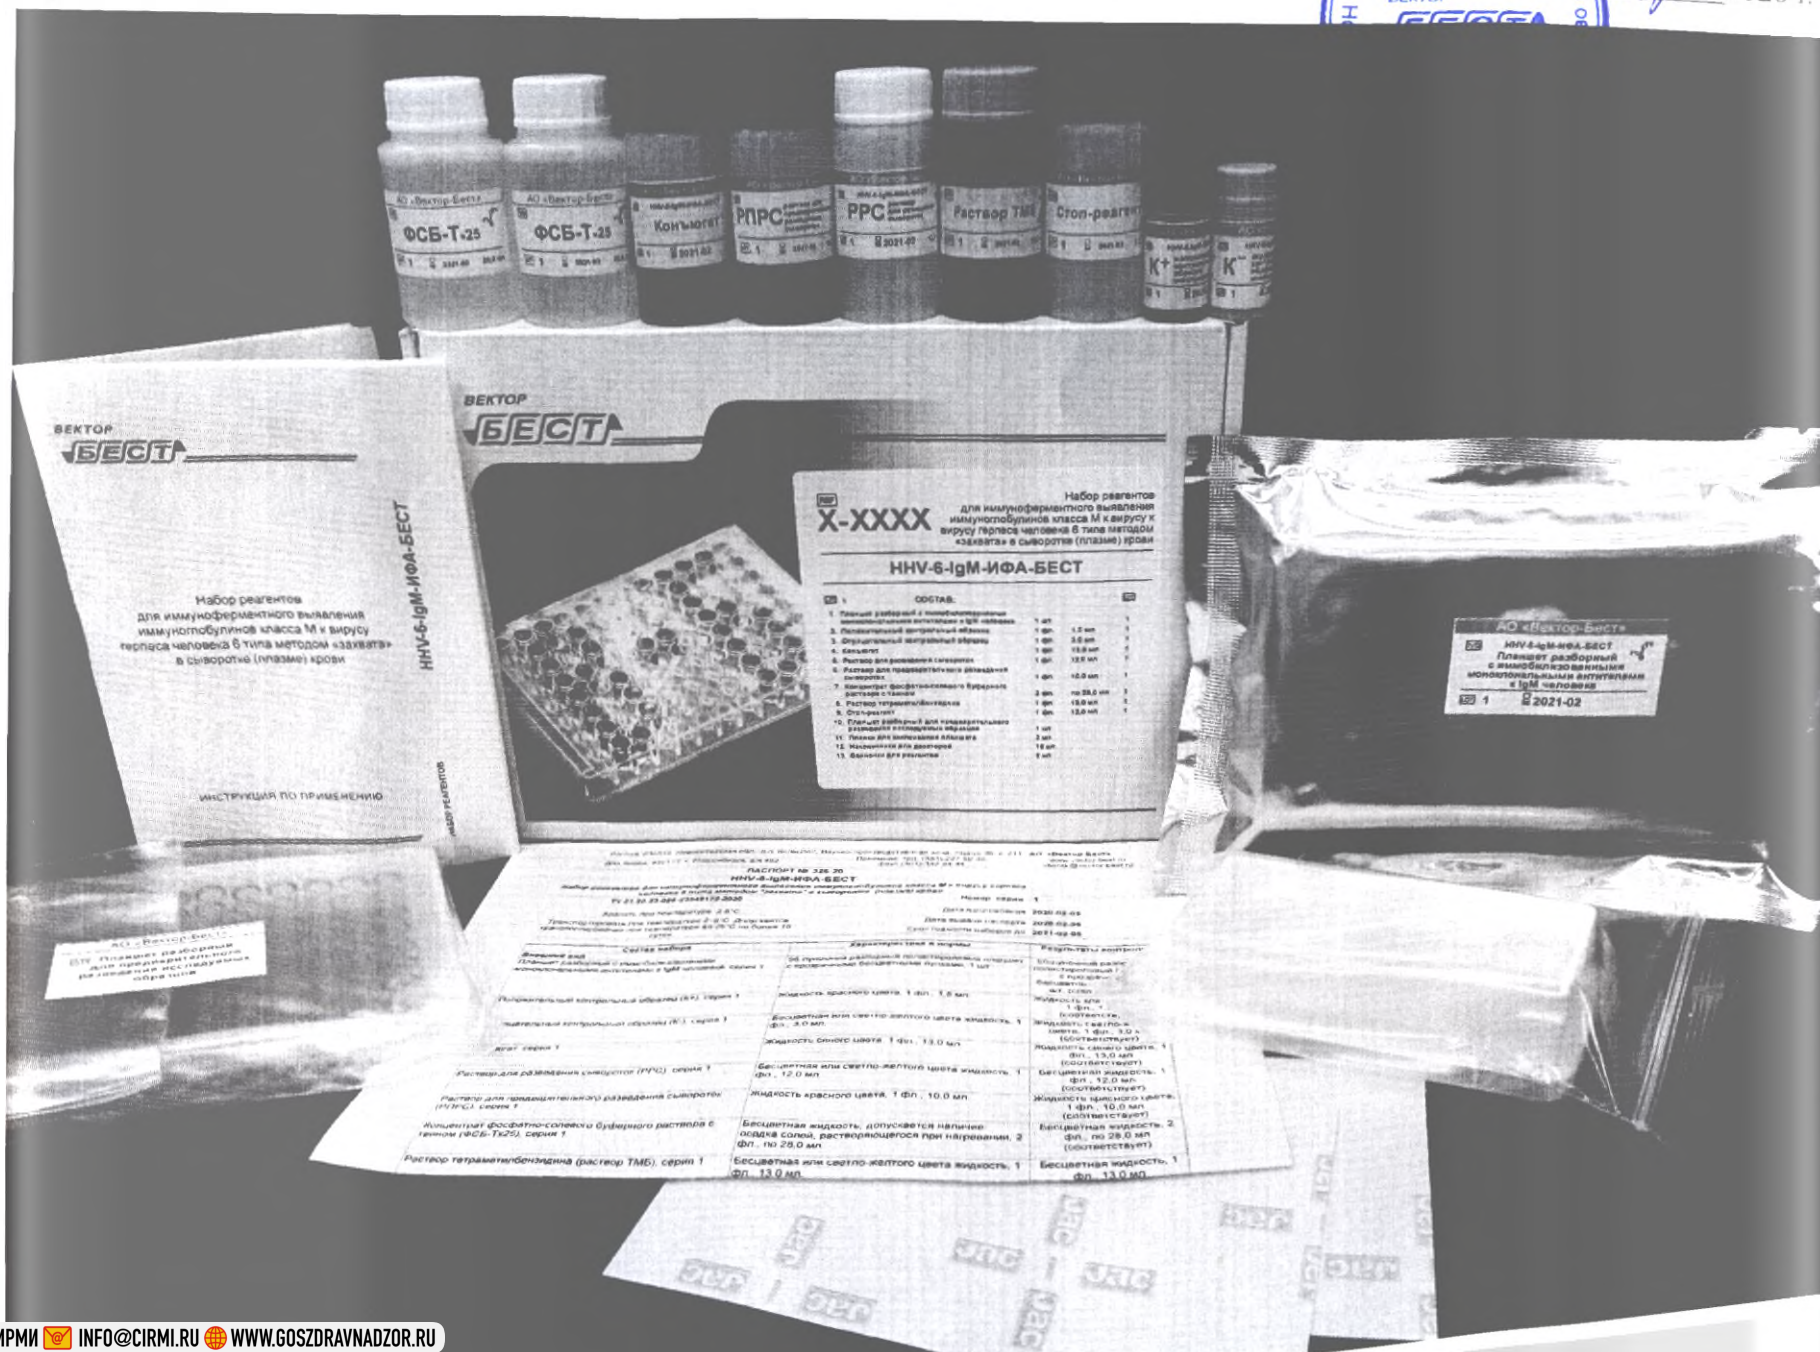

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ННУ-6-IgM-ИФА-БЕСТ” №1
серия 1


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ М.Д. Хусаинов
2020 г.




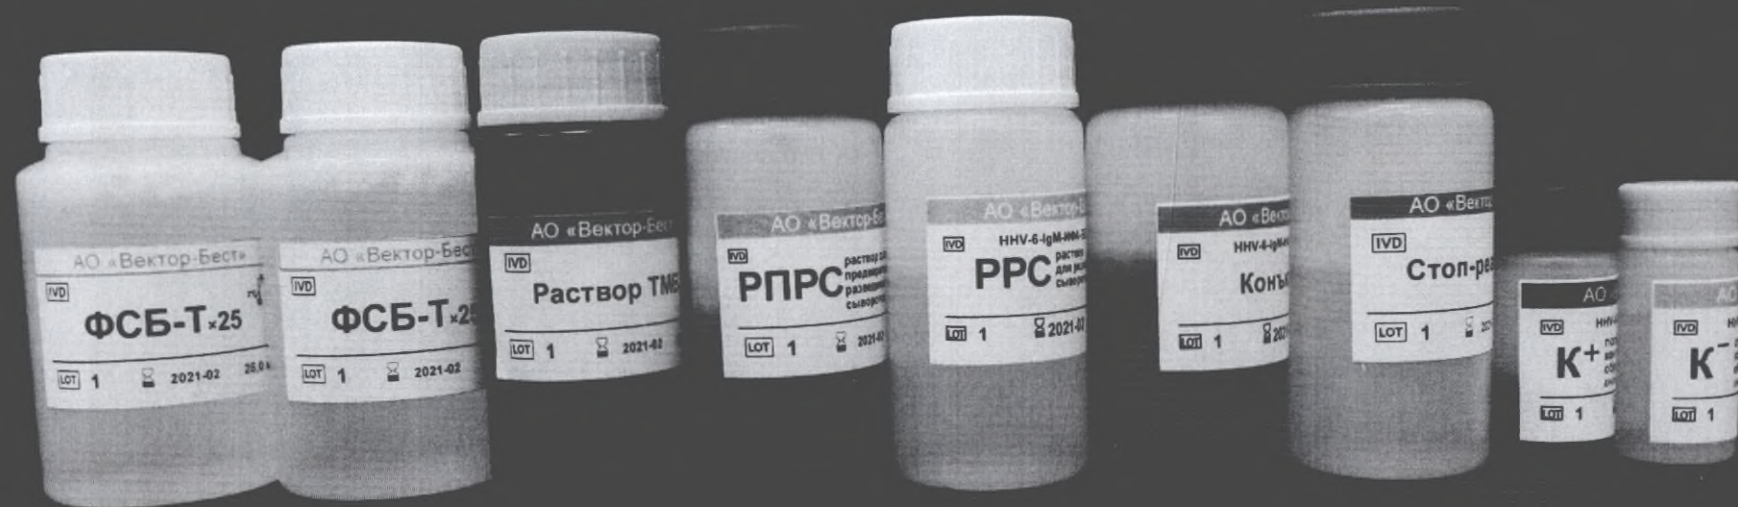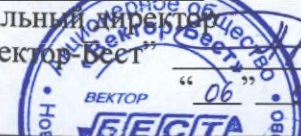

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ННУ-6-IgM-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 1



Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2020 г.

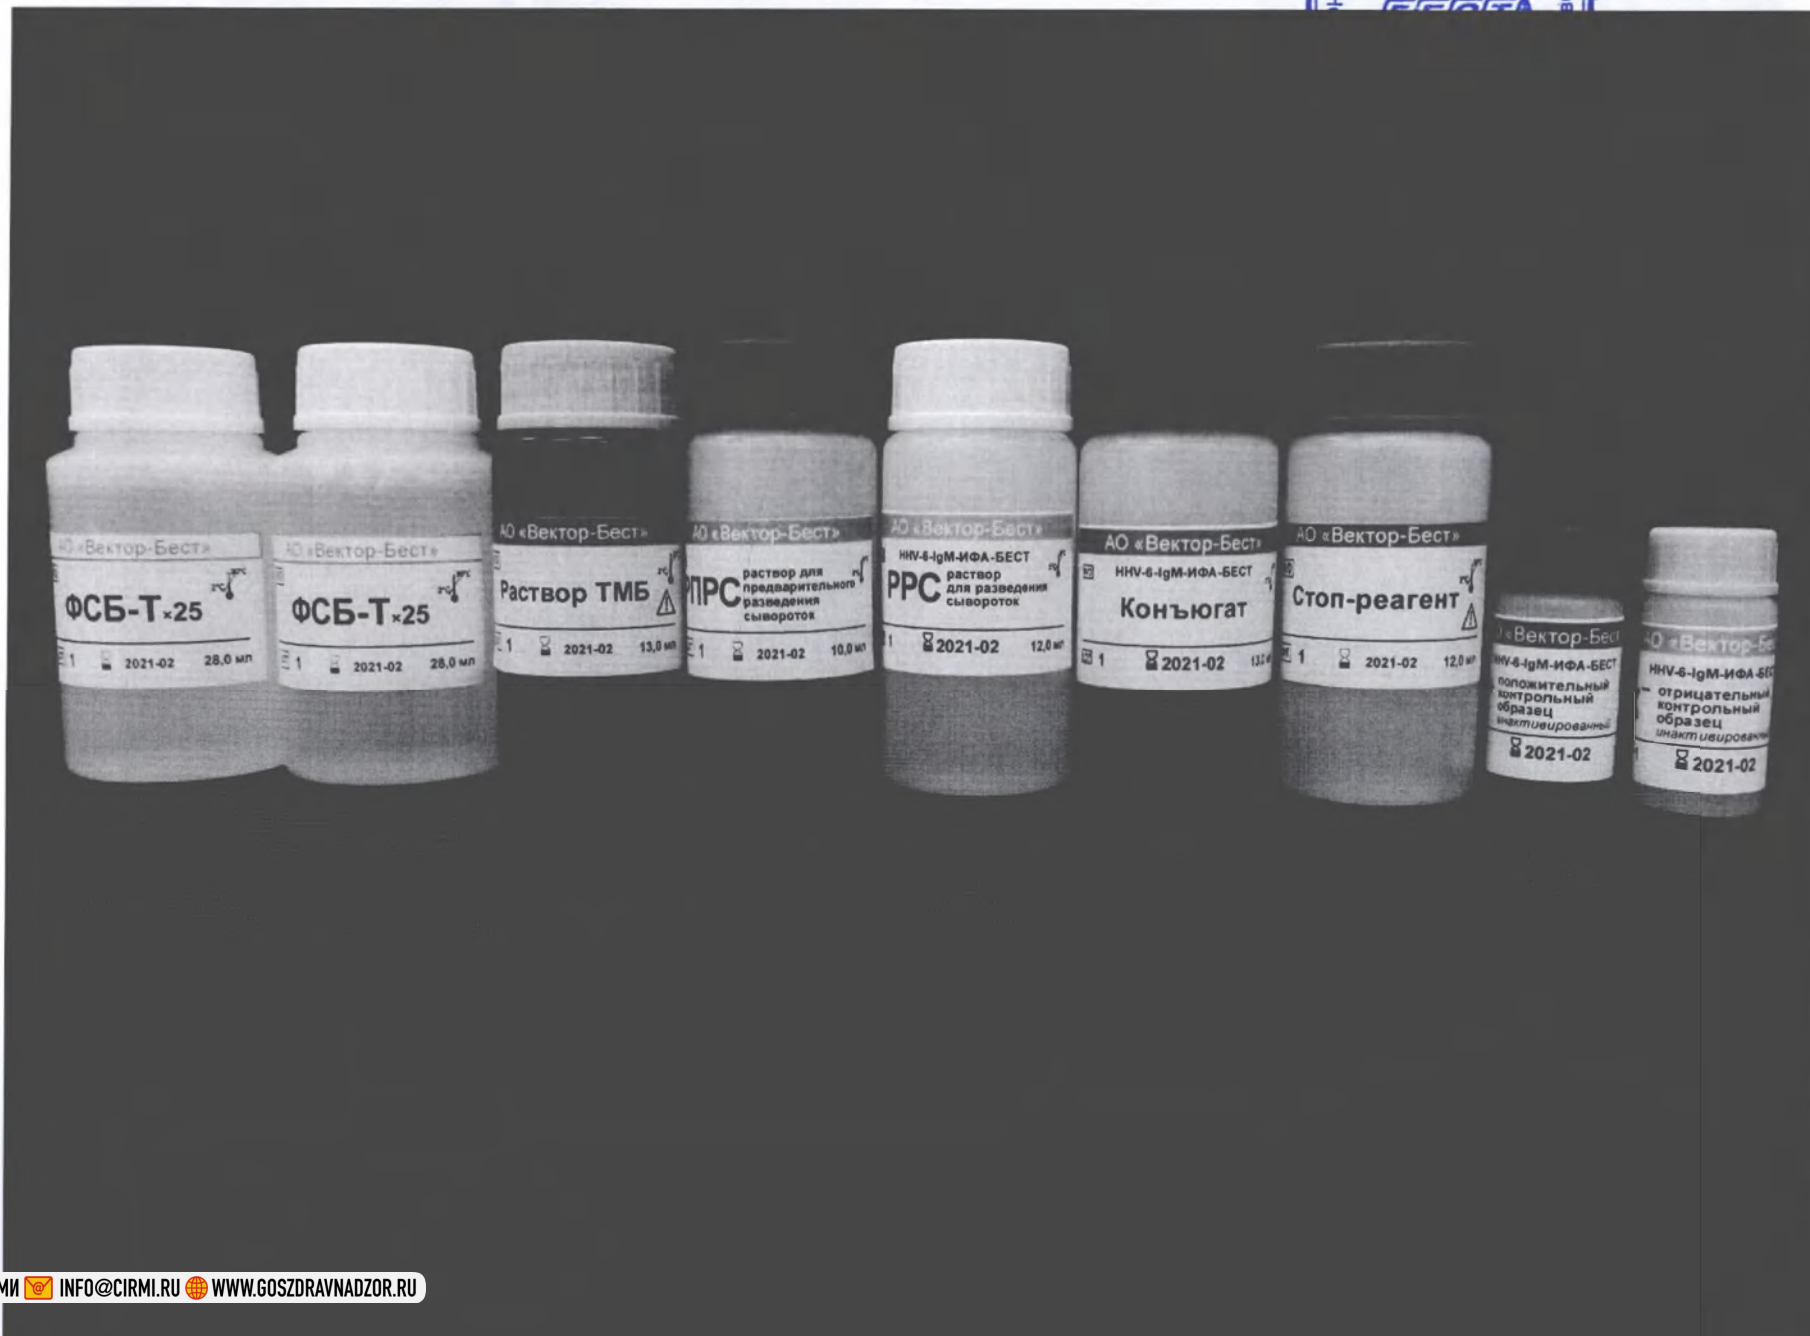

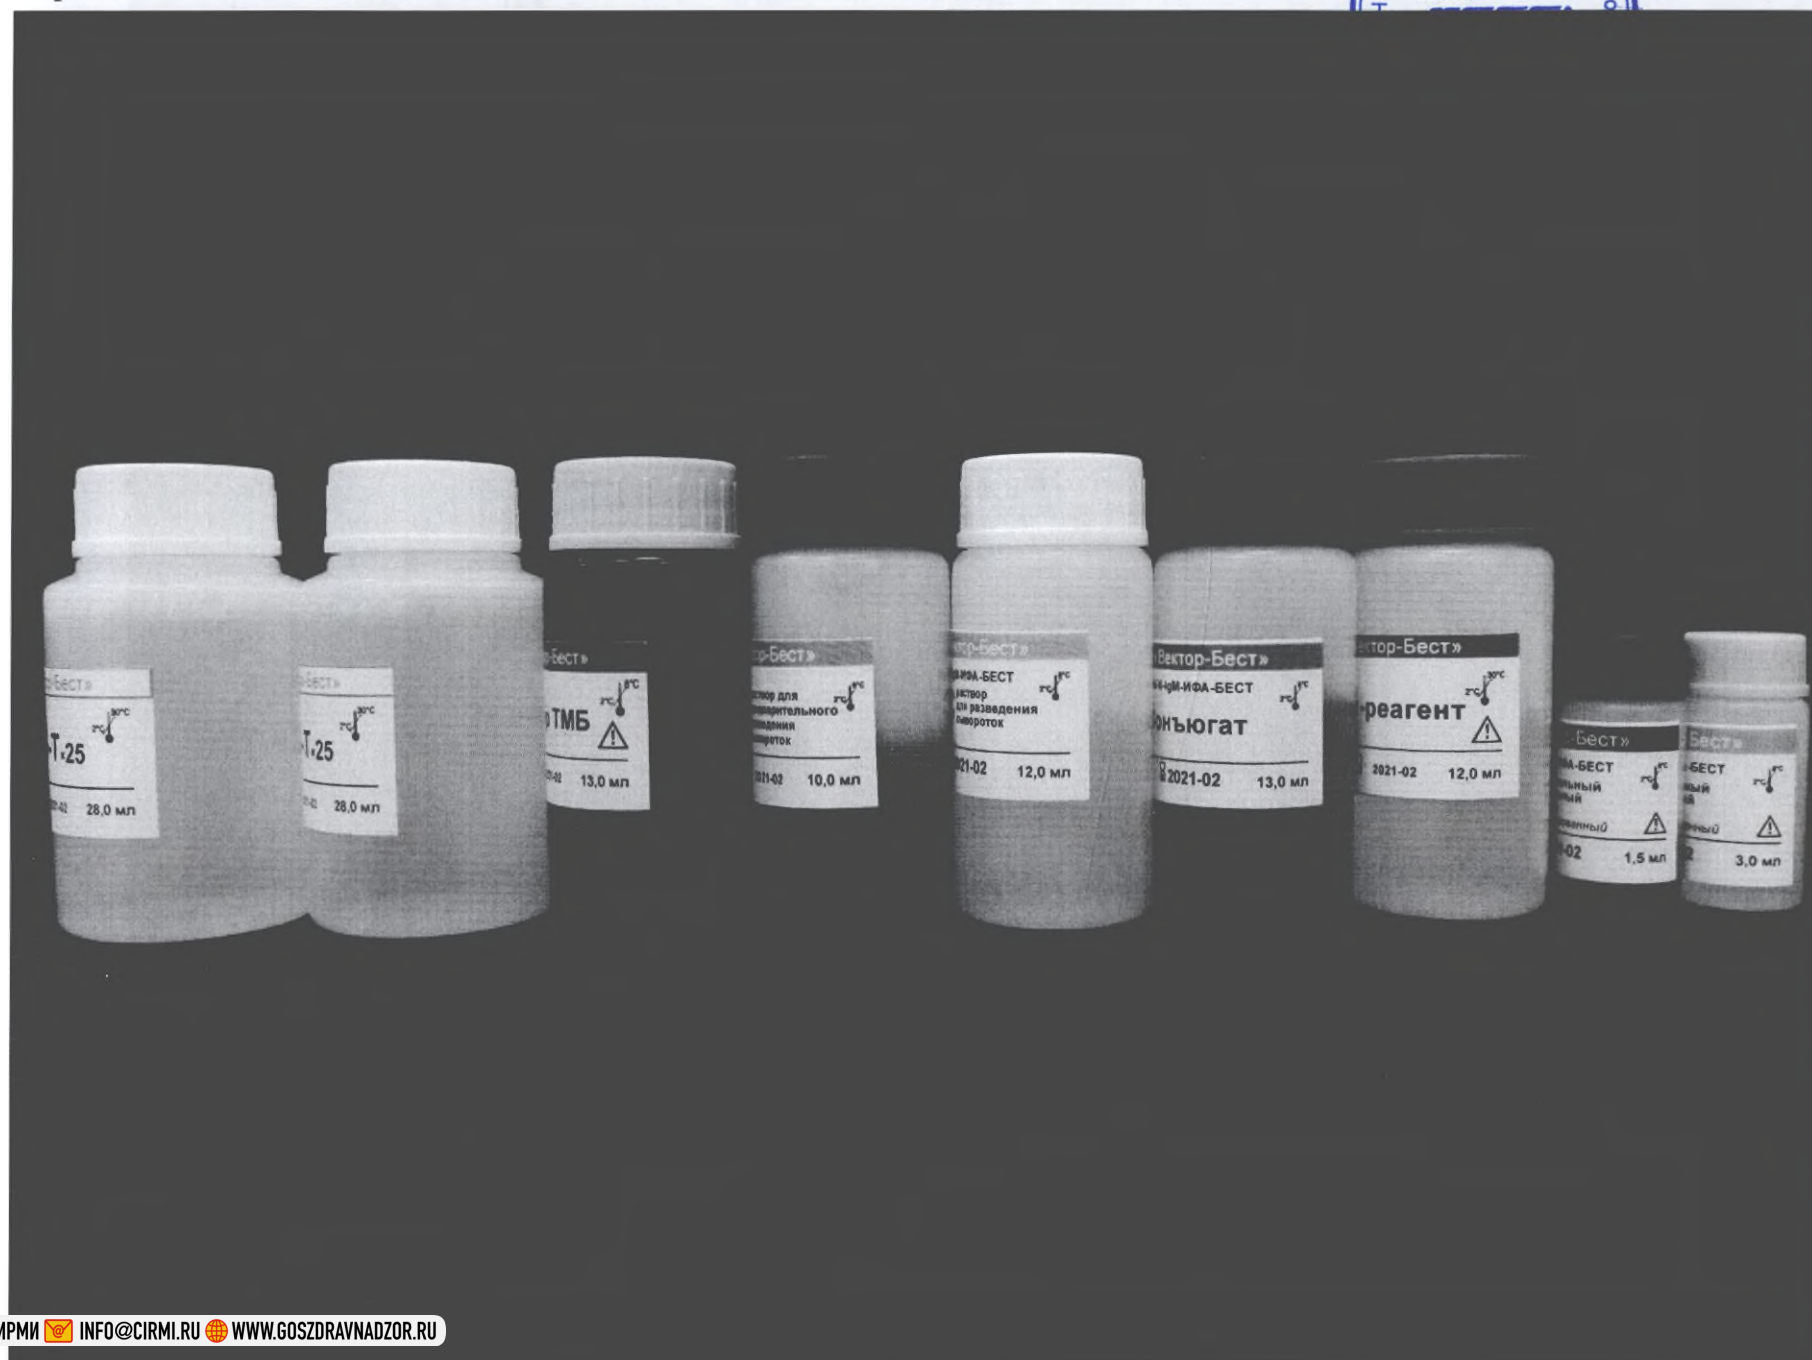

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ННУ-6-IgM-ИФА-БЕСТ” № 5
серия 1


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2020 г.

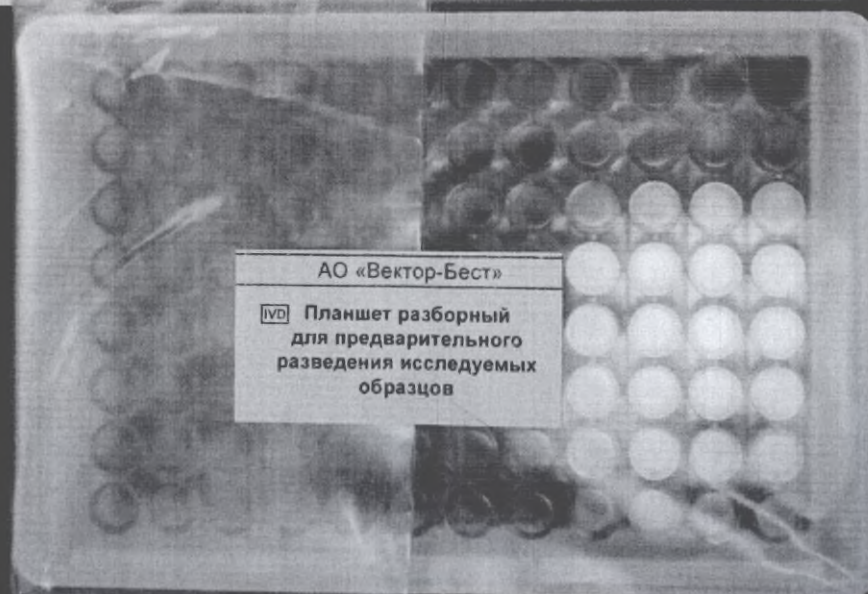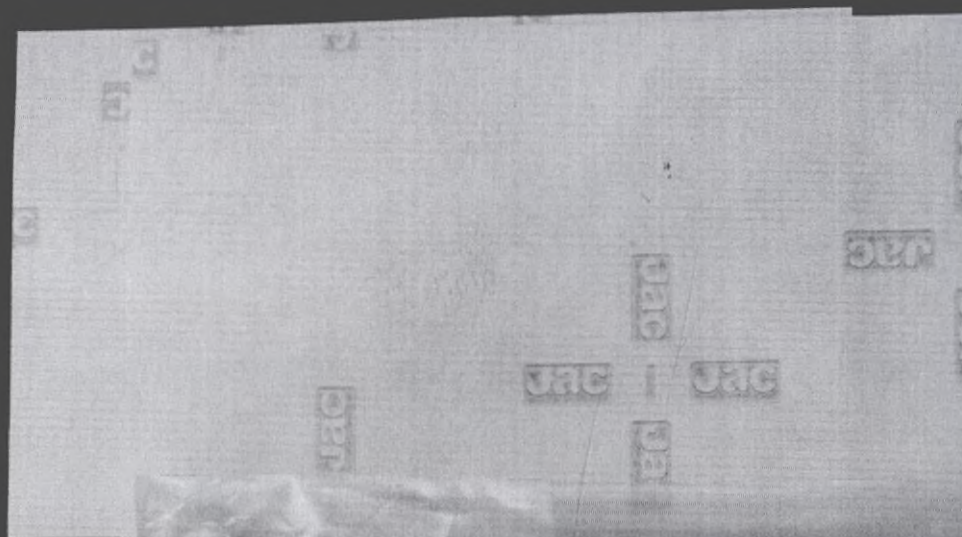

АО «Вектор-Бест»


 Планшет разборный
для предварительного
разведения исследуемых
образцов



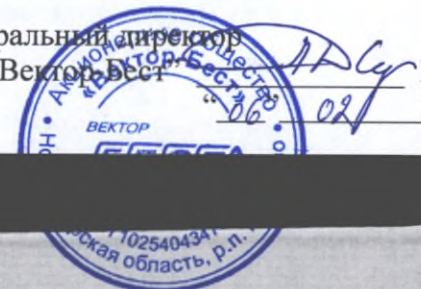

ВЕКТОР

БЕСТ

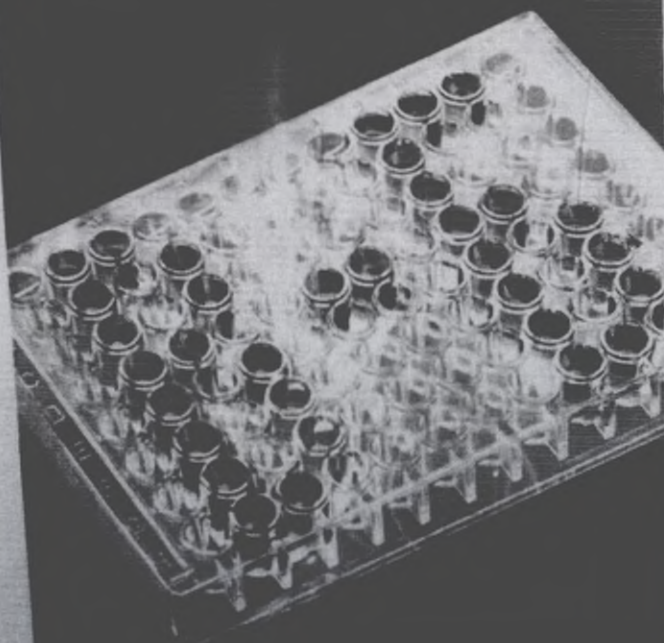

REF

X-XXXX

Набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М к вирусу к
вирусу герпеса человека 6 типа методом
«захвата» в сыворотке (плазме) крови

HNV-6-IgM-ИФА-БЕСТ

LOT 1


СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека	1 шт.		1
2. Положительный контрольный образец	1 фл.	1,5 мл	1
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл.	3,0 мл	1
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	1
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	1
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл	1
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с танином	2 фл.	по 28,0 мл	1
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл	1
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.		
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.		
12. Наконечники для дозаторов	16 шт.		
13. Ванилины для реагентов	2 шт.		


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"HIV-6-IgM-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.

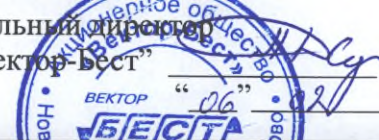

БЕКТОР

БЕСТ

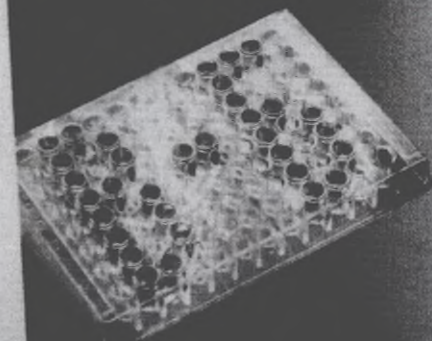

REF X-XXXX

Σ 96

LOT

1

ТУ 21.20.23-098-23548172-2020


РУ №

2020-02-05

2021-02-05

HIV-6-IgM-ИФА-БЕСТ

IVD




XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ННУ-6-IgM-ИФА-БЕСТ” №3
серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.Д. Хусаинов
2020 г.

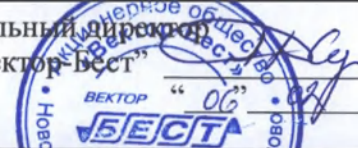

АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“ННУ-6-IgM-ИФА-БЕСТ”
 серия 2

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 2020 г.

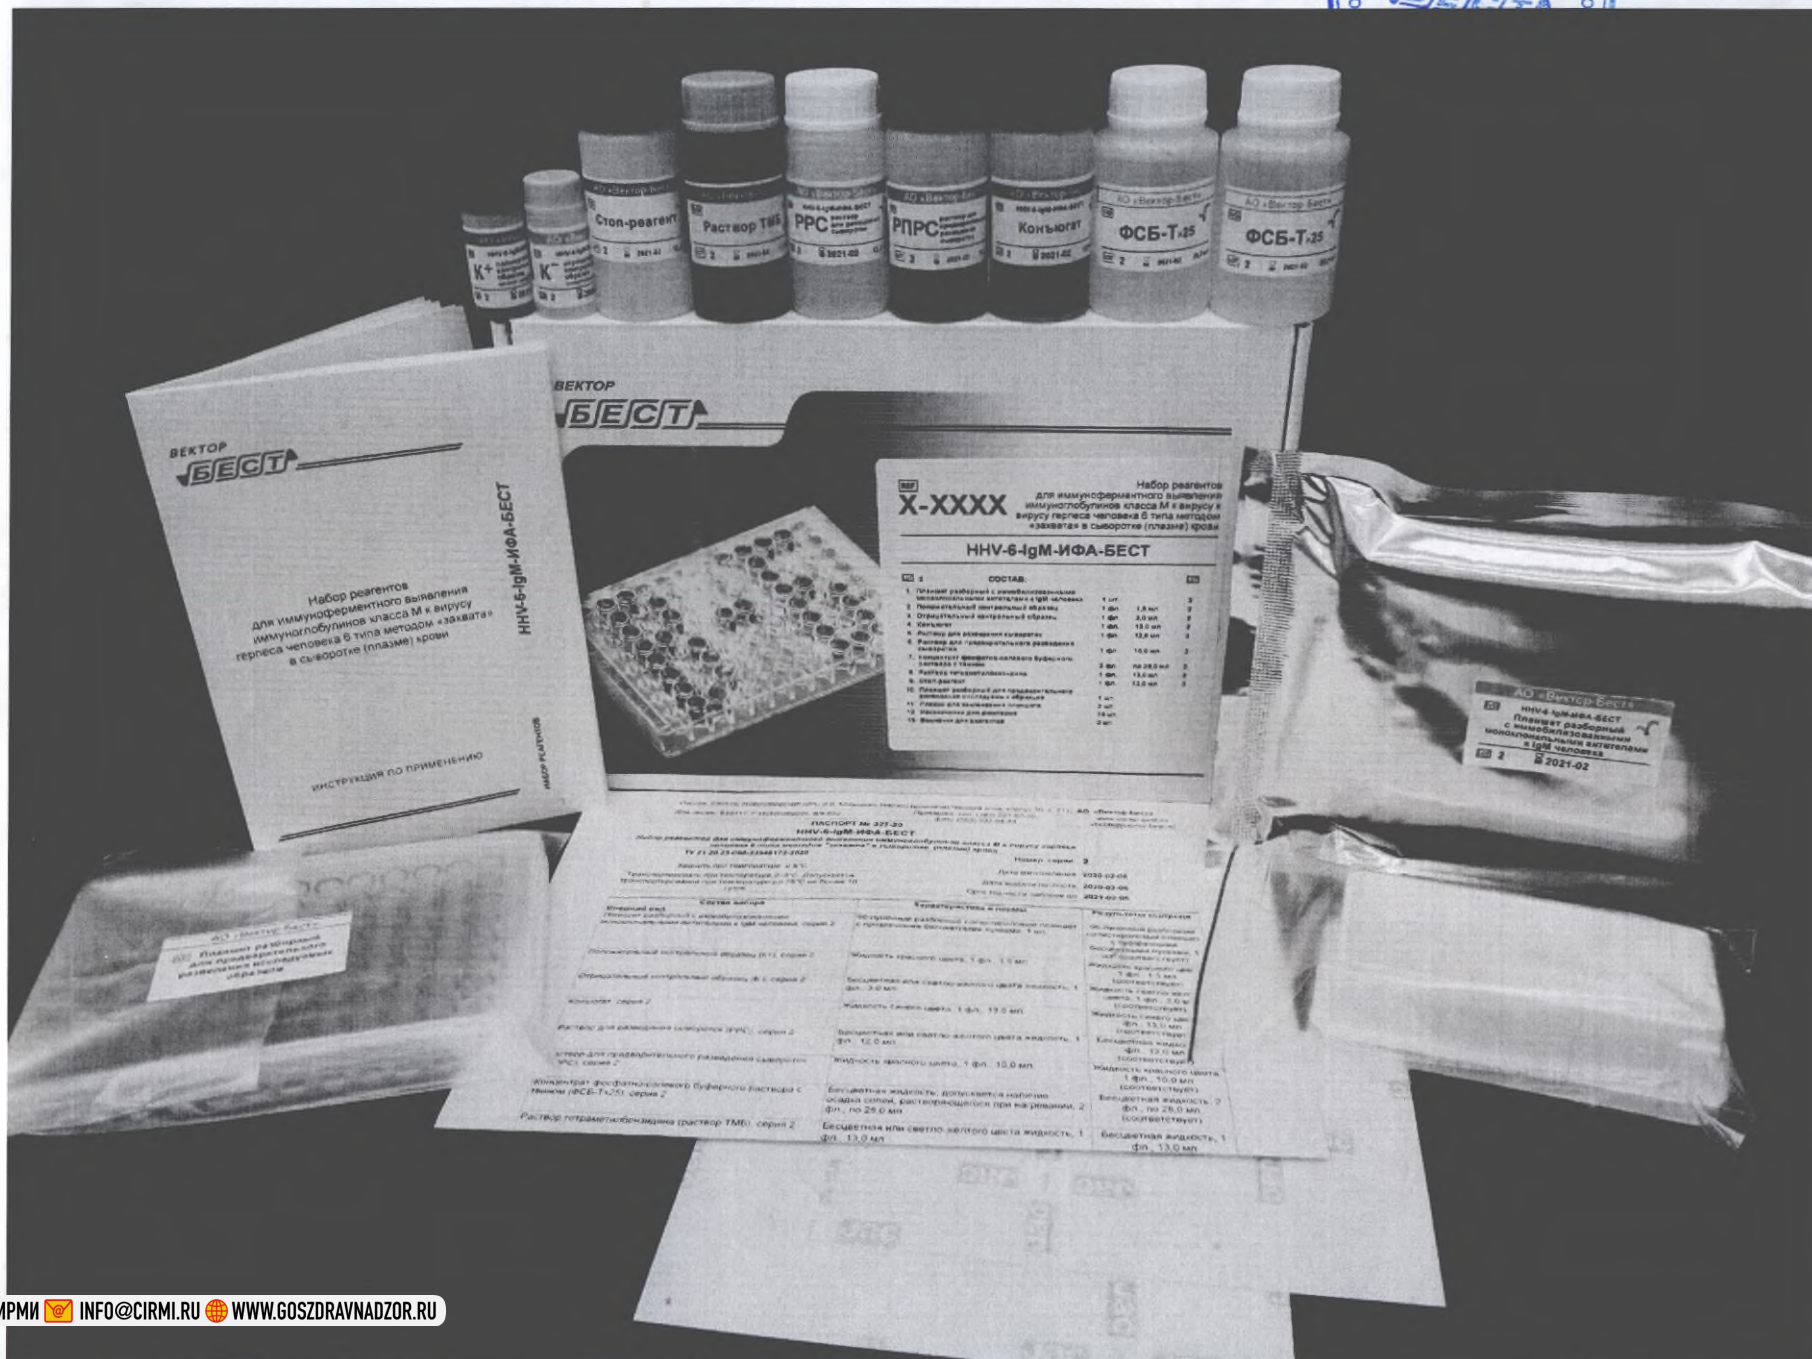

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ННУ-6-IgM-ИФА-БЕСТ” №1
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
2020 г.

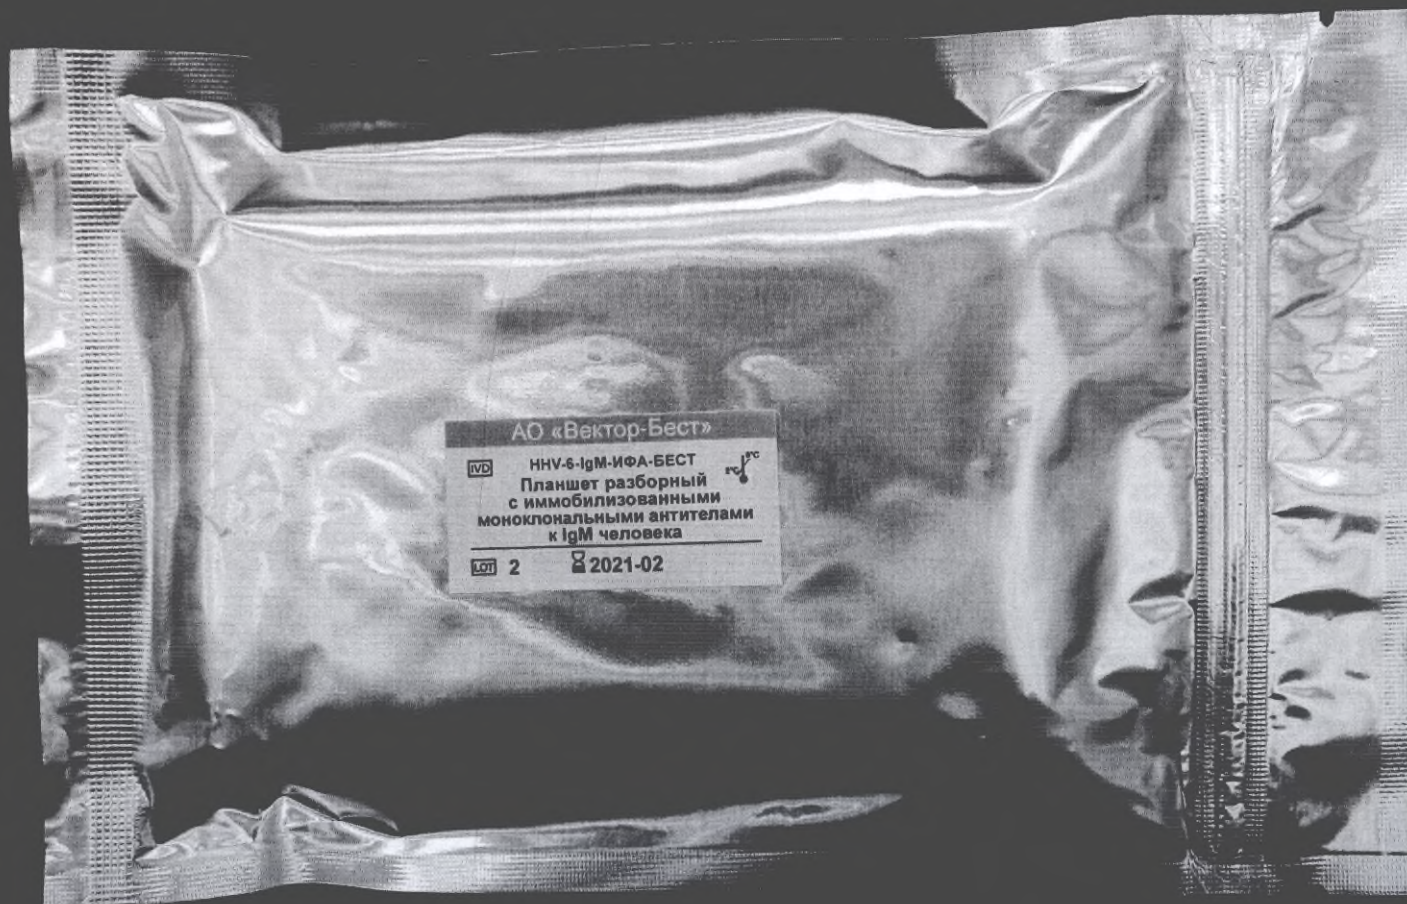

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ННУ-6-IgM-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“06” 02 2020 г.






Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“HNV-6-IgM-ИФА-БЕСТ” № 4
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“06” _____ 2020 г.

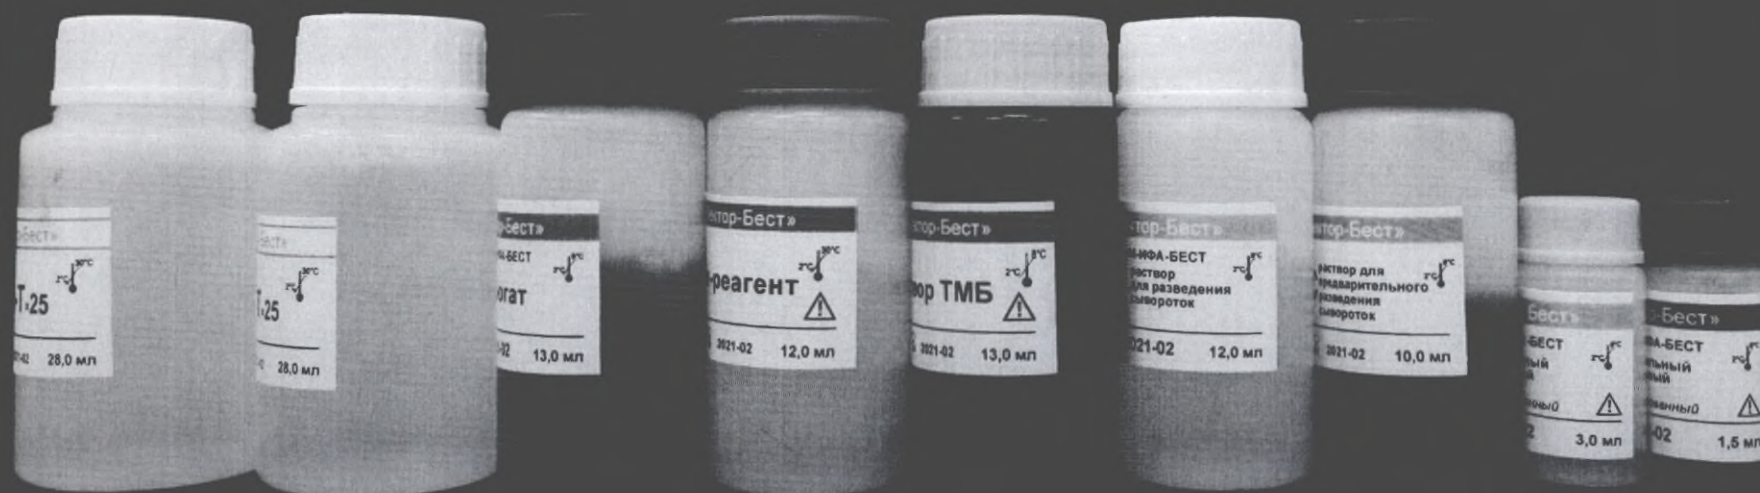

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ННУ-6-IgM-ИФА-БЕСТ” № 5
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“06” 02 2020 г.

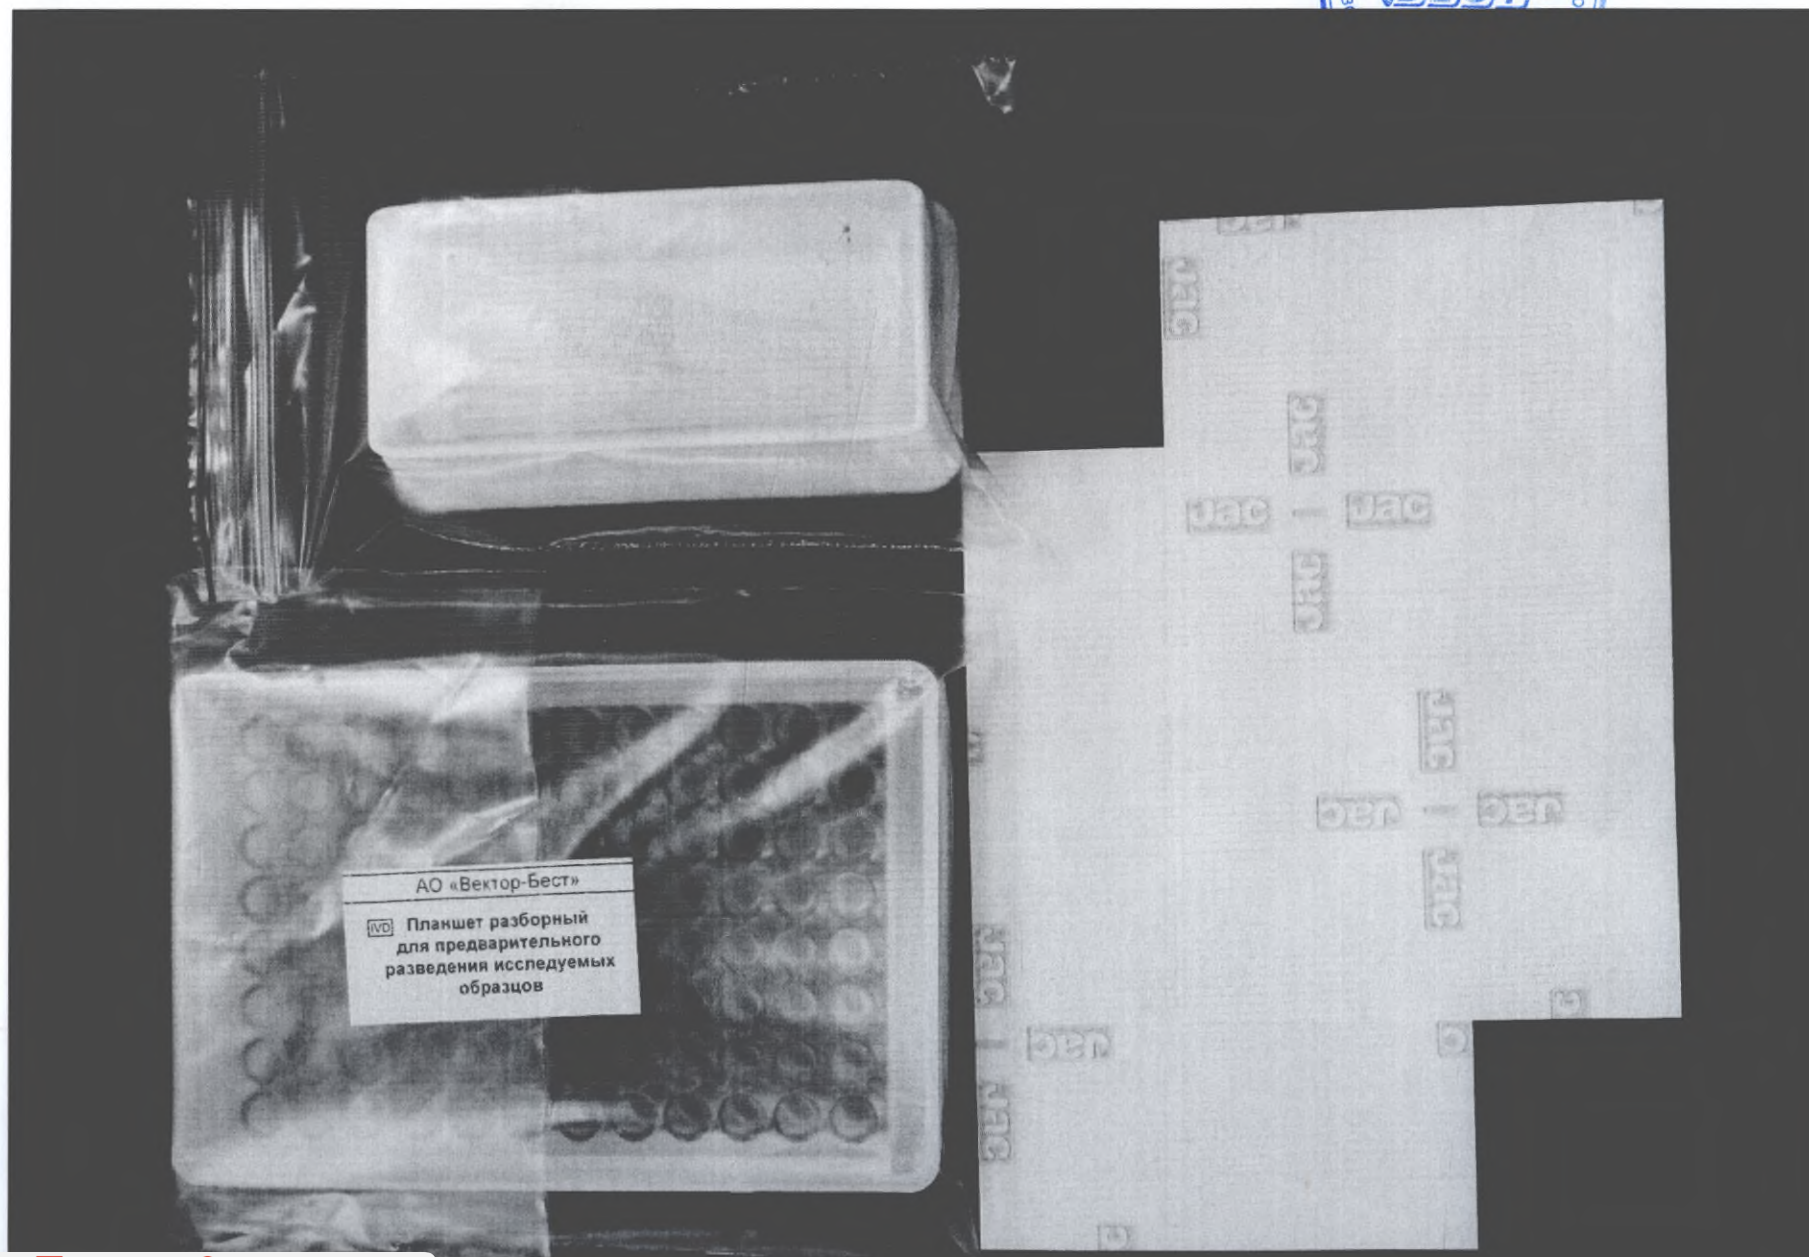

БЕКТОР

БЕСТ



REF

X-XXXX

Набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М к вирусу к
вирусу герпеса человека 6 типа методом
«захвата» в сыворотке (плазме) крови

HNV-6-IgM-ИФА-БЕСТ

LOT 2


СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека	1 шт.		2
2. Положительный контрольный образец	1 фл.	1,5 мл	2
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл.	3,0 мл	2
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	2
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	2
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл	2
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл	2
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл	2
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	2
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.		
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.		
12. Наконечники для дозаторов	16 шт.		
13. Ваточки для реагентов	2 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“HNV-6-IgM-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“06” 02 2020 г.

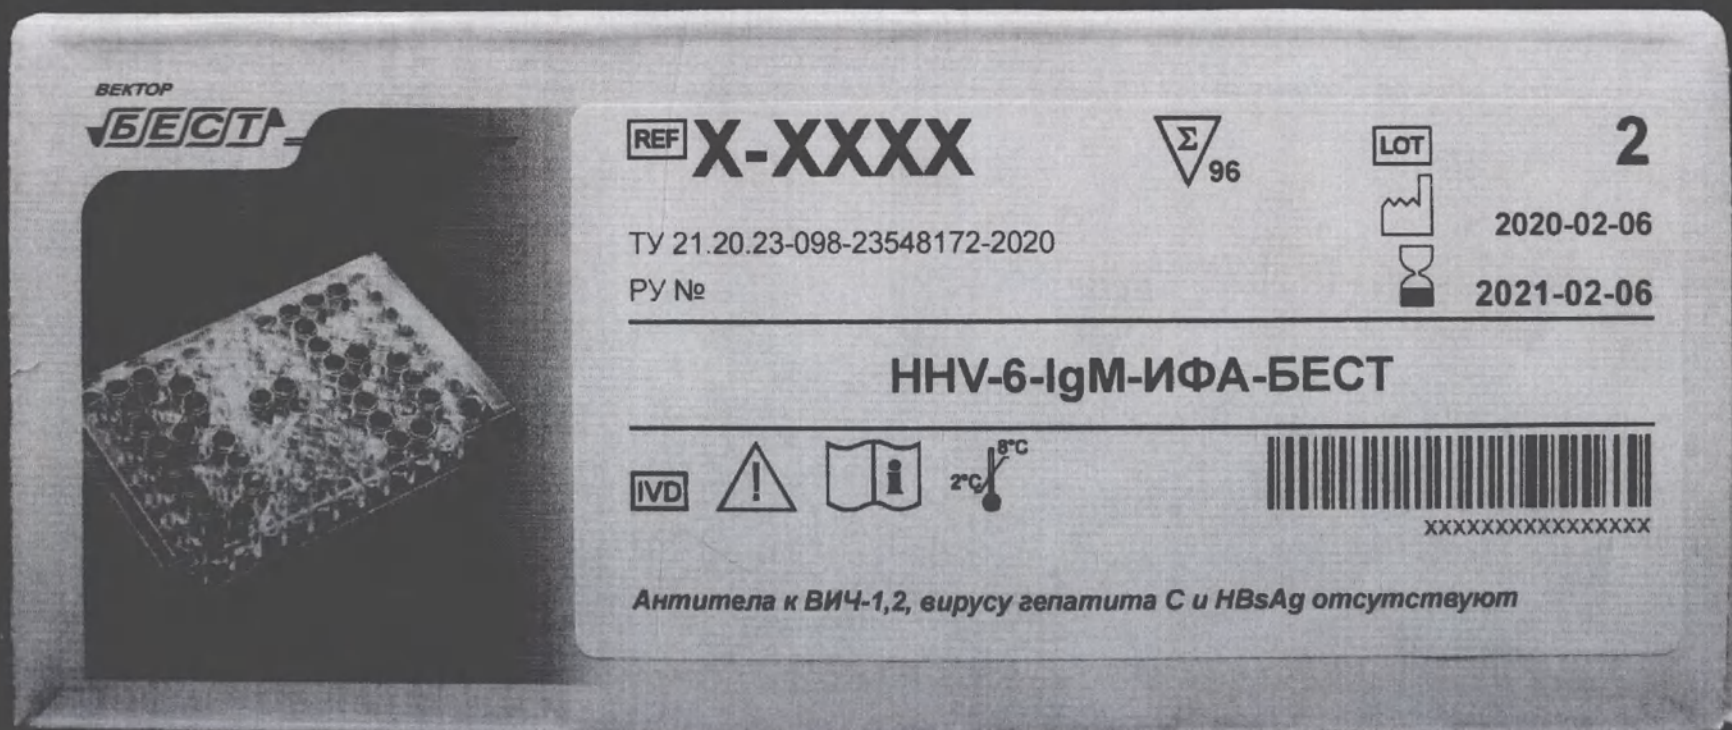

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ННУ-6-IgM-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“06” “02” 2020 г.






АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ННУ-6-IgM-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 2

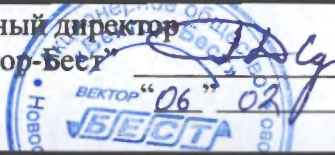Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“06” “02” 2020 г.




АО «Вектор-Бест»

Россия. 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru