

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "ГЛАВМЕДСНАБ"

« 15 » июня 2020 г.



Саенков М.А.

Фотографические изображения Медицинского Изделия:

«Фороптор автоматический цифровой DR19»

Состав:

1. Основной блок фороптора DR19-1шт.
2. Блок управления и коммутации-1шт.
3. Упор для лба-1шт.
4. Карта «ближнего» зрения-1шт.
5. Направляющая карты «ближнего» зрения-1шт.
6. Винты крепления-2шт.
7. Предохранитель-2шт.
8. Кабель передачи данных-1шт.
9. Кабель питания-1шт.
10. Пылезащитный чехол -1шт.
11. Руководство по эксплуатации-1шт.

Производства:


MEDIZS Inc. («МЭДИЗС Инк.»)

Адрес места производства медицинского изделия:

94-10, Techno2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea

(94-10 ул. Техно-2, район Юсонг, г. Тэджон, Южная Корея)

1. Упаковка Медицинского Изделия: «Фороптор автоматический цифровой DR19»
1)

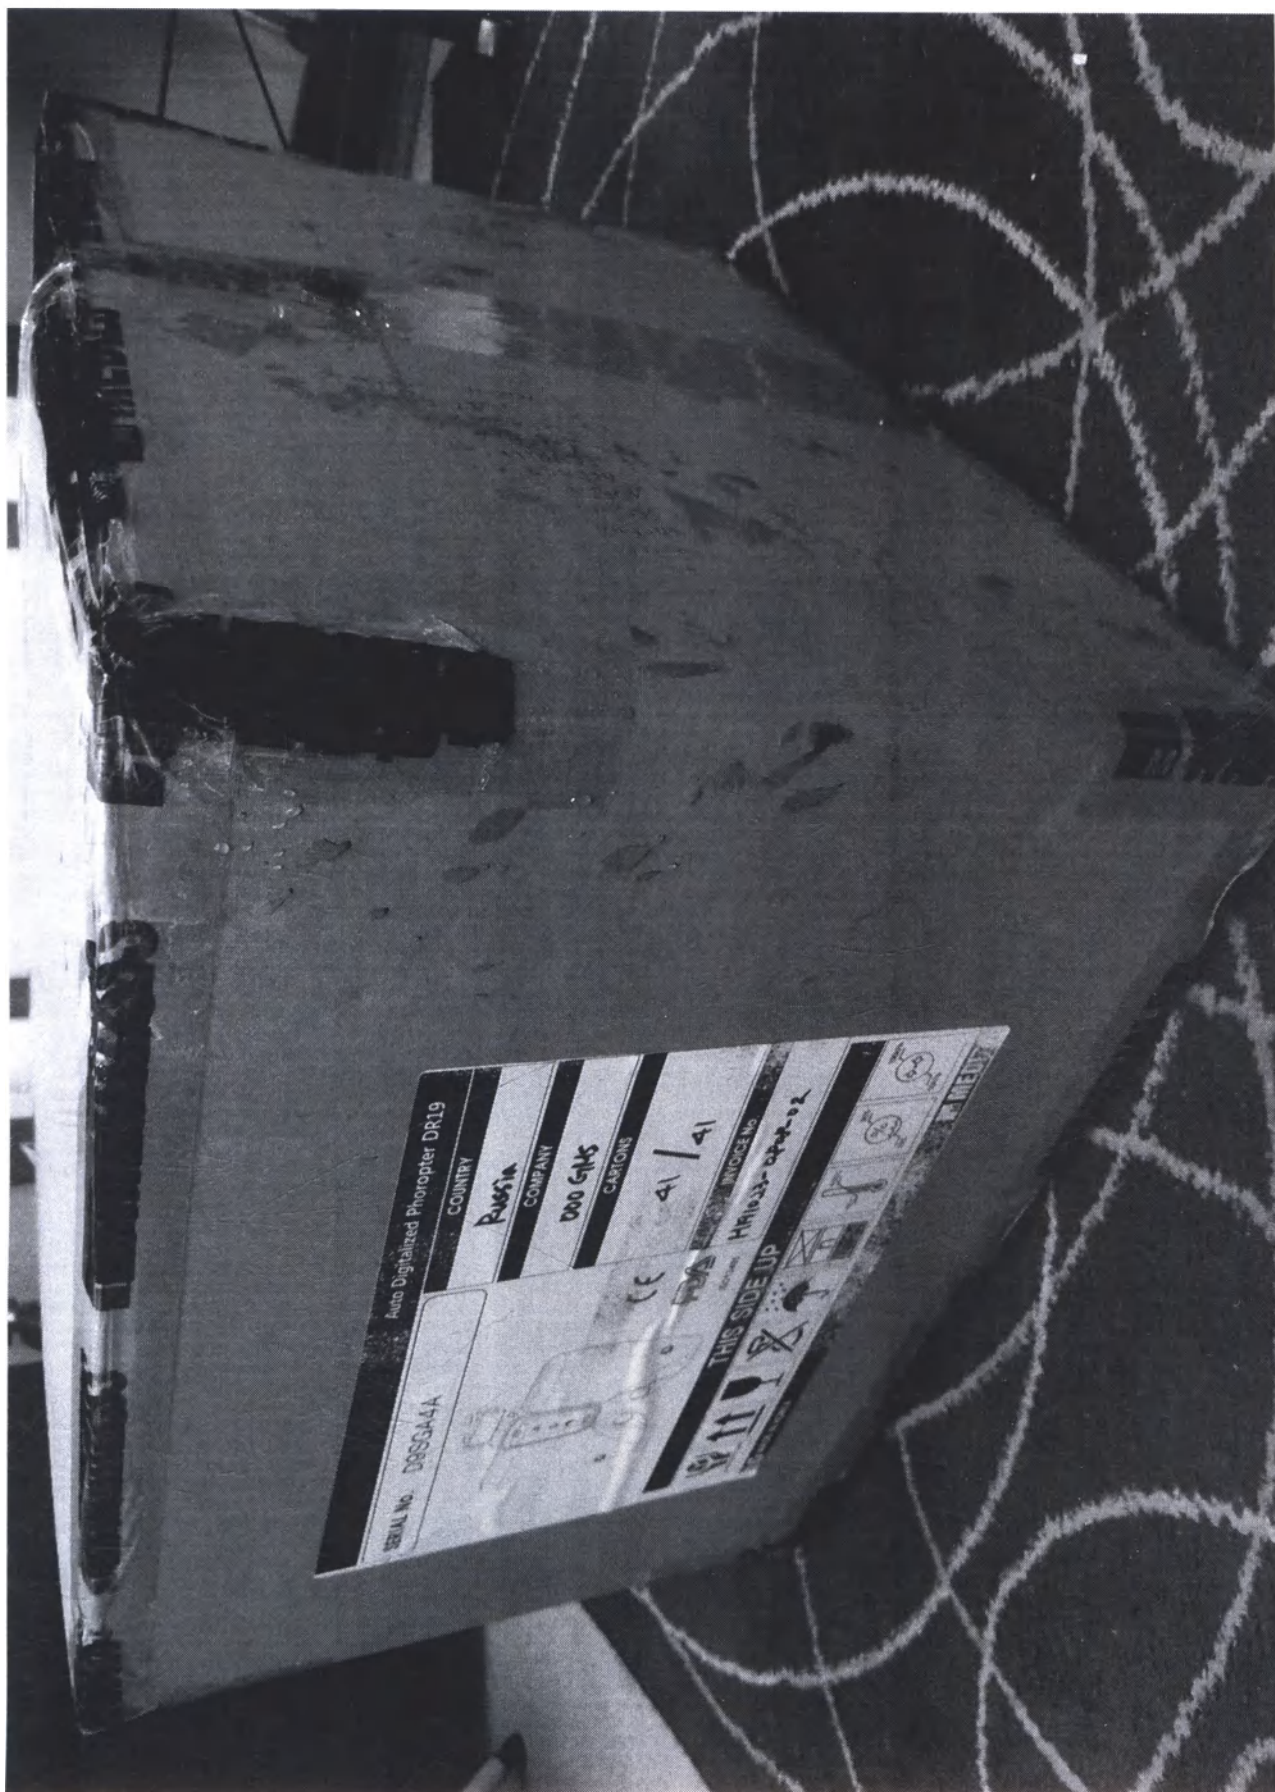





2. Основной блок фороптора DR19


Фронтальная сторона




Тыльная сторона




3. Блок управления и коммутации

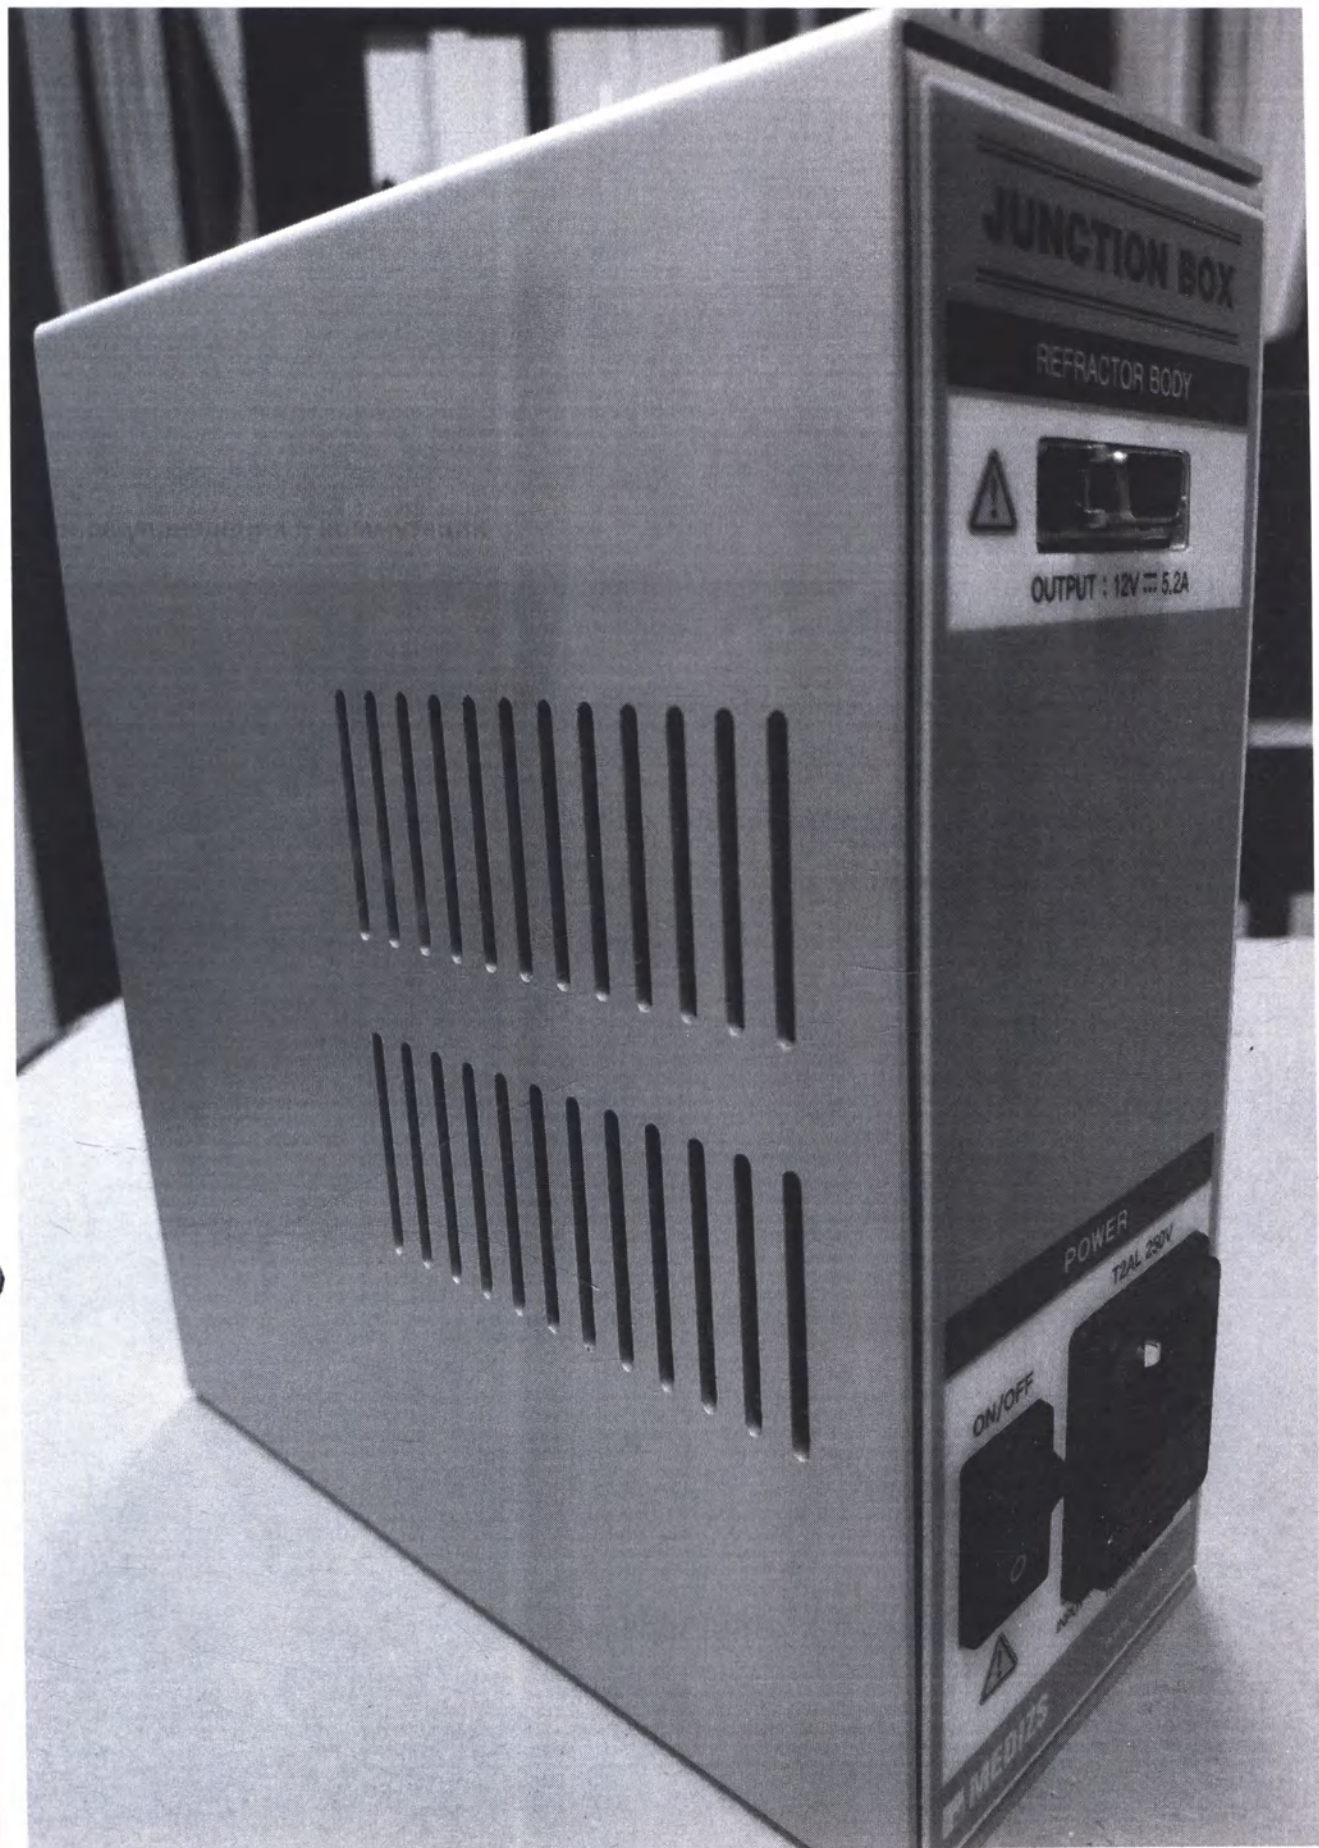


4. Упор для лба

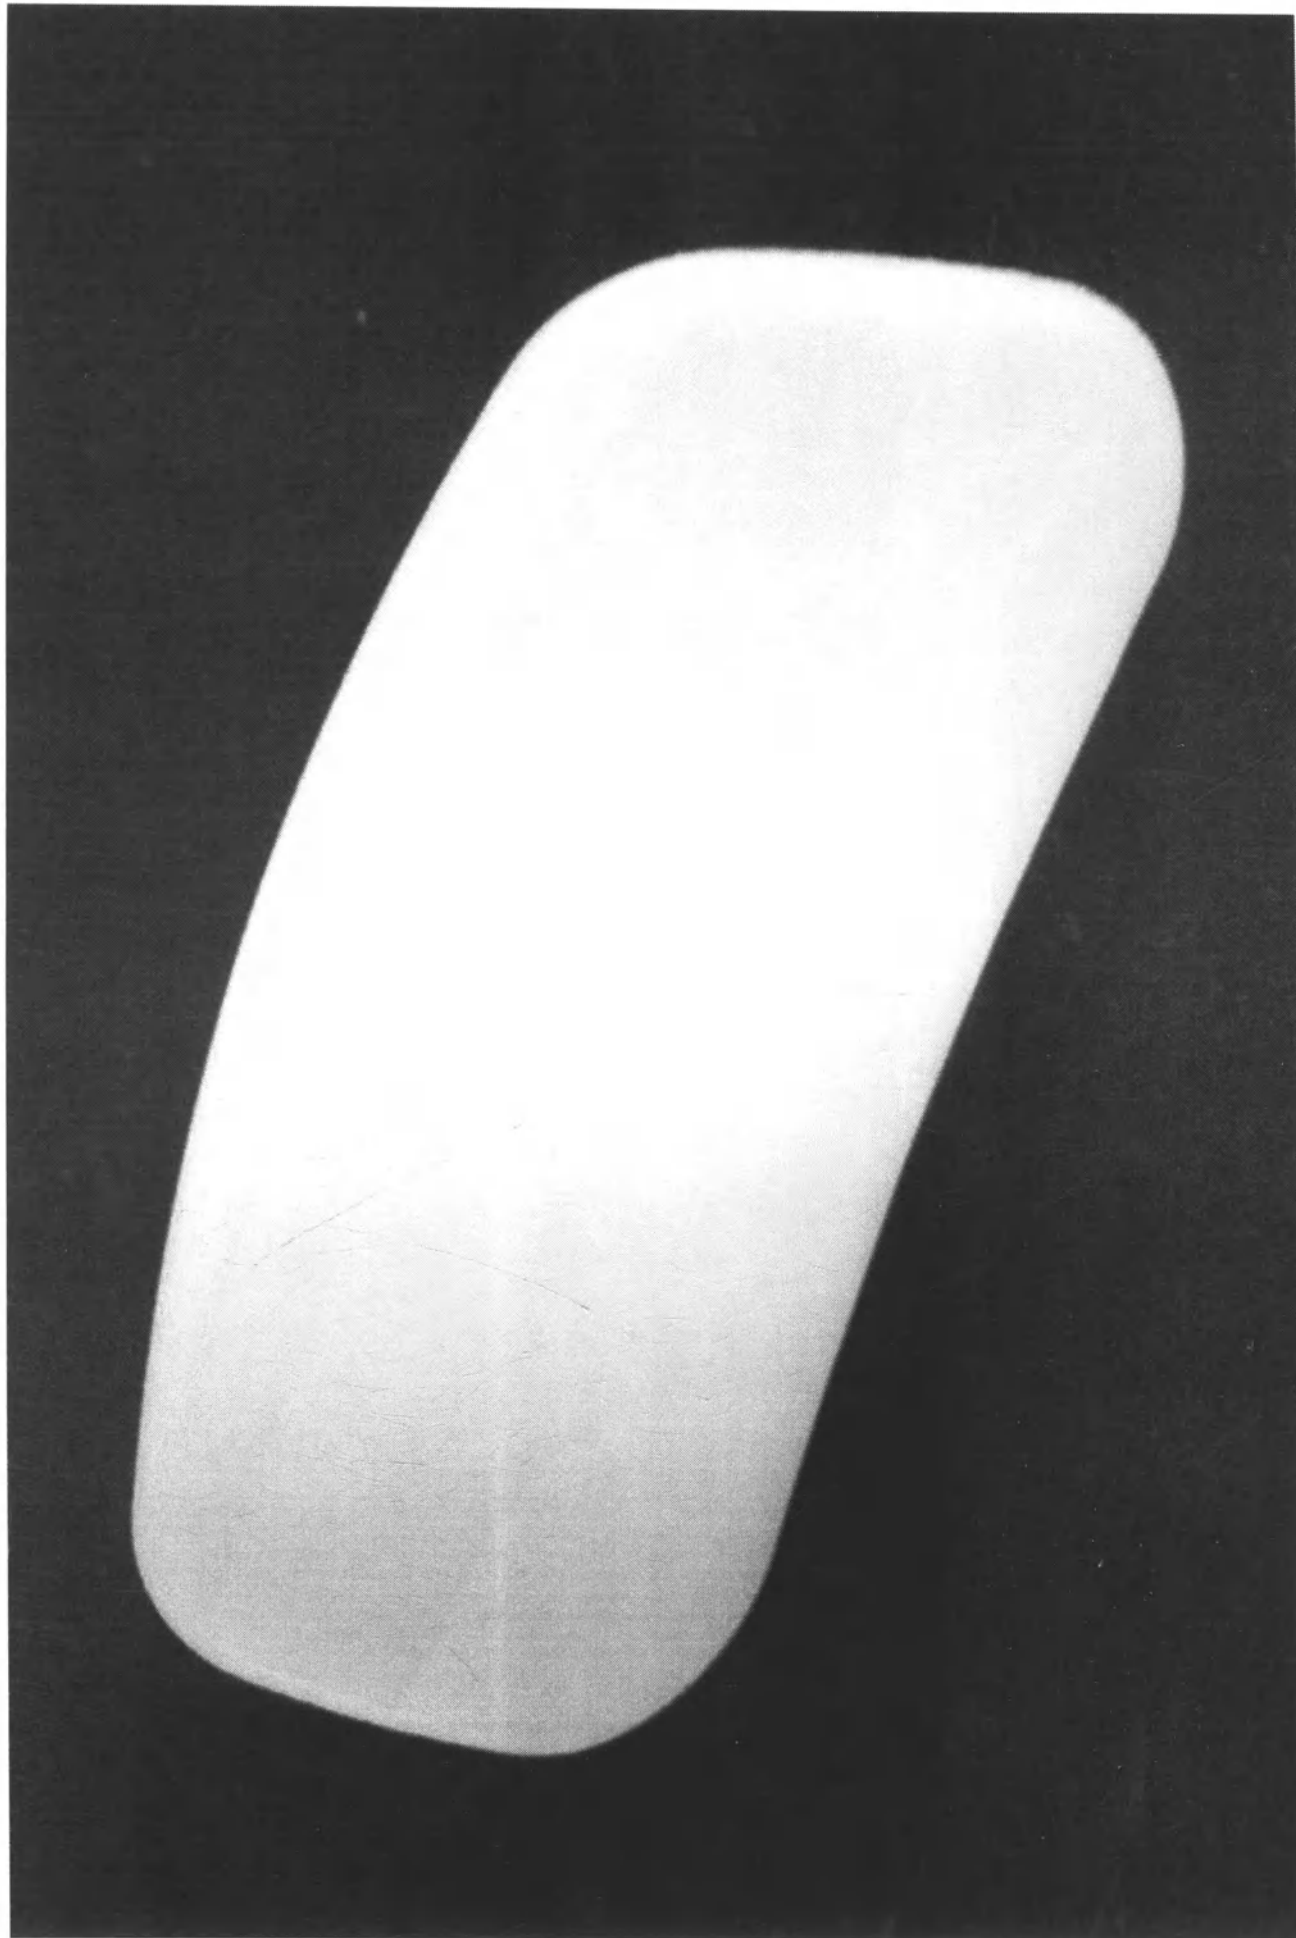


5. Карта «ближнего» зрения

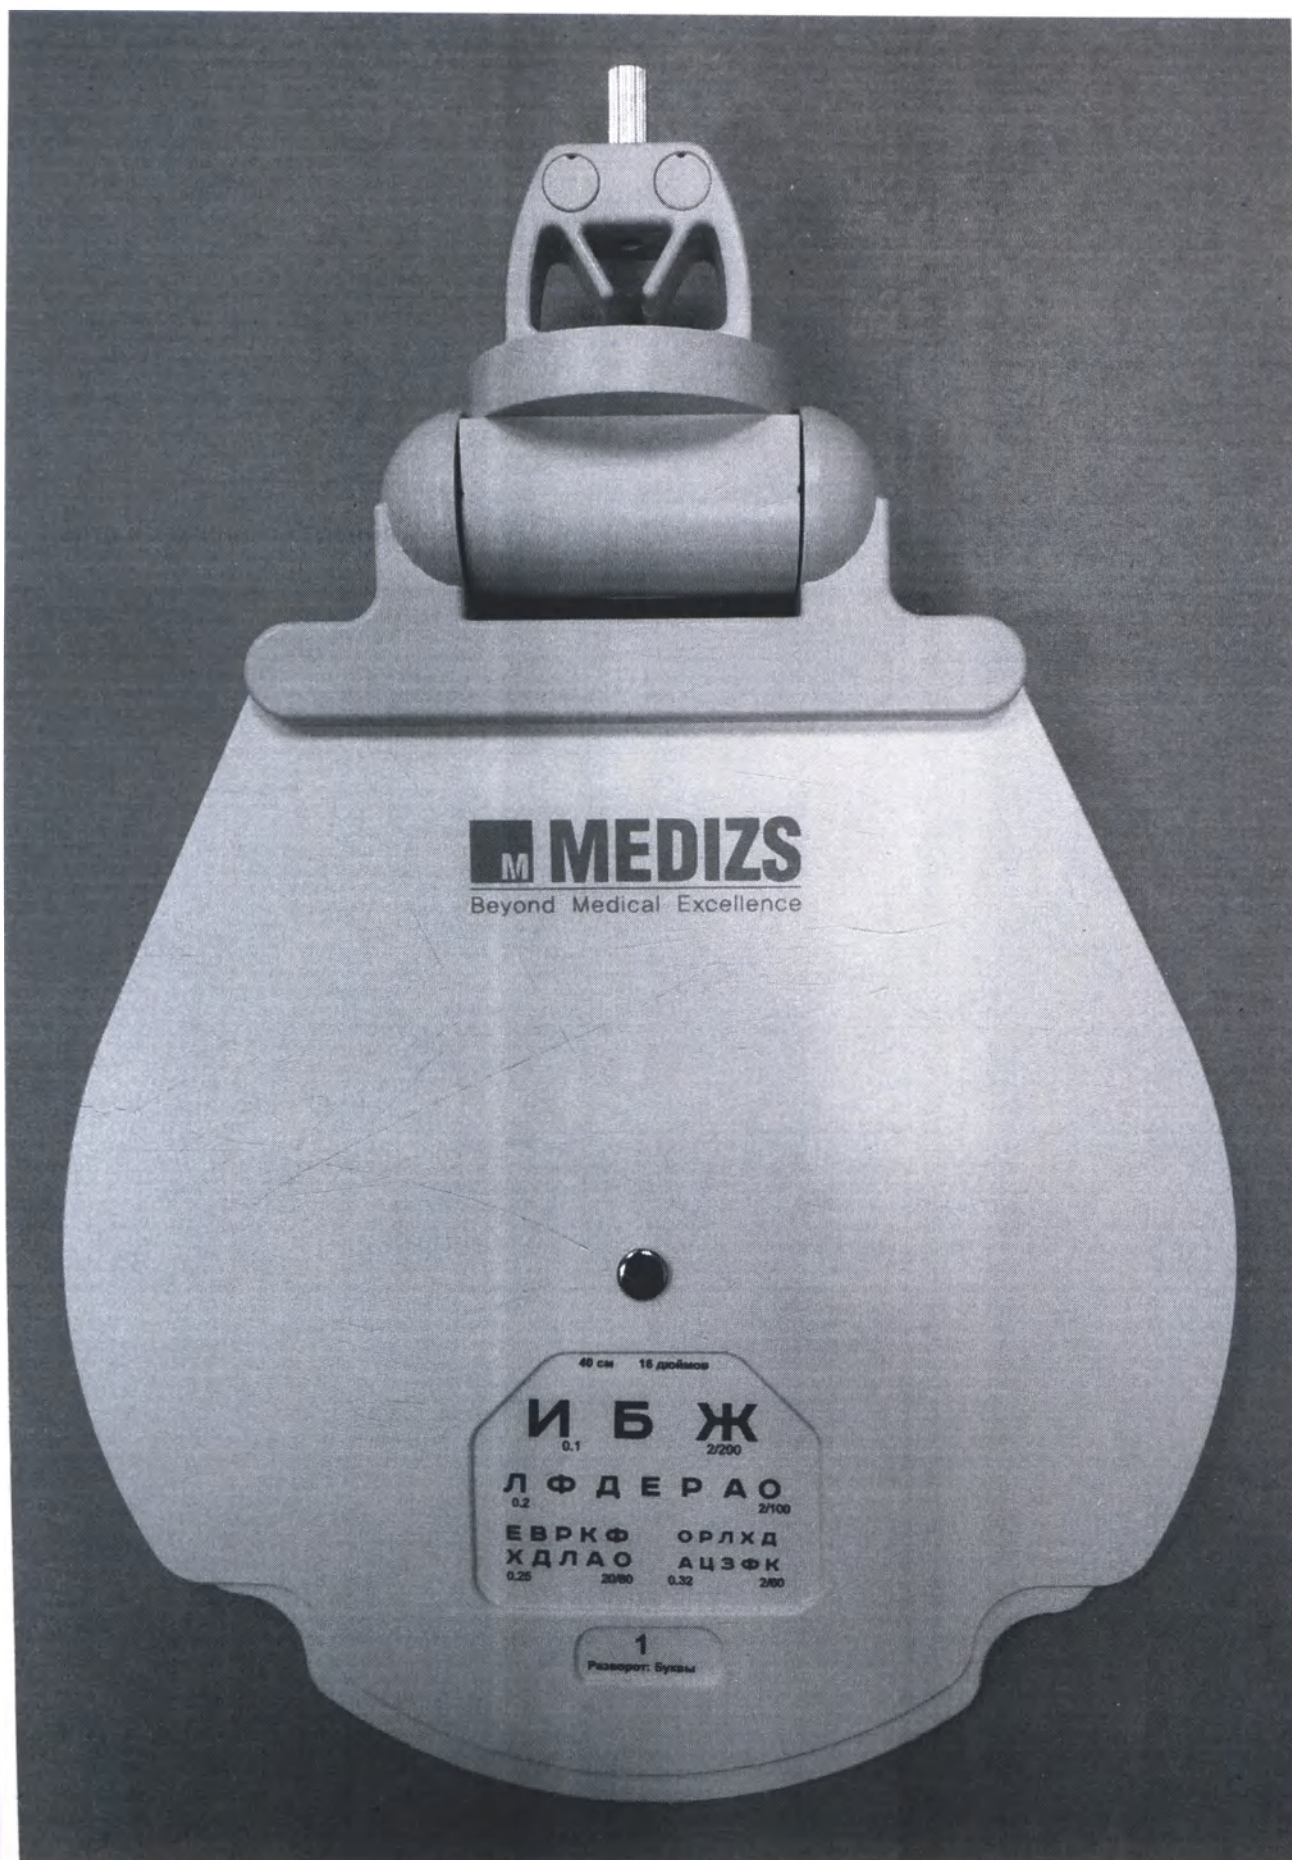


6. Направляющая карты «ближнего» зрения

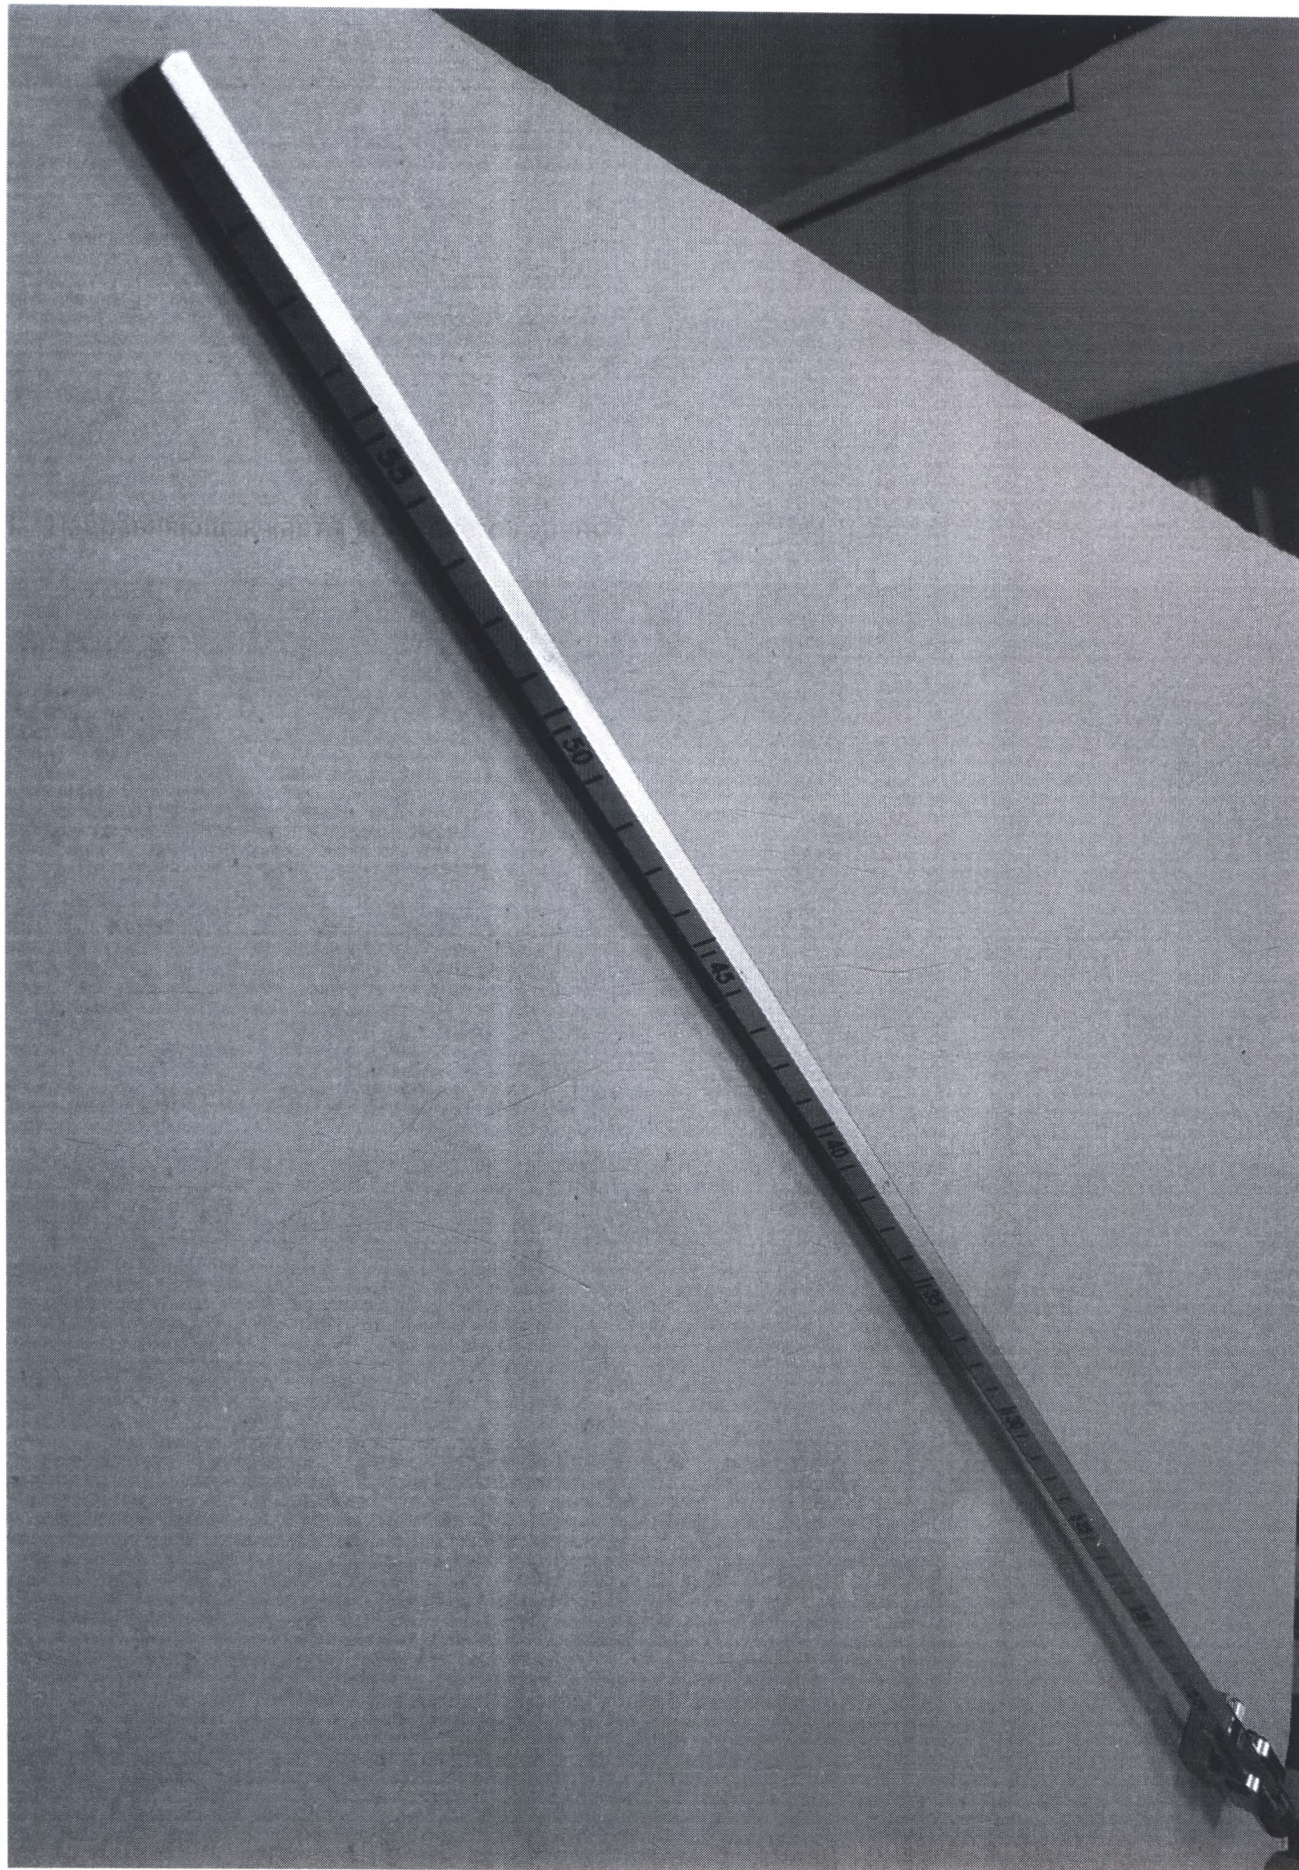


7. Винты крепления

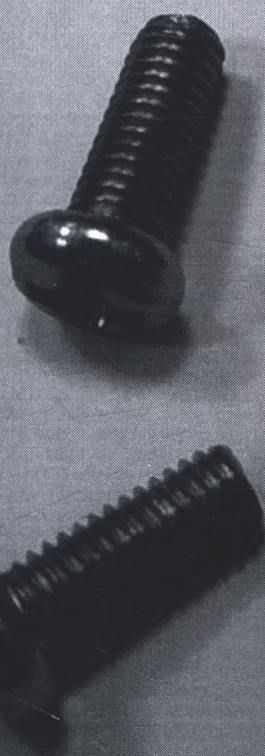

8. Предохранитель

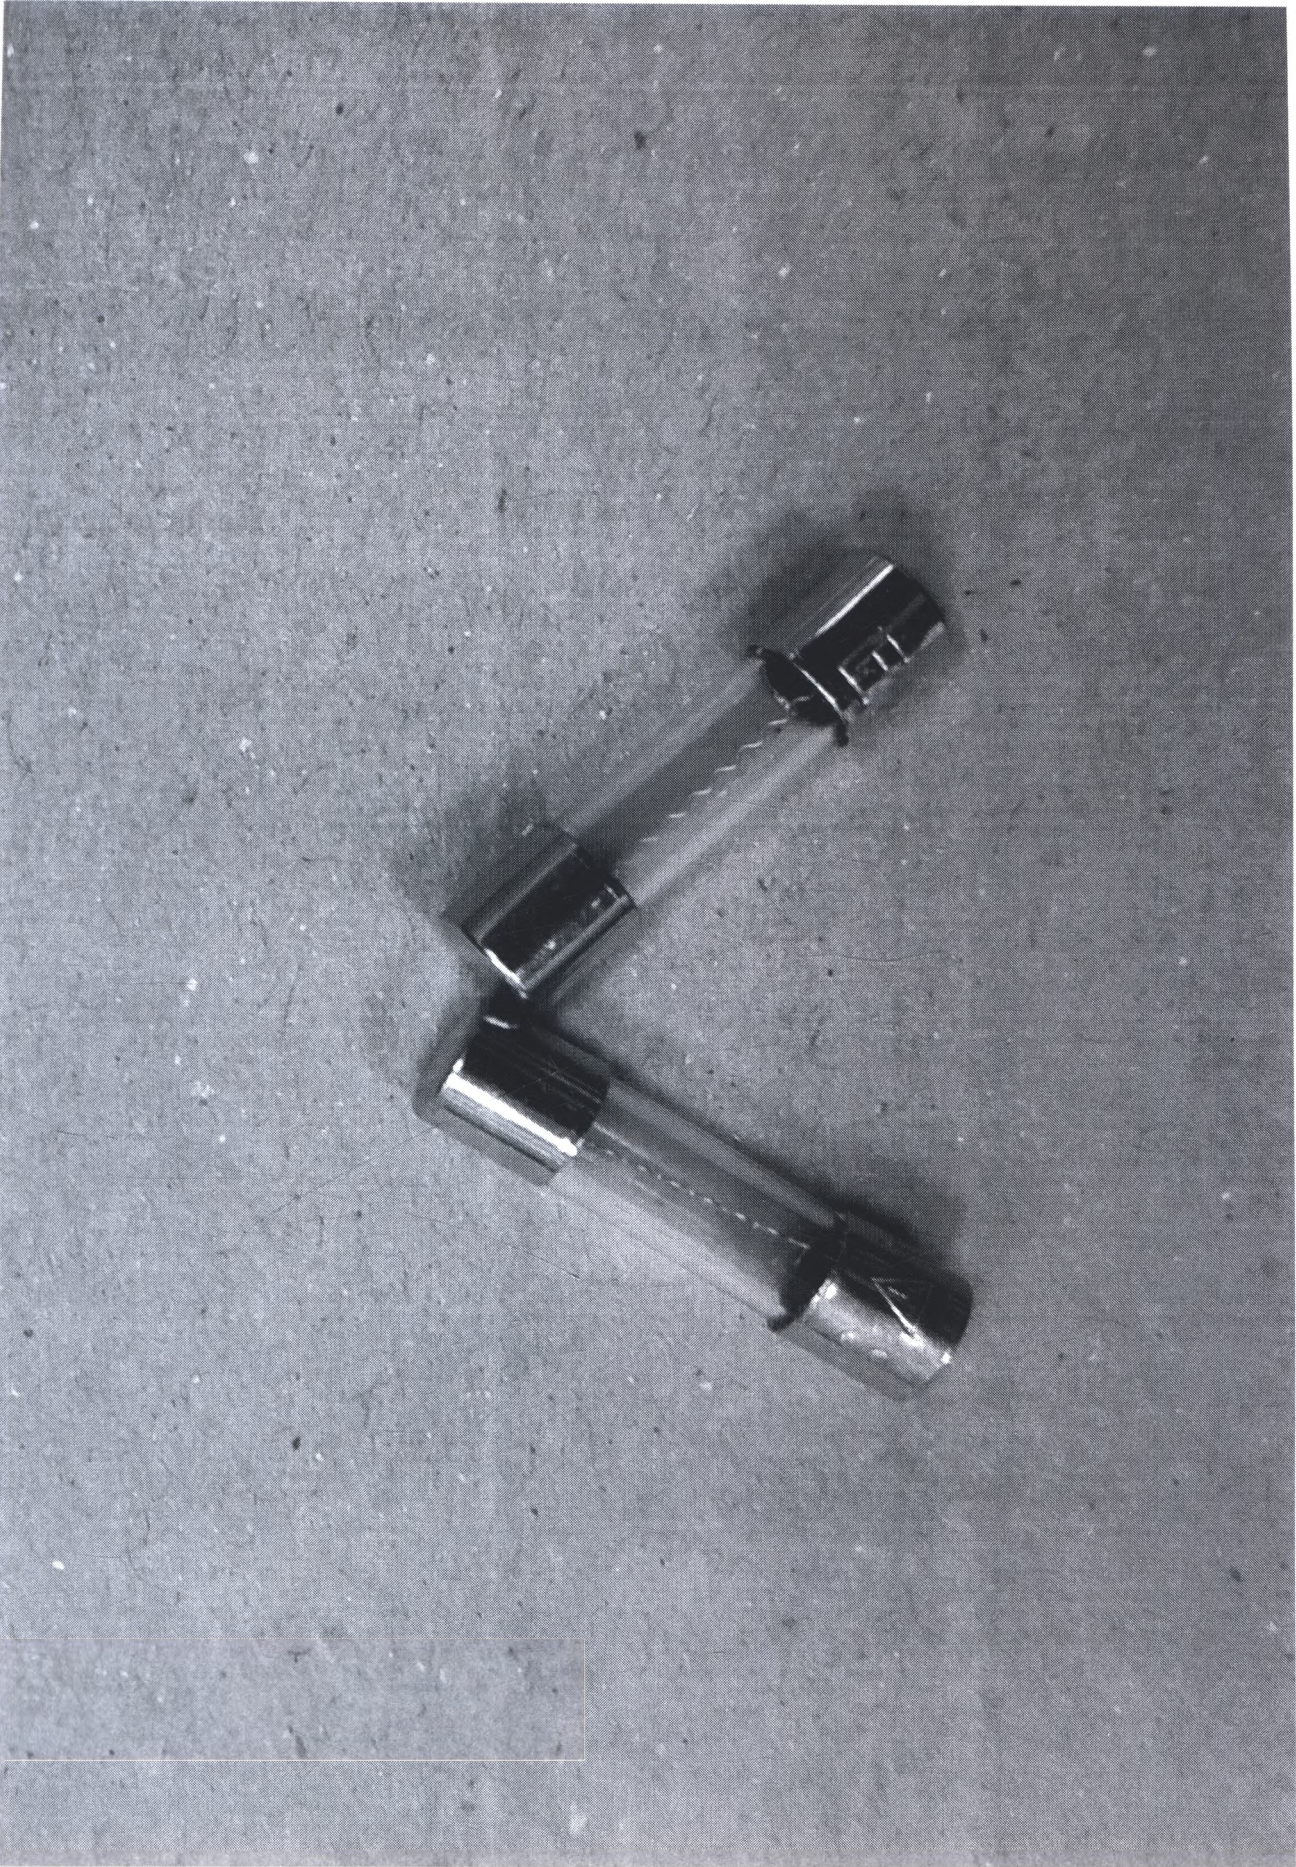


9. Кабель передачи данных

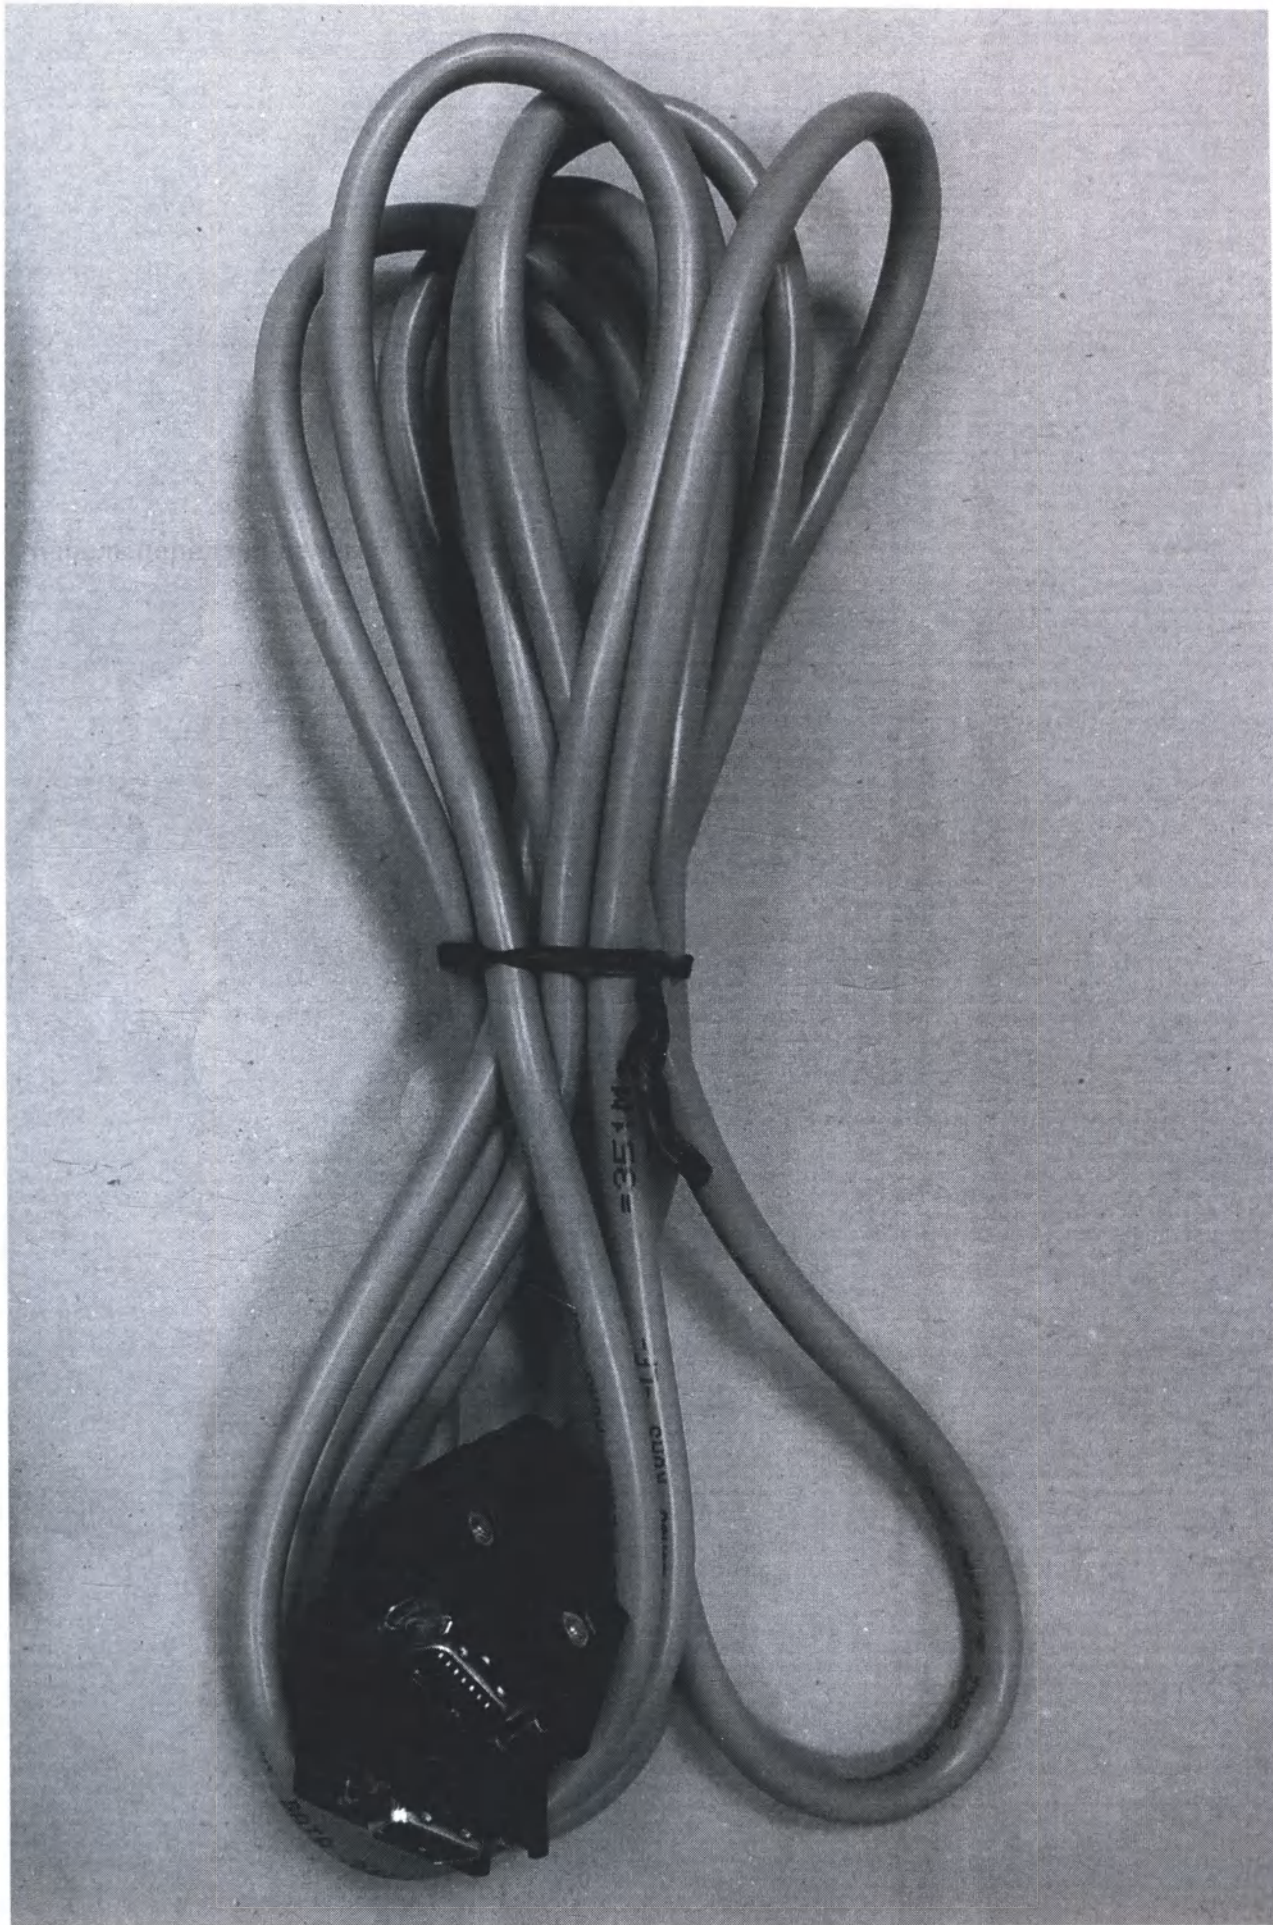

10. Кабель питания



11. Пылезащитный чехол

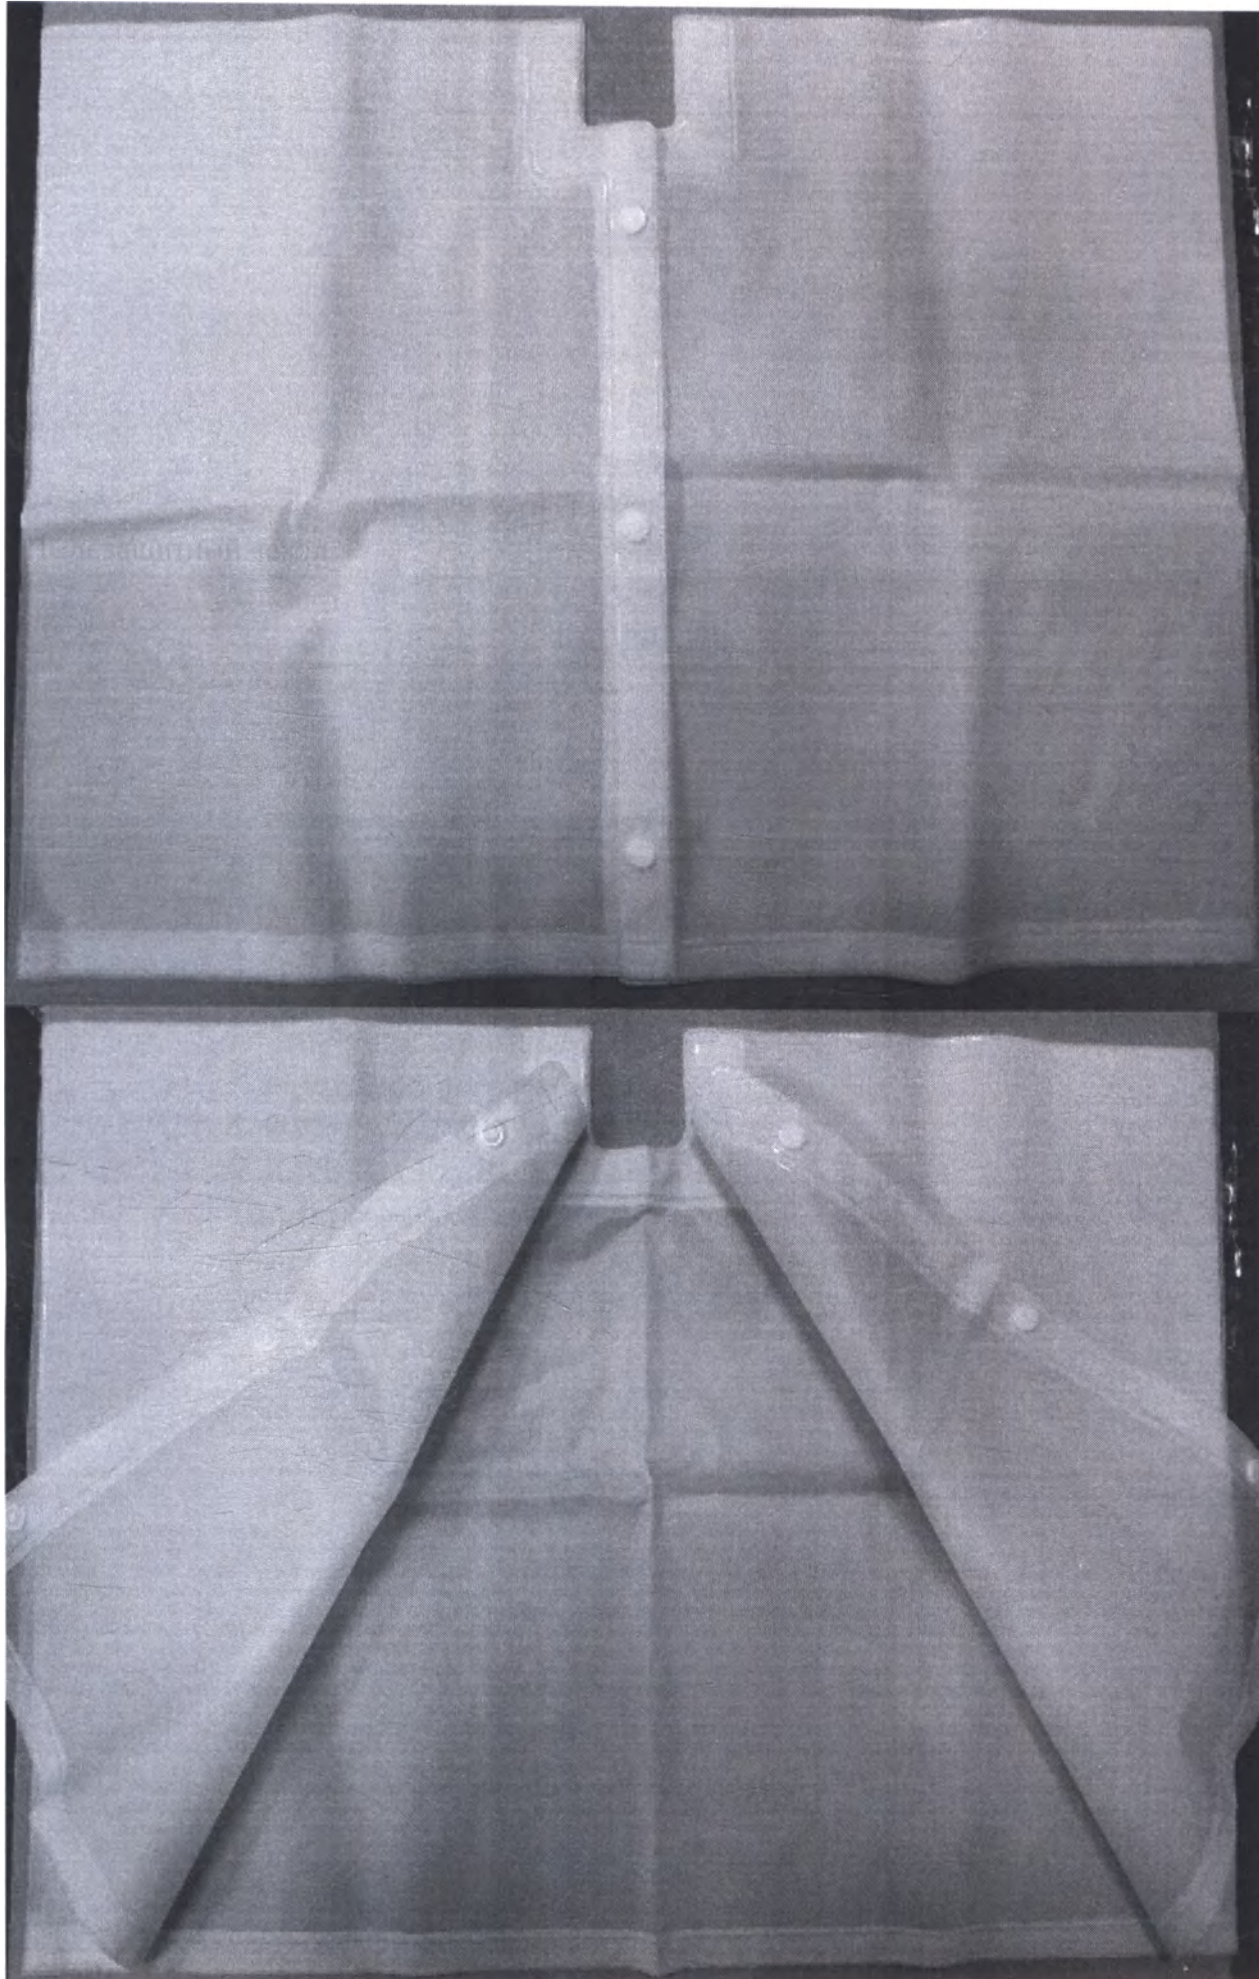

Руководство по эксплуатации

Фороптор автоматический цифровой DR19.

Состав:

1. Основной блок фороптора DR19-1шт.
2. Блок управления и коммутации-1шт.
3. Упор для лба-1шт.
4. Карта «ближнего» зрения-1шт.
5. Направляющая карты «ближнего» зрения-1шт.
6. Винты крепления-2шт.
7. Предохранитель-2шт.
8. Кабель передачи данных-1шт.
9. Кабель питания-1шт.
10. Пылезащитный чехол -1шт.
11. Руководство по эксплуатации-1шт.

MEDIZS Inc.94-10, Techno2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea

MEDIZS

Пронумеровано, _____ и
скреплено _____ печатью

15 (пятнадцать)
листов.

Генеральный директор
ООО «ГМС»



Савенков М. А.

М. П.