

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ПРЕМИУМ МЕД»

Целин О.Б.


2020 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И МАРКИРОВКА

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для вибрационной липосакции Liposat power configuration

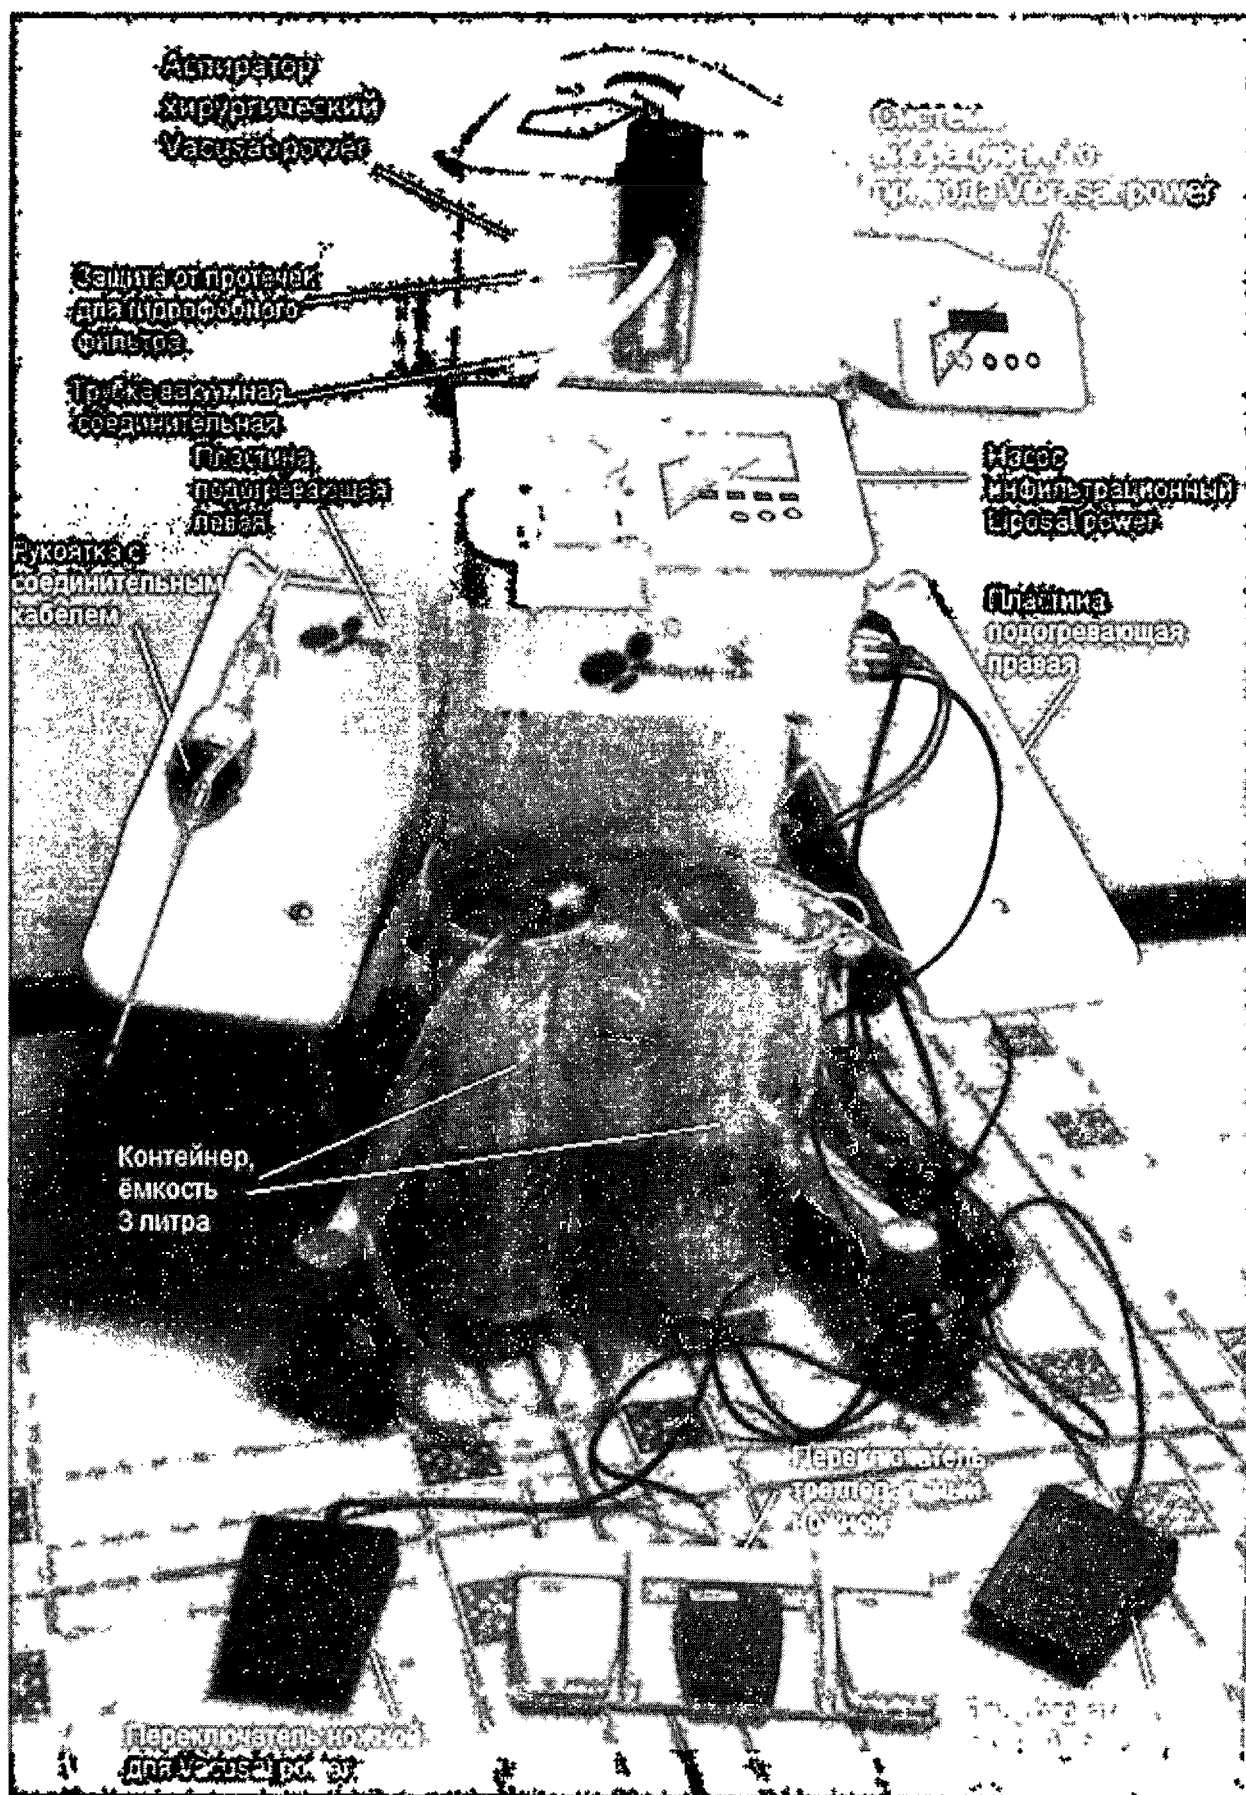

Общий вид:
Система для вибрационной липосакции Liposat power configuration

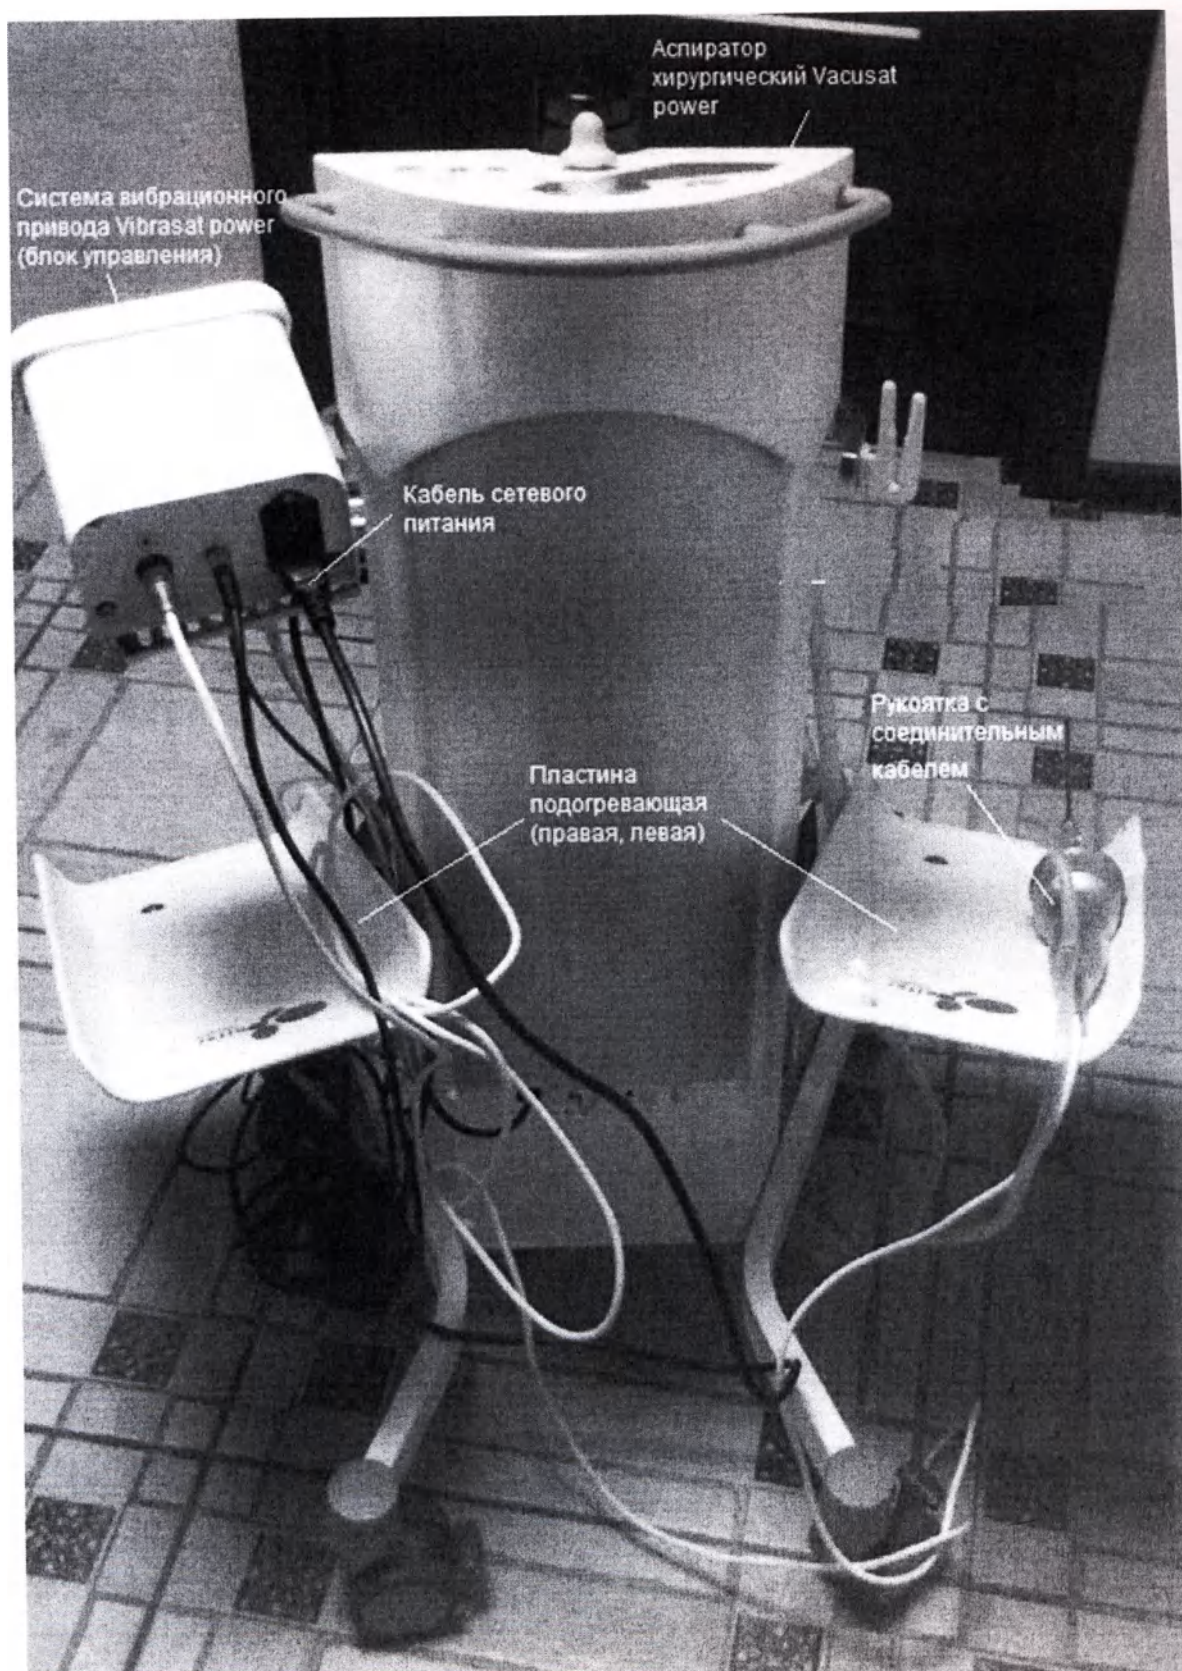


Общий вид:
Система для вибрационной липосакции Liposat power configuration



Общий вид:
Система для вибрационной липосакции Liposat power configuration



Общий вид:
Система для вибрационной липосакции Liposat power configuration

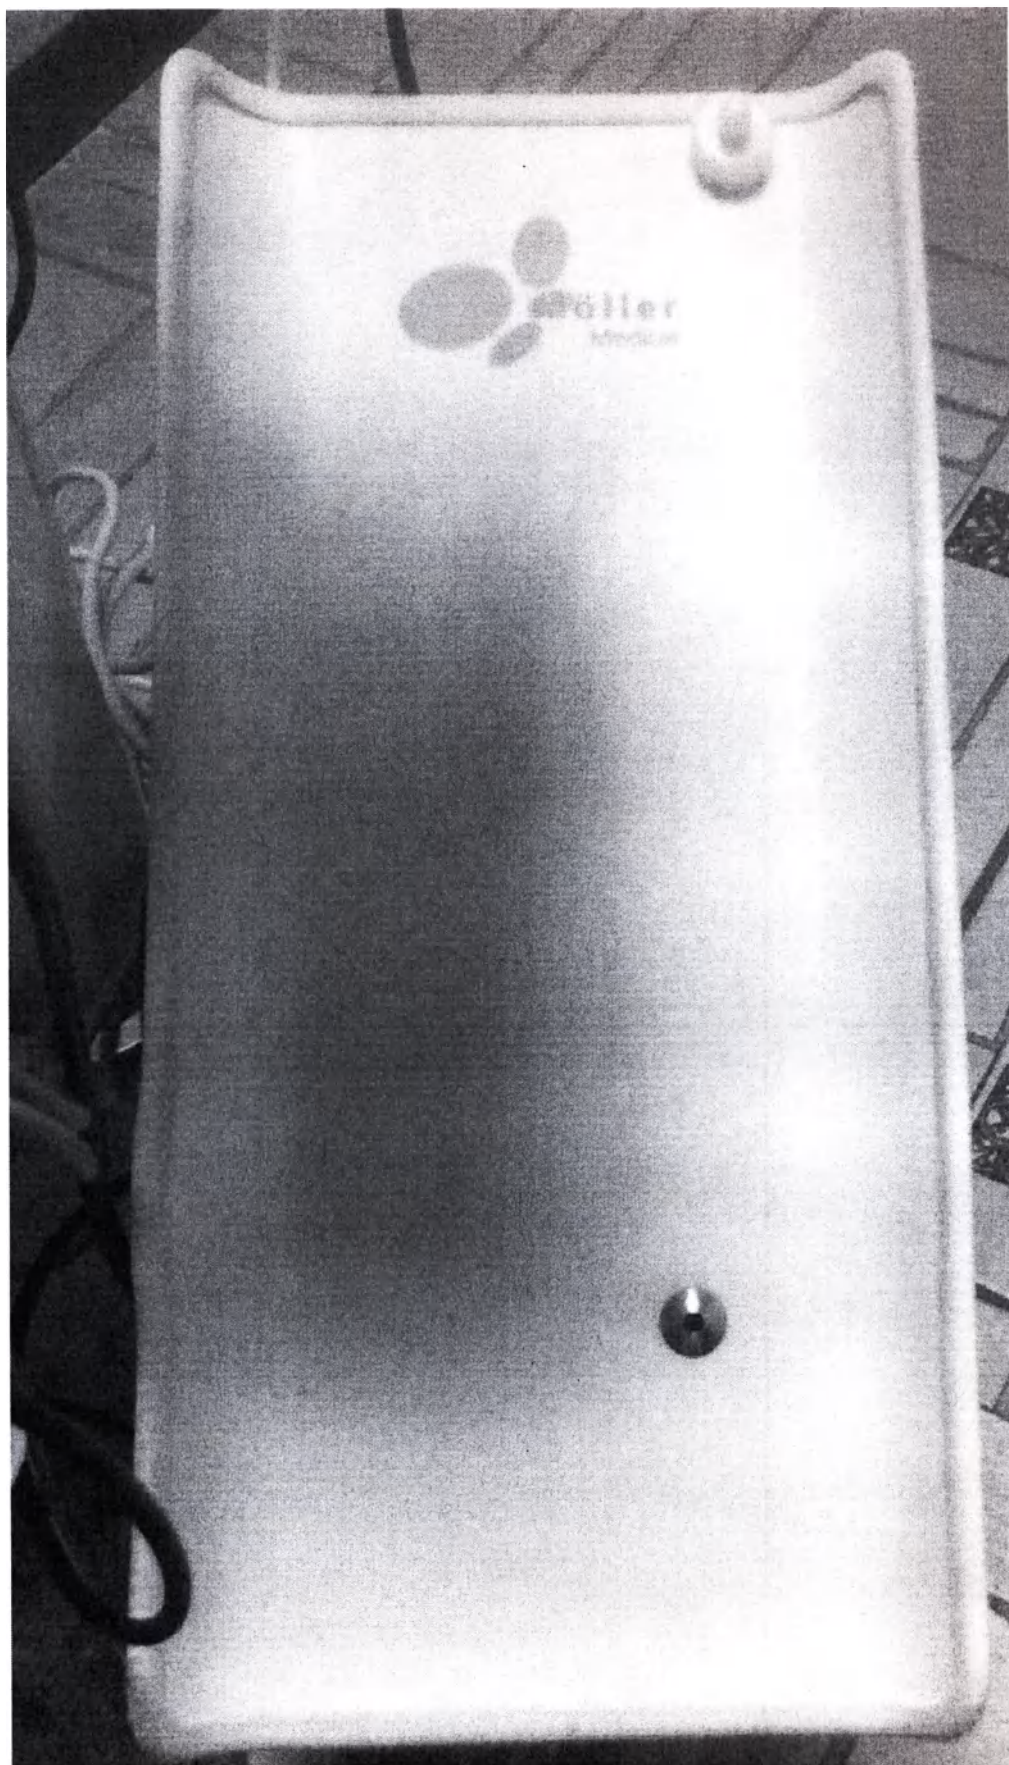


Общий вид:
Пластина подогревающая




Общий вид:
Контейнер, ёмкость 3 литра



Общий вид:
Мешок для контейнера, одноразовый, ёмкость 3 литра

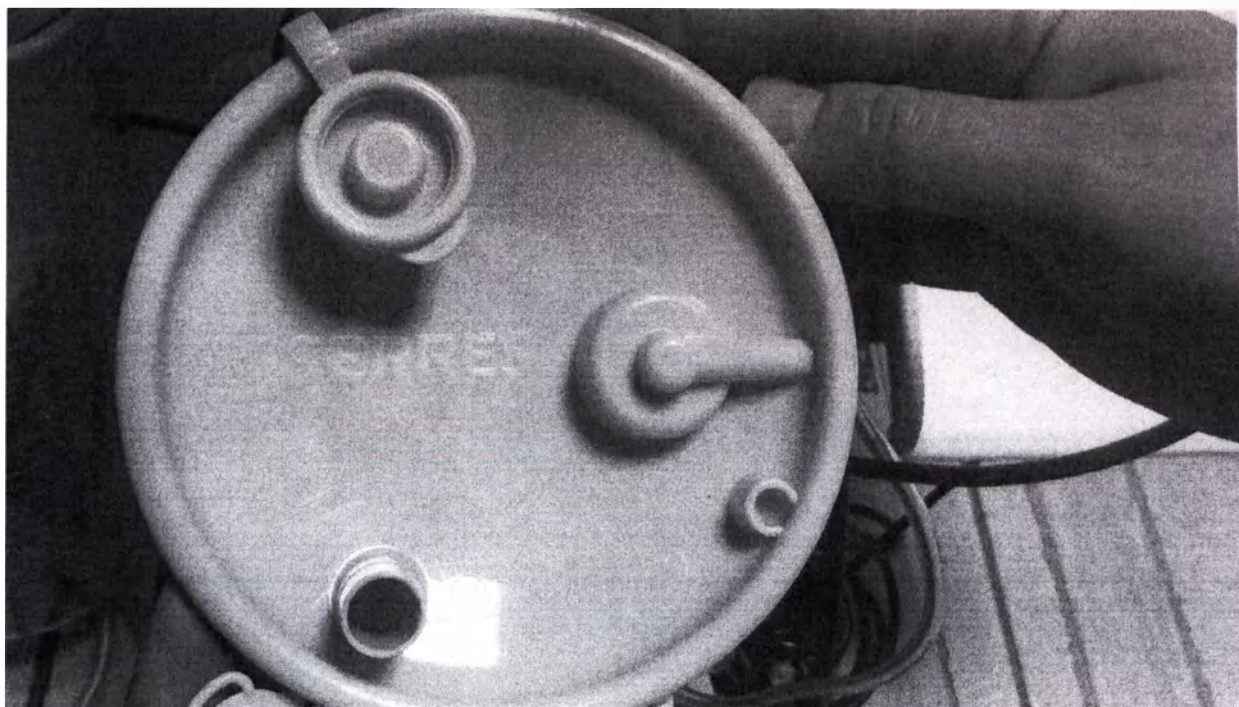


Общий вид сверху:
Мешок для контейнера, одноразовый, ёмкость 3 литра

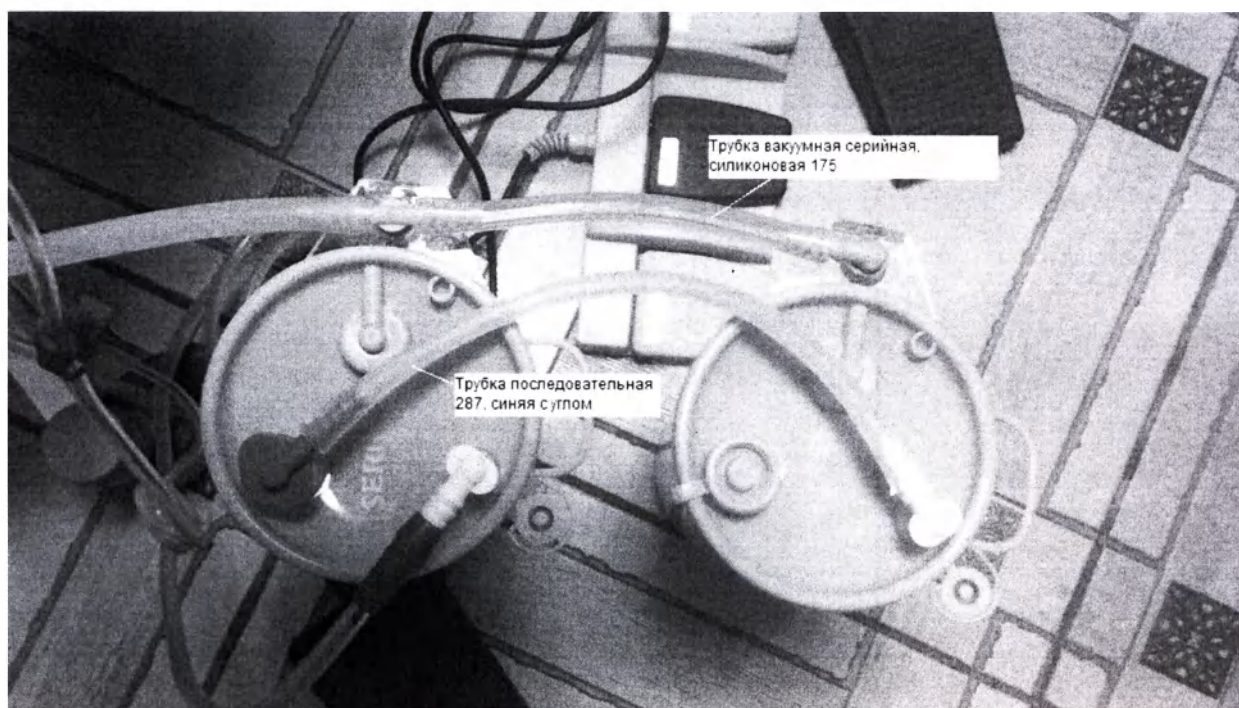


Общий вид соединения контейнеров с мешками для аспирации между собой и с вакуумным аспиратором




Общий вид:
Рукоятка с соединительным кабелем (для Vibrasat power)

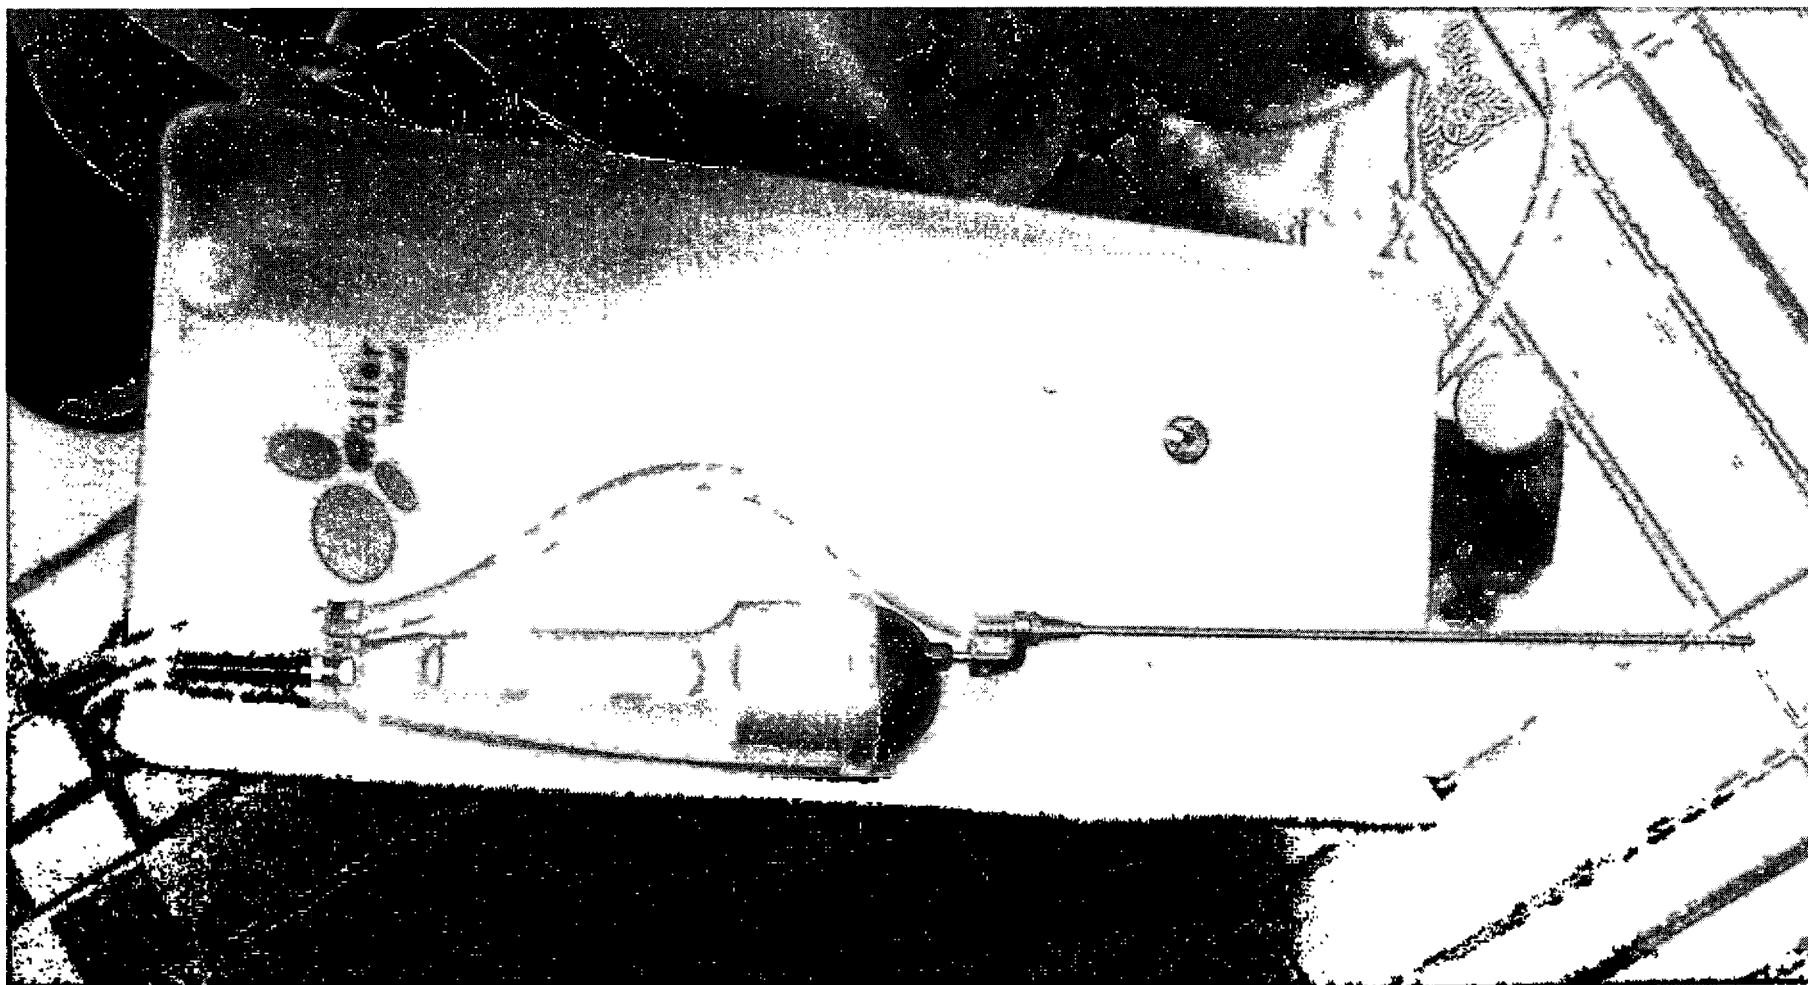


Общий вид:
Рукоятка с соединительным кабелем с канюлей для липосакции

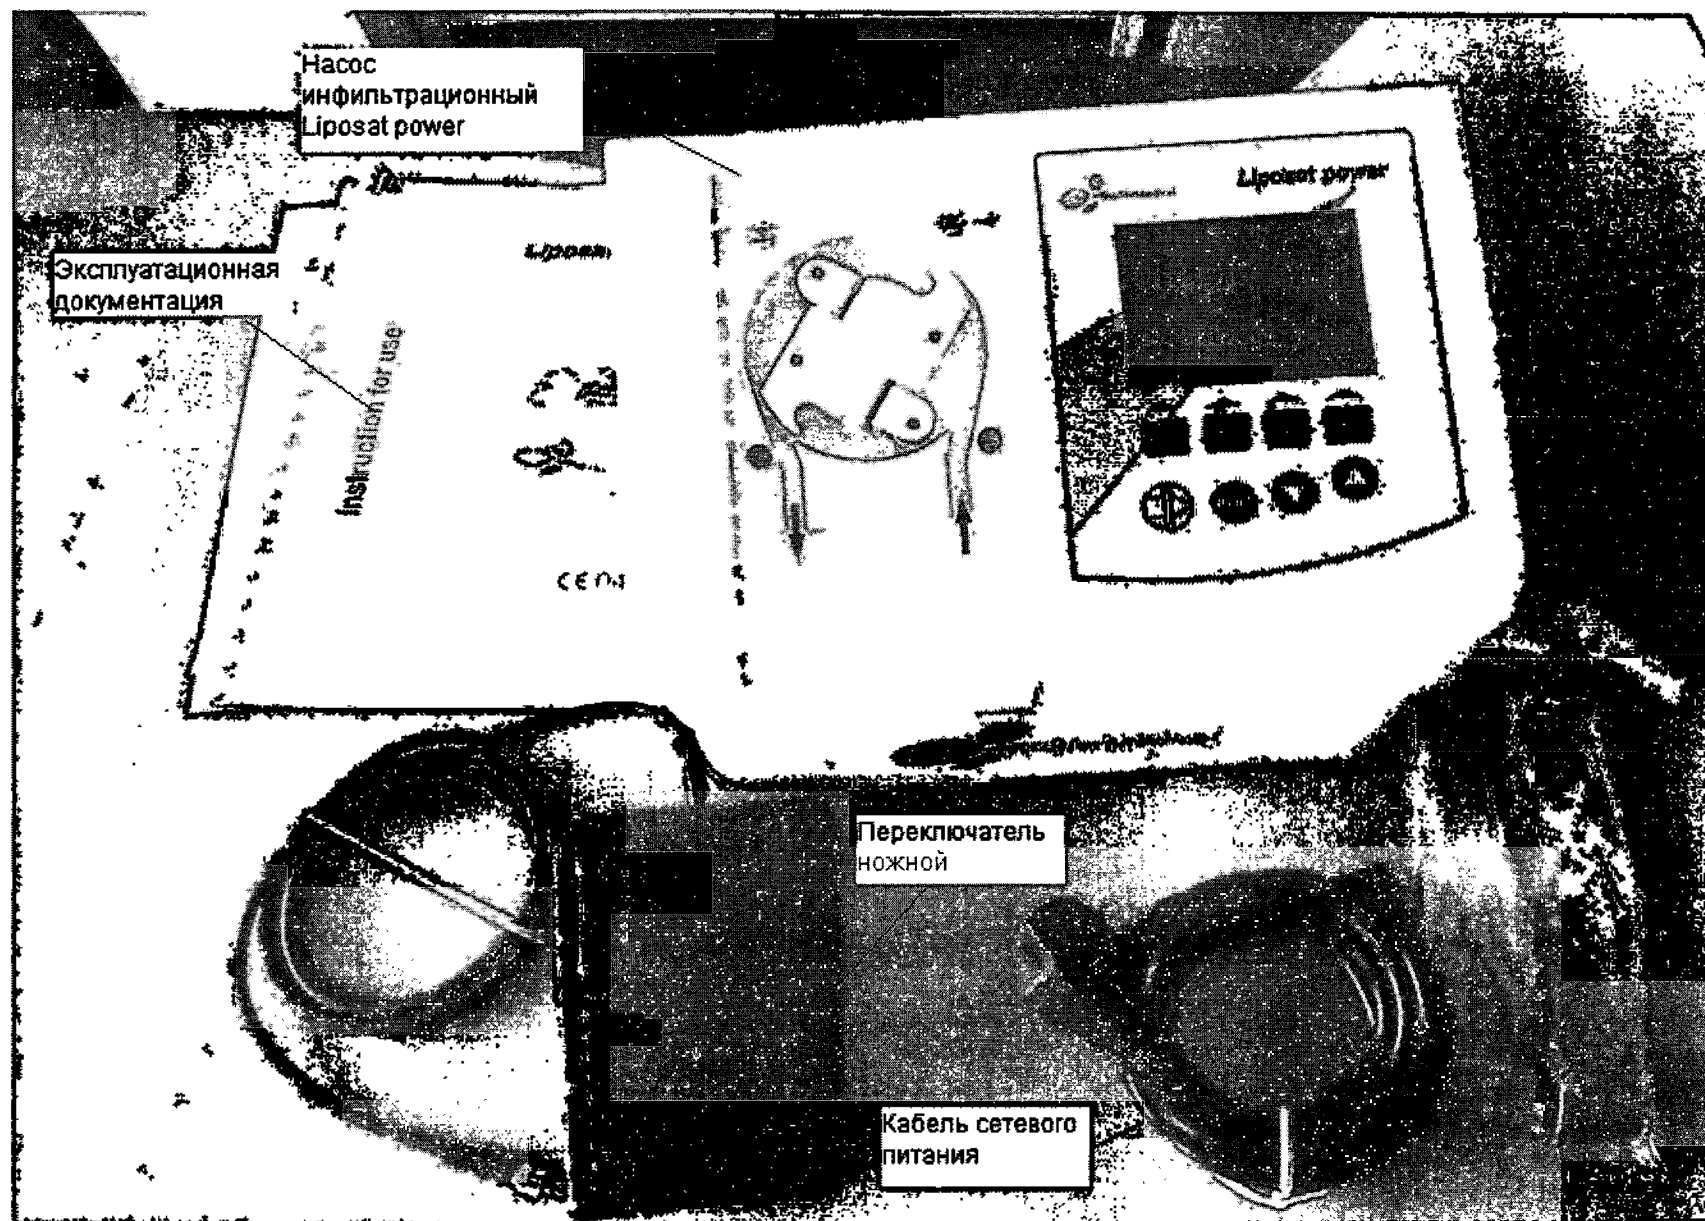


Общий вид:
Насос инфильтрационный Liposat power, артикул 00002274

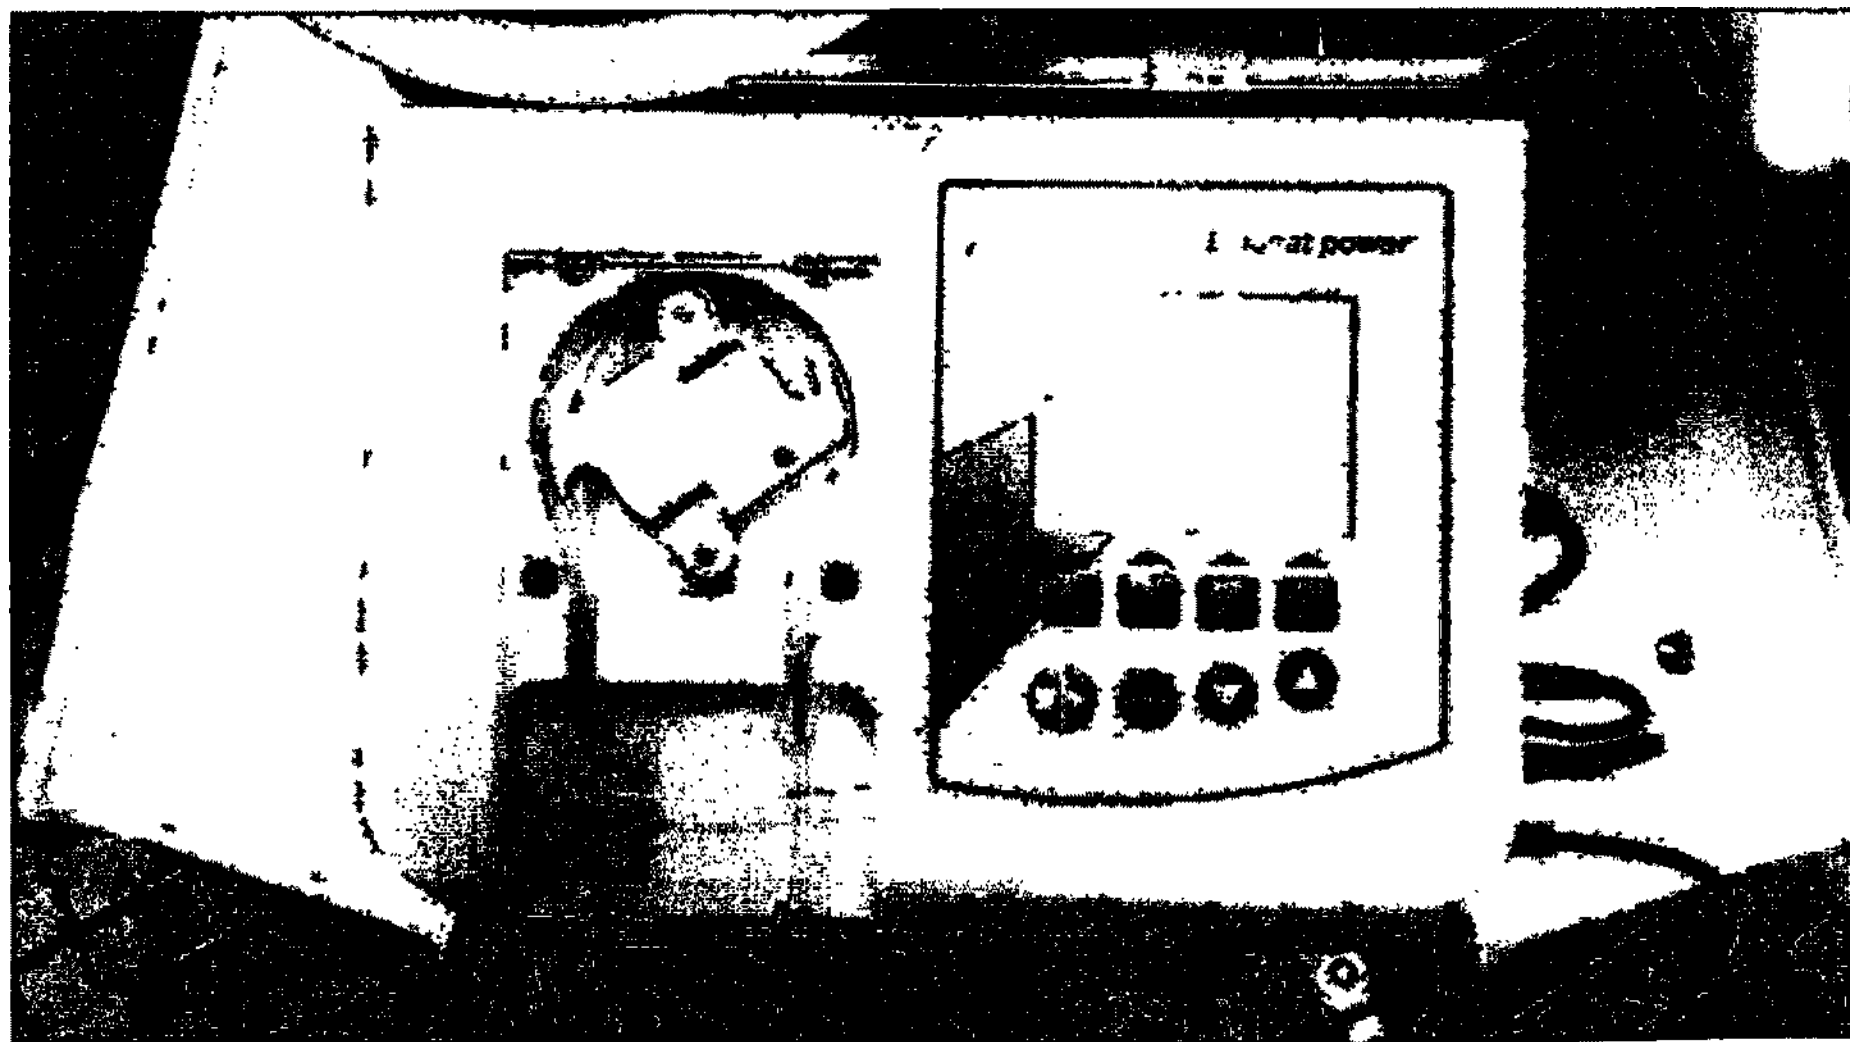

Общий вид (сверху):
Насос инфильтрационный Liposat power

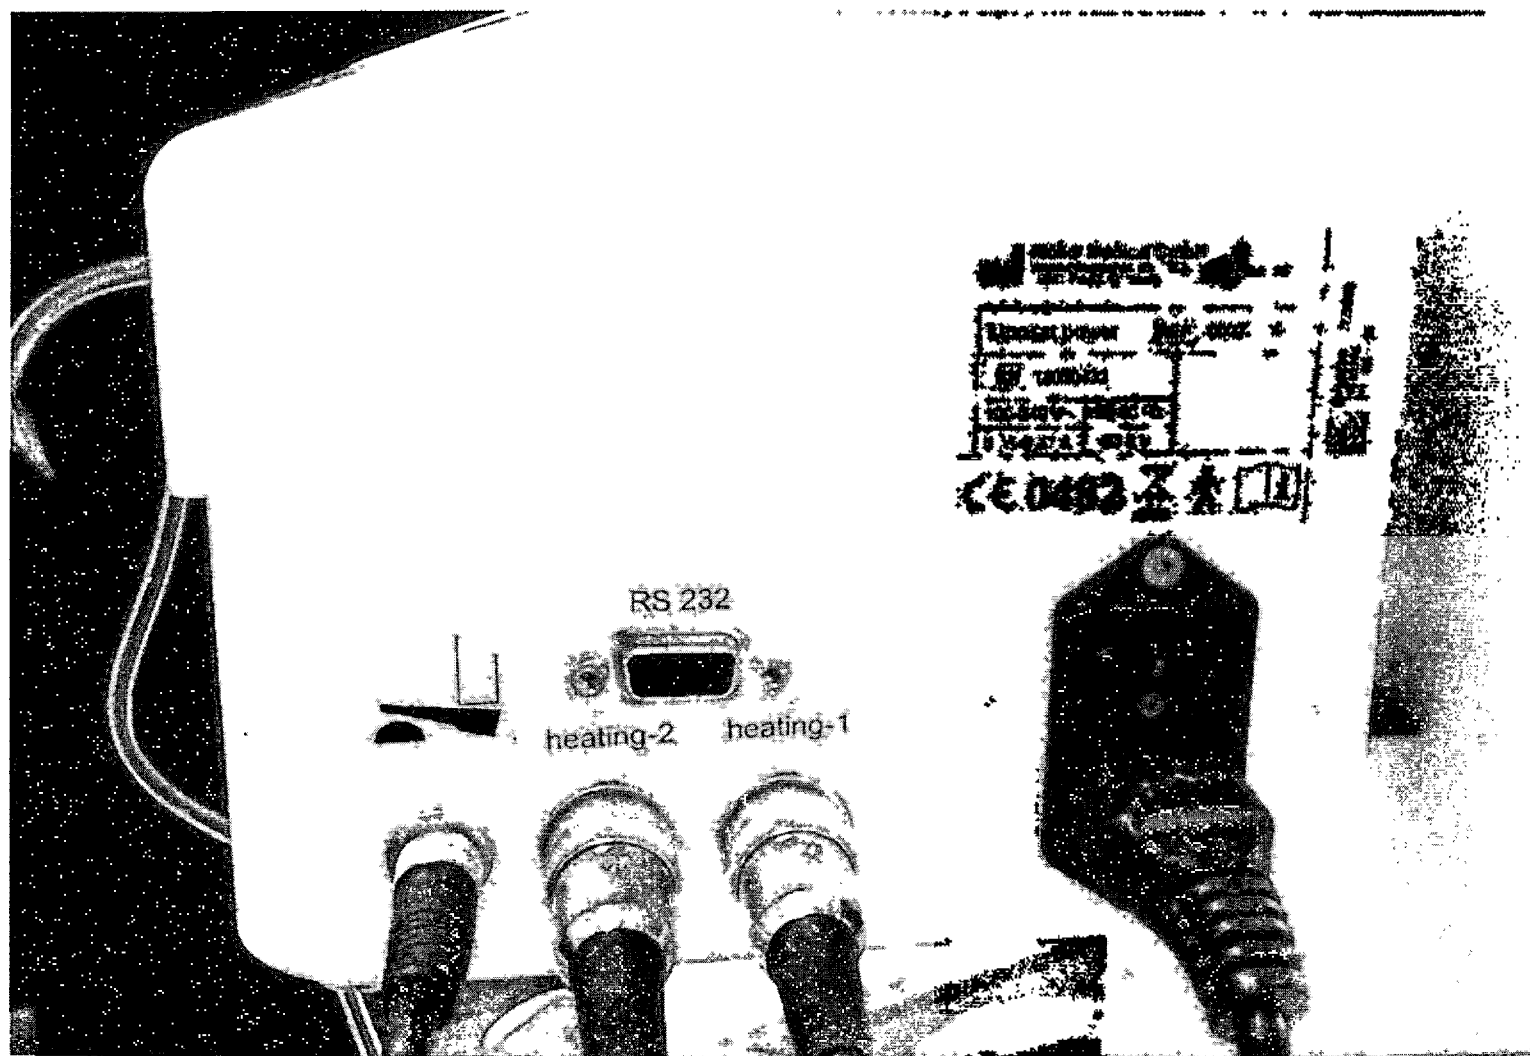


Общий вид (сбоку):
Насос инфильтрационный Liposat power, артикул 00002274

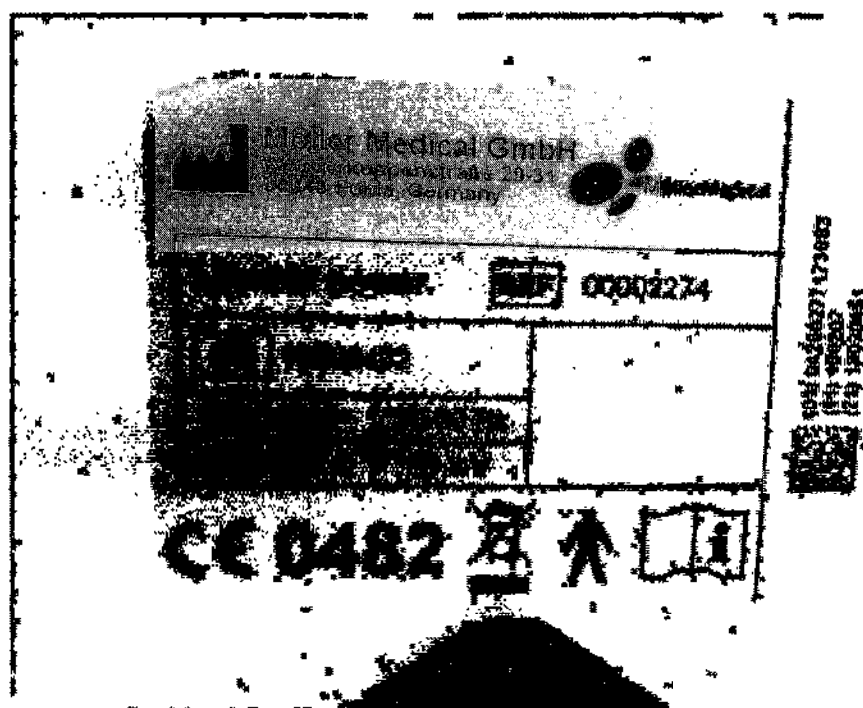


Маркировка. Насос инфльтрационный Liposat power, артикул 00002274



Общий вид:
Аспиратор хирургический Vacusat power, артикул 00002252 (вид спереди)

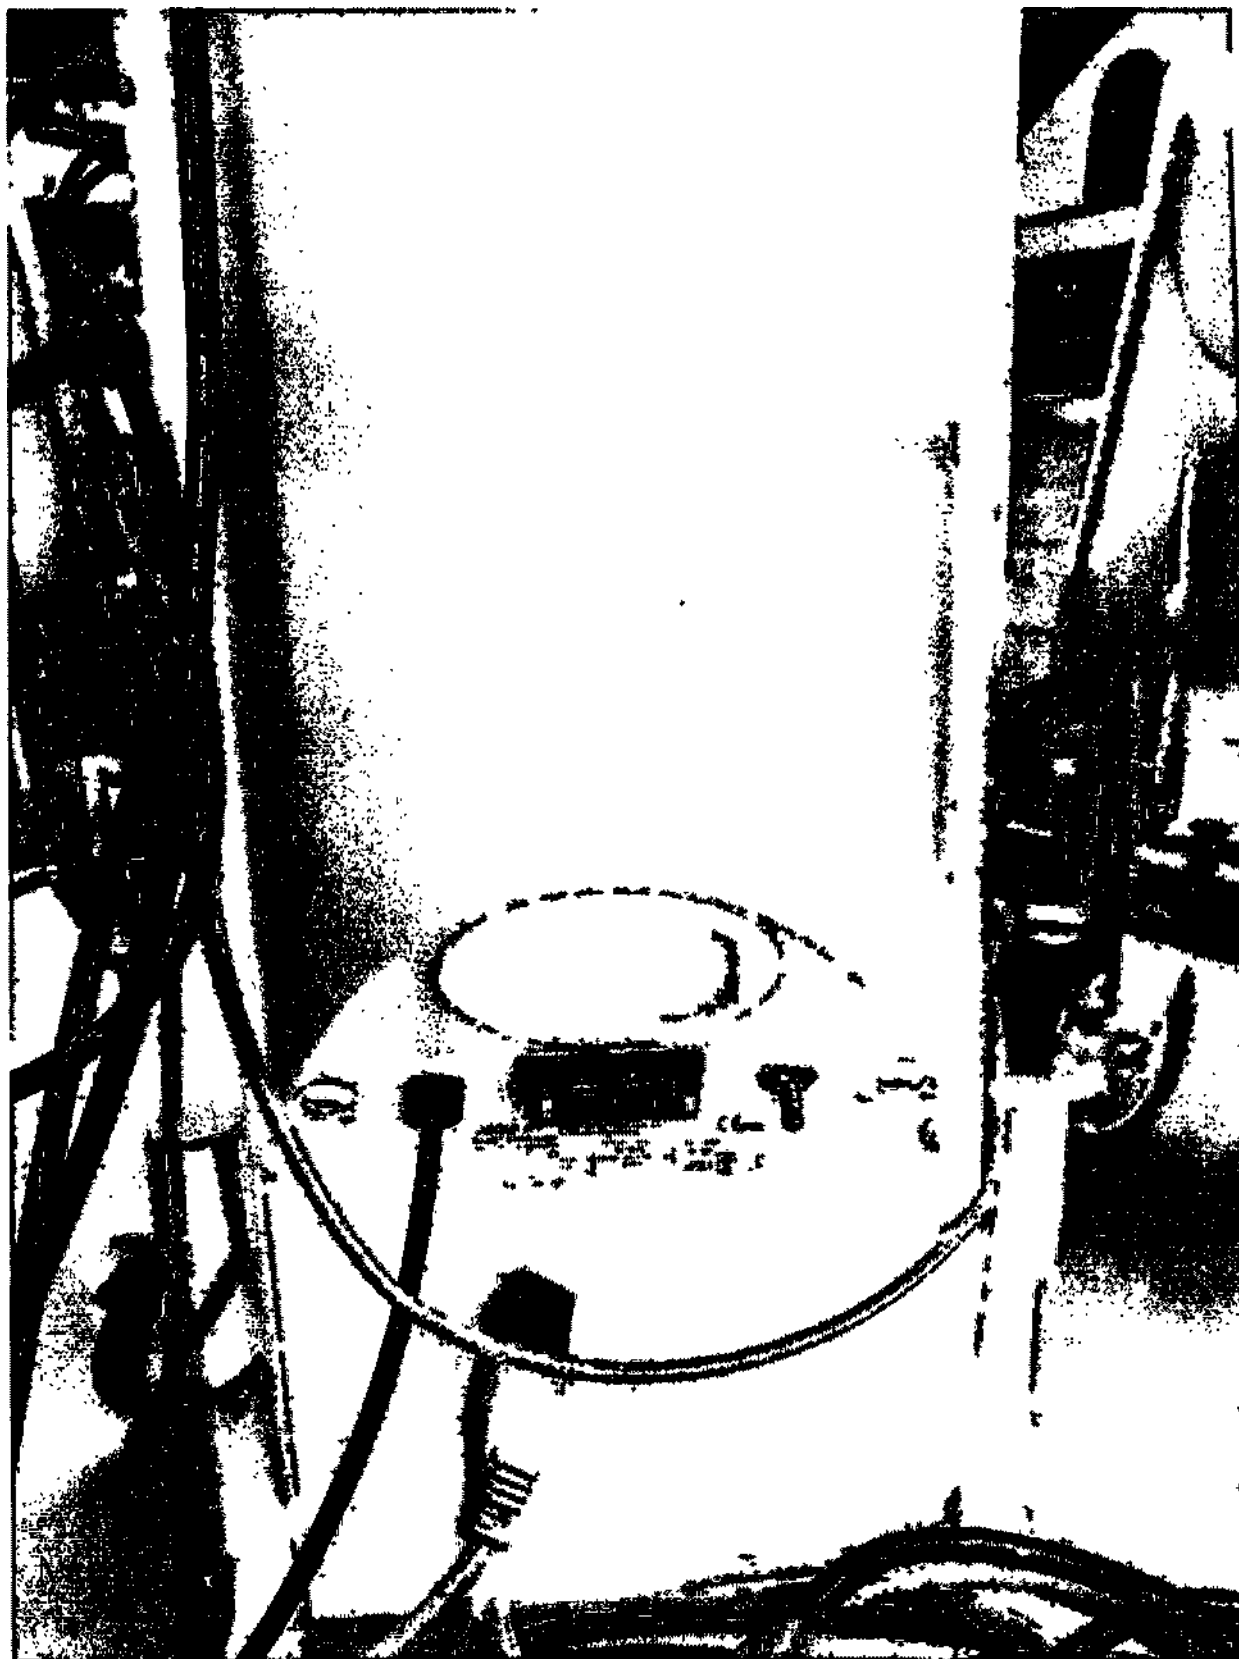

Общий вид:
Аспиратор хирургический Vacusat power, артикул 00002252 (вид сзади)

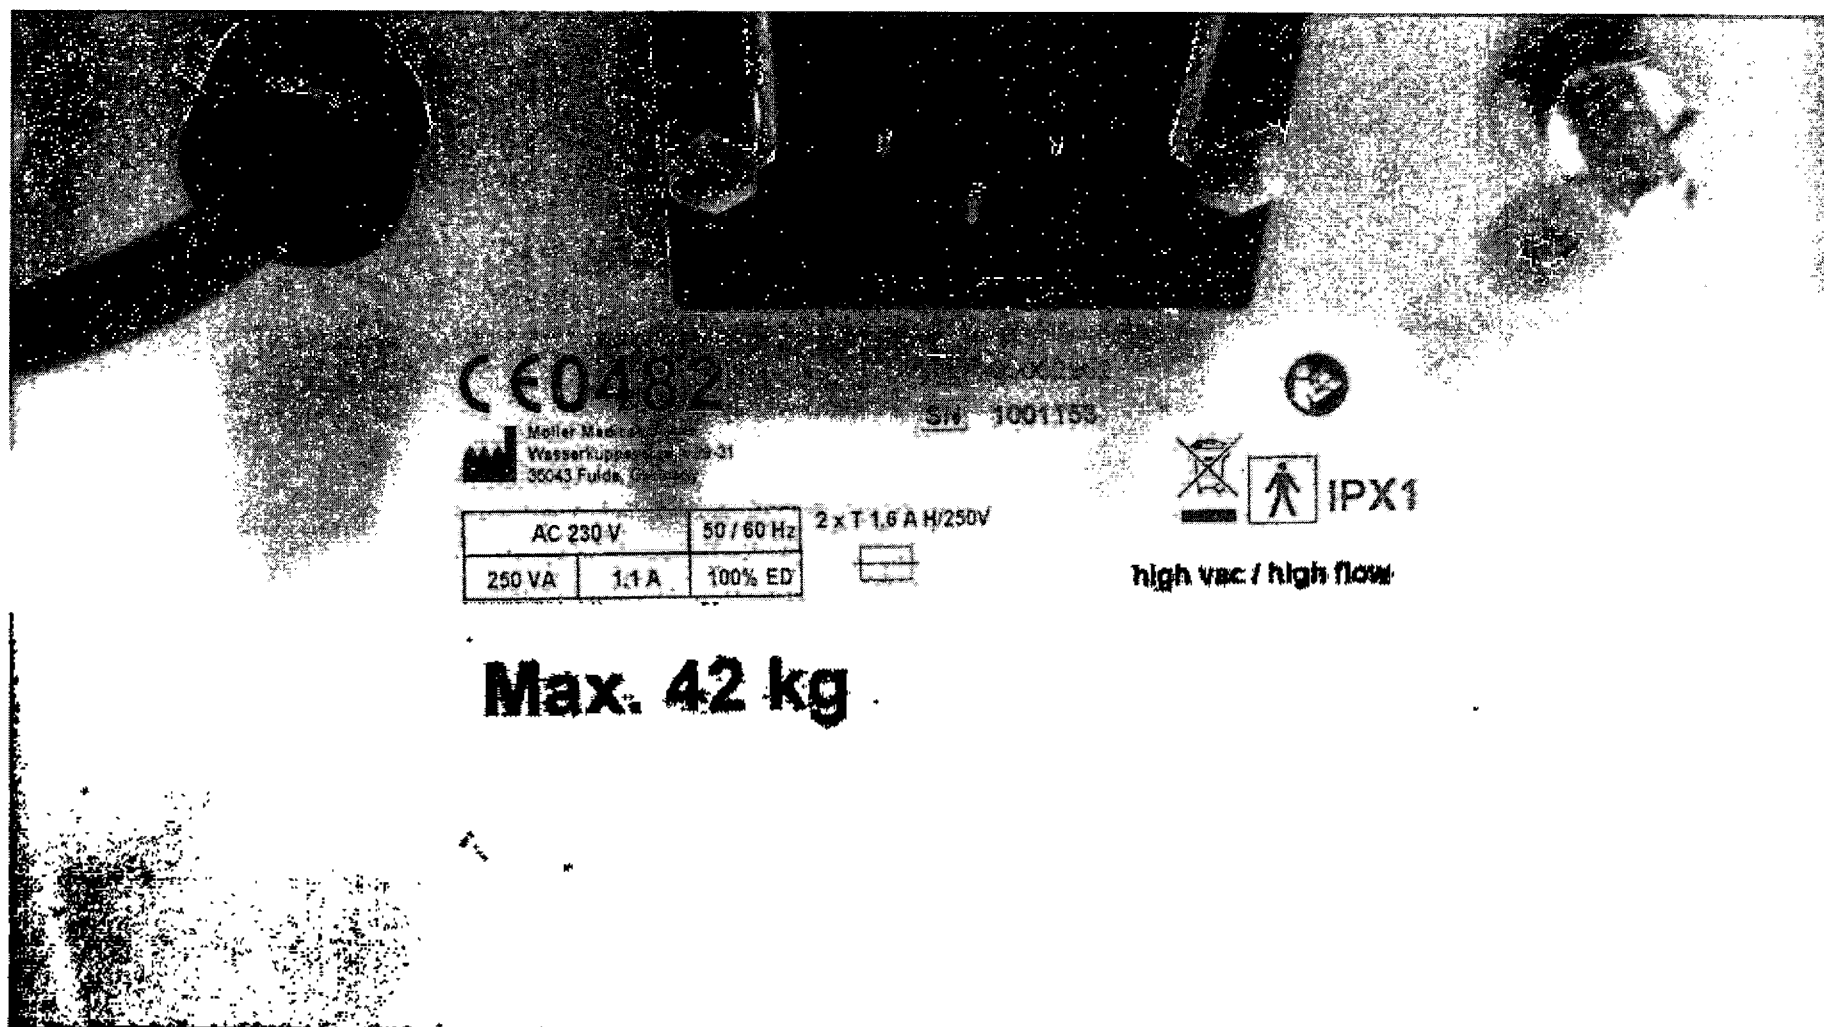

Маркировка.Аспиратор хирургический Vacusat power, артикул 00002252

C €0482



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

REF 00002252

SN 1001153



IPX1

AC 230 V		50 / 60 Hz
250 VA	1,1 A	100% ED


2 x T 1,6 A H/250V




high vac / high flow

2 x T 1,6 A H/250V


Маркировка.Аспиратор хирургический Vacusat power, артикул 00002252

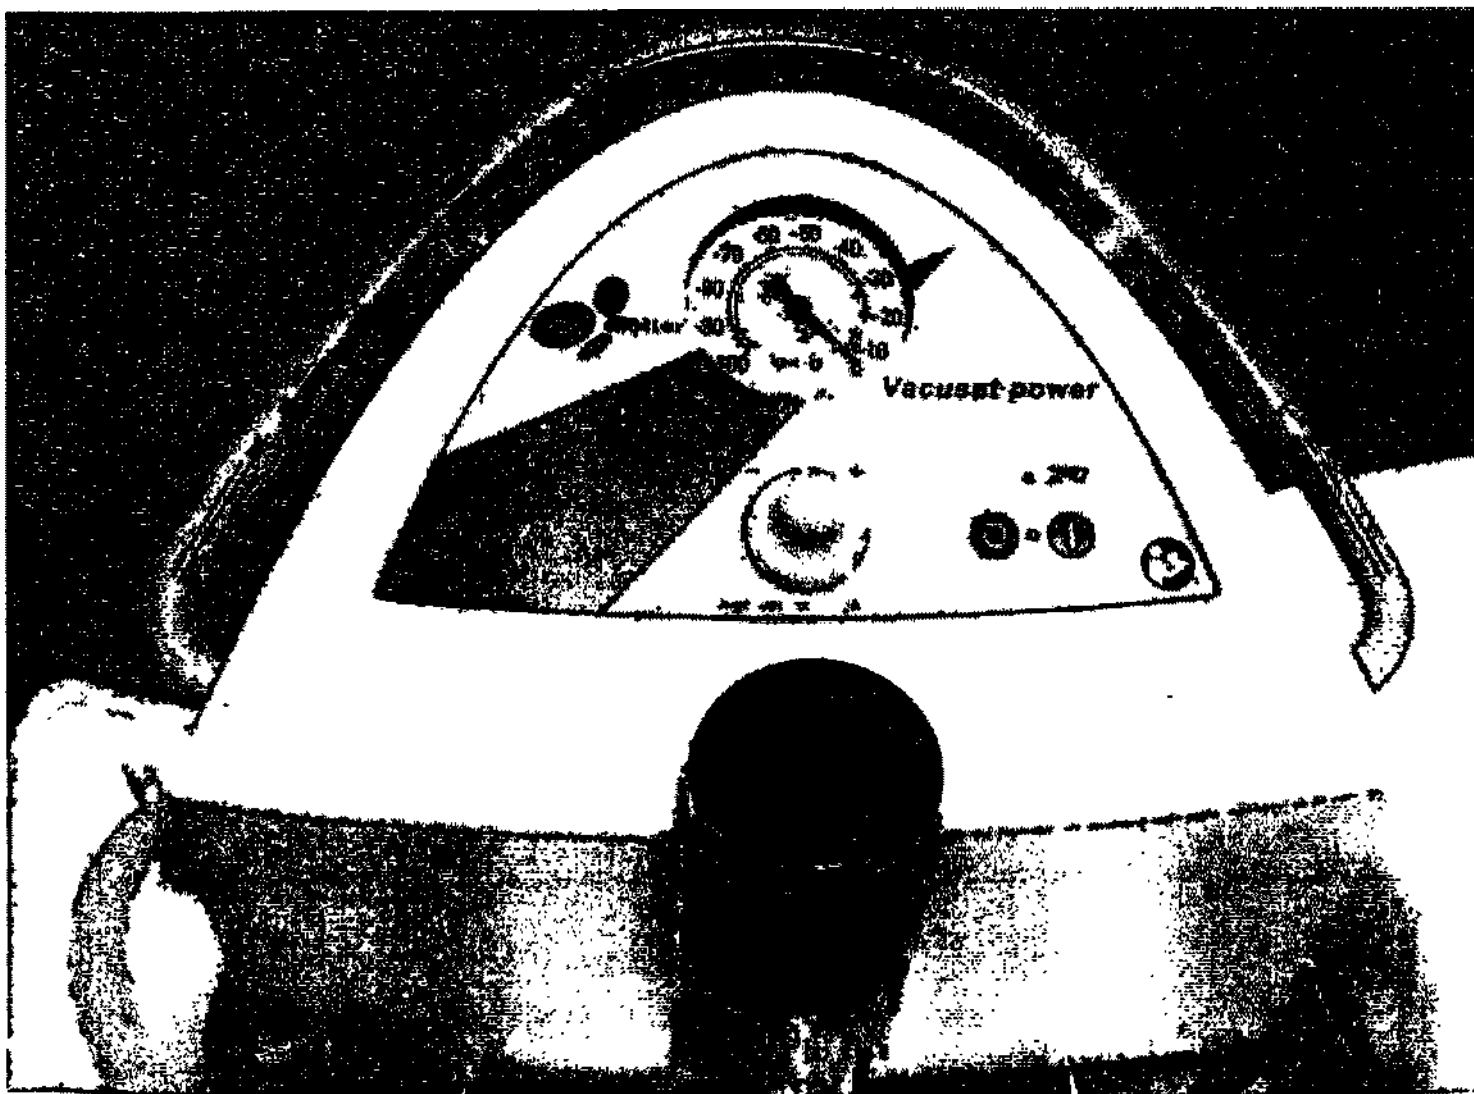


Маркировка панели. Аспиратор хирургический Vacusat power, артикул 00002252

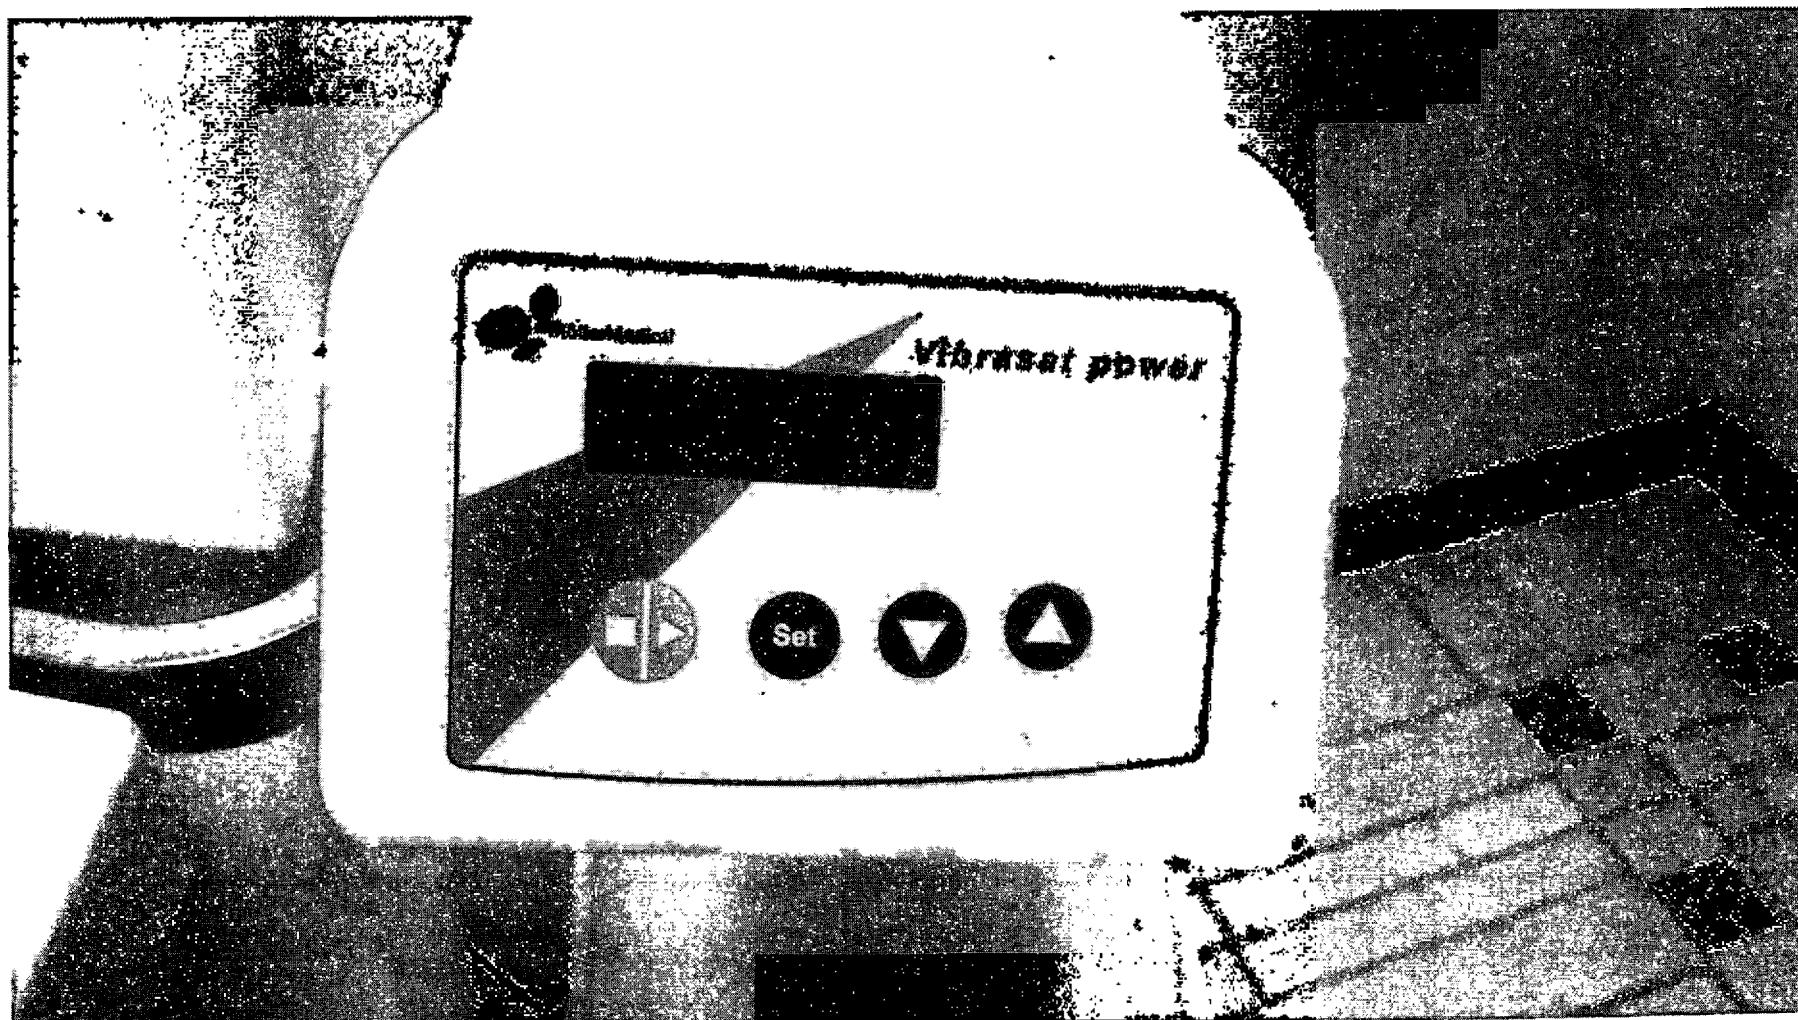

Маркировка панели. Система вибрационного привода Vibrasat power

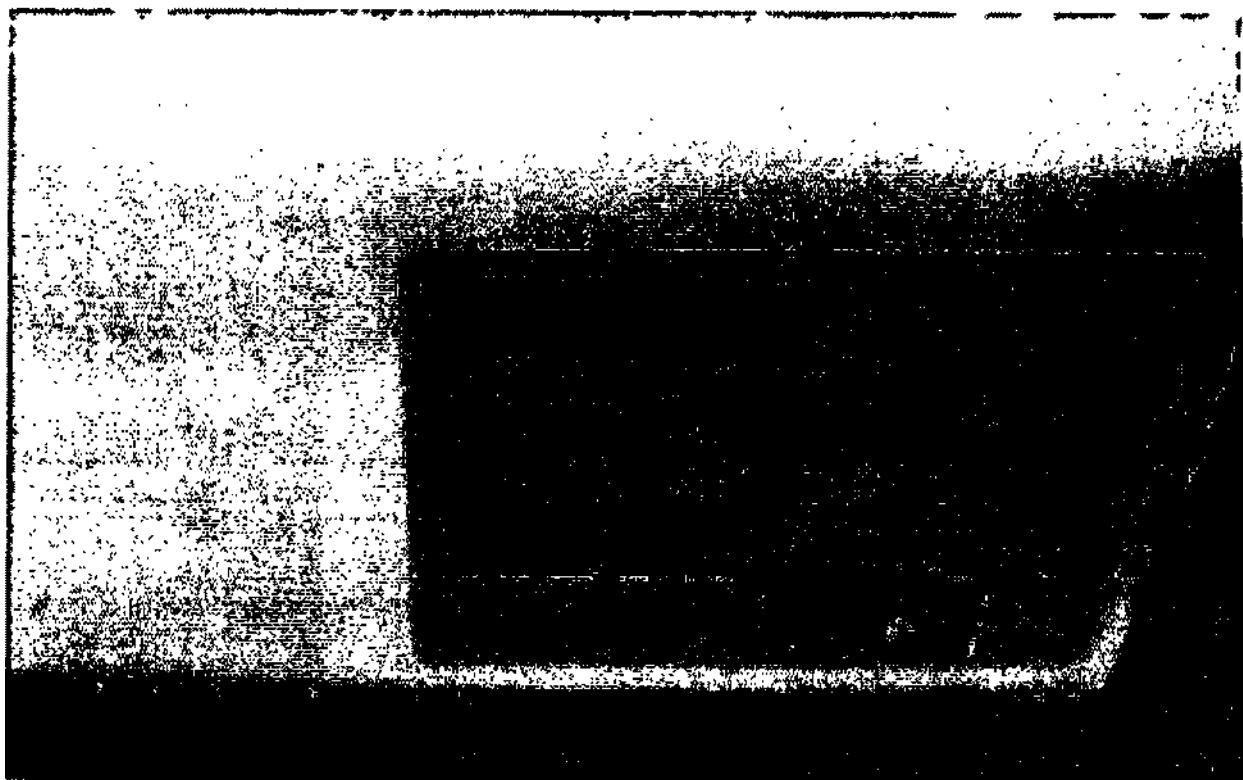

Маркировка. Система вибращионного привода Vibrasat power, артикул 00002246

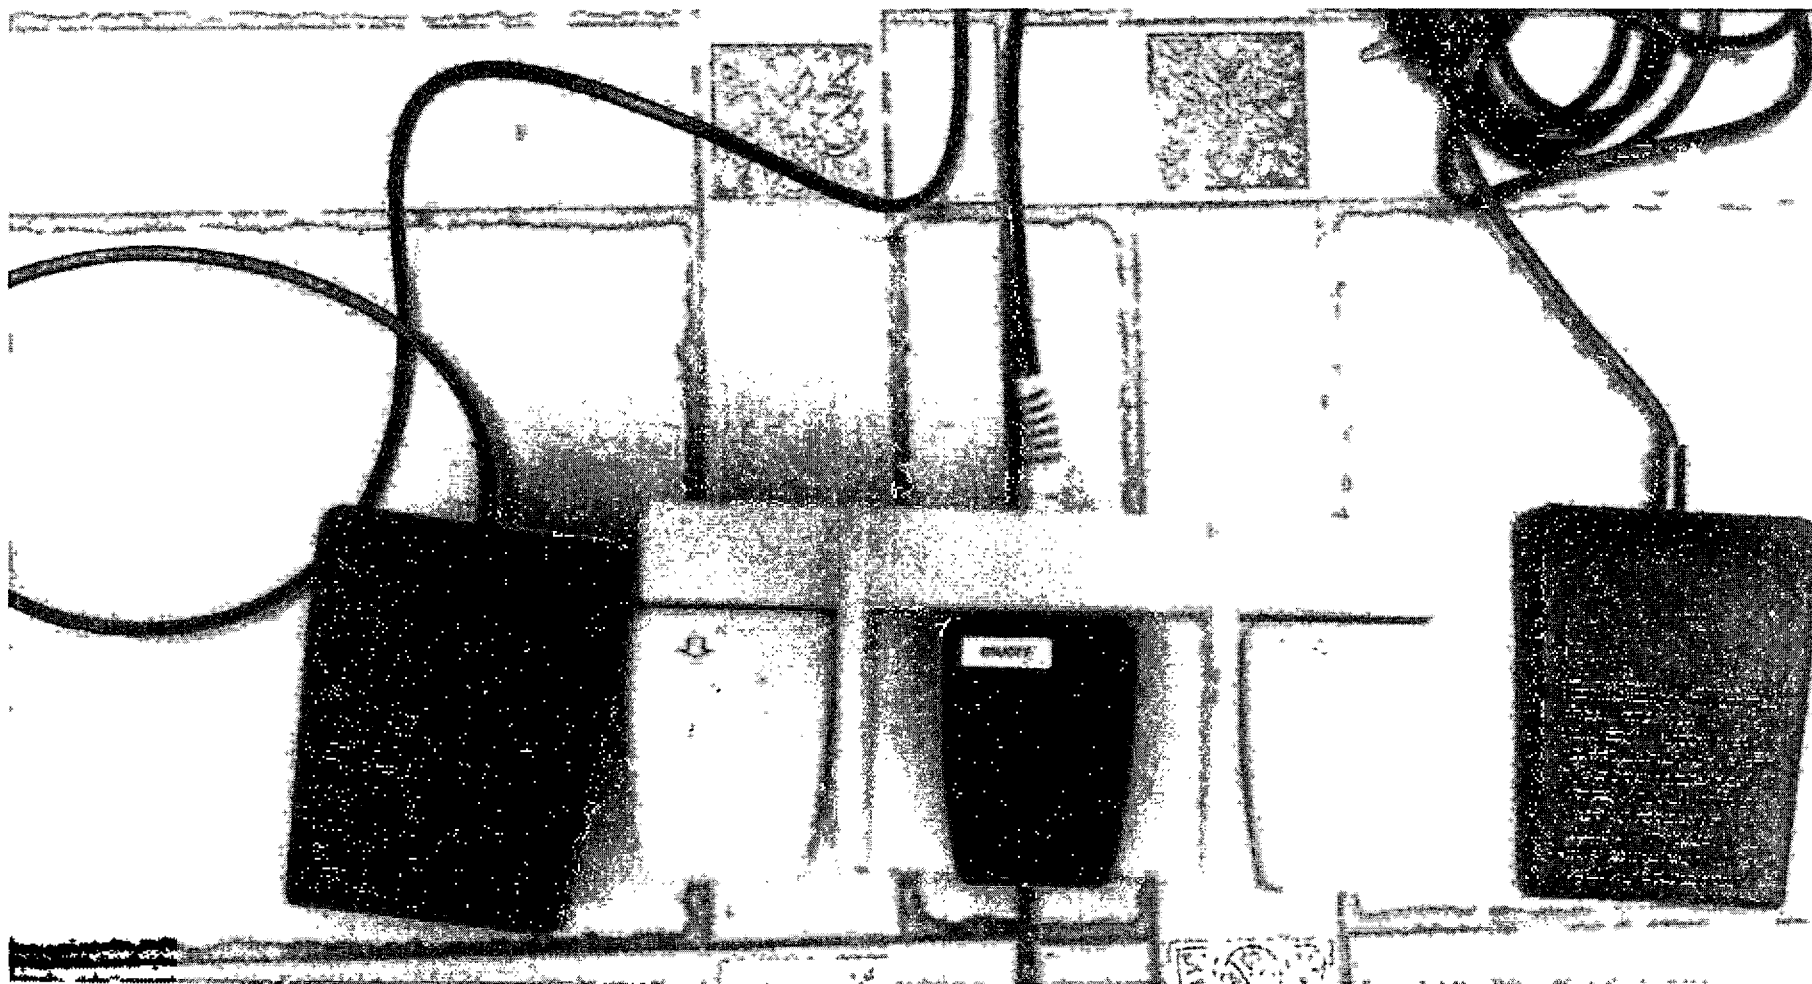


Общий вид ножных переключателей (с лева на право):


- 1.Переключатель ножной (из комплектации Vacusat power). 2.Переключатель трехпедальный ножной (из комплектации Vibrasat power).
3. Переключатель ножной (из комплектации Liposat power)




Маркировка. Переключатель ножной (из комплектации Liposat power).

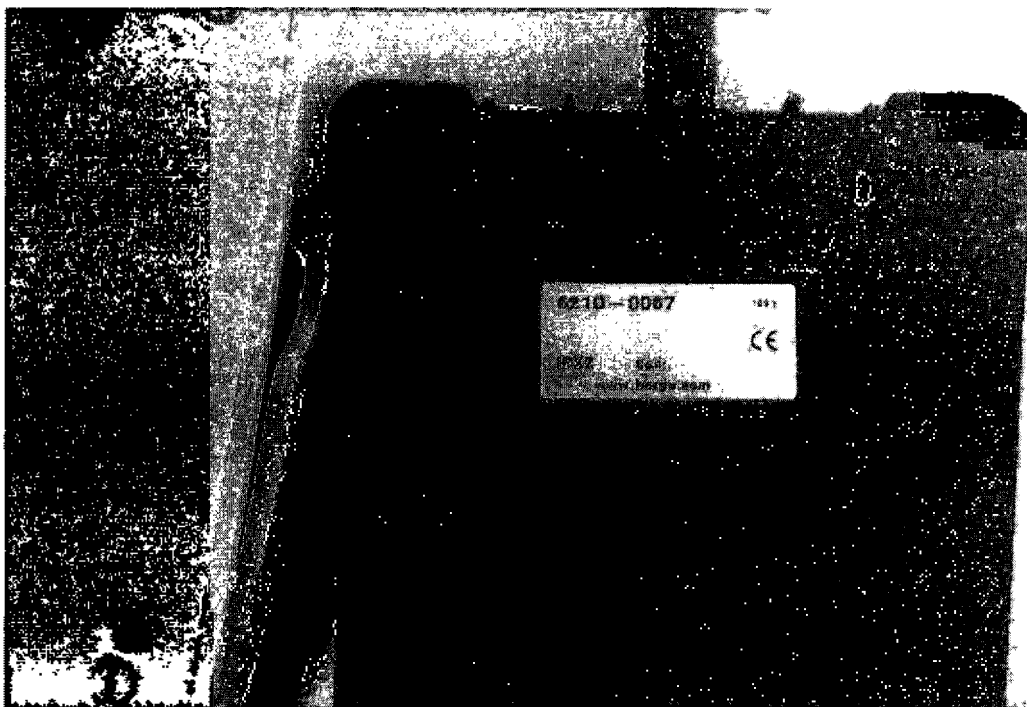

Маркировка. Переключатель ножной (из комплектации Vacusat power)

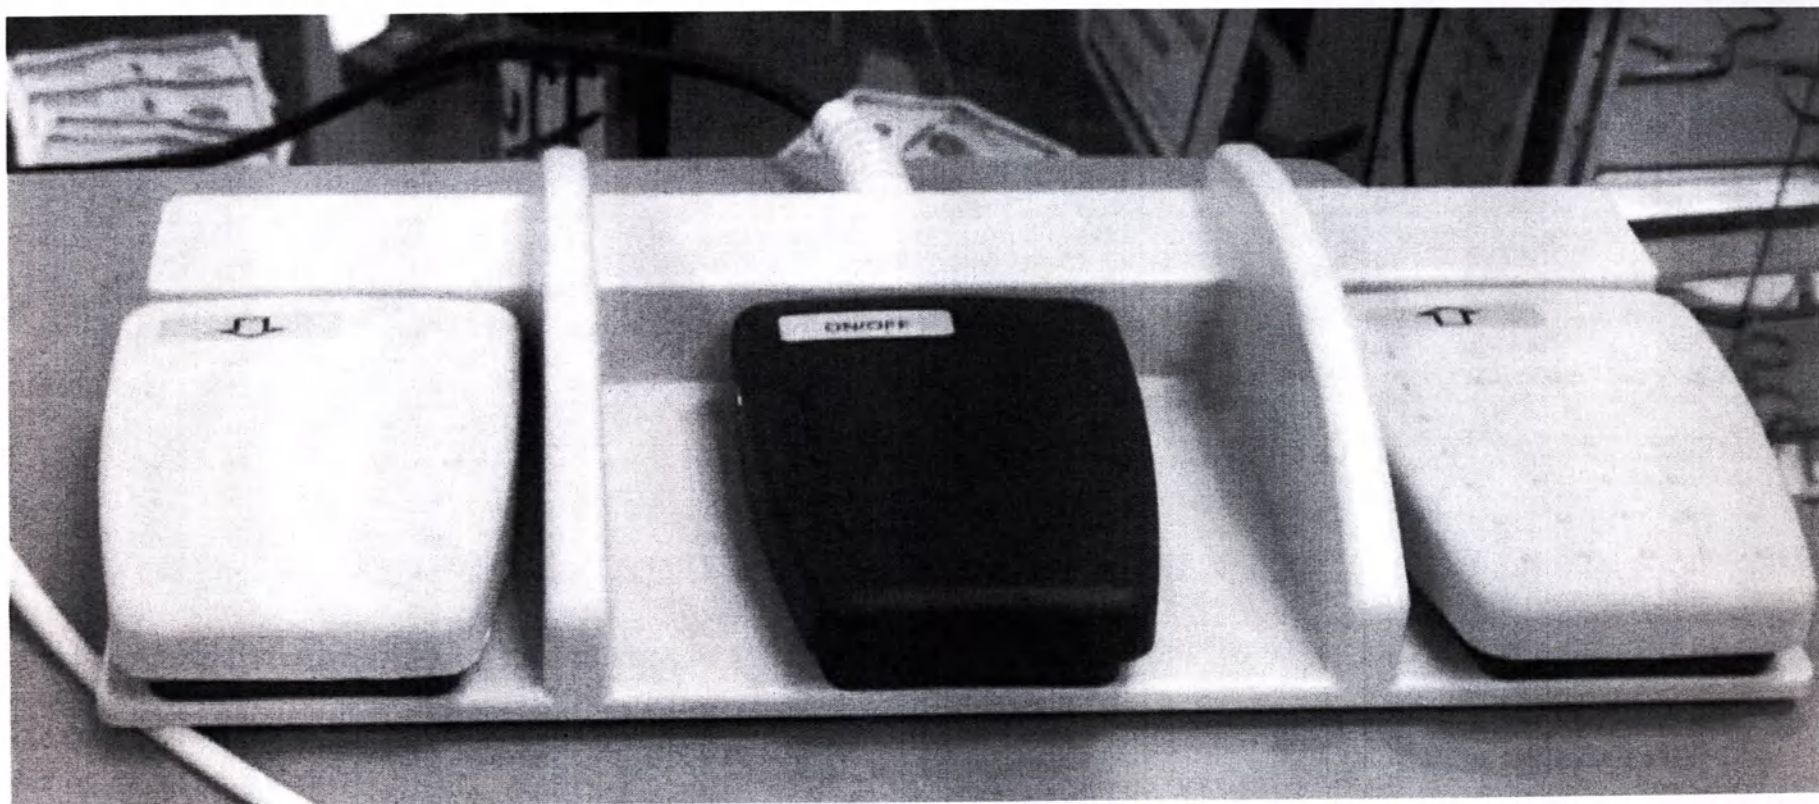

**Маркировка (вид сверху). Переключатель трехпедальный ножной (из комплектации Vibrasat power)
(слева на право: кнопка Вниз, кнопка Пуск/Стоп, кнопка Вверх).**

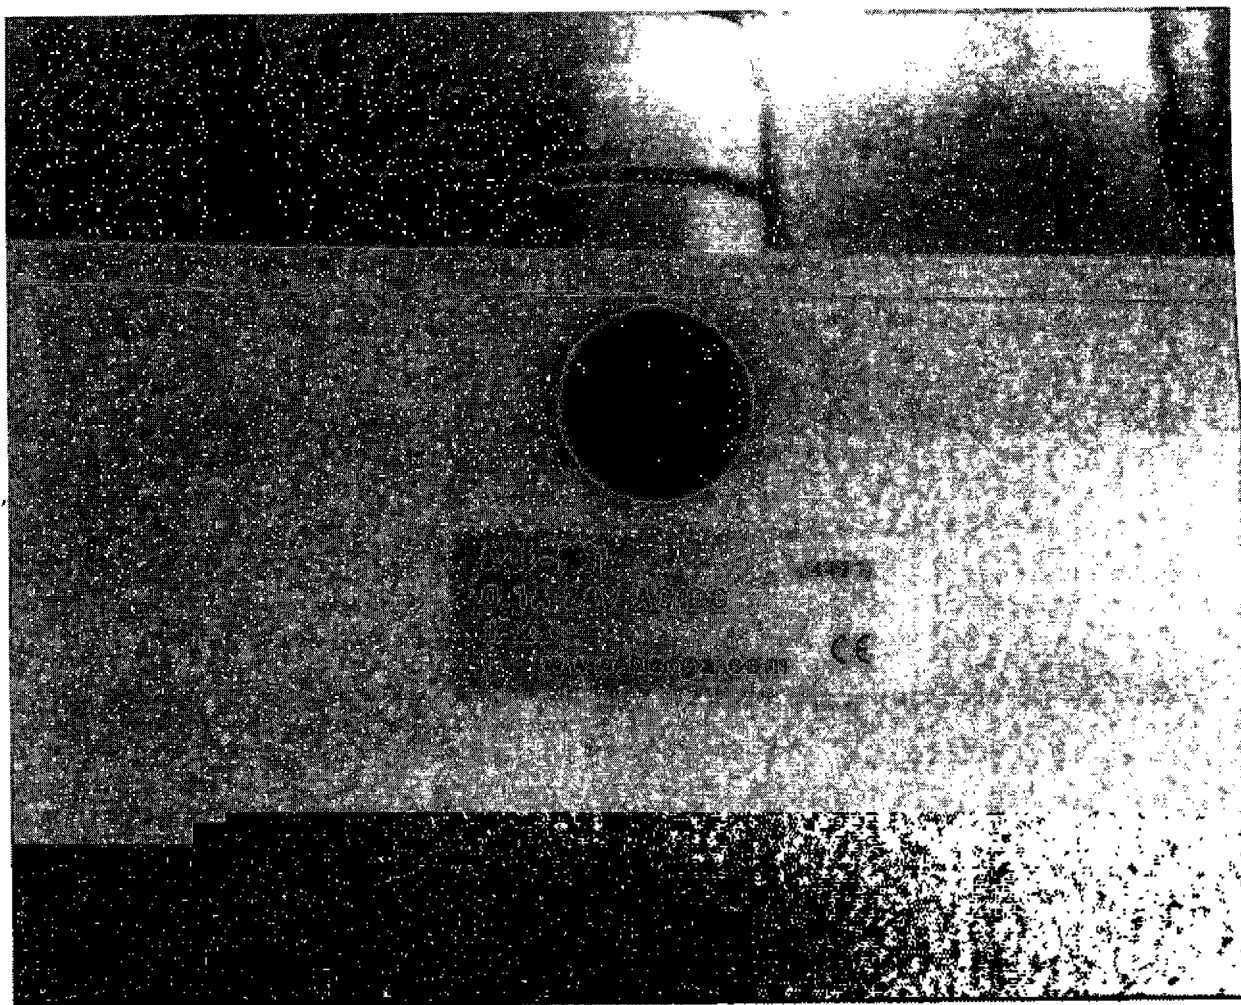

Маркировка (место нанесения: основание изделия). Переключатель трехпедальный ножной (из комплектации Vibrasat power).

Этикетка стерильной упаковки. Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)

Vibrasat Liposuktionskanüle
Vibrasat Liposuction cannula

REF 00001534 2020-06-22 **ø 4,0 x 250 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174224
(10) ABC123
(17) 250523

STERILEEO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskanüle
Vibrasat Liposuction cannula

REF 00001535 2020-06-22 **ø 4,0 x 350 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174231
(10) ABC123
(17) 250523

STERILEEO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskanüle
Vibrasat Liposuction cannula

REF 00001536 2020-06-22 **ø 3,0 x 250 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174248
(10) ABC123
(17) 250523

STERILEEO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskanüle
Vibrasat Liposuction cannula

REF 00001537 2020-06-22 **ø 3,0 x 350 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174255
(10) ABC123
(17) 250523

STERILEEO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskanüle
Vibrasat Liposuction cannula

REF 00001538 2020-06-22 **ø 2,5 x 150 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174262
(10) ABC123
(17) 250523

STERILEEO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Продукция	REF	Ø, мм	Длина, мм
Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)	00001534	4,0	250
Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)	00001535	4,0	350
Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)	00001536	3,0	250
Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)	00001537	3,0	350
Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)	00001538	2,5	150

Этикетка стерильной упаковки. Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)

Vibrasat Liposuktionskanüle
Vibrasat Liposuction cannula

REF 00002855 2020-06-22 **Ø 4,0 - 250 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174323
(10) ABC123
(17) 250523

STERILE EO
R_{ONLY}

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskanüle
Vibrasat Liposuction cannula

REF 00002856 2020-06-22 **Ø 4,0 - 350 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174330
(10) ABC123
(17) 250523

STERILE EO
R_{ONLY}

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskanüle
Vibrasat Liposuction cannula

REF 00002857 2020-06-22 **Ø 3,0 - 250 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174347
(10) ABC123
(17) 250523

STERILE EO
R_{ONLY}

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskanüle
Vibrasat Liposuction cannula

REF 00002858 2020-06-22 **Ø 3,0 - 350 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174354
(10) ABC123
(17) 250523

STERILE EO
R_{ONLY}

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskanüle
Vibrasat Liposuction cannula

REF 00002859 2020-06-22 **Ø 2,5 - 150 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174361
(10) ABC123
(17) 250523

STERILE EO
R_{ONLY}

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Продукция	REF	Ø, мм	Длина, мм
Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)	00002855	4,0	250
Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)	00002856	4,0	350
Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)	00002857	3,0	250
Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)	00002858	3,0	350
Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)	00002859	2,5	150

Этикетка стерильной упаковки. Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula Rapid Extract.)

Vibrasat Liposuktionskan. Rapid-Extract.
Vibrasat Liposuction cannula Rapid-Ext.

REF 00002324 2020-06-22 **Ø 3,0 x 350 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174293
(10) ABC123
(17) 250523

STERILEEO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskan. Rapid-Extract.
Vibrasat Liposuction cannula Rapid-Ext.

REF 00002325 2020-06-22 **Ø 4,0 x 250 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174308
(10) ABC123
(17) 250523

STERILEEO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskan. Rapid-Extract.
Vibrasat Liposuction cannula Rapid-Ext.

REF 00002323 2020-06-22 **Ø 3,0 x 250 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174286
(10) ABC123
(17) 250523

STERILEEO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskan. Rapid-Extract.
Vibrasat Liposuction cannula Rapid-Ext.

REF 00002326 2020-06-22 **Ø 4,0 x 350 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277174316
(10) ABC123
(17) 250523

STERILEEO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Продукция	REF	Ø, мм	Длина, мм
Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat liposuction cannula Rapid Extract.)	00002323	3,0	250
Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat liposuction cannula Rapid Extract.)	00002324	3,0	350
Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat liposuction cannula Rapid Extract.)	00002325	4,0	250
Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat liposuction cannula Rapid Extract.)	00002326	4,0	350

Этикетка стерильной упаковки. Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula Rapid Extract.)

Vibrasat Liposuktionskan. Rapid-Extract.
Vibrasat Liposuction cannula Rapid-Ext.

REF 00002890 2020-06-22 **Ø 3,0 - 350 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277/174385
(10) ABC123
(17) 250523

STERILE EO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskan. Rapid-Extract.
Vibrasat Liposuction cannula Rapid-Ext.

REF 00002892 2020-06-22 **Ø 4,0 - 350 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277/174405
(10) ABC123
(17) 250523

STERILE EO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskan. Rapid-Extract.
Vibrasat Liposuction cannula Rapid-Ext.

REF 00002891 2020-06-22 **Ø 3,0 - 250 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277/174382
(10) ABC123
(17) 250523

STERILE EO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482

Vibrasat Liposuktionskan. Rapid-Extract.
Vibrasat Liposuction cannula Rapid-Ext.

REF 00002893 2020-06-22 **Ø 4,0 - 250 mm**

LOT ABC123 2025-05-23

(01) 04260277/174415
(10) ABC123
(17) 250523

STERILE EO
R ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482


Продукция	REF	Ø, мм	Длина, мм
Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat liposuction cannula Rapid Extract.)	00002890	3,0	350
Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat liposuction cannula Rapid Extract.)	00002891	3,0	250
Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat liposuction cannula Rapid Extract.)	00002892	4,0	350
Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat liposuction cannula Rapid Extract.)	00002893	4,0	250

Этикетка стерильной упаковки. Канюля для удаления потовых желез (Perspiratory glands cannula)

Schweißdrüsenabsaugkanüle
Perspiratory glands cannula

REF 00002889 2020-06-22 **ø 3,0 x 200 mm**

LOT ABC123 2025-05-23 (01) 04260277174378
(10) ABC123
(17) 250523

 **STERILE EO**
Rx ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga

 **Möller Medical GmbH**
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482


Продукция	REF	Ø, мм	Длина, мм
Канюля для удаления потовых желез (Perspiratory glands cannula)	00002889	3,0	200

Этикетка стерильной упаковки. Канюля для удаления потовых желез (Perspiratory glands cannula)

Schweißdrüsenabsaugkanüle
Perspiratory glands cannula

REF 00001599 2020-06-22 **ø 3,0 x 200 mm**

LOT ABC123 2025-05-23 (01) 04260277174279
(10) ABC123
(17) 250523


 **STERILE EO**
Rx ONLY

www.moeller-medical.com/ifu-ga


 **Möller Medical GmbH**
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

CE 0482


Продукция	REF	Ø, мм	Длина, мм
Канюля для удаления потовых желез (Perspiratory glands cannula)	00001599	3,0	200

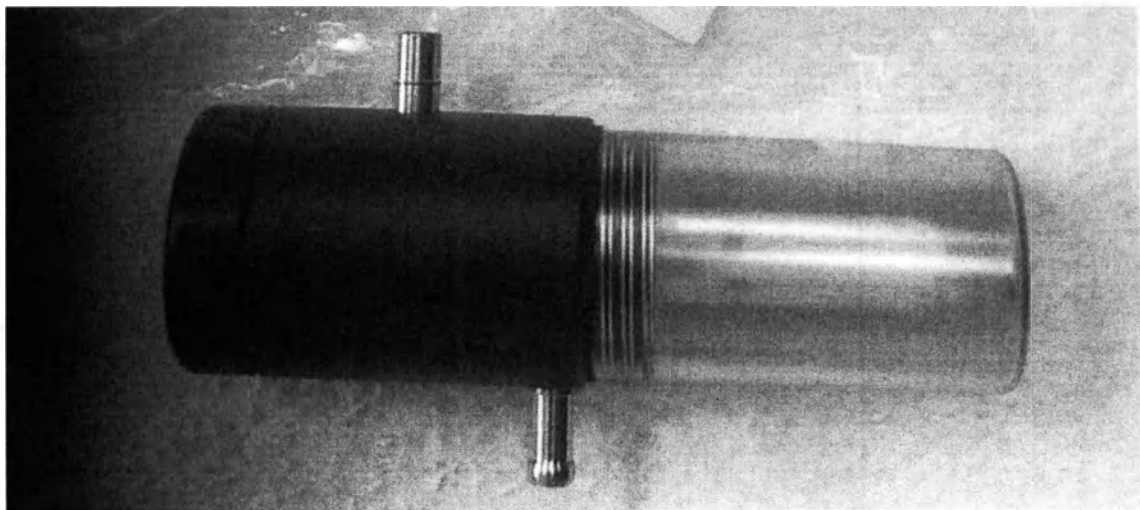


Защита от протечек для гидрофобного фильтра, артикул 00002299

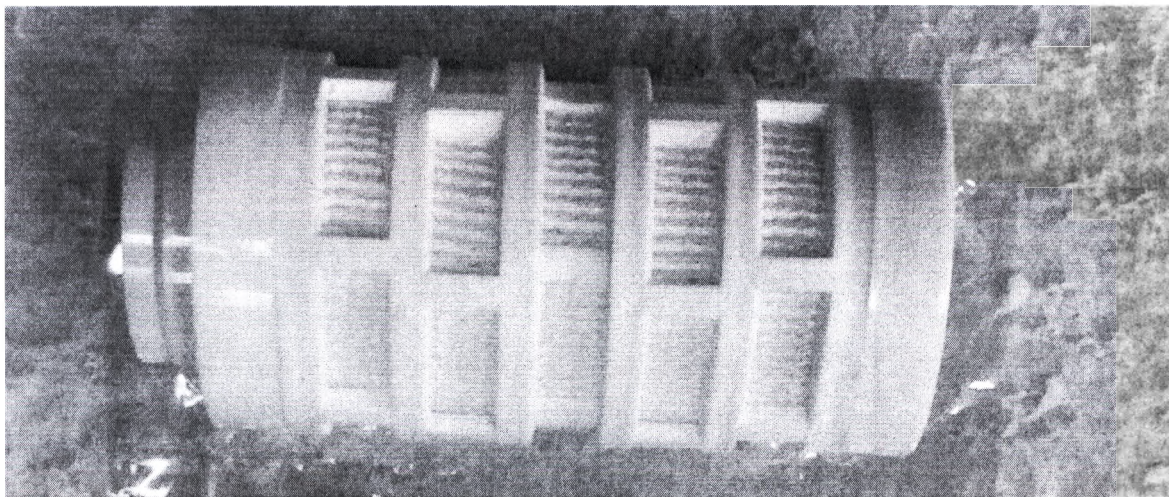



Фильтр гидрофобный для прибора (защиты от протечек), артикул 00002297

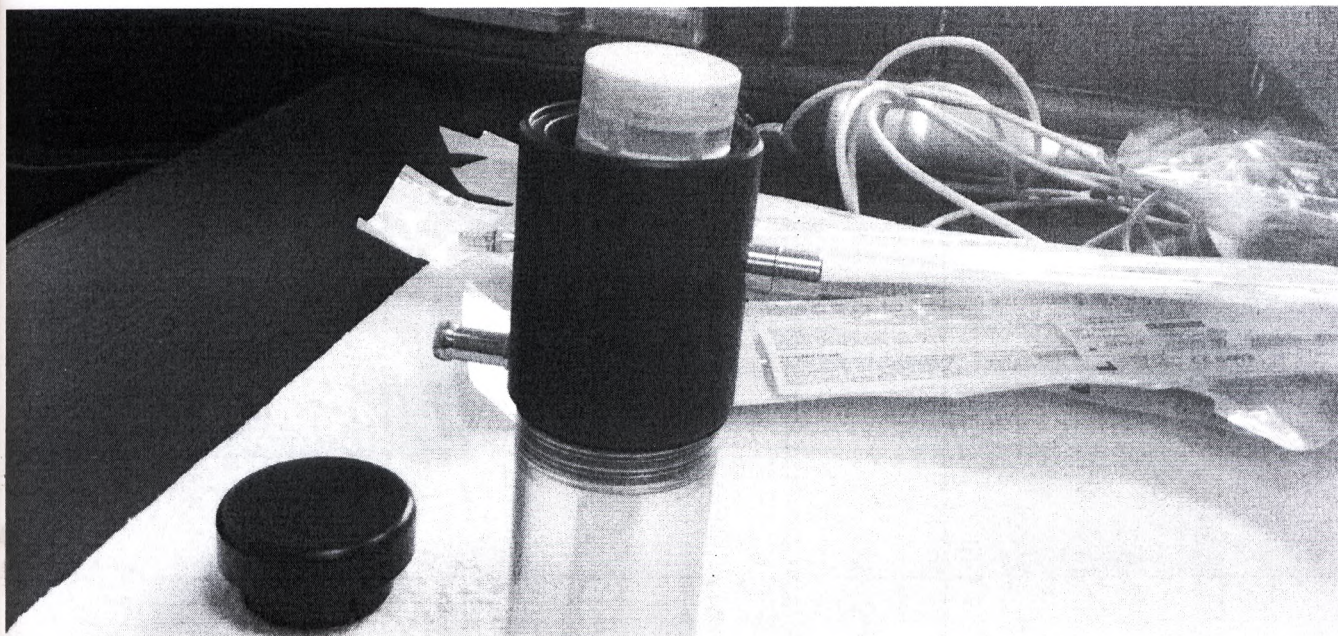


Общий вид размещения изделия «Фильтр гидрофобный для прибора (защиты от протечек), артикул 00002297» в устройстве «Защита от протечек для гидрофобного фильтра, артикул 00002299»

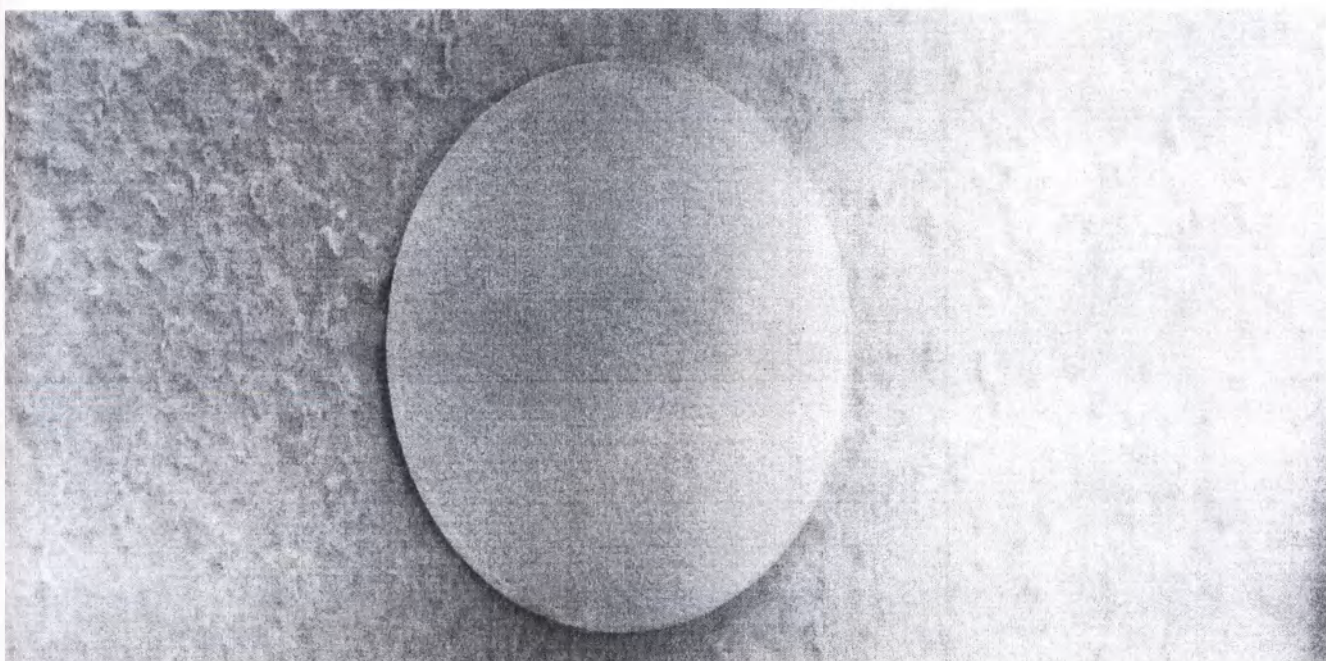


Фильтр воздушный для Vacusat Power (бактериальный фильтр), артикул 00002296

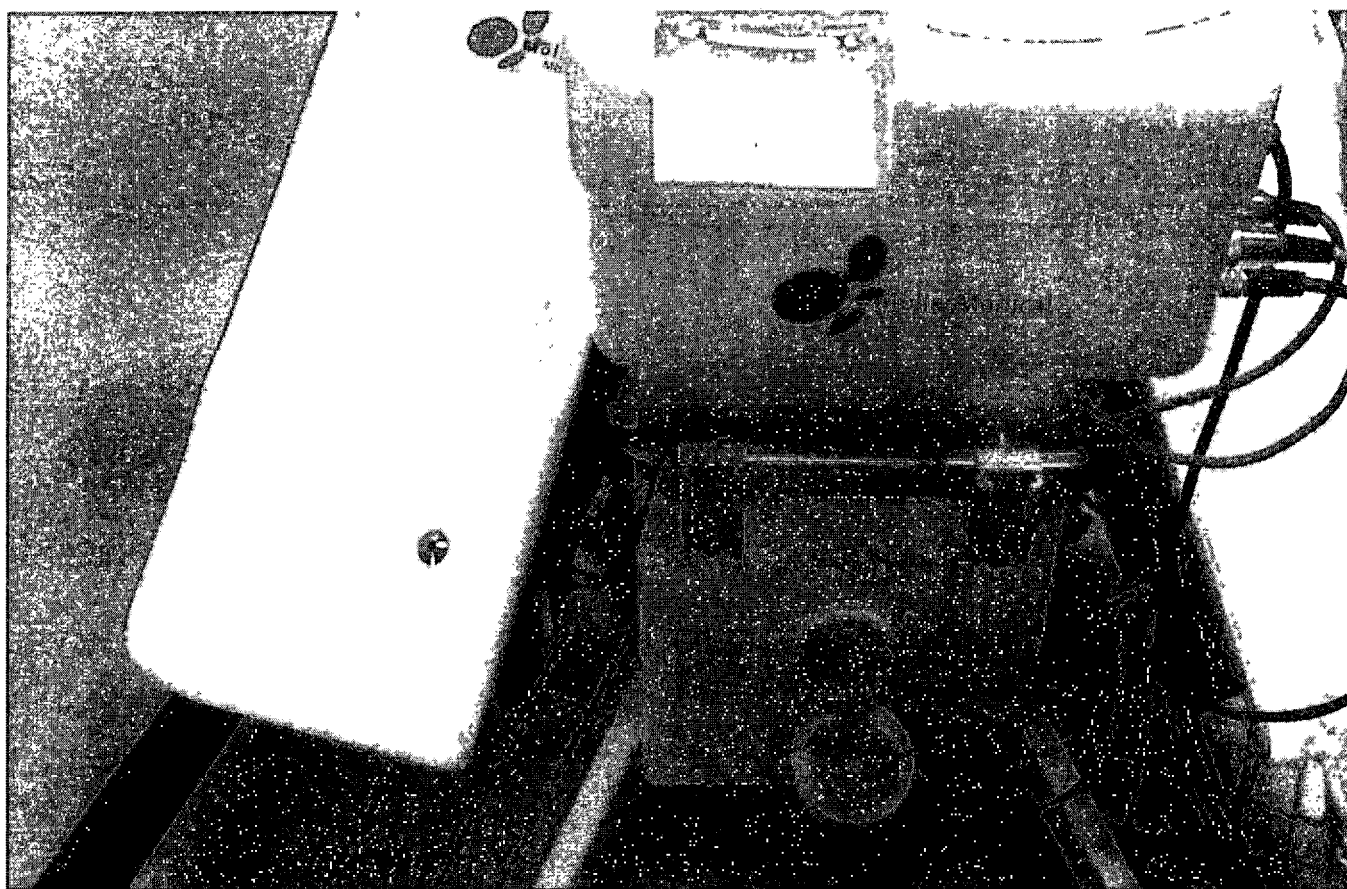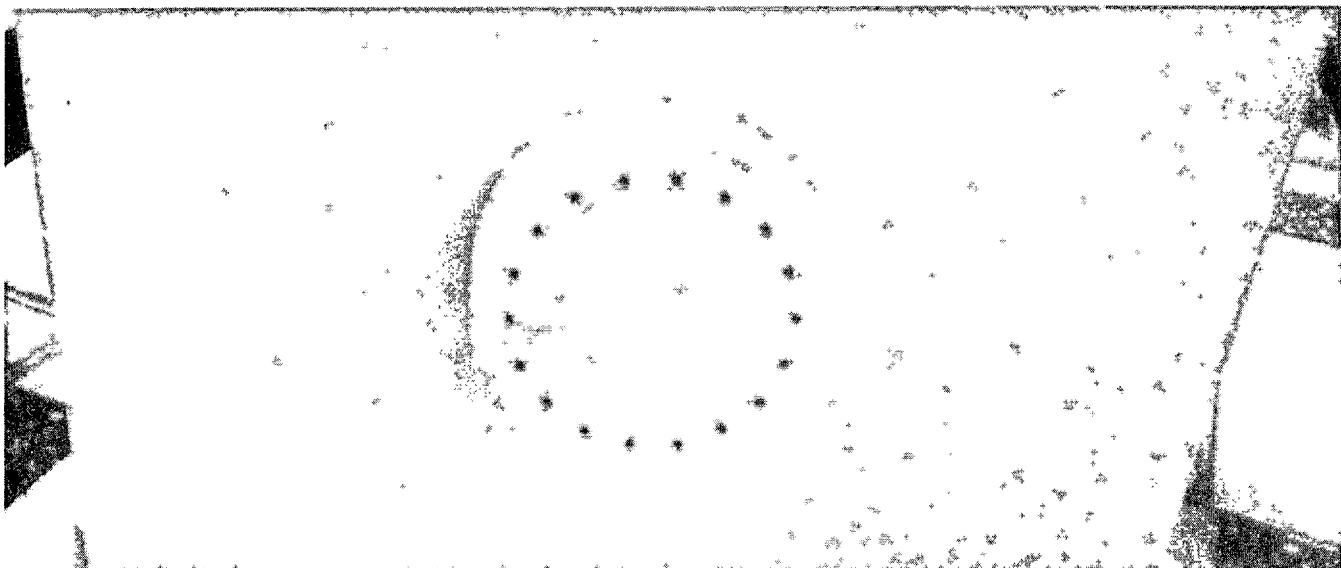

Место размещения изделия «Фильтр воздушный для Vacusat Power (бактериальный фильтр), артикул 00002296» в Vacusat power

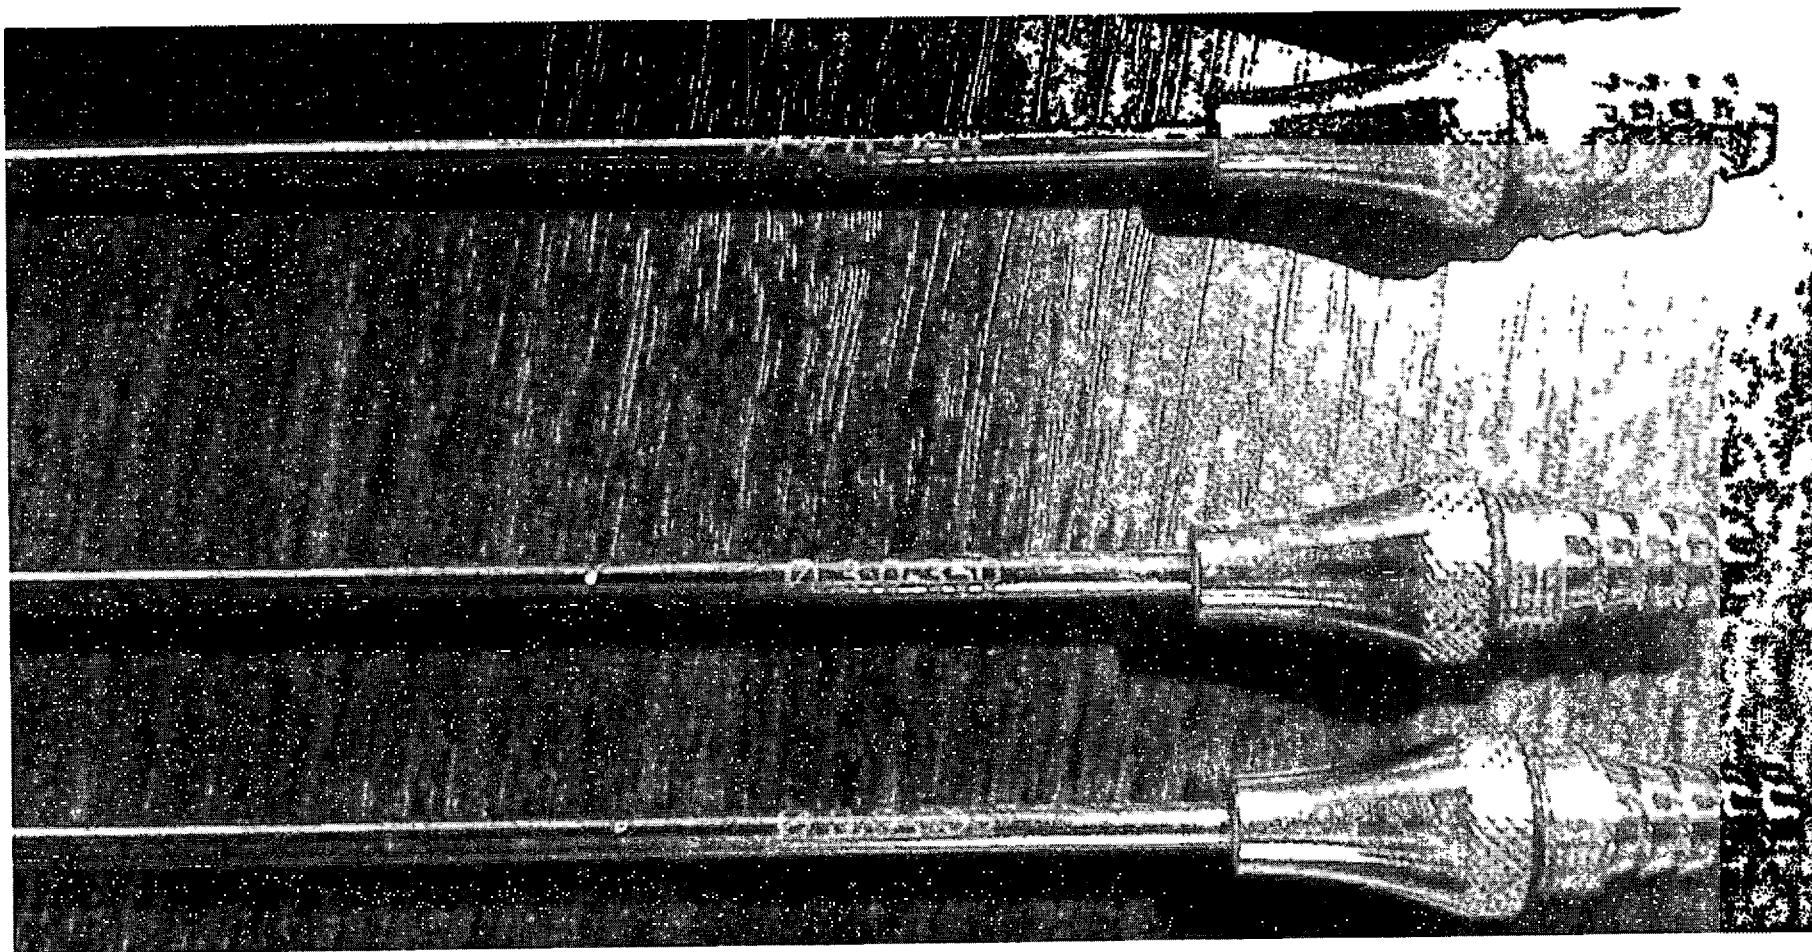

Маркировка канюли, на примере «Канюля для липосакции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula)»

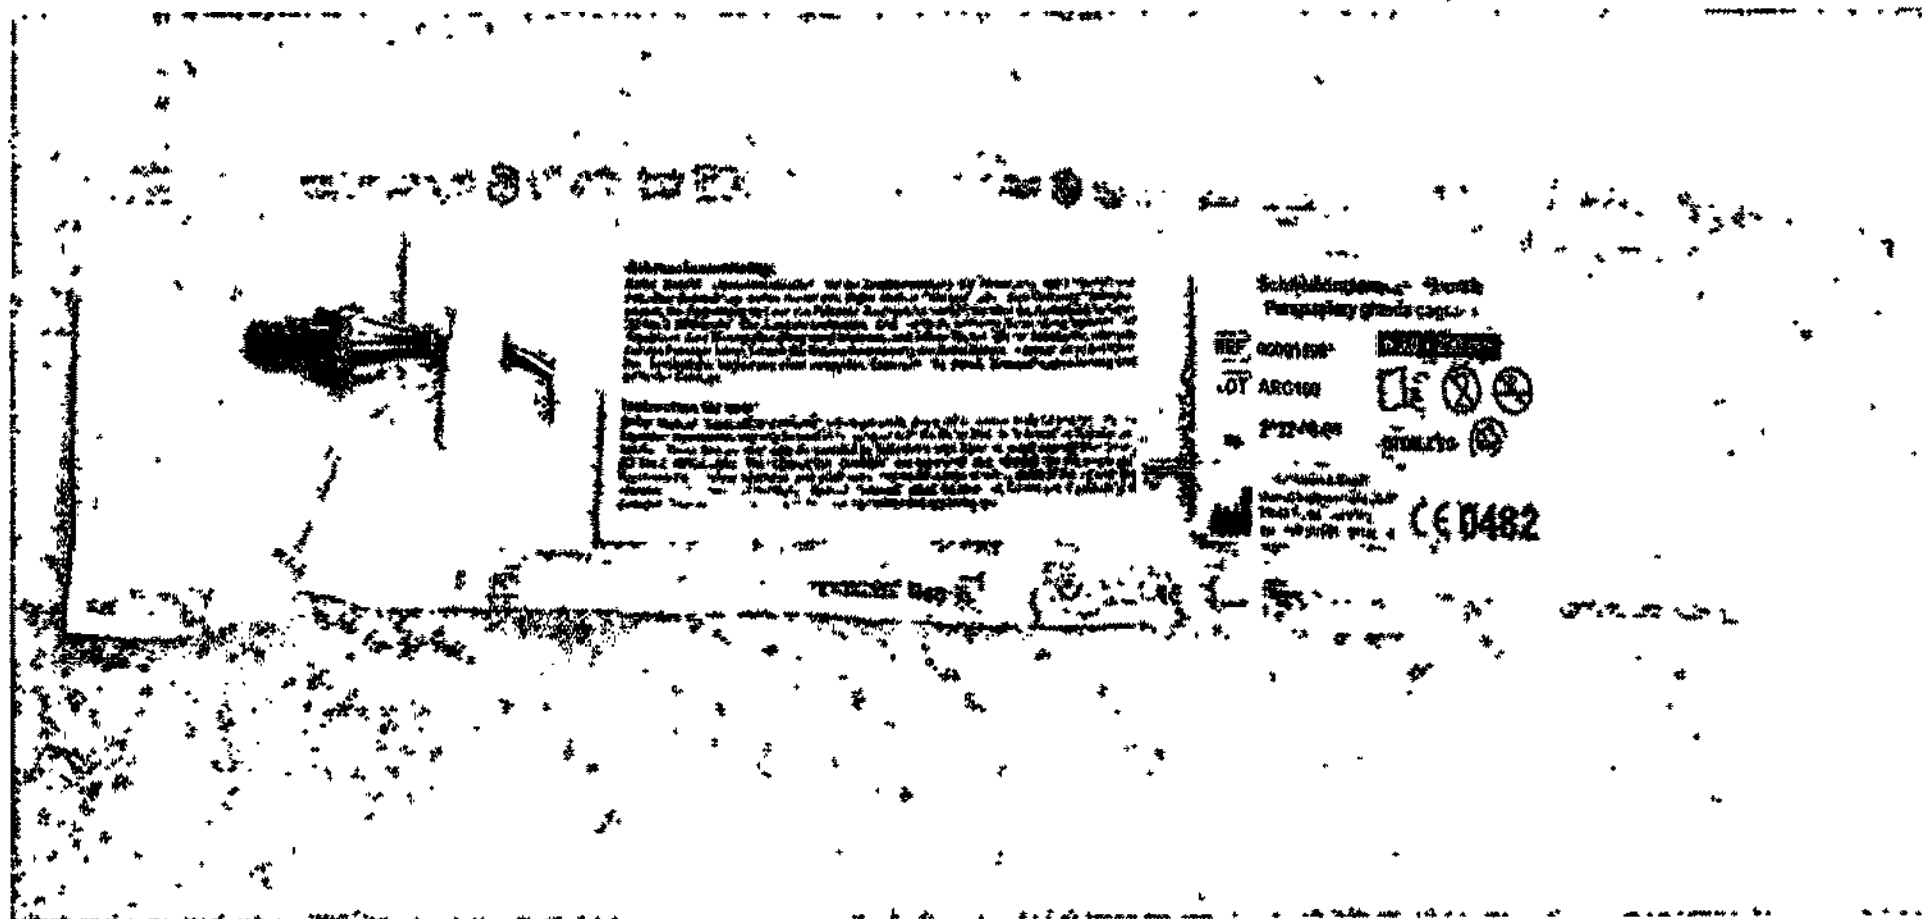

Индивидуальная упаковка канюли, на примере «Канюля для удаления потовых желез (Perspiratory glands cannula)»

Аспиратор хирургический Vacusat power

REF

00002252

SN



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31,
DE-36043 Fulda, Germany



Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «ПРЕМИУМ МЕД», 107014, Москва, ул. Егерская, д.1,
помещение 3а. Тел.: +74993915464, +74954114481


Макет маркировки транспортной упаковки Vacusat power

Насос инфльтрационный Liposat power

REF

00002274

SN



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31,
DE-36043 Fulda, Germany



Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «ПРЕМИУМ МЕД», 107014, Москва, ул. Егерская, д.1,
помещение 3а. Тел.: +74993915464, +74954114481

Макет маркировки транспортной упаковки Liposat power

Система вибрационного привода Vibrasat power

REF

00002246

SN




Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31,
DE-36043 Fulda, Germany




Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «ПРЕМИУМ МЕД», 107014, Москва, ул. Егерская, д.1,
помещение 3а. Тел.: +74993915464, +74954114481

Макет маркировки транспортной упаковки Vibrasat power

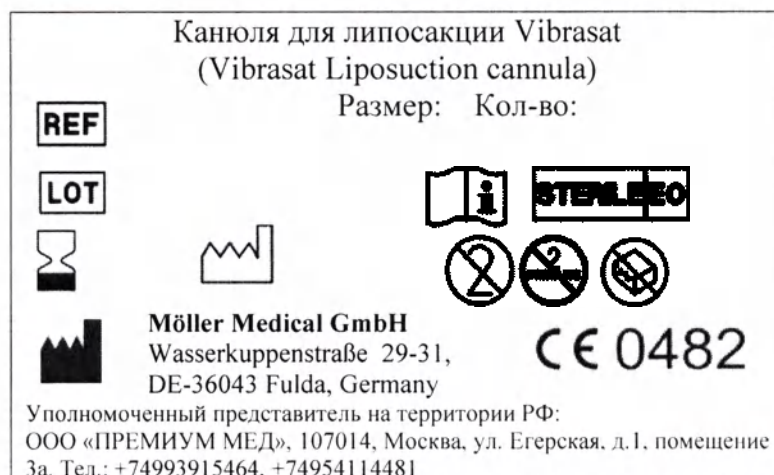

Макет маркировки транспортной упаковки «Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula Rapid Extract.)»

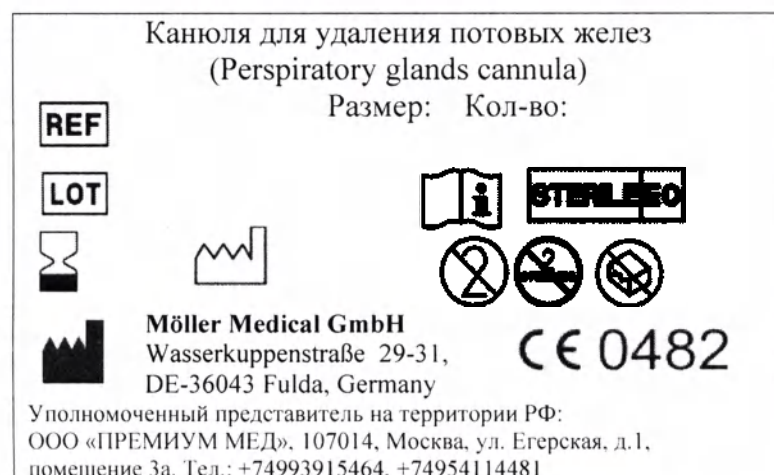

Макет маркировки транспортной упаковки «Канюля для удаления потовых желез (Perspiratory glands cannula)»

Фильтр воздушный для Vacusat Power
(бактериальный фильтр), артикул 00002296

Маркировка упаковки. Фильтр воздушный для Vacusat Power (бактериальный фильтр)

Фильтр гидрофобный для прибора (защиты
от протечек), артикул 00002297

Кол-во:

Маркировка упаковки. Фильтр гидрофобный для прибора (защиты от протечек)

Защита от протечек для гидрофобного
фильтра, артикул 00002299

Кол-во:

Маркировка упаковки. Защита от протечек для гидрофобного фильтра

Трубка вакуумная соединительная 8/14мм,
длина 1000мм, артикул 00002255

Маркировка упаковки. Трубка вакуумная соединительная 8/14мм, длина 1000мм

Контейнер для сбора жира, ёмкость 3000 мл,
артикул 00002257.

Кол-во:

Маркировка упаковки. Контейнер для сбора жира, ёмкость 3000 мл

Мешок для контейнера одноразовый,
ёмкость 3000 мл, зеленый, артикул 00002256

Кол-во:

Маркировка упаковки. Мешок для контейнера одноразовый, ёмкость 3000 мл, зеленый

Трубка вакуумная последовательная с угловым
коннектором, синяя 287, артикул 00002260

Маркировка упаковки. Трубка вакуумная последовательная с угловым коннектором, синяя 287,

Трубка вакуумная силиконовая с
Т-адаптером 175, артикул 00002259

Маркировка упаковки. Трубка вакуумная силиконовая с Т-адаптером 175

Комплект крепления для Vibrasat power,
артикул 00002283

Маркировка упаковки. Комплект крепления для Vibrasat power

Подогревающие пластины для
инфильтрационной жидкости, артикул
00002542:

-пластина подогревающая левая – 1 шт.

-пластина подогревающая правая -1 шт.

Маркировка упаковки. Подогревающие пластины для инфильтрационной жидкости

ПРИЛОЖЕНИЕ (СПРАВОЧНОЕ)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Система для вибрационной липосакции Liposat power configuration», в составе:

I. Аспиратор хирургический Vacusat power, артикул 00002252, базовая комплектация:

- 1.1 Аспиратор 220В, с комплектом для монтажа – 1 шт.
- 1.2 Кабель сетевого питания – 1шт.
- 1.3 Направляющая опоры - 2шт.
- 1.4 Держатель для крепления на направляющей блока – 2 шт.
- 1.5 Переключатель ножной – 1 шт.
- 1.6 Трубка вакуумная соединительная 8/14мм, длина 1000мм, артикул 00002255 – 1 шт.
- 1.7 Контейнер для сбора жира, ёмкость 3000 мл, артикул 00002257 – 2 шт.
- 1.8 Мешок для контейнера одноразовый, ёмкость 3000 мл, зеленый, артикул 00002256 – не более 100 шт (при необходимости)
- 1.9 Трубка вакуумная последовательная с угловым коннектором, синяя 287, артикул 00002260 – 1 шт.
- 1.10 Трубка вакуумная силиконовая с Т-адаптером 175, артикул 00002259 – 1 шт.
- 1.11 Фильтр воздушный для Vacusat Power (бактериальный фильтр), артикул 00002296 – 1шт.
- 1.12 Защита от протечек для гидрофобного фильтра, артикул 00002299 - не более 2 шт.
- 1.13 Фильтр гидрофобный для прибора (защита от протечек), артикул 00002297 – не более 2 шт.
- 1.14 Руководство по эксплуатации Vacusat power – 1 шт.

II. Насос инфильтрационный Liposat power, артикул 00002274, базовая комплектация:

- 2.1 Насос 220В, с комплектом для монтажа – 1 шт.
- 2.2 Кабель сетевого питания – 1шт.
- 2.3 Переключатель ножной – 1 шт.
- 2.4 Подогревающие пластины для инфильтрационной жидкости, артикул 00002542:
 - пластина подогревающая левая – 1 шт.
 - пластина подогревающая правая -1 шт.
- 2.6 Руководство по эксплуатации Liposat power – 1шт.

III. Система вибрационного привода Vibrosat power, артикул 00002246, базовая комплектация:

- 3.1 Блок управления – 1 шт.;
- 3.2 Рукоятка с соединительным кабелем – 1 шт.
- 3.3. Разъем для подключения канюли - 1 шт.
- 3.4. Переключатель трехпедальный ножной - 1шт.
- 3.5. Кабель сетевого питания - 1 шт.
- 3.6. Комплект крепления для Vibrosat power, артикул 00002283- 1 шт.
- 3.7. Канюля для липосакции Vibrosat (Vibrosat Liposuction cannula), варианты исполнения:
 - 3.7.1. Канюля для липосакции Vibrosat (Vibrosat Liposuction cannula) – не более 5 шт:
 - Стальная муфта, с тремя отверстиями, стерильная, Ø4,0x250 мм, артикул 00001534
 - Пластиковая муфта, с тремя отверстиями, стерильная, Ø4,0x250 мм, артикул 00002855
 - Стальная муфта, с тремя отверстиями, стерильная, Ø4,0x350 мм, артикул 00001535
 - Пластиковая муфта, с тремя отверстиями, стерильная, Ø4,0x350 мм, артикул 00002856
 - Стальная муфта, с тремя отверстиями, стерильная, Ø3,0x250 мм, артикул 00001536

- Пластиковая муфта, с тремя отверстиями, стерильная, Ø3,0x250 мм, артикул 00002857
 - Стальная муфта, с тремя отверстиями, стерильная, Ø3,0x350 мм, артикул 00001537
 - Пластиковая муфта, с тремя отверстиями, стерильная, Ø3,0x350 мм, артикул 00002858
 - Стальная муфта, с тремя отверстиями, стерильная, Ø2,5x150 мм, артикул 00001538
 - Пластиковая муфта, с тремя отверстиями, стерильная, Ø2,5x150 мм, артикул 00002859
- 3.8. Канюля для липосакции для быстрой экстракции Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula Rapid Extract.), варианты исполнения:
- 3.8.1. Канюля для липосакции с быстрой экстракцией Vibrasat (Vibrasat Liposuction cannula Rapid Extract.) – не более 5 шт:
- Стальная муфта, с девятью отверстиями, стерильная, Ø3,0x250 мм, артикул 00002323
 - Пластиковая муфта, с девятью отверстиями, стерильная, Ø3,0x250 мм, артикул 00002891
 - Стальная муфта, с девятью отверстиями, стерильная, Ø3,0x350 мм, артикул 00002324
 - Пластиковая муфта, с девятью отверстиями, стерильная, Ø3,0x350 мм, артикул 00002890
 - Стальная муфта, с девятью отверстиями, стерильная, Ø4,0x250 мм, артикул 00002325
 - Пластиковая муфта, с девятью отверстиями, стерильная, Ø4,0x250 мм, артикул 00002893
 - Стальная муфта, с девятью отверстиями, стерильная, Ø4,0x350 мм, артикул 00002326
 - Пластиковая муфта, с девятью отверстиями, стерильная, Ø4,0x350 мм, артикул 00002892
- 3.9. Канюля для удаления потовых желез (Perspiratory glands cannula) – не более 5 шт:
- 3.9.1 Канюля для удаления потовых желез (Perspiratory glands cannula), варианты исполнения:
- Стальная муфта, стерильная, Ø3,0x200 мм, артикул 00001599
 - Пластиковая муфта, стерильная, Ø3,0x200 мм, артикул, 00002889
- 3.10 Комплект крепления для Vibrosat power, артикул 00002283 – 1 шт.
- 3.11 Руководство по эксплуатации Vibrosat power – 1шт.

IV. Руководство по эксплуатации Liposat power configuration – 1шт.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 43 (Сорок три) л.

Генеральный директор
ООО "Премиум Мед" Пылин О.Б.