


«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»  
А.Г.Плехов



## **МАКЕТ МАРКИРОВКИ**

**Набор реагентов для определения концентрации железа  
в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом  
с Ферен-S без депротеинизации  
«ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ»,  
ТУ 21.20.23-068-94568735-2020**



REF B 24.04

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-S без депротеинизации



Реагент №1: 2 x 50 мл  
Реагент №2: 1 x 25 мл  
Калибратор: 1 флакон


ТУ 21.20.23-068-94568735-2020  
РЗН 2020/11925 от 11.09.2020

LOT Серия: 0022 Дата выпуска: 2023.02 Годен до: 2024.08  
только для in vitro диагностики  
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку дом 56, литера А  
UK IRON-VITAL  
R1: 2 x 50 ml  
R2: 1 x 25 ml  
Calibrator: 1 vial  
IVD  
Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenuki 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia




24042302220022





REF B 24.14

Добор реагентов для определения концентрации железа  
в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом  
с Ферен-S без депротеинизации



Реагент №1: 2 x 100 мл  
Реагент №2: 2 x 25 мл  
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020  
РЗН 2020/11925 от 11.09.2020

LOT Серия: 0022 Дата выпуска: 2023.02 Годен до: 2024.08  
только для in vitro диагностики

UK IRON-VITAL

LOT 0022

R1: 2 x 100 ml  
R2: 2 x 25 ml  
Calibrator: 1 vial

2024.08

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamensk 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

IVD



24142302220022

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**  
REF B 24.14  
REF B 24.24  
**100 мл**  
2°C 8°C  
LOT 0022  
Годен до: 2024.08  
только для in vitro диагностики

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**  
REF B 24.14  
REF B 24.24  
**100 мл**  
2°C 8°C  
LOT 0022  
Годен до: 2024.08  
только для in vitro диагностики

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**  
REF B 24.04  
REF B 24.14  
REF B 24.24  
**25 мл**  
2°C 8°C  
LOT 0022  
Годен до: 2024.08  
только для in vitro диагностики


**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**  
REF B 24.04  
REF B 24.14  
REF B 24.24  
**25 мл**  
2°C 8°C  
LOT 0022  
Годен до: 2024.08  
только для in vitro диагностики

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**  
35,9 мкмоль/л  
**лиофилизат**  
растворить в 3,0 мл дистиллированной воды  
LOT 0022  
Годен до: 2024.08  
только для in vitro диагностики

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.24

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-S без депротеинизации



Реагент №1: 4 x 100 мл  
Реагент №2: 4 x 25 мл  
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020  
РЗН 2020/11925 от 11.09.2020

LOT Серия: 0022



Дата выпуска: 2023.02

Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку дом 56, литера А

UK IRON-VITAL

R1: 4 x 100 ml  
R2: 4 x 25 ml  
Calibrator: 1 vial

LOT 0022

2024.08

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenskuyu 56 A, 194356  
St. Petersburg, Russia

IVD



24242212210021

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 2

REF B 24.04  
REF B 24.14  
REF B 24.24

25 мл

LOT 0022



годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 2

REF B 24.04  
REF B 24.14  
REF B 24.24

25 мл

LOT 0022



годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 2

REF B 24.04  
REF B 24.14  
REF B 24.24

25 мл

LOT 0022



годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 2

REF B 24.04  
REF B 24.14  
REF B 24.24

25 мл

LOT 0022



годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

35,9 мкмоль/л

лиофилизат

растворить в 3,0 мл деминерализованной воды

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.14  
REF B 24.24

100 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.14  
REF B 24.24

100 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.14  
REF B 24.24

100 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.14  
REF B 24.24

100 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР



REF B 24.74-1.150

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-С без депротеинизации

Реагент №1: 2 x 40 мл

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020

Реагент №2: 2 x 12 мл

РЗН 2020/11925 от 11.09.2020



LOT Серия: 0022



Дата выпуска: 2023.02



Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK IRON-VITAL

R1: 2 x 40 ml

LOT 0022

R2: 2 x 12 ml

2024.08

IVD



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia



91002302000022

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.74-1.150

40 мл

LOT 0022



годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.74-1.150

40 мл

LOT 0022



годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.74-1.150

12 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.74-1.150

12 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

REF B 24.714-1.150

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-S без депротеинизации

Реагент №1: 4 x 40 мл  
Реагент №2: 4 x 12 мл

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020

РЗН 2020/11925 от 11.09.2020

LOT

Серия:  
0022Дата выпуска:  
2023.02Годен до:  
2024.08

только для in vitro диагностики  
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

## UK IRON-VITAL

R1: 4 x 40 ml  
R2: 4 x 12 ml

LOT

0022



2024.08



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

IVD



97142109000014

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.150

40 мл

LOT 0022



годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.150

40 мл

LOT 0022



годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.150

40 мл

LOT 0022



годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.150

40 мл

LOT 0022



годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.150

РЕАГЕНТ 2 12 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.150

РЕАГЕНТ 2 12 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.150

РЕАГЕНТ 2 12 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.150

РЕАГЕНТ 2 12 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

REF B 24.74-1.300

### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-S без депротеинизации

Реагент №1: 3 x 52 мл  
Реагент №2: 3 x 15 мл

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020  
РЗН 2020/11925 от 11.09.2020



LOT Серия: 0022



Дата выпуска: 2023.02



Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 58, литера А

### UK IRON-VITAL

R1: 3 x 52 ml  
R2: 3 x 15 ml

LOT 022

Годен до: 2024.08

IVD



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 58 A, 194356  
St. Petersburg, Russia

### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT 0022

Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT 0022

Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT 0022

Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0022

Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0022

Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0022

Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

REF В 24.714-1.300

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ


Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-С без депротеинизации

Реагент №1: 6 x 52 мл

Реагент №2: 6 x 15 мл

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020

РЗН 2020/11925 от 11.09.2020



LOT

Серия:  
0022Дата выпуска:  
2023.02Годен до:  
2024.08

только для in vitro диагностики  
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK IRON-VITAL

R1: 6 x 52 ml

R2: 6 x 15 ml

LOT

0022



2024.08



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenuk 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

IVD

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

52 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

52 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

52 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

52 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

15 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

52 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

52 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

15 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.714-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

REF B 24.74-1.420

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-S без депротеинизации

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020

РЗН 2020/11925 от 11.09.2020

Реагент №1: 2 x 72 мл

Реагент №2: 2 x 20 мл



LOT

Серия: 0022



Дата выпуска: 2023.02



Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK IRON-VITAL

R1: 2 x 72 ml

LOT 0022

R2: 2 x 20 ml

годен до: 2024.08

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 56 A, 194356  
St. Petersburg, Russia

IVD

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



91042302000022

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



REF B 24.714-1.420

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-S без депротеинизации

Реагент №1: 4 x 72 мл  
Реагент №2: 4 x 20 мл

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020  
РЗН 2020/11925 от 11.09.2020

LOT Серия: 0022 Дата выпуска: 2023.02 Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK IRON-VITAL

R1: 4 x 72 ml  
R2: 4 x 20 ml

LOT 0022

2024.08

IVD

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356  
St. Petersburg, Russia

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



97172302000022



## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 24.724-1.420

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-S без депротеинизации

Реагент №1: 6 x 72 мл

Реагент №2: 6 x 20 мл

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020

РЗН 2020/11925 от 11.09.2020



LOT Серия: 0022



Дата выпуска: 2023.02



Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 55, литера А

UK IRON-VITAL

R1: 6 x 72 ml

R2: 6 x 20 ml

LOT 0022

2024.08

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 55 A, 194356  
St. Petersburg, Russia

IVD

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420



РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420



РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420



РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.724-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

REF B 24.74-1.200

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-С без депротеинизации

Реагент №1: 4 x 20 мл  
Реагент №2: 4 x 5 мл

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020  
РЗН 2020/11925 от 11.09.2020



LOT

Серия:  
0022Дата выпуска:  
2023.02Годен до:  
2024.08

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 5Б, литера А

## UK IRON-VITAL

R1: 4 x 20 ml  
R2: 4 x 5 ml

LOT 0022

2024.08

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu 5B A 194358  
St. Petersburg, Russia

IVD



91022302000022

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.200


РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.200

РЕАГЕНТ 2

5 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.200

РЕАГЕНТ 2

5 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.200


РЕАГЕНТ 2

5 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.200

РЕАГЕНТ 2

5 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



REF B 24.714-1.200

### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-S без депротеинизации

Реагент №1: 8 x 20 мл  
Реагент №2: 8 x 5 мл

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020  
РЗН 2020/11925 от 11.09.2020

LOT Серия: 0022 Дата выпуска: 2023.02 Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

### UK IRON-VITAL

R1: 8 x 20 ml  
R2: 8 x 5 ml

LOT 0022

годен до: 2024.08

IVD

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356  
St. Petersburg, Russia

### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.200



РЕАГЕНТ 2

5 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



### ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.714-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики  
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия





РЕАГЕНТ 2

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.200

5 МЛ

LOT 0022

годен до:2024.08

ТОЛЬКО ДЛЯ ІН ВІТРО ДІАГНОСТИКИ  
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



РЕАГЕНТ 2

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.200

5 МЛ

LOT 0022

годен до:2024.08

ТОЛЬКО ДЛЯ ІН ВІТРО ДІАГНОСТИКИ  
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



РЕАГЕНТ 2

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.200

5 МЛ

LOT 0022

годен до:2024.08

ТОЛЬКО ДЛЯ ІН ВІТРО ДІАГНОСТИКИ  
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



РЕАГЕНТ 2

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.200

5 МЛ

LOT 0022

годен до:2024.08

ТОЛЬКО ДЛЯ ІН ВІТРО ДІАГНОСТИКИ  
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



РЕАГЕНТ 2

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.200

5 МЛ

LOT 0022

годен до:2024.08

ТОЛЬКО ДЛЯ ІН ВІТРО ДІАГНОСТИКИ  
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



РЕАГЕНТ 2

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.200

5 МЛ

LOT 0022

годен до:2024.08

ТОЛЬКО ДЛЯ ІН ВІТРО ДІАГНОСТИКИ  
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



РЕАГЕНТ 2

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.714-1.200

5 МЛ

LOT 0022

годен до:2024.08

ТОЛЬКО ДЛЯ ІН ВІТРО ДІАГНОСТИКИ  
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



REF В 24.74-2.200

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-С без депротеинизации

Реагент №1: 2 x 40 мл  
Реагент №2: 1 x 20 мл  
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020  
РЗН 2020/11925 от 11.09.2020



LOT

Серия: 0022



Дата выпуска: 2023.02



Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

## UK IRON-VITAL

R1: 2 x 40 ml  
R2: 1 x 20 ml  
Calibrator: 1 vial

LOT

0022



2024.08



Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenuki 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

IVD

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.74-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT

0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.74-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT

0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



910522001802120230



## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.74-2.200

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT

0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ  
35,9 мкмоль/л  
лиофилизат

растворить в 3,0 мл деионизированной воды

LOT

0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



REF В 24.74-2.300

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-З без депротеинизации

Реагент №1: 4 x 40 мл

Реагент №2: 2 x 20 мл

Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020

РЗН 2020/11925 от 11.09.2020



LOT Серия:  
0022



Дата выпуска:  
2023.02



Годен до:  
2024.08

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

**UK IRON-VITAL**

R1: 4 x 40 ml

R2: 2 x 20 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0022

2024.08

IVD

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamenuki 56 A 194356  
St. Petersburg, Russia

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF В 24.74-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF В 24.74-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF В 24.74-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF В 24.74-2.300

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,  
Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF В 24.74-2.300

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**35,9 мкмоль/л  
лиофилизат

реставрация в 5,0 мл деионизованной воды

LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF В 24.74-2.300

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

REF B 24.74-1.600

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ


Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-S без депротеинизации

Реагент №1: 4 x 68 мл

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020

Реагент №2: 4 x 20 мл

РЗН 2020/11925 от 11.09.2020



LOT

Серия: 0022



Дата выпуска: 2023.02



Годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK IRON-VITAL

R1: 4 x 68 ml

LOT 0022

R2: 4 x 20 ml

2024.08

IVD

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamensk, 56 A, 194355  
St. Petersburg, Russia



247416001802120230

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.600

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.600

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.600

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

## ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.74-1.600

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF B 24.714-1.600

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-З без депротеинизации

Реагент №1: 6 x 68 мл

Реагент №2: 6 x 20 мл

ТУ 21.20.23-068-94568735-2020

РЗН 2020/11925 от 11.09.2020



LOT

Серия:  
0022Дата выпуска:  
2023.02Годен до:  
2024.08

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,  
дом 56, литера А

UK IRON-VITAL

R1: 6 x 68 ml

R2: 6 x 20 ml

LOT 0022

2024.08

IVD

Vital Development Corporation  
Doroga v Kamensk, 56 A, 194356  
St. Petersburg, Russia



02471418001802120230

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 1

68 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 2 20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 2 20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 2 20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

ЖЕЛЕЗО-  
ВИТАЛ

REF В 24.714-1.600

РЕАГЕНТ 2 20 мл



LOT 0022

годен до: 2024.08

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент  
Корпорэйшн, Россия

Прошито, пронумеровано,  
и скреплено печатью



Всего

Ген. директор

листа(ов)

Илев А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»  
А.Г.Плехов



2023 г.


## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**

**Набор реагентов для определения концентрации железа  
в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом  
с Ферен-S без депротенинизации  
«ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ»,  
ТУ 21.20.23-068-94568735-2020**

# ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.04

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с ферен-5 без депротенизации



Реагент №1: 2 x 50 мл  
Реагент №2: 1 x 25 мл  
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.33-060-94565735-2020  
РУ

LOT

Серия: 0012



Дата выпуска: 2019.07



Годен до: 2021.01




ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ  
ОД: 2 x 50 мл  
РОЗ: 1 x 25 мл  
САМОХРАН: 1 год

LOT 0012

2021.01

ВНИМАНИЕ! Хранить в холодильнике при температуре +2...+8°C. Не замораживать.

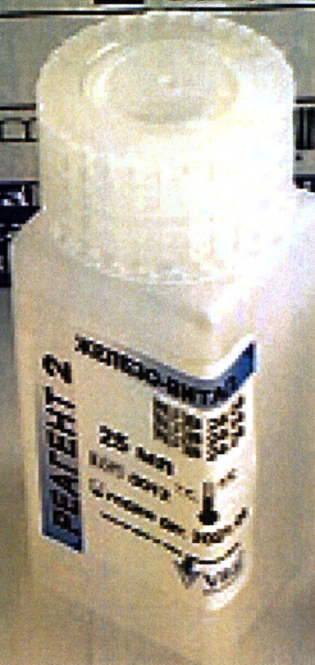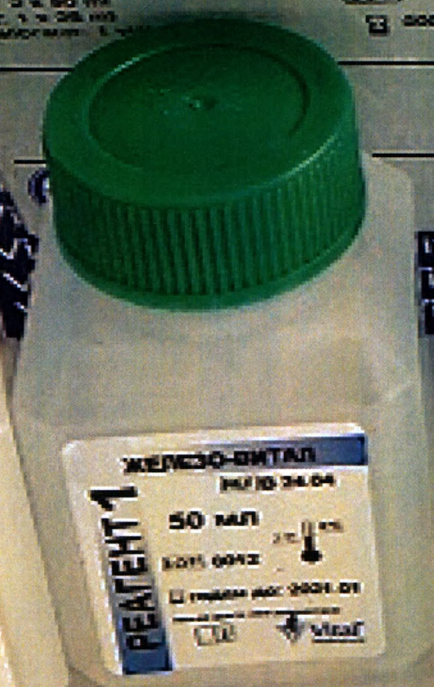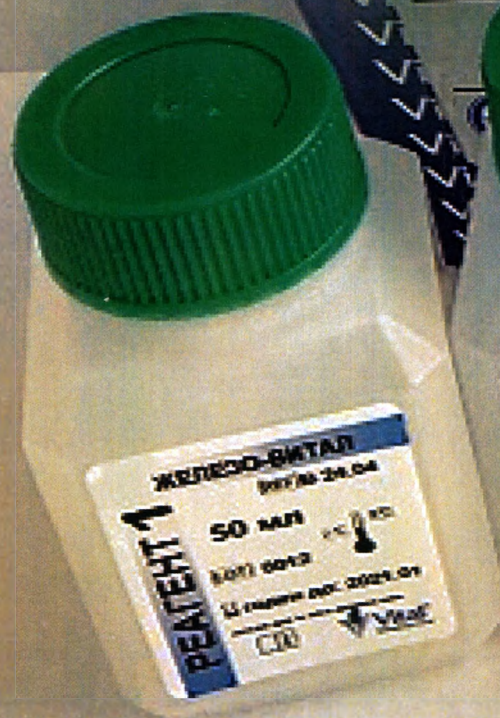

# ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.14

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-Б без депротеинизации

20°C 8°C

Реагент №1: 2 x 100 мл  
Реагент №2: 2 x 25 мл  
Калибратор: 1 флакон



ТУ 21.20.23-040-94065735-2020  
РУ

Серия:


Дата выпуска:






Годен до:

0012  
2021.01

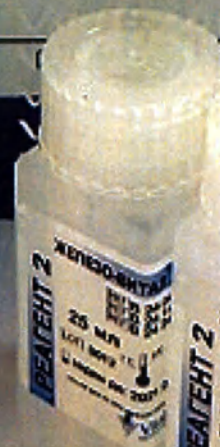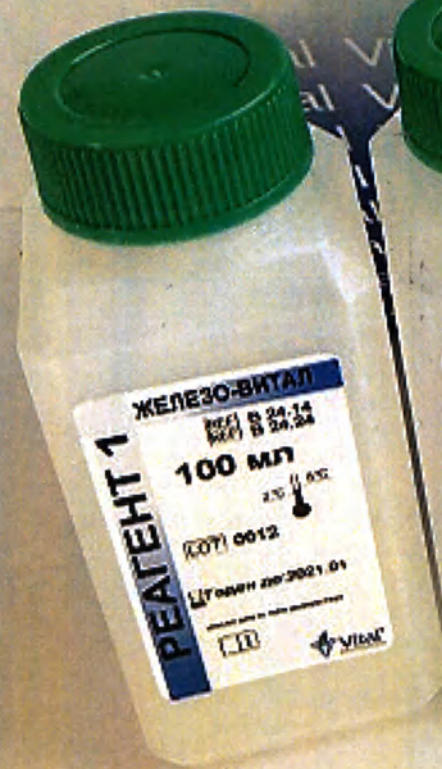



Vital Vital  
Vital Vital  
Vital Vital  
Vital Vital  
Vital Vital  
Vital Vital  
Vital Vital

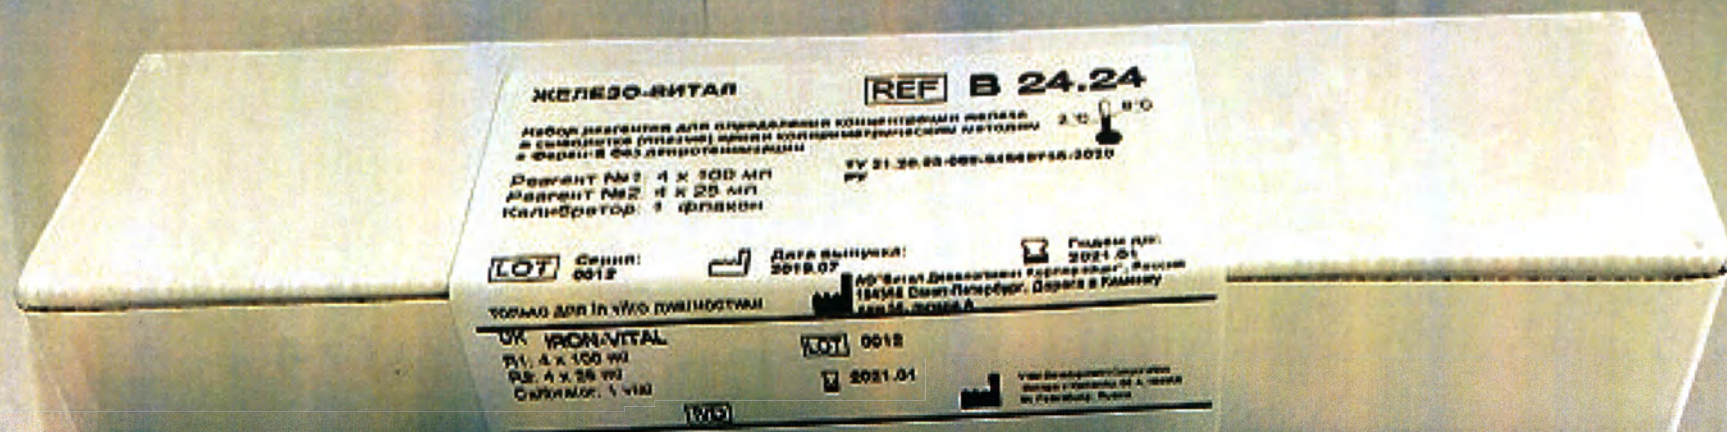

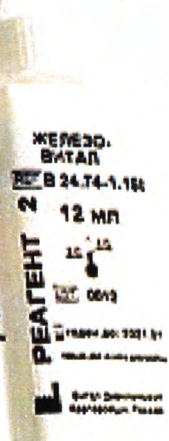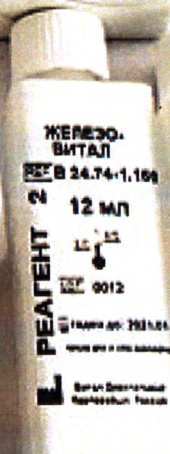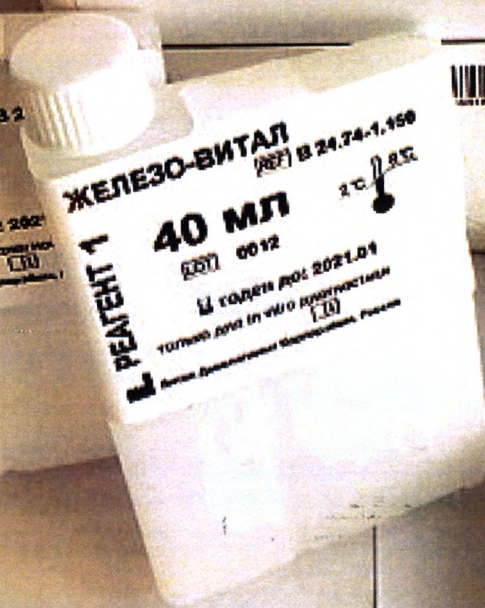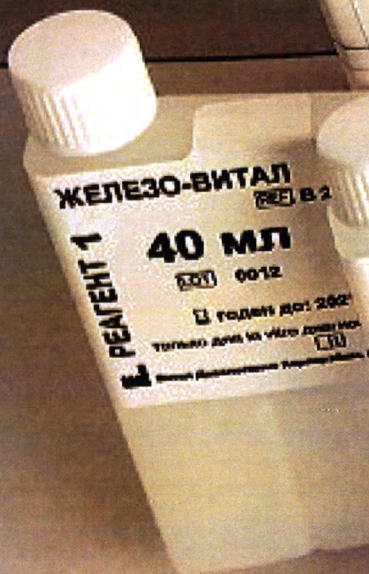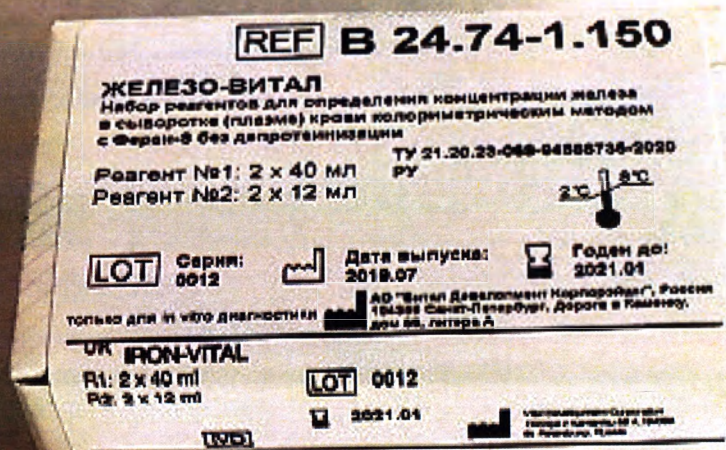





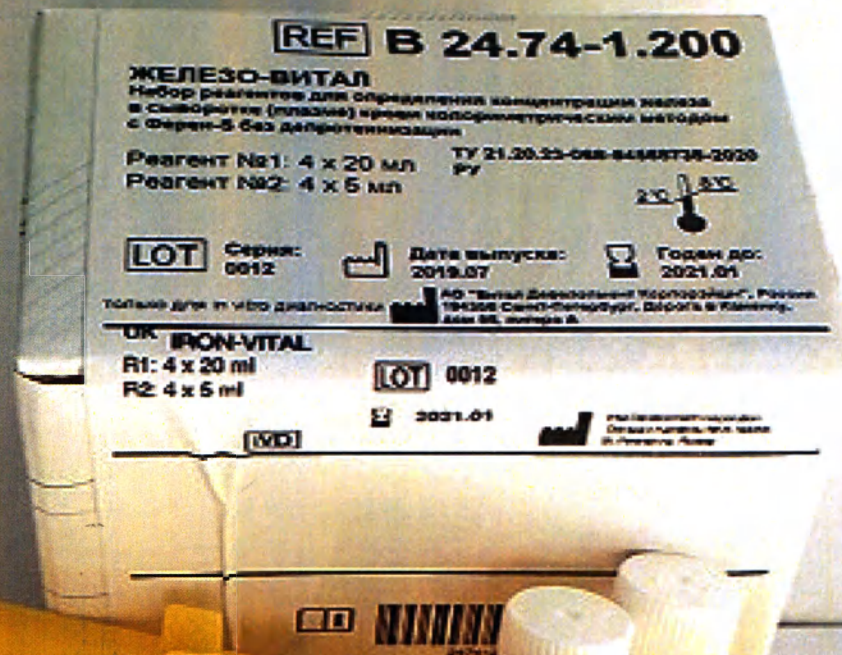

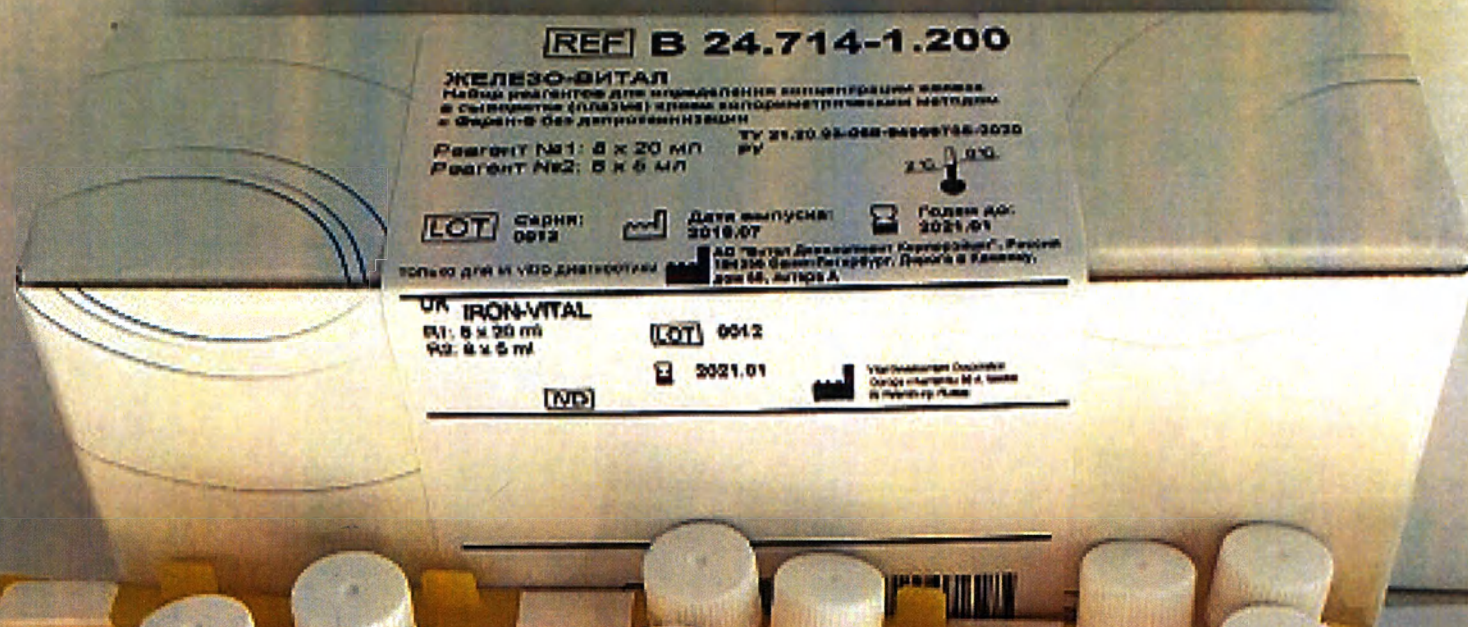





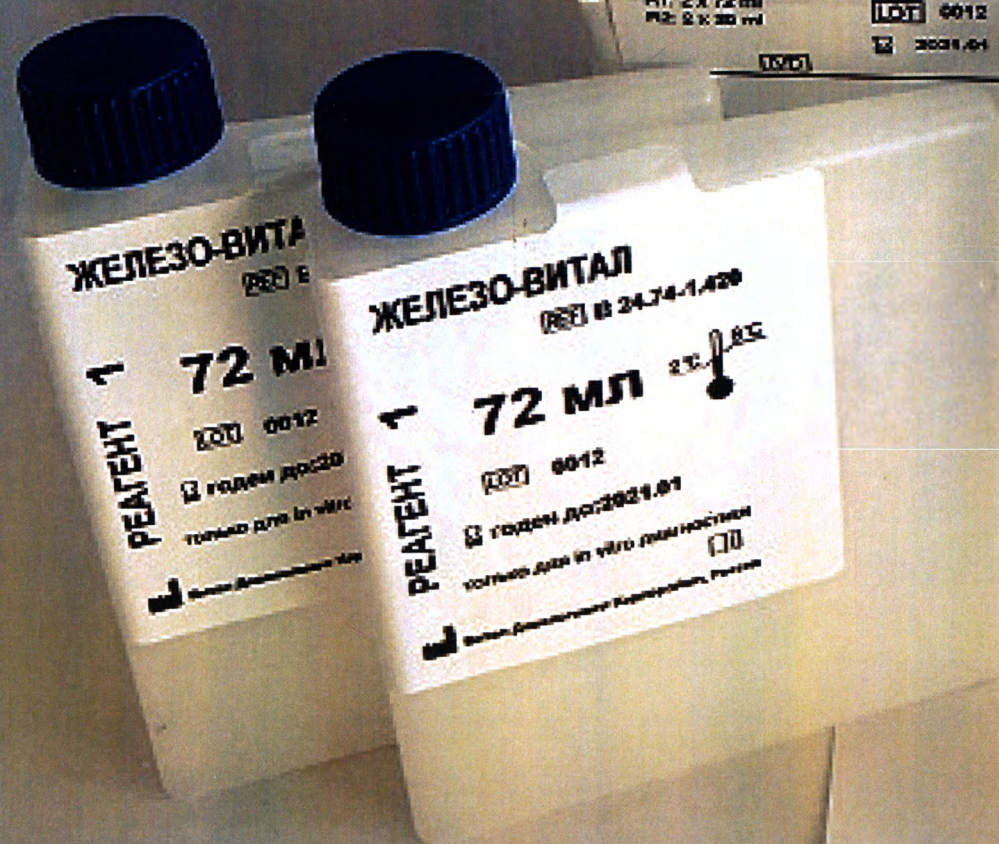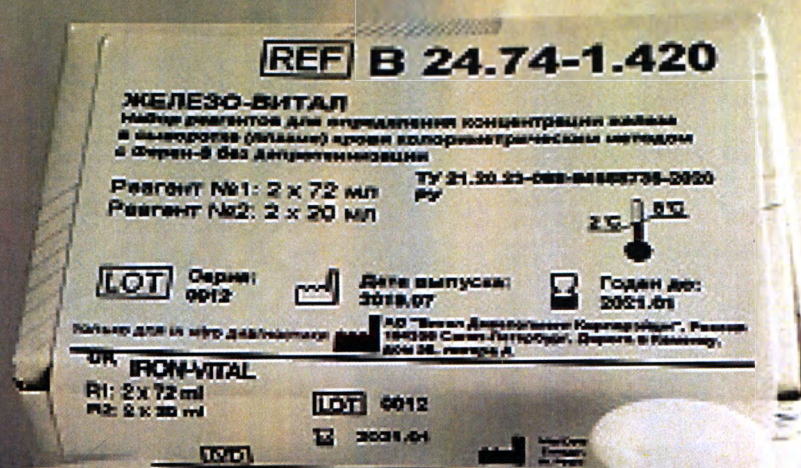

**REF В 24.714-1.420**

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**  
Набор реактивов для определения концентрации железа  
в биологических (плазма) жидкостях колориметрическим методом  
с ферри-Б без дигидрохлорида

Реагент №1: 4 x 72 мл  
Реагент №2: 4 x 20 мл

ТУ 24.30.33-088-9466738-0020  
РФ

LOT

Серия  
0012

Дата выпуска:  
2018.07

Годен до:  
2021.01

Годен до:  
2021.01

только для in vitro диагностики

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ  
№1: 4 x 72 мл  
№2: 4 x 20 мл

LOT 0012

2021.01

ТМД

Исследования проводятся  
в соответствии с инструкцией  
по применению

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**  
REF В 24.714-1.420

**72 МЛ**

LOT 0012

Годен до: 2021.01

только для in vitro диагностики

Исследования проводятся  
в соответствии с инструкцией  
по применению

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**  
REF В 24.714-1.420

**72 МЛ**

LOT 0012

Годен до: 2021.01

только для in vitro диагностики

Исследования проводятся  
в соответствии с инструкцией  
по применению

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**  
REF В 24.714-1.420

**20 МЛ**

LOT 0012

Годен до: 2021.01

только для in vitro диагностики

Исследования проводятся  
в соответствии с инструкцией  
по применению

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**  
REF В 24.714-1.420


**20 МЛ**

LOT 0012

Годен до: 2021.01

только для in vitro диагностики

Исследования проводятся  
в соответствии с инструкцией  
по применению

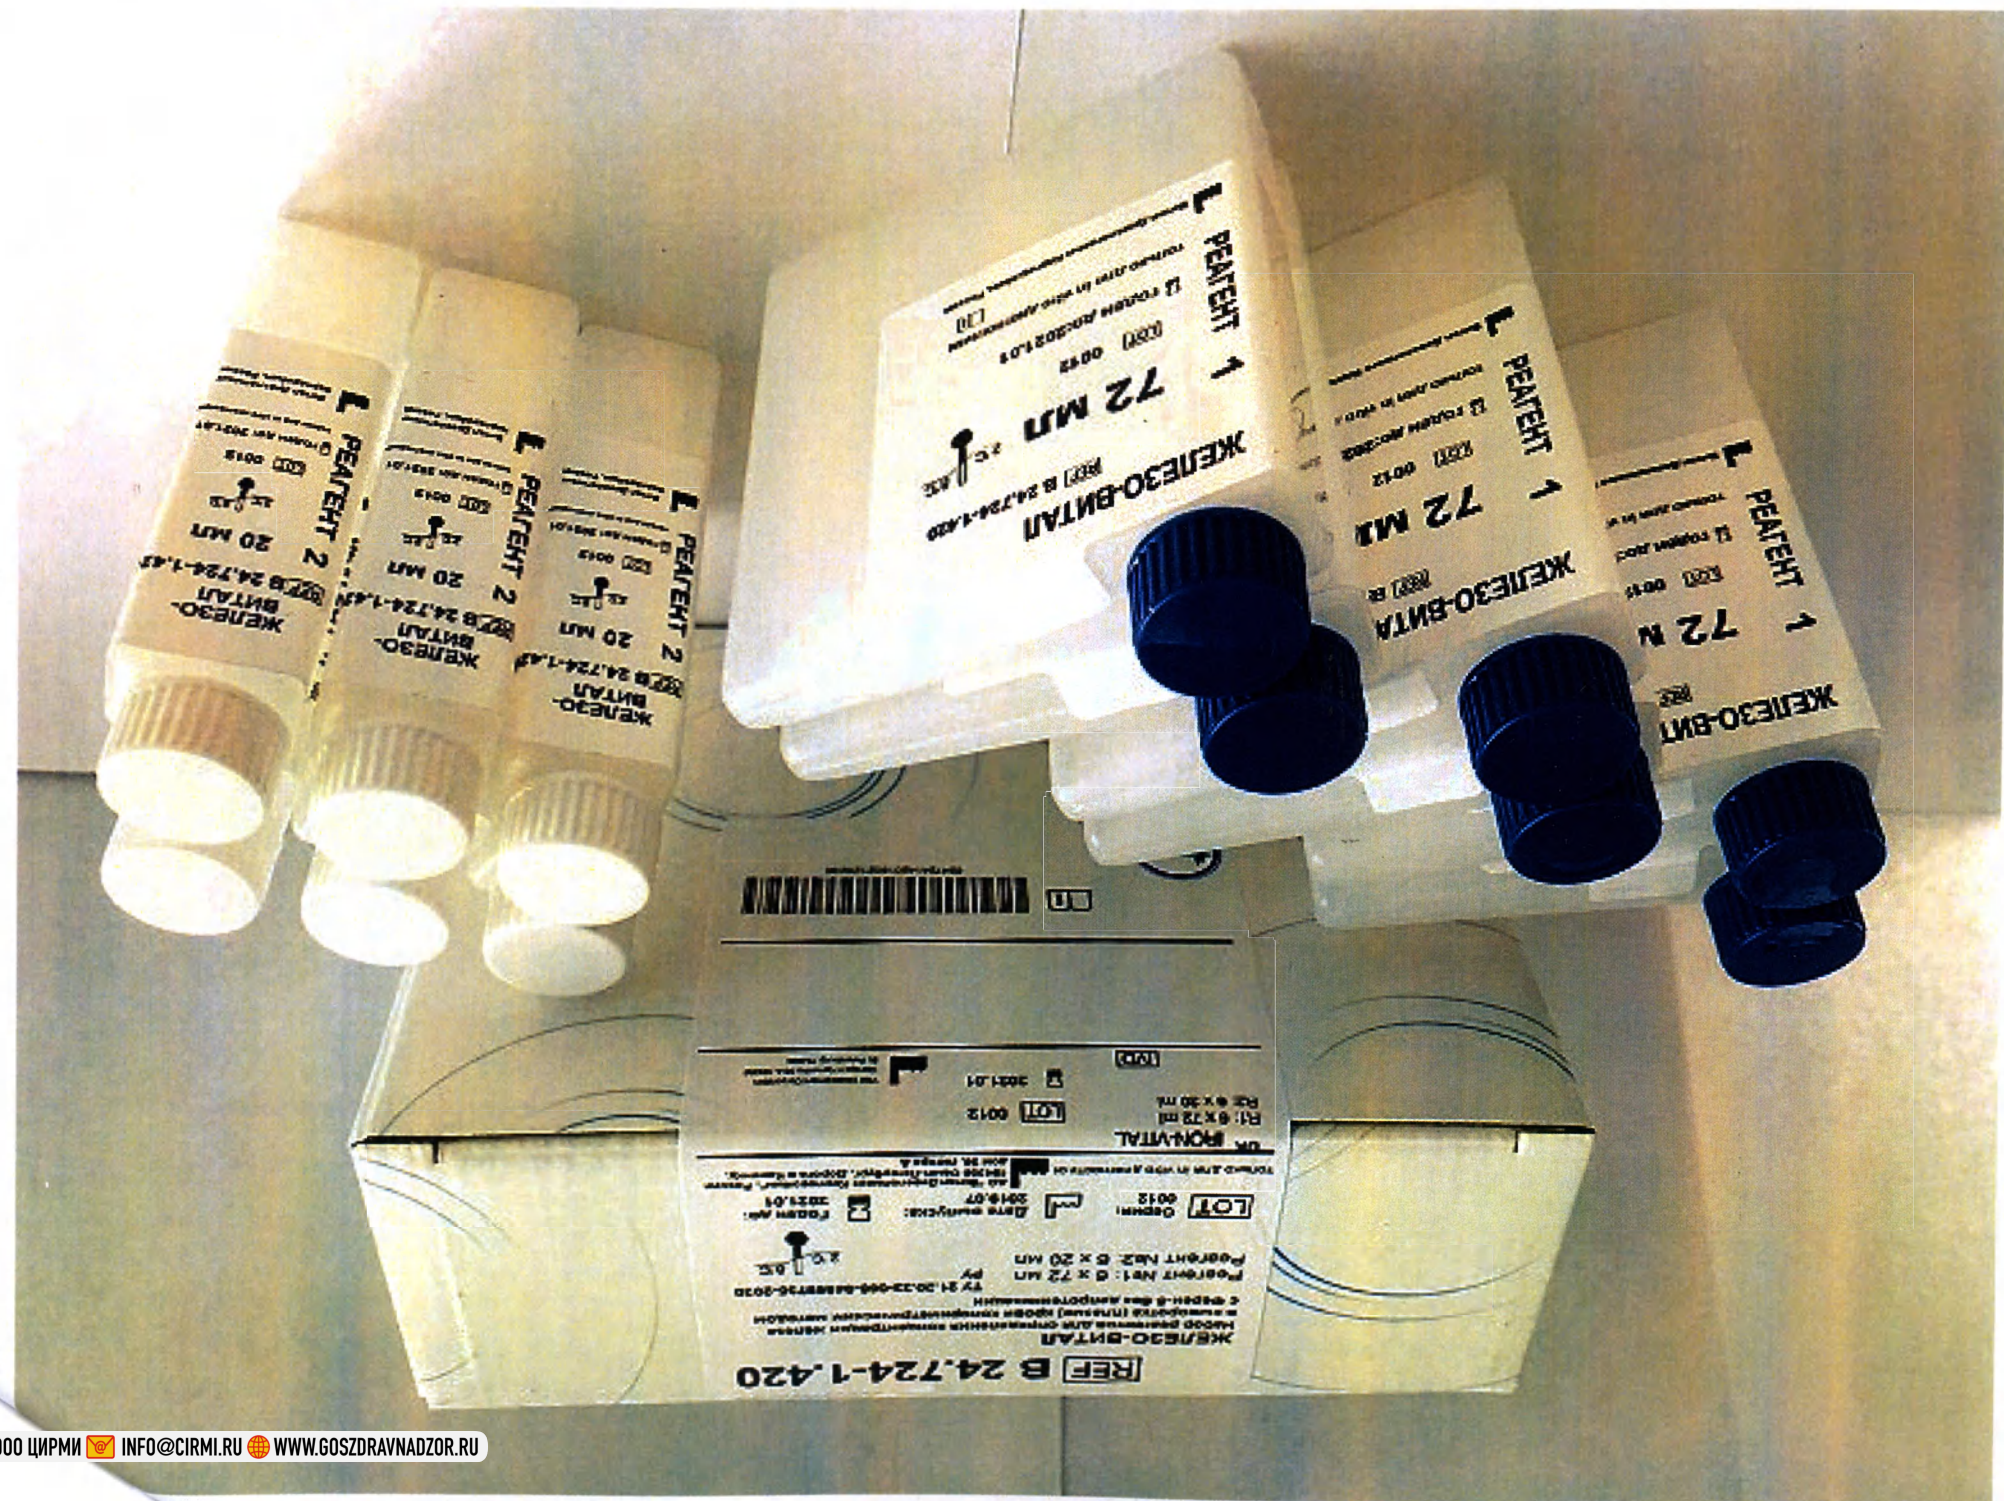

REF B 24.74-1.600

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с ферри-В без депротектирования

Реагент №1: 4 x 68 мл

Реагент №2: 4 x 20 мл

LOT

Серия: 0012



Дата выпуска: 2021.07



Годен до: 2021.01

Упаковка для in vitro диагностики

АО "Витал Диалогический Корпорейшн", Россия  
194306 Санкт-Петербург, Девятая линия, д. 10, литера А

UK IRON-VITAL

Kit: 4 x 68 ml

Re: 4 x 20 ml

LOT 0012

2021.01

For Information Only  
Not for Clinical Use

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.74-1.600

РЕАГЕНТ 1

**68 МЛ**

LOT 0012

Годен до: 2021.01

Упаковка для in vitro диагностики

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.74-1.600

РЕАГЕНТ 1

**68 МЛ**

LOT 0012

Годен до: 2021.01

Упаковка для in vitro диагностики

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.74-1.600

РЕАГЕНТ 2

**20 МЛ**

LOT 0012

Годен до: 2021.01

**ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ**

REF B 24.74-1.600


РЕАГЕНТ 2


**20 МЛ**

LOT 0012

Годен до: 2021.01



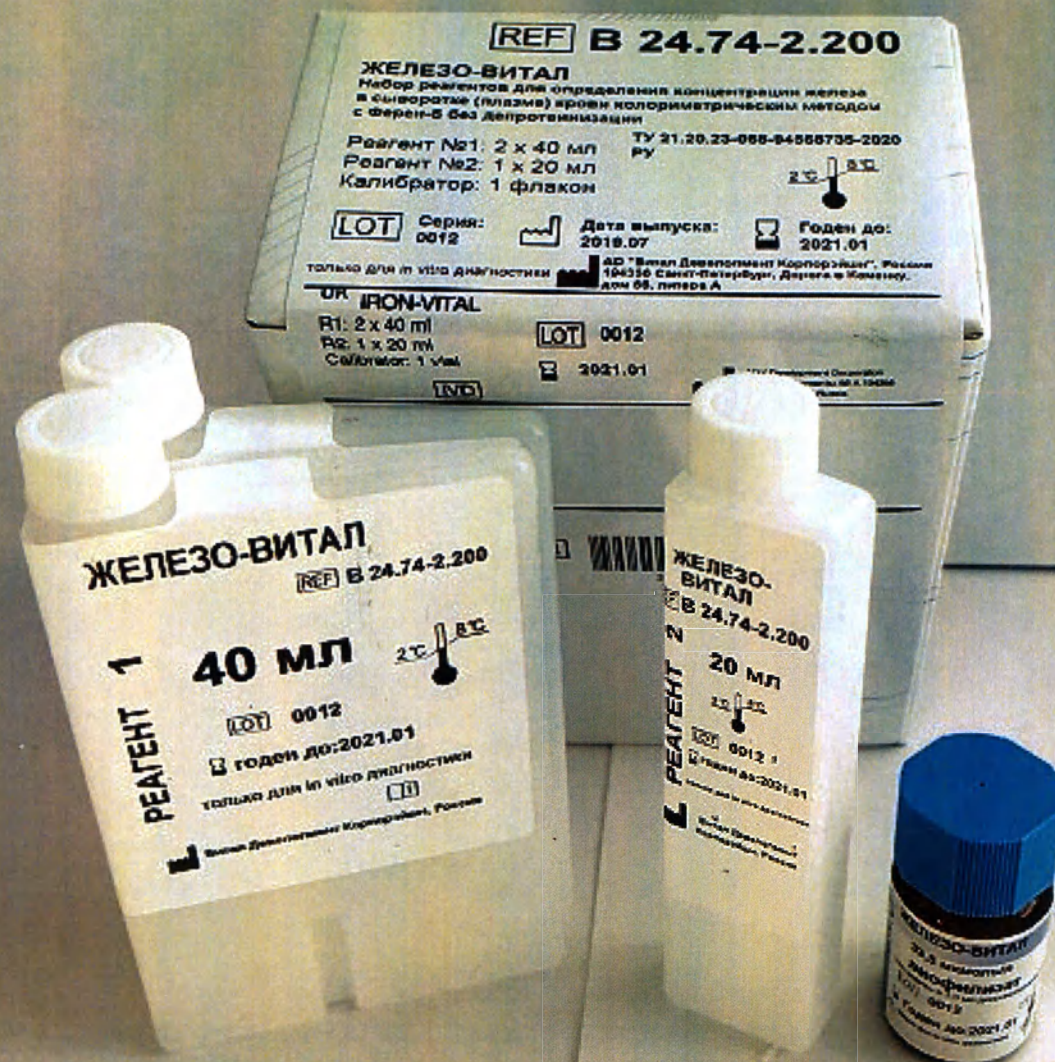

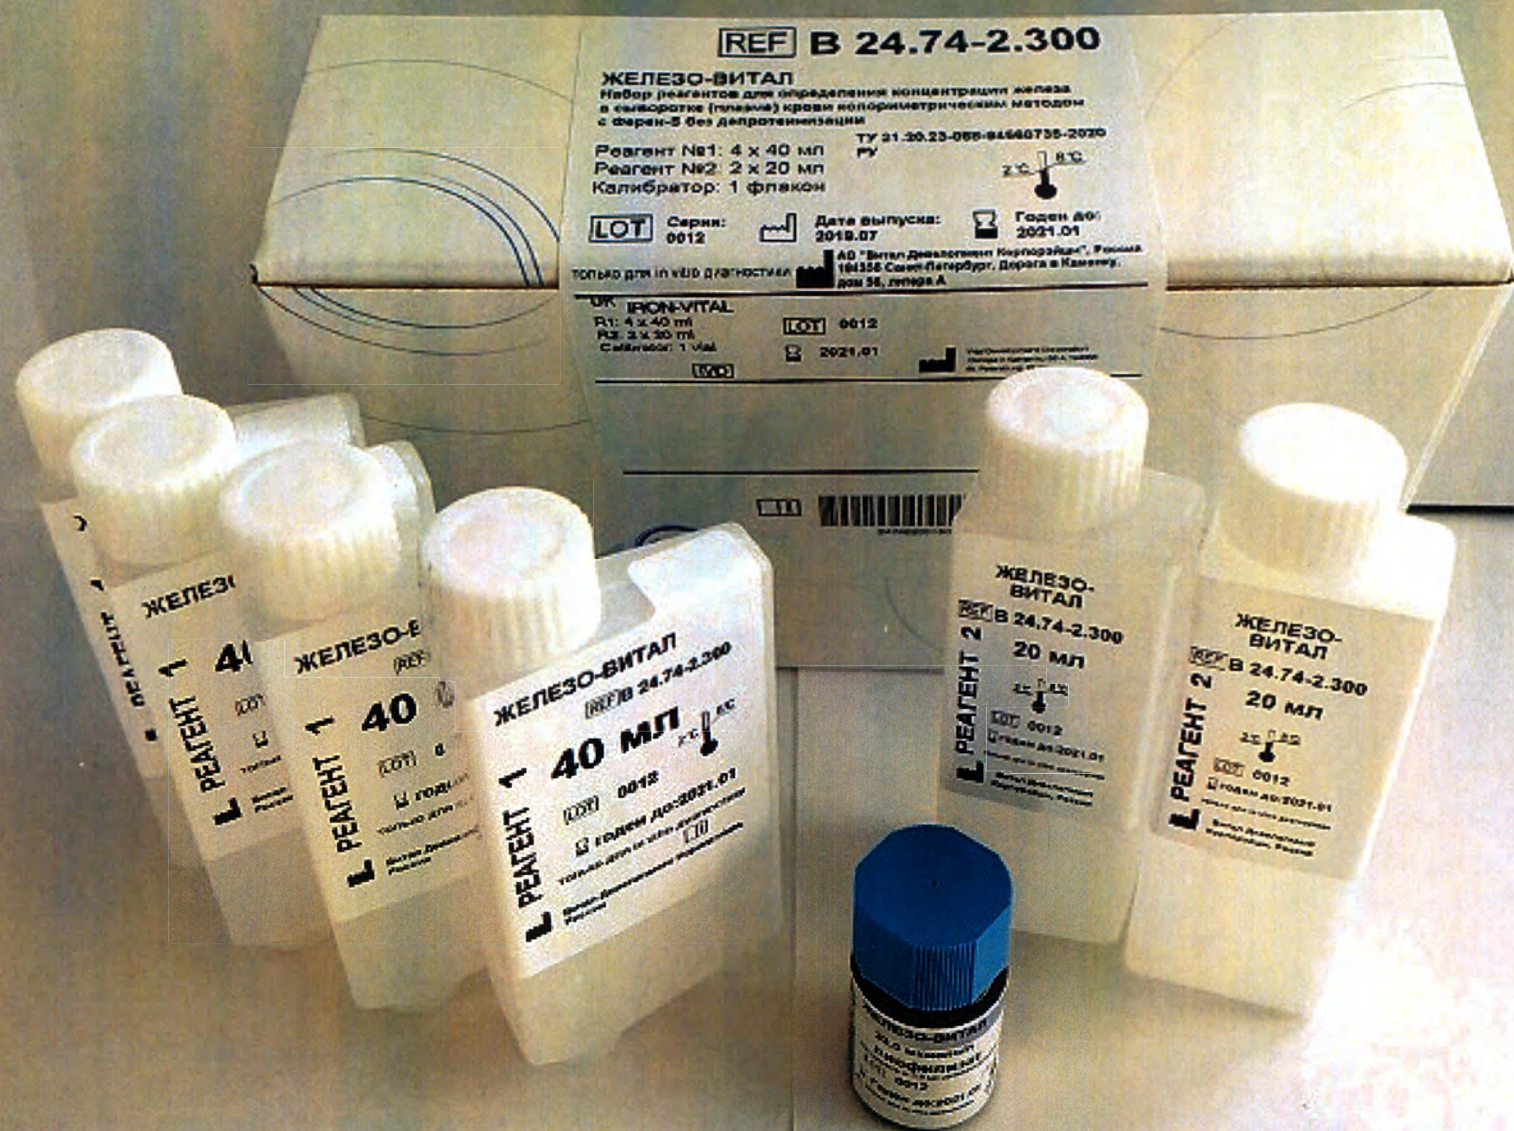

Прошито, пронумеровано,  
и скреплено печатью



17

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.