

Руководитель направления по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
«ООО «Сименс Здравоохранение»



Чигринец Е.А.
2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Набор реагентов для определения раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимических
серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic Antigen (Atellica IM CEA))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностика Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

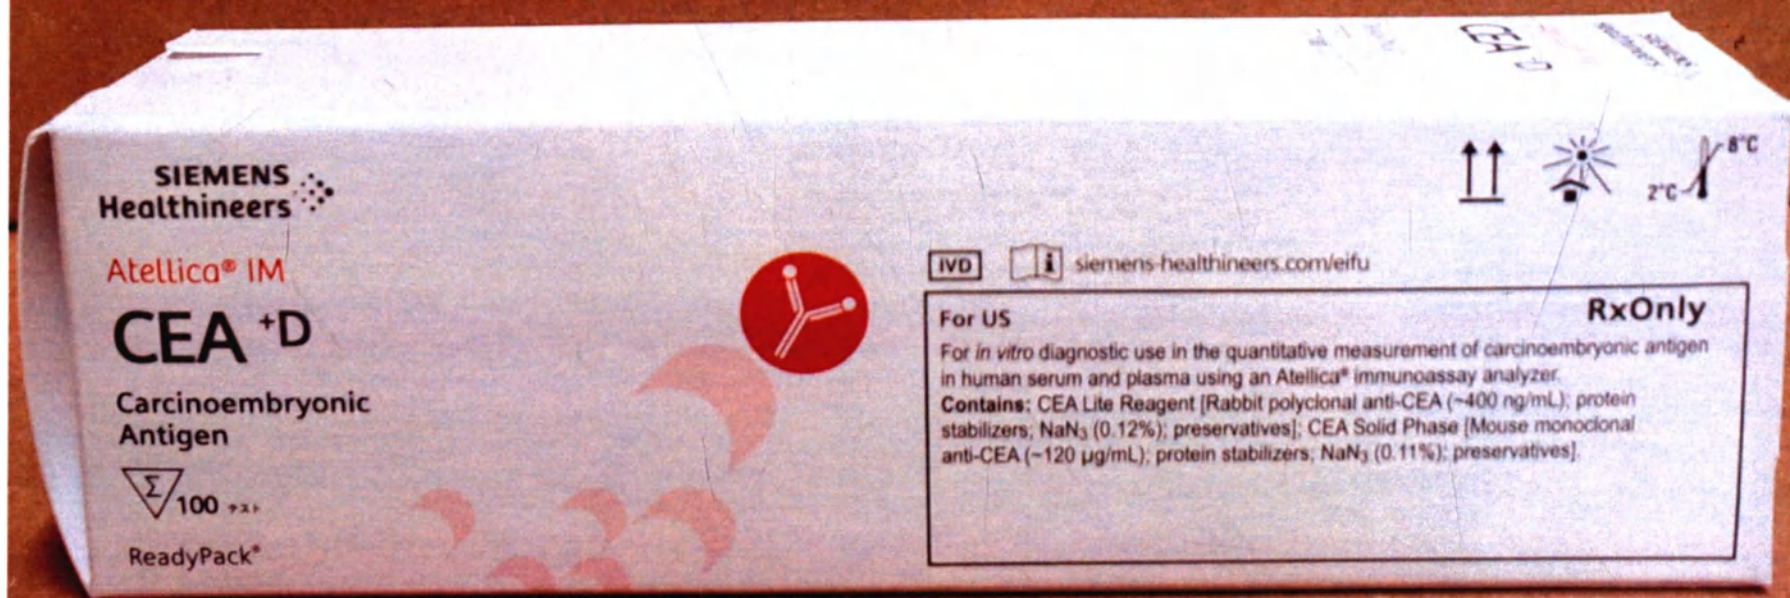


Рисунок 1. Набор реагентов для определения раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic

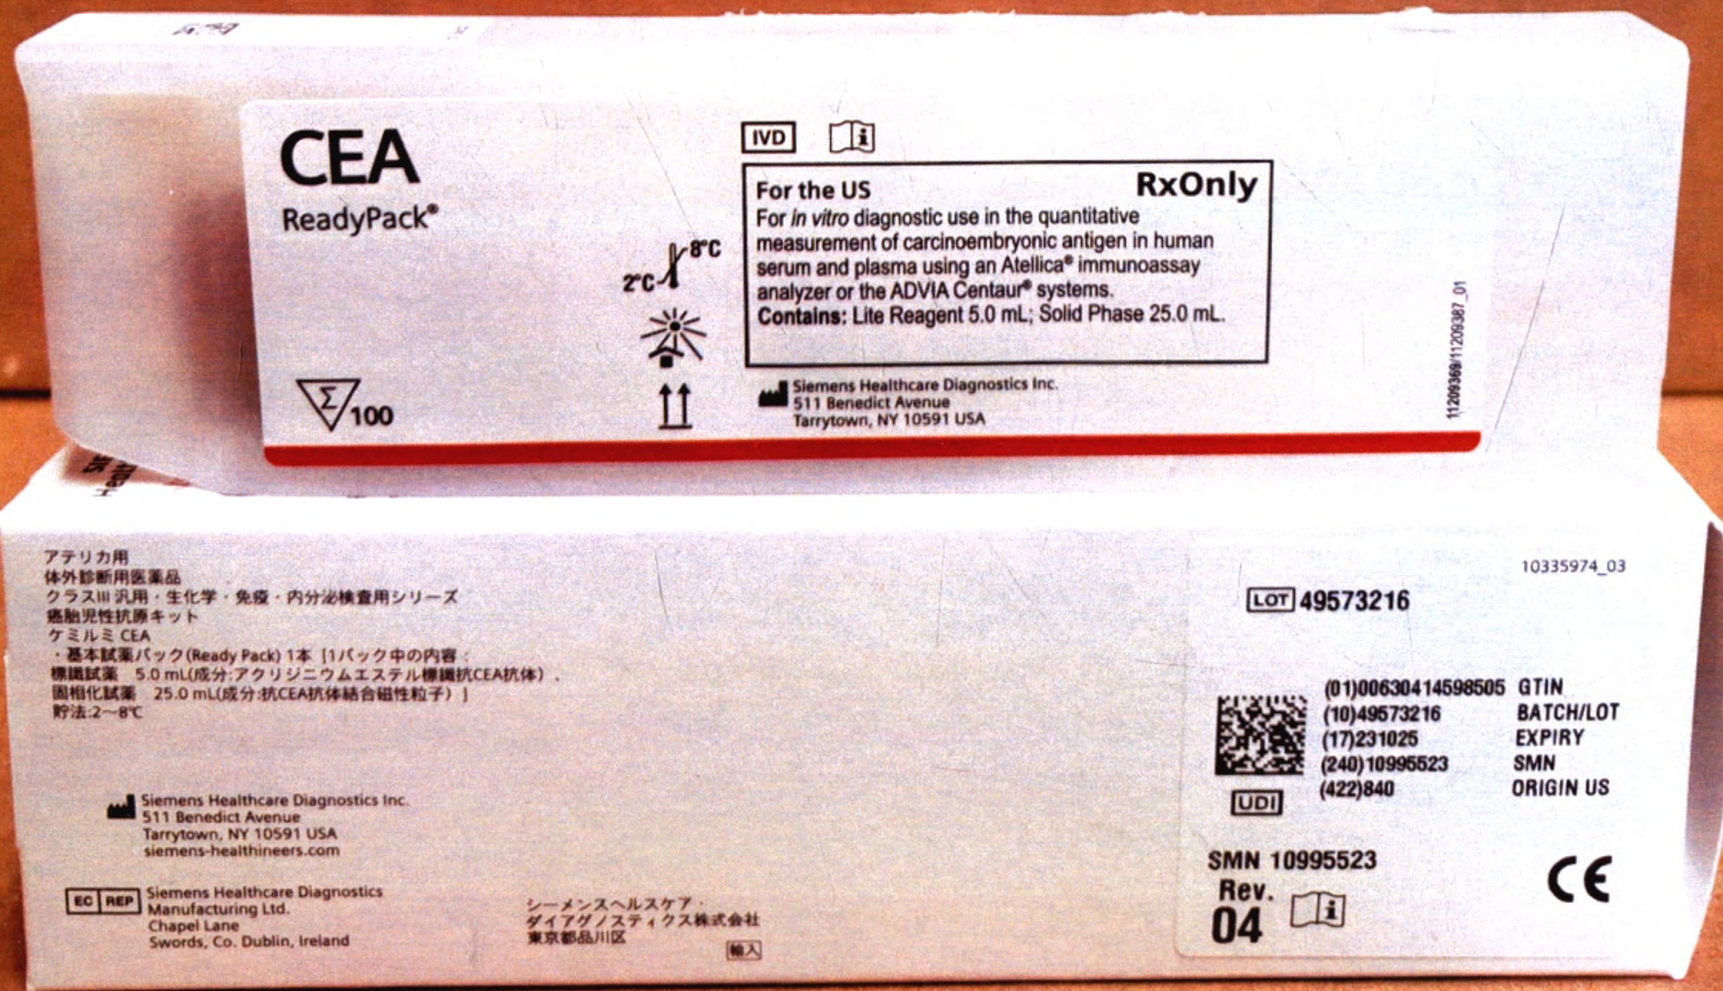


Рисунок 2. Набор реагентов для определения раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic



Рисунок 3. Набор реагентов для определения раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic


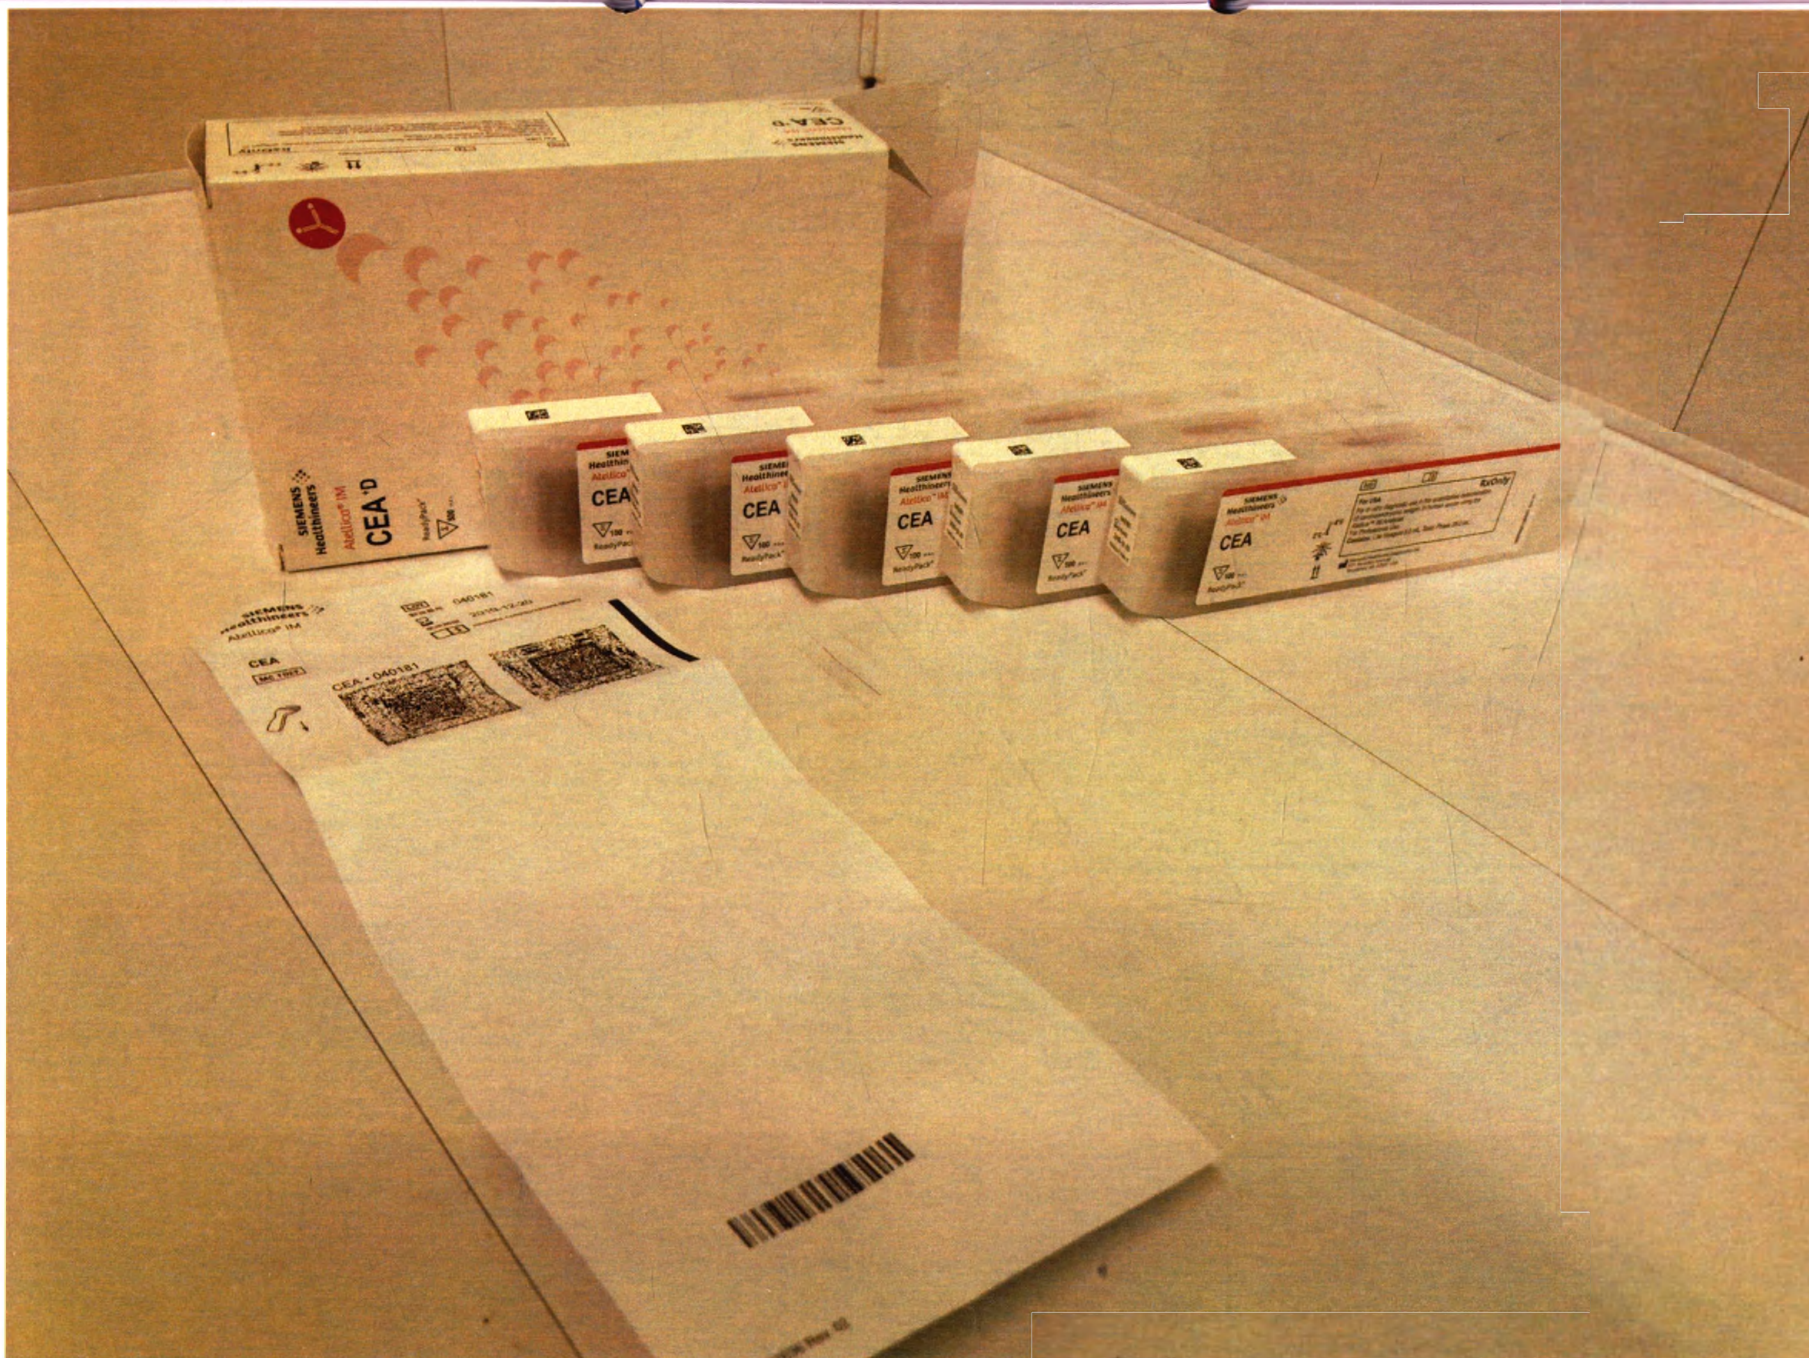


Рисунок 4. Набор реагентов для определения раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic

CEA

ReadyPack®



IVD



For the US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use in the quantitative measurement of carcinoembryonic antigen in human serum and plasma using an Atellica® immunoassay analyzer or the ADVIA Centaur® systems.


Contains: Lite Reagent 5.0 mL; Solid Phase 25.0 mL.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA

11209369/11209387_01

CEA

ReadyPack®



IVD



For the US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use in the quantitative measurement of carcinoembryonic antigen in human serum and plasma using an Atellica® immunoassay analyzer or the ADVIA Centaur® systems.

Contains: Lite Reagent 5.0 mL; Solid Phase 25.0 mL.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA

11209369/11209387_01

Рисунок 5. Набор реагентов для определения раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic



Рисунок 6. Набор реагентов для определения раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимической серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic Antigen (Atellica IM CEA)); 2. Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM CEA

10995523

Набор реагентов для определения раково-
эмбрионального антигена на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM
Carcinoembryonic Antigen (Atellica IM CEA))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2020/12255 от 14.10.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

10995524

Набор реагентов для определения раково-
эмбрионального антигена на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM
Carcinoembryonic Antigen (Atellica IM CEA))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2020/12255 от 14.10.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96



Всего прошито и пронумеровано
9 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

