


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов

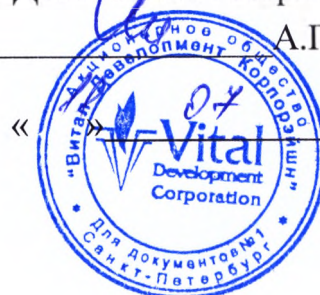

2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина
в сыворотке крови дихлоранилиновым методом
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-086-94568735-2020**

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF B 03.08

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 1 x 100 мл
Реагент №2: 1 x 25 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-086-94568735-2020
РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

LOT Серия:
0016



Дата выпуска:
2023.01



Годен до:
2024.07

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 55, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 1 x 100 ml

R2: 1 x 25 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0016

2024.07

Vita Development Corporation
Doroga v Kamenuk 55 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



03082301180016

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF B 03.08

РЕАГЕНТ 1

100 мл



LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF B 03.08

РЕАГЕНТ 2

25 мл



LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

49,6 мкмоль/л
растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016



Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.18

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.



Реагент №1: 2 x 84 мл
Реагент №2: 1 x 42 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-086-94568735-2020
РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

LOT Серия:
0016



Дата выпуска:
2023.01



Годен до:
2024.07

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194355 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 2 x 84 ml

LOT 0016



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A, 194355
St. Petersburg, Russia

R2: 1 x 42 ml

2024.07

Calibrator: 1 vial

IVD



03182301160016

БИЛУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.18

РЕАГЕНТ 1

84 мл



LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.18

РЕАГЕНТ 1

84 мл



LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.18

РЕАГЕНТ 2

42 мл



LOT 0016

Годен до: 2024.07



БИЛУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

49,6 мкмоль/л

растворить в 1,0 мл

дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016




Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF B 03.28

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.



Реагент №1: 1 x 240 мл
Реагент №2: 1 x 60 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-086-94568735-2020
РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

LOT Серия: 0016 Дата выпуска: 2023.01 Годен до: 2024.07
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

LOT 0016

R1: 1 x 240 ml

R2: 1 x 60 ml

Calibrator: 1 vial

IVD



03282301160016

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF B 03.28 REF B 03.48

РЕАГЕНТ 1

240 мл

LOT 0016



Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF B 03.28 REF B 03.48

РЕАГЕНТ 2

60 мл

LOT 0016



Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

49,6 мкмоль/л

растворить в 1,0 мл дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016




годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.38

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.



Реагент №1: 2 x 205 мл
Реагент №2: 2 x 50 мл
Калибратор: 2 флакона

ТУ 21.20.23-086-94568735-2020
РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

LOT Серия: 0016 Дата выпуска: 2023.01 Годен до: 2024.07
только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку дом 56, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL LOT 0016

R1: 2 x 205 ml
R2: 2 x 50 ml
Calibrator: 2 vials

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



03382210150015

БИЛУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.38

РЕАГЕНТ 1

205 мл

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.38

РЕАГЕНТ 1

205 мл

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.38

РЕАГЕНТ 2

50 мл

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.38

РЕАГЕНТ 2

50 мл

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

49,6 мкмоль/л
растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

49,6 мкмоль/л
растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016


Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.48

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.



Реагент №1: 2 x 240 мл
Реагент №2: 2 x 60 мл
Калибратор: 2 флакона

ТУ 21.20.23-086-94568735-2020
РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

LOT Серия: 0016 Дата выпуска: 2023.01 Годен до: 2024.07
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 2 x 240 ml

R2: 2 x 60 ml

Calibrator: 2 vials

LOT 0016

2024.07

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



03482301160016

БИЛУРИБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.28 REF В 03.48

РЕАГЕНТ 1

240 мл



LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУРИБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.28 REF В 03.48

РЕАГЕНТ 1

240 мл



LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУРИБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.28 REF В 03.48

РЕАГЕНТ 2

60 мл



LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУРИБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ REF В 03.28 REF В 03.48

РЕАГЕНТ 2

60 мл



LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУРИБИН ПРЯМОЙ-КАЛИБРАТОР ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л
растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



БИЛУРИБИН ПРЯМОЙ-КАЛИБРАТОР ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л
растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



REF B 03.78-1.150

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 4 x 40 мл

ТУ 21.20.23-086-94568735-2020

Реагент №2: 4 x 12 мл

РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

Калибратор: 1 флакон

LOT Серия:
0016



Дата выпуска:
2023.01



Годен до:
2024.07

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 4 x 40 ml

R2: 4 x 12 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0016

2024.07

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



93732301160016

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.150

40 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.150

40 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.150

40 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л

растворить в 1,0 мл

дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.150

40 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 1

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.150

12 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.150

12 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.150

12 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.150

12 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2

REF В 03.78-1.200

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 4 x 20 мл
 Реагент №2: 4 x 5 мл
 Калибратор: 1 флакон

Серия: 0016
 Дата выпуска: 2023.01
 Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики
 АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 4 x 20 ml

R2: 4 x 5 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0016

2024.07

IVD

Vital Development Corporation
 Doroga v Kamenu 56 A 194356
 St. Petersburg, Russia

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.78-1.200
 20 мл
 LOT 0016
 годен до: 2024.07
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.78-1.200
 20 мл
 LOT 0016
 годен до: 2024.07
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.78-1.200
 20 мл
 LOT 0016
 годен до: 2024.07
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.78-1.200
 20 мл
 LOT 0016
 годен до: 2024.07
 только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.78-1.200
 5 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.78-1.200
 5 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л
 растворить в 1,0 мл дистиллированной воды
 лиофилизат
 LOT 0016
 годен до: 2024.07
 только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.78-1.200
 5 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.78-1.200
 5 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 03.718-1.200

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
прямого билирубина в сыворотке крови
дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 8 x 20 мл ТУ 21.20.23-086-94568735-2020
Реагент №2: 8 x 5 мл РЗН 2020/12229 от 08.10.2020
Калибратор: 1 флакон

LOT Серия: 0016 Дата выпуска: 2023.01 Годен до: 2024.07
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 8 x 20 ml R2: 8 x 5 ml
Calibrator: 1 vial

IVD

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.200

РЕАГЕНТ 1 20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.200

РЕАГЕНТ 2 5 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.200

РЕАГЕНТ 2 5 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

5 мл REF В 03.718-1.200

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

5 мл REF В 03.718-1.200

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

5 мл REF В 03.718-1.200

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

5 мл REF В 03.718-1.200

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

5 мл REF В 03.718-1.200

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

БИЛИРУБИН-ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

5 мл REF В 03.718-1.200

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л

растворить в 1,0 мл дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF B 03.78-1.300

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 3 x 52 мл

ТУ 21.20.23-086-94568735-2020

Реагент №2: 3 x 15 мл

РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

Калибратор: 1 флакон

LOT

Серия:
0016Дата выпуска:
2023.01Годен до:
2024.07

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 3 x 52 ml

R2: 3 x 15 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0016

2024.07

IVD

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF B 03.78-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, РоссияБИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF B 03.78-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, РоссияБИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF B 03.78-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, РоссияБИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ49,6 мкмоль/л
растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР



REF В 03.718-1.300

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 6 x 52 мл
Реагент №2: 6 x 15 мл
Калибратор: 2 флакона

Серия: 0016
Дата выпуска: 2023.01
Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 6 x 52 ml
R2: 6 x 15 ml
Calibrator: 2 vials

LOT 0016

годен до: 2024.07

IVD

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

52 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

52 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

52 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

52 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

15 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

52 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

52 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

15 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл

2°C 8°C
LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл

2°C 8°C
LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл

2°C 8°C
LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.718-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл

2°C 8°C
LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

КАЛИБРАТОР
БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л

растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016 2°C 8°C

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР
БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л

растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016 2°C 8°C

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



REF B 03.78-1.420

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 2 x 72 мл
Реагент №2: 2 x 20 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-086-94568735-2020
РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

Серия: 0016
Дата выпуска: 2023.01
Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 2 x 72 мл
R2: 2 x 20 мл
Calibrator: 1 vial

Lot 0016
2024.07

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuki 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл
Lot 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл
Lot 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



93762301160016

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF B 03.78-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл
Lot 0016
годен до: 2024.07
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF B 03.78-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл
Lot 0016
годен до: 2024.07
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л
растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды
лиофилизат

Lot 0016
годен до: 2024.07
только для in vitro диагностики



REF В 03.718-1.420

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 4 x 72 мл
Реагент №2: 4 x 20 мл
Калибратор: 2 флакона

Серия: 0016
Дата выпуска: 2023.01
Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 4 x 72 мл
R2: 4 x 20 мл
Calibrator: 2 vials

LOT 0016

2024.07

IVD



93972301180016



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л

растворить в 1,0 мл

дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Vital Development

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л

растворить в 1,0 мл

дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Vital Development

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 03.728-1.420

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 6 x 72 мл ТУ 21.20.23-086-94568735-2020
Реагент №2: 6 x 20 мл РЗН 2020/12229 от 08.10.2020
Калибратор: 2 флакона

LOT

Серия:
0016Дата выпуска:
2023.01Годен до:
2024.07

только для in vitro диагностики

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 6 x 72 ml

R2: 6 x 20 ml

Calibrator: 2 vials

LOT

0016



2024.07

IVD

Vital Development Corporation
Dorogoy v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT

0016

годен до:2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT

0016

годен до:2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT

0016

годен до:2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT

0016

годен до:2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT

0016

годен до:2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT

0016

годен до:2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

РЕАГЕНТ 1

72 мл



LOT

0016

годен до:2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

РЕАГЕНТ 2

20 мл



LOT

0016

годен до:2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

20 мл

2C

8°C

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорация, Россия



БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

20 мл

2C

8°C

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорация, Россия



БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

20 мл

2C

8°C

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорация, Россия



БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.728-1.420

20 мл

2C

8°C

LOT 0016



годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорация, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ
49,6 мкмоль/л
растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды
лиофилизат
LOT 0016
годен до: 2024.07
только для in vitro диагностики

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ
49,6 мкмоль/л
растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды
лиофилизат
LOT 0016
годен до: 2024.07
только для in vitro диагностики



REF B 03.78-2.200

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 4 x 20 мл ТУ 21.20.23-086-94568735-2020

Реагент №2: 1 x 20 мл РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

Калибратор: 1 флакон

Серия: 0016
Дата выпуска: 2023.01
Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 4 x 20 ml

R2: 1 x 20 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0016

2024.07

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л

растворить в 1,0 мл

дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

!

Vital Development

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.200

РЕАГЕНТ 2

20 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 03.718-2.200

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 4 x 35 мл

ТУ 21.20.23-086-94568735-2020

Реагент №2: 2 x 18 мл

РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

Калибратор: 1 флакон



LOT

Серия:
0016Дата выпуска:
2023.01Годен до:
2024.07

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 4 x 35 ml

R2: 2 x 18 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0016

годен до: 2024.07

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

93961802120230



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.718-2.200

РЕАГЕНТ 2

18 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ

REF В 03.718-2.200

РЕАГЕНТ 2

18 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-2.200

РЕАГЕНТ 1

35 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ49,6 мкмоль/л
растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР



REF B 03.78-2.300

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 4 x 32 мл ТУ 21.20.23-086-94568735-2020

Реагент №2: 4 x 8 мл РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

Калибратор: 1 флакон



LOT

Серия: 0016



Дата выпуска: 2023.01



Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 4 x 32 ml

R2: 4 x 8 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0016

2024.07

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kamensk, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



937811501802120230



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.300

РЕАГЕНТ 1

32 мл

LOT

0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.300

РЕАГЕНТ 1

32 мл

LOT

0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.300

РЕАГЕНТ 1

32 мл

LOT

0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.300

РЕАГЕНТ 1

32 мл

LOT

0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.300

РЕАГЕНТ 2

8 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.300

РЕАГЕНТ 2

8 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л

растворить в 1,0 мл
дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.300

РЕАГЕНТ 2

8 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF B 03.78-2.300

РЕАГЕНТ 2

8 мл

LOT 0016

годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



REF В 03.718-2.300

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 4 x 38 мл
 Реагент №2: 2 x 20 мл
 Калибратор: 1 флакон

LOT Серия:
0016

Дата выпуска:
2023.01

Годен до:
2024.07

только для in vitro диагностики
 АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
 дом 55, литера А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 4 x 38 ml

R2: 2 x 20 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0016

Годен до:
2024.07

IVD

Vital Development Corporation
 Doroga v Kamenu 55 A, 194356
 St. Petersburg, Russia



93952207130013



БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-2.300

РЕАГЕНТ 1 38 мл

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
 Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-2.300

РЕАГЕНТ 1 38 мл

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
 Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-2.300

РЕАГЕНТ 1 38 мл

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
 Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-2.300

РЕАГЕНТ 1 38 мл

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
 Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-2.300

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
 Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

REF В 03.718-2.300

РЕАГЕНТ 2 20 мл

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
 Корпорэйшн, Россия

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

49,6 мкмоль/л
 растворить в 1,0 мл
 дистиллированной воды

лиофилизат

LOT 0016

Годен до: 2024.07

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
 Корпорэйшн, Россия

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего _____ листа(ов)

Исполнитель директор

Плехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»


А.Г.Плехов



2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ



**Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина
в сыворотке крови дихлоранилиновым методом
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-086-94568735-2020**

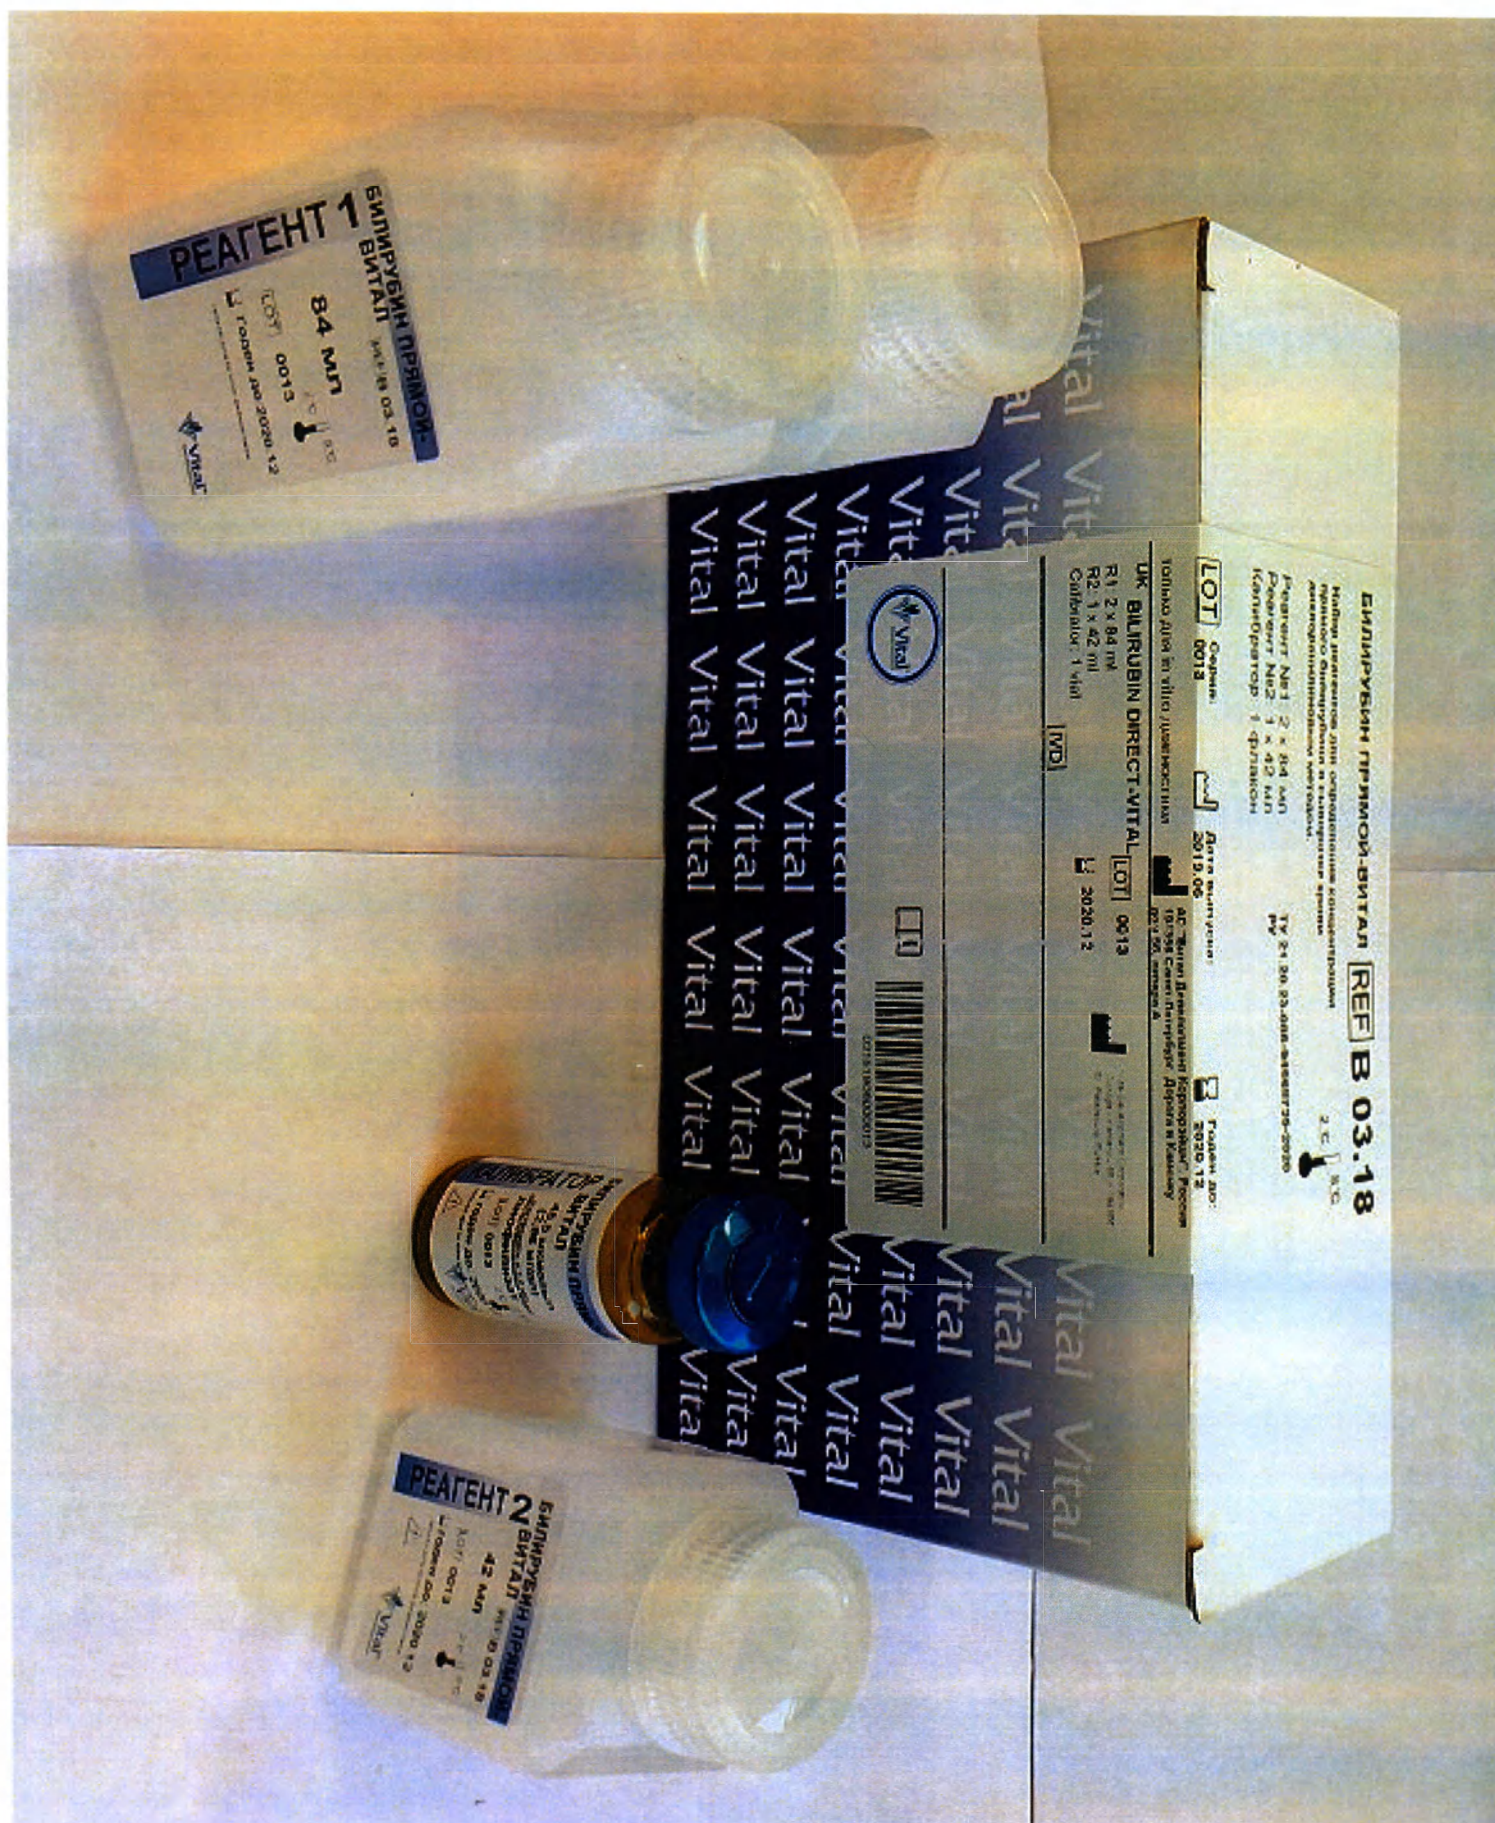






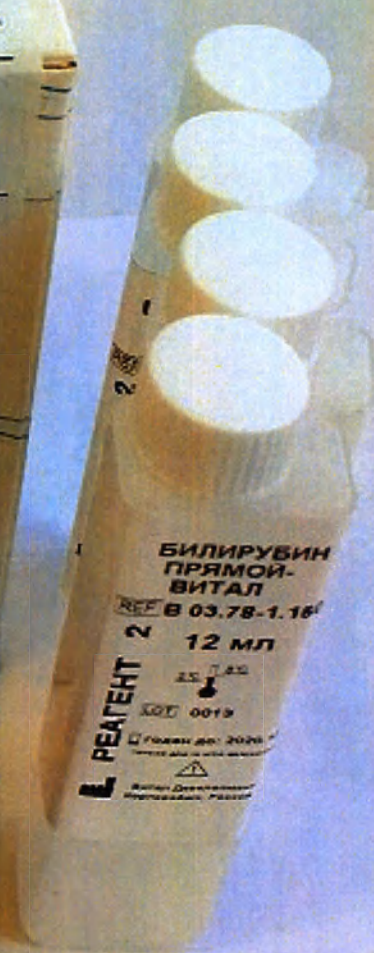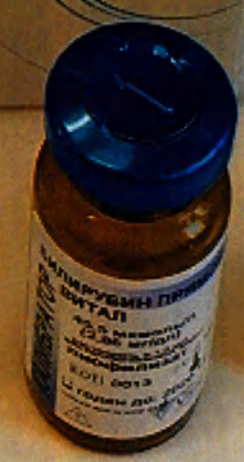

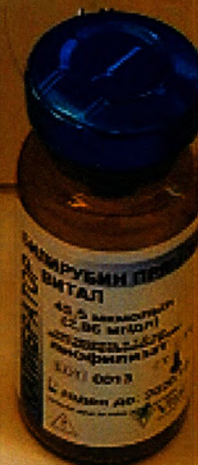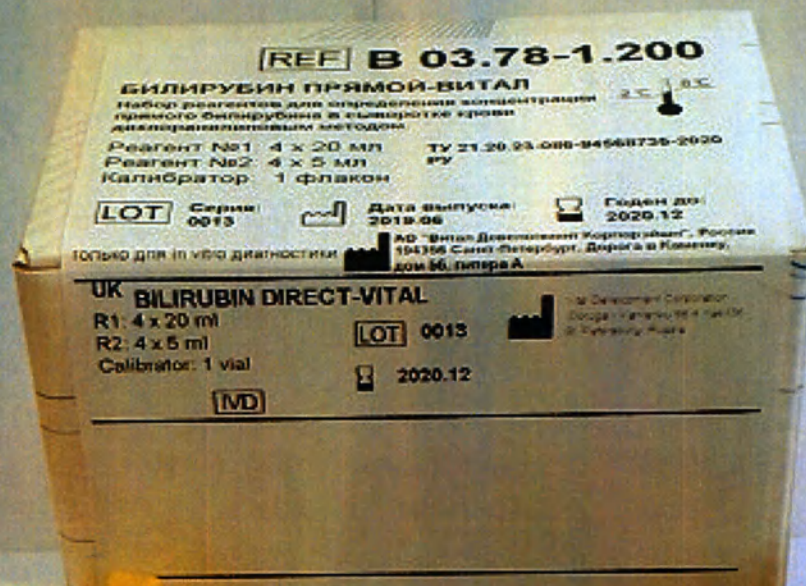



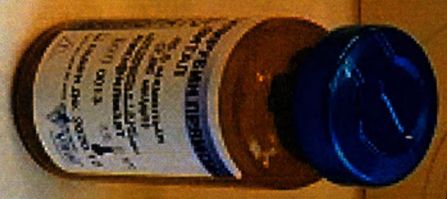




БИПИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ
REF B 03.718-1.200

Анализатор: БИПИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ
Производитель: ООО "Цирми", Россия
Срок годности: 2 года
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °С
Состав: БИПИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ, Вода дистиллированная
Содержимое: 1 флакон 20 мл

DR. BIPIRUBIN DIRECT-VITAL
R1: 8 x 20 ml
R2: 5 x 5 ml
Calculator: 1 ml

LOT 0013
EXP 2020-12

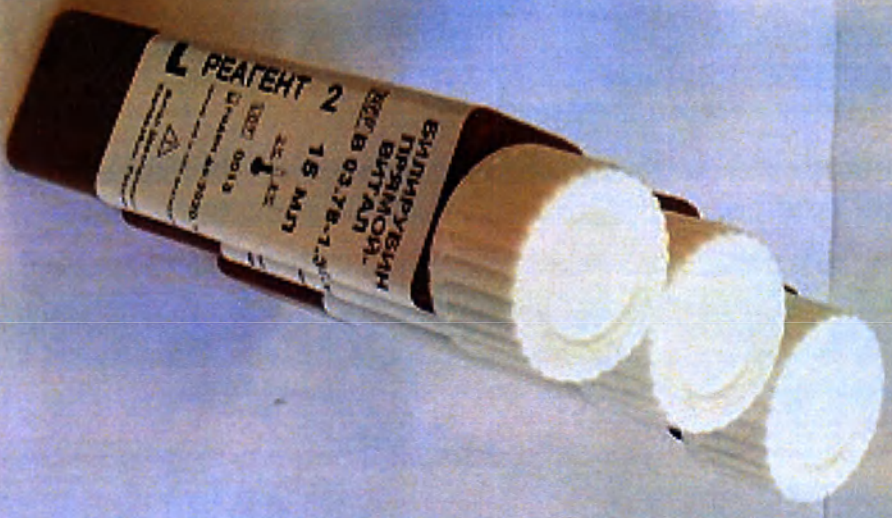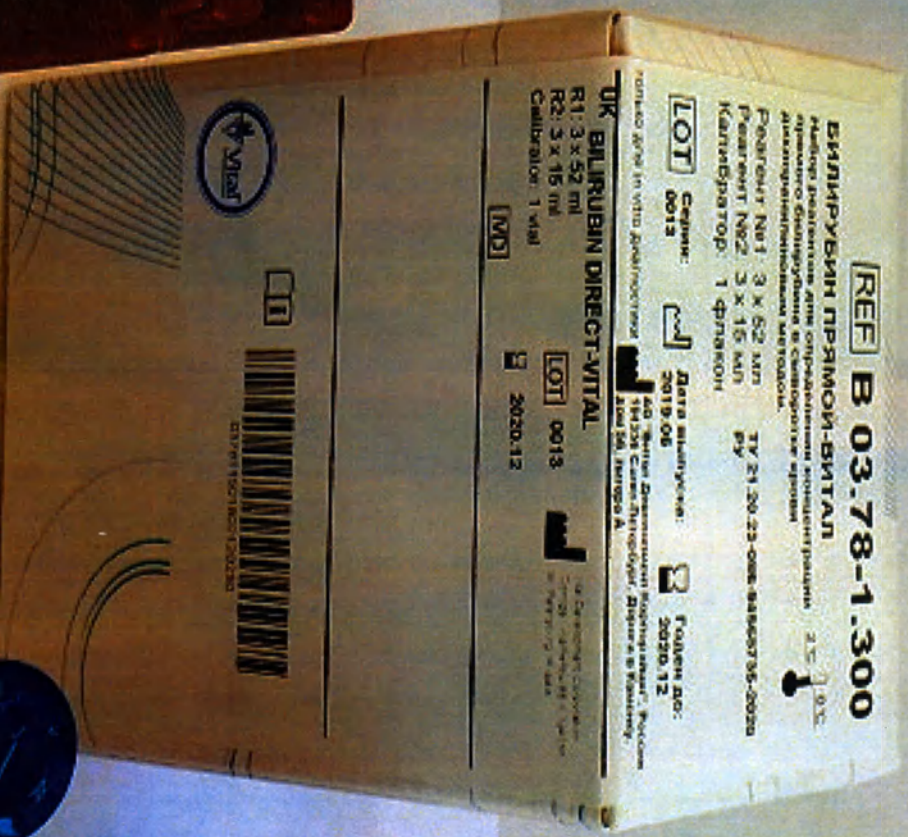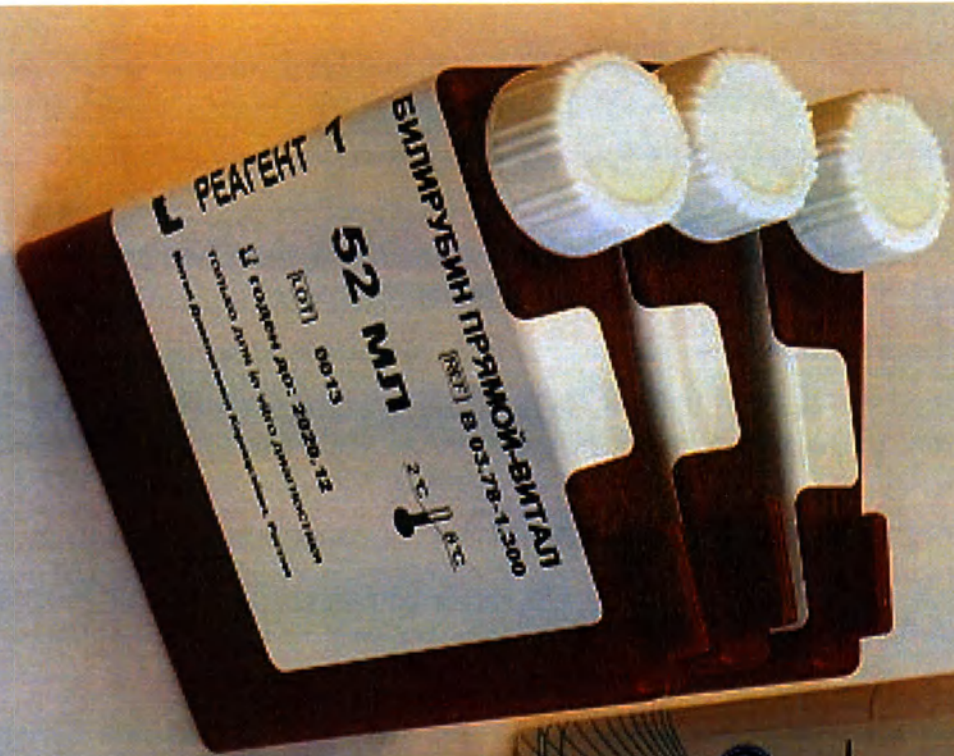

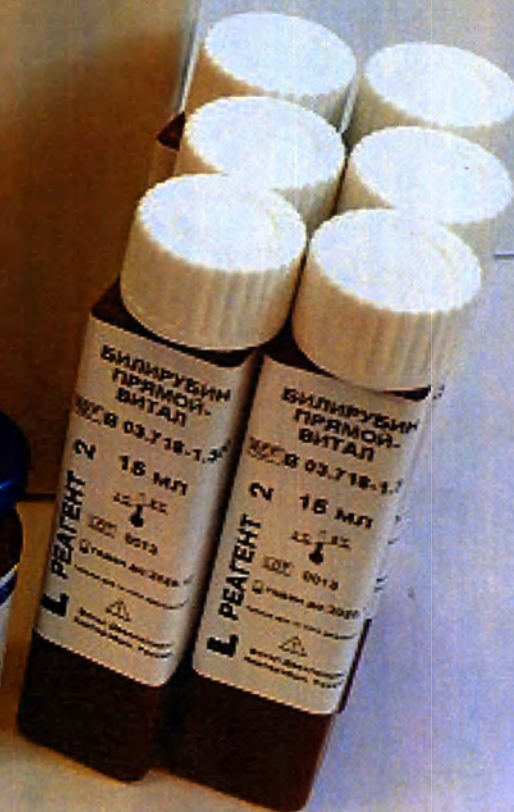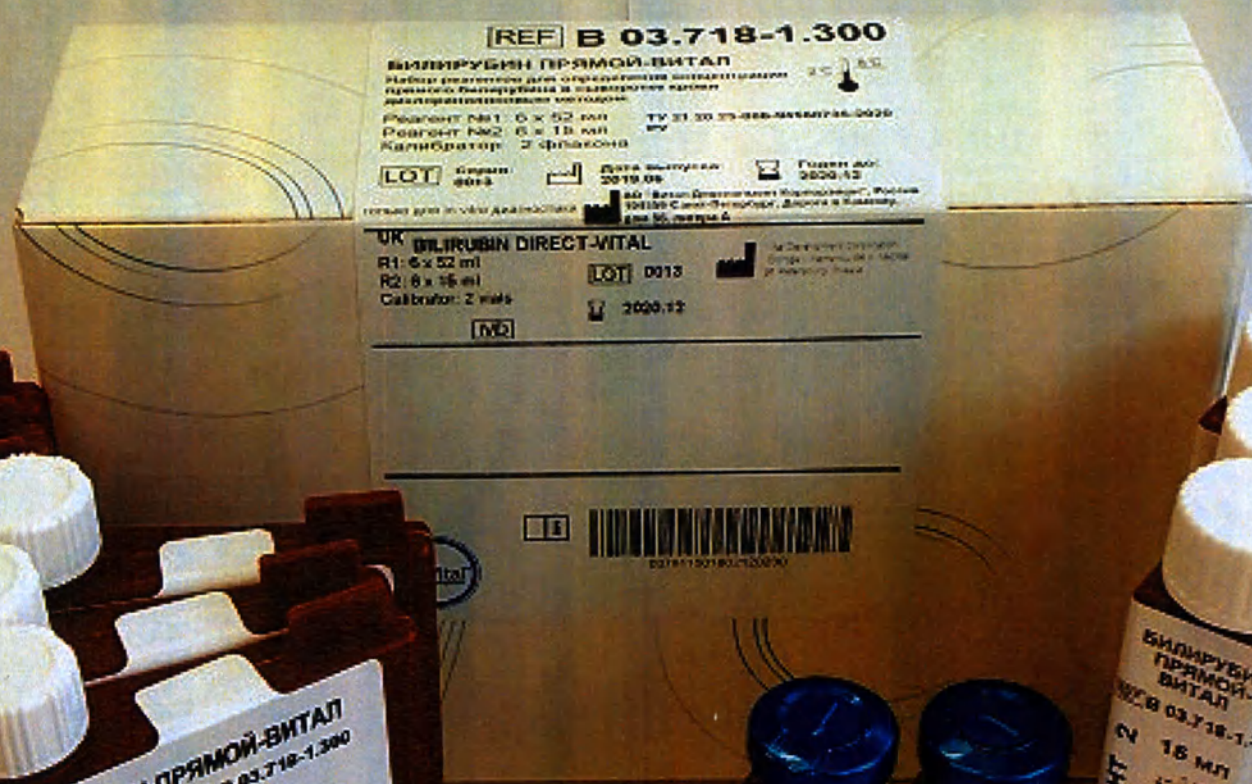

REF В 03.78-1.420

БИПИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации билирубина в сыворотке крови
дифференциальным методом.

Реагент №1 2 x 72 мл ТУ 21.20.03-086-94568735-2020
Реагент №2 2 x 20 мл Р.У. 21.20.03-086-94568735-2020

Калибратор 1 флакон

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2018.06 Срок до: 2020.12

Полное наименование: АД "Витал-Диагностика" ООО "Витал-Диагностика", Россия
125135 Санкт-Петербург, Девятая в Милану, д. 65, литера А

OR БИПИРУБИН DIRECT-VITAL

Р1: 2 x 72 мл LOT 0010 Р2: 2 x 20 мл LOT 0010

Калибратор 1 шт

EXP 2020.12

БИПИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

(REF) В 03.78-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0013

Упаковка: 20x720x80.12

Содержит реактив для определения билирубина в сыворотке крови

Производитель: ООО "Витал-Диагностика", Россия

РЕАГЕНТ 2 20 мл

БИПИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

(REF) В 03.78-1.420

LOT 0010

Упаковка: 20x720x80.12

Содержит реактив для определения билирубина в сыворотке крови

Производитель: ООО "Витал-Диагностика", Россия



REF B 03.718-1.420

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
прямого билирубина в сыворотке крови
дихлоранилиновым методом.

Реагент №1: 4 x 72 мл

ТУ 21.20.25-006-94568735-2020

Реагент №2: 4 x 20 мл

РУ

Калибратор: 2 флакона

LOT

Серия: 0013

Дата выпуска: 2019.06

Годен до: 2020.12

Годен до: 2020.12

только для in vitro диагностики

AD "Витал Диагностика Корпорейшн", Россия
191256 Санкт-Петербург, Дегляк в Коммуна,
дом 55, литер А

UK BILIRUBIN DIRECT-VITAL

R1: 4 x 72 ml

LOT 0013

R2: 4 x 20 ml

Calibrator: 2 vials

2020.12

(VVD)



0013 191256 0001 2020.12

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ
REF B 03.718-1.420
72 МЛ

0013

Годен до: 2020.12

только для in vitro диагностики

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ
REF B 03.718-1.420
20 МЛ

БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ
REF B 03.718-1.420
20 МЛ


БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ
REF B 03.718-1.420
20 МЛ


БИЛИРУБИН
ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ
REF B 03.718-1.420
20 МЛ









БИПИРУЕИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ
 REF B 03.78-2.200
 20 МЛ
 РЕАГЕНТ 1
 LOT 0013
 Годен до: 2020.12
 Калибратор: 1 vial

БИПИРУЕИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ
 REF B 03.78-2.200
 Набор реактивов для определения концентрации
 прямого бипируеина в сыворотке крови
 лабораторным методом
 Реагент №1: 4 x 20 мл
 Реагент №2: 1 x 20 мл
 Калибратор: 1 флакон
 LOT Сериал: 0013
 Дата выпуска: 2019.06
 Годен до: 2020.12
 АД "Витал Диагностика Координация" - Россия
 194156 Санкт-Петербург, Адмирала Корнилова
 дом 56, корпус А
 УК ВИРУБИН ДИРЕКТ-ВИТАЛ
 R1: 4 x 20 ml
 R2: 1 x 20 ml
 Калибратор: 1 vial
 LOT 0013
 2020.12

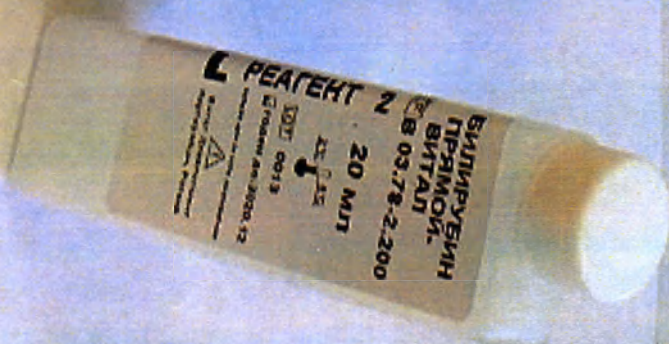

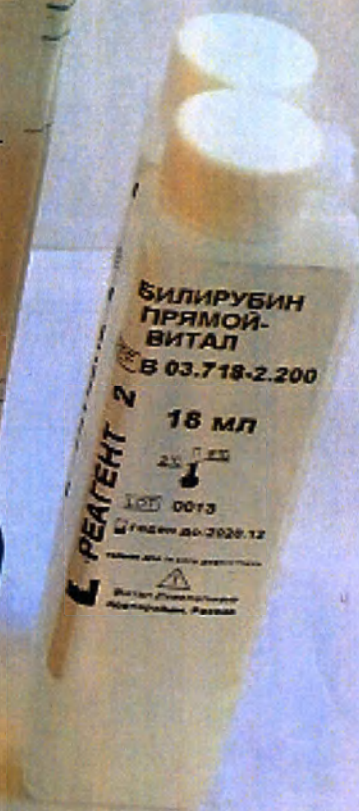

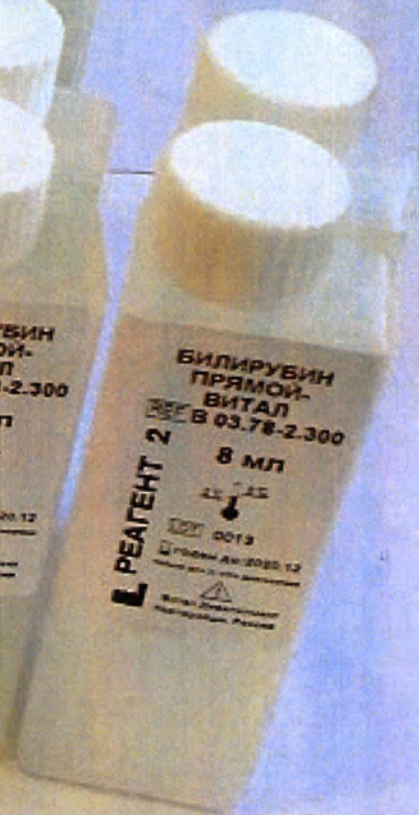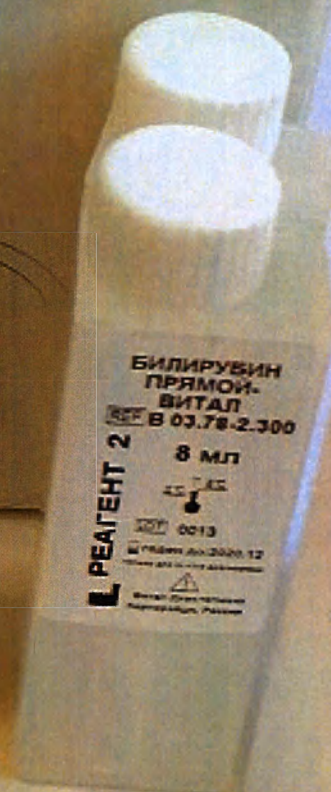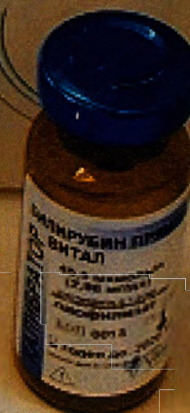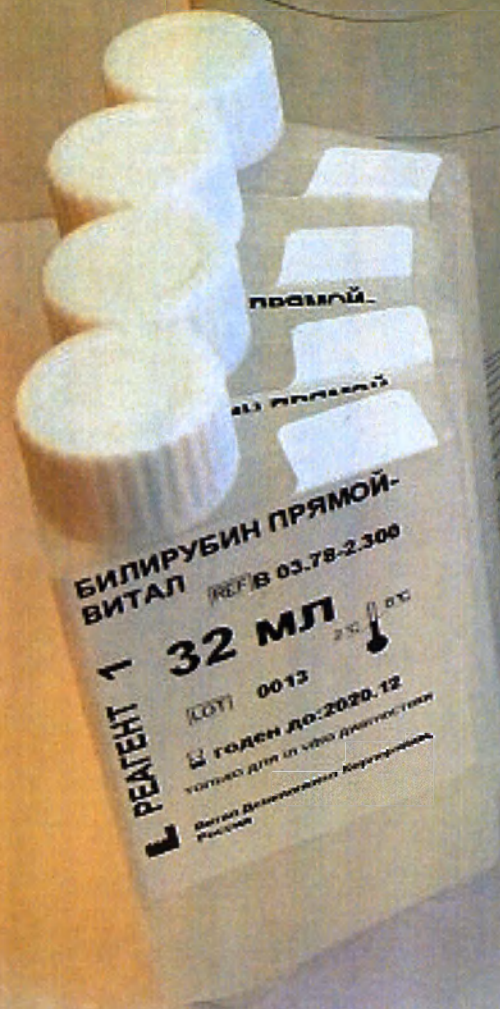

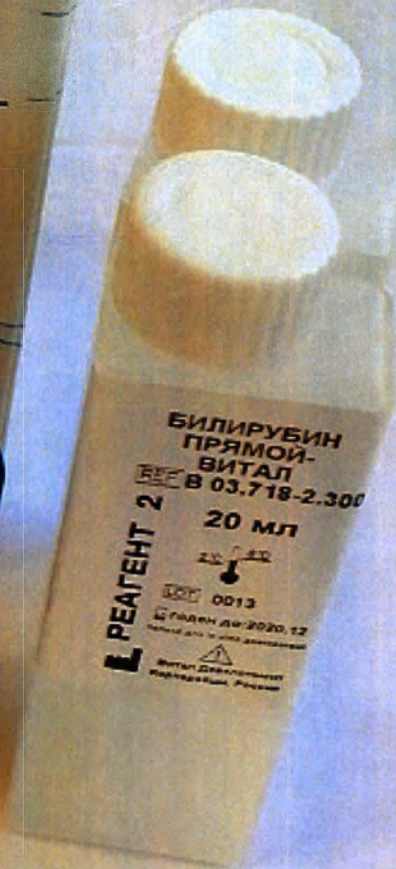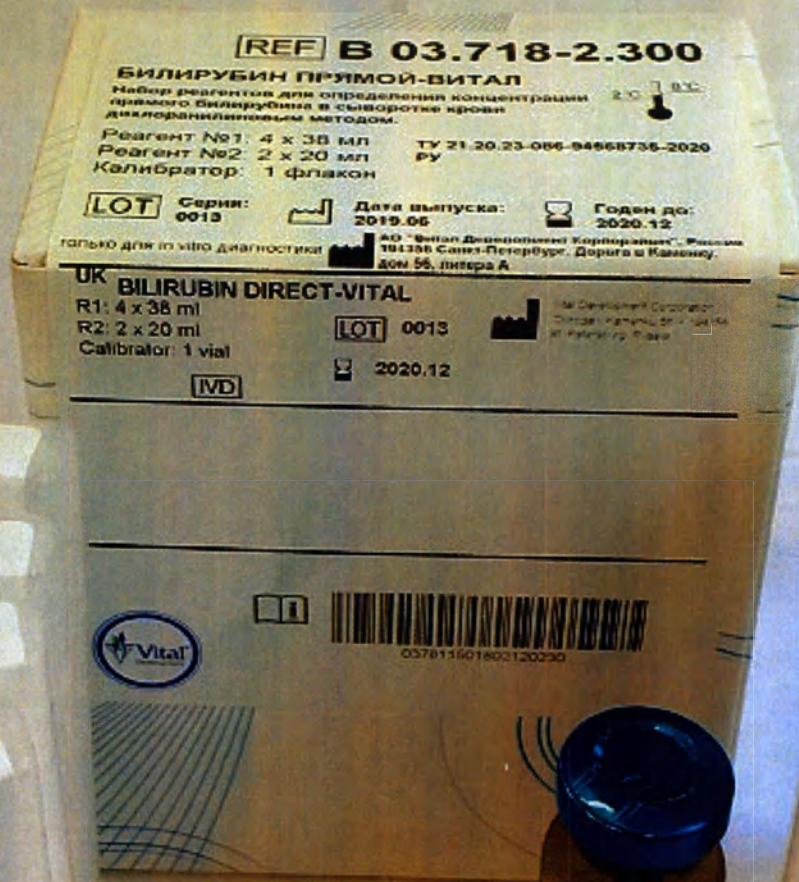

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

