

- Фотографические изображения медицинского изделия
- Макет маркировки потребительской упаковки

DIALAB  Общество с ограниченной ответственностью
DIALAB. Производство и реализация
химико-технической продукции и лабораторных приборов
Промышленный центр Нижняя Австрия Юг, Хондаштрассе, объект M55, 2351,
Винер-Нойдорф, Австрия

Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2005224
ру

Комплект поставки:
- кассеты экспресс-теста в индивидуальной упаковке, в пачочных пакетах, с пипеткой и валиком-оттиском – 25 шт.,
- аналитический буфер, 1 шт.,
- инструкция по применению – 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ИКС-ТЕХ», 109044, Россия, г. Москва, ул. Крупянский вал, д. 18, офис 315
телефон: +7 495 748-56 16, info@ixs-tech.ru, www.ixs-tech.ru
Номер партии, дата производства, срок годности –
на оригинальной упаковке производителя

DIALAB
www.dialab.at



Инструкция по применению медицинского изделия
«Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма)»

1. Производитель медицинского изделия

DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Labormessinstrumenten
Gesellschaft m.b.H.
(Общество с ограниченной ответственностью DIALAB. Производство и реализация химико-
технической продукции и лабораторных приборов) Австрия.
Адрес: Промышленный центр Нижняя Австрия Юг, Хондаштрассе, объект M55, 2351,
Винер-Нойдорф, Австрия
Тел. +43 (0) 2236 660910-0, факс +43 (0) 2236 660910-30, e-mail: office@dialab.at

2. Уполномоченный представитель производителя (изготовителя)

ООО «ИКС-ТЕХ»

«Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партии 2005224»
(общий вид изделия)



Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2005224»
(потребительская упаковка-коробка)

DIALAB

Общество с ограниченной ответственностью
DIALAB Производство и реализация
химико-технической продукции и лабораторных приборов

Промышленный центр Нижняя Австрия Юг, Хондаштрассе, объект M55, 2351,
Винер-Нойдорф, Австрия

Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2005224
РУ _____

Комплект поставки

- кассеты экспресс-теста в индивидуальной упаковке, в пленочных пакетах, с пипеткой и влагопоглотителем – 25 шт.;
- аналитический буфер-1 шт.;
- инструкция по применению- 1шт.




Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ИКС-ТЕХ». 109044, Россия, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 14, офис 315
телефон +7 495 748-56 16, info@x-tech.su. www.x-tech.su



*Номер партии, дата производства, срок годности –
на оригинальной упаковке производителя*

DIALAB
www.dialab.at

“Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2005224”
(потребительская упаковка - коробка)

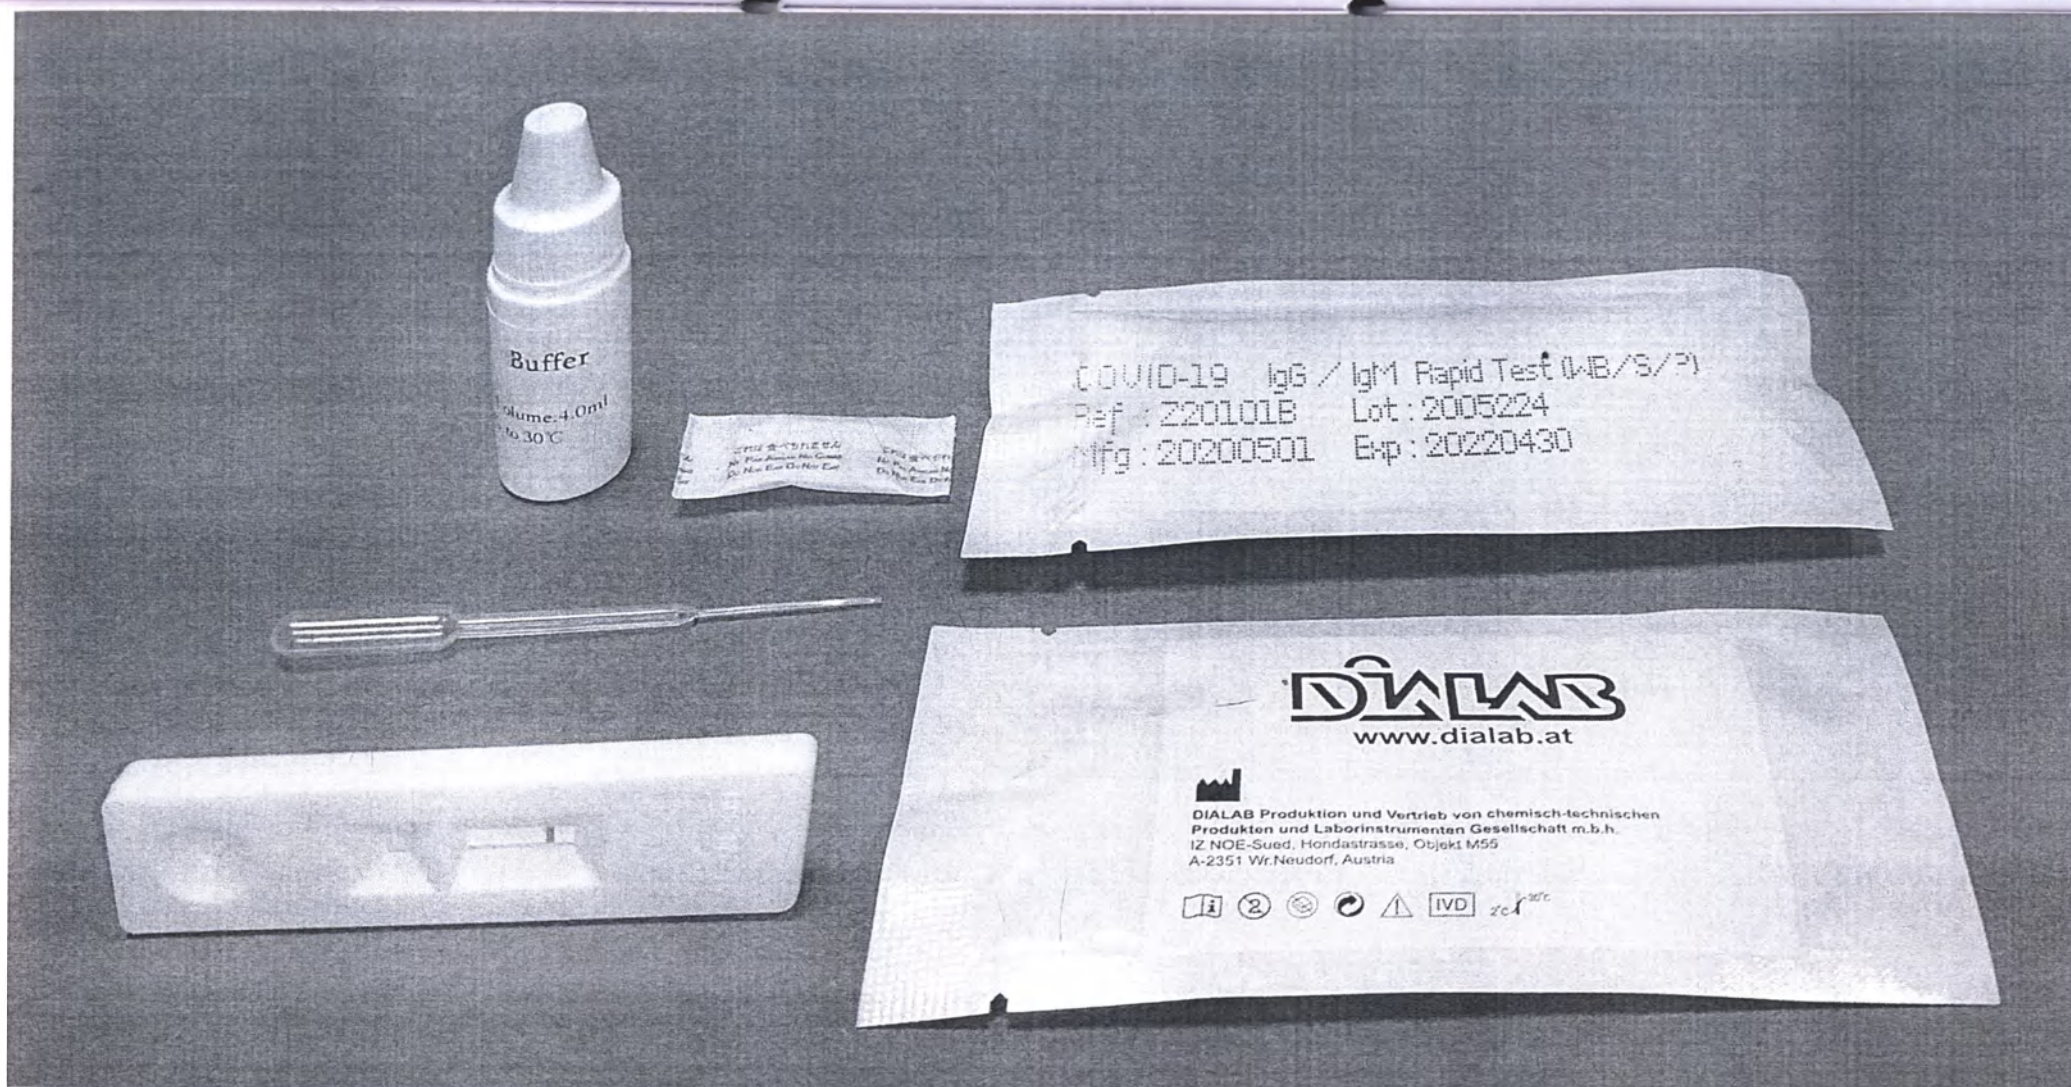

**“Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2005224
(блистер, тест-кассета, пипетка, буфер, влагопоглотитель)**

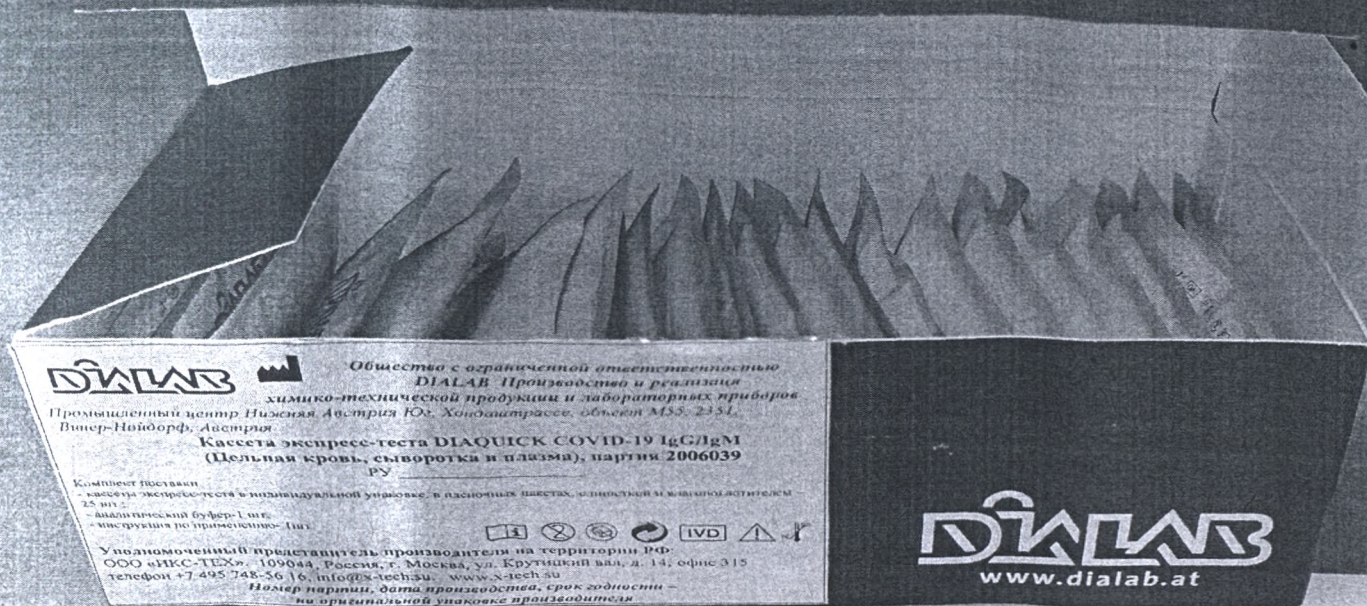

Инструкция по применению медицинского изделия
«Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма)»


1. Производитель медицинского изделия

DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten
Gesellschaft m.b.H.
(Общество с ограниченной ответственностью DIALAB Производство и реализация химико-
технической продукции и лабораторных приборов) Австрия
Адрес: Промышленный центр Нижняя Австрия Юг, Хондаштрассе, объект M55, 2351,
Винер-Нойдорф, Австрия
Тел. +43 (0) 2236 660910-0, факс +43 (0) 2236 660910-30, e-mail: office@dialab.at

2. Уполномоченный представитель производителя (изготовителя)

ООО «ЦИС-ТЕХ»

«Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партии 2006039»
(общий вид изделия)

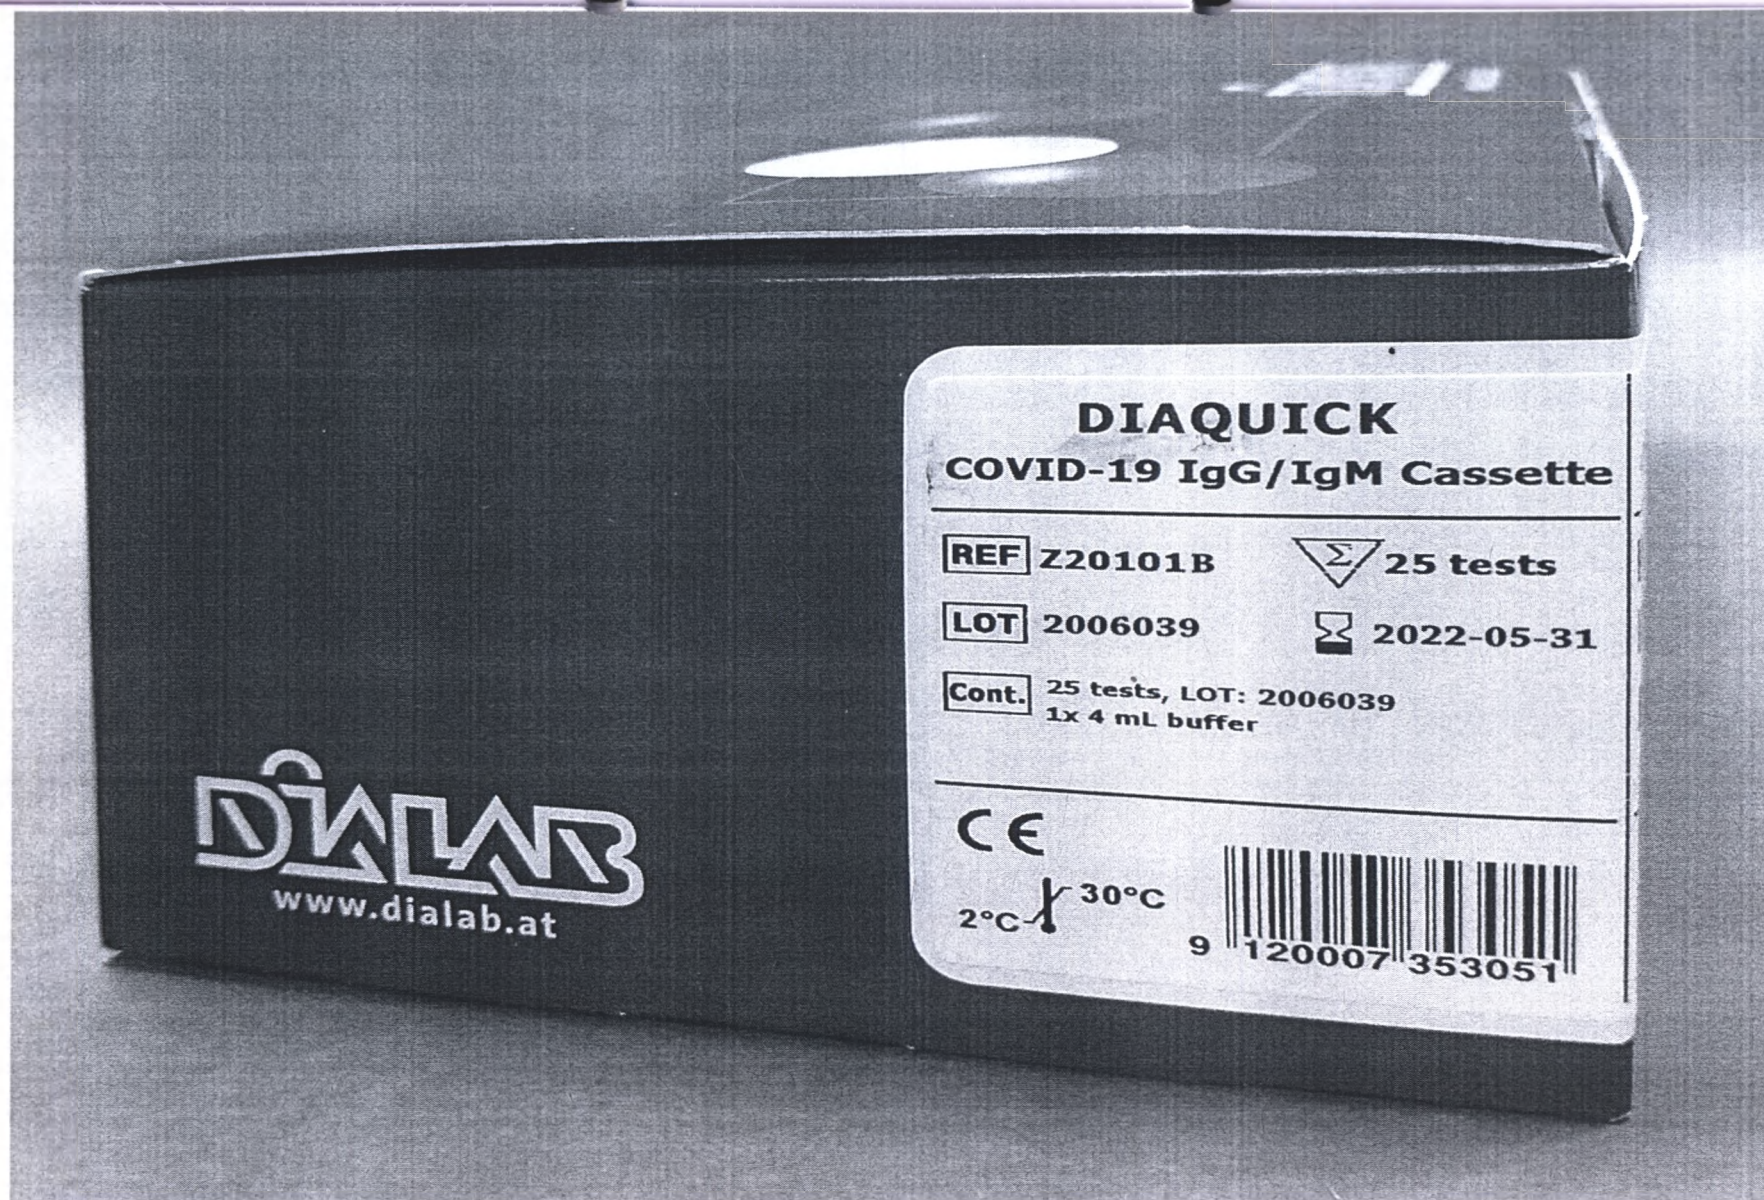

“Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2006039”
(потребительская упаковка - коробка)

DIALAB

Общество с ограниченной ответственностью
DIALAB Производство и реализация
химико-технической продукции и лабораторных приборов
Промышленный центр Нижняя Австрия Юг, Хондаштрассе, объект M55, 2351,
Винер-Нойдорф, Австрия

Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2006039
РУ _____

Комплект поставки

- кассеты экспресс-теста в индивидуальной упаковке, в пленочных пакетах, с пипеткой и влагопоглотителем – 25 шт.;
- аналитический буфер-1 шт.;
- инструкция по применению- 1шт.




Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ИКС-ТЕХ». 109044, Россия, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 14, офис 315
www.x-tech.su
телефон +7 495 748-56 16, info@x-tech.su

Номер партии, дата производства, срок годности –
на оригинальной упаковке производителя

DIALAB
www.dialab.at

“Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2006039”
(потребительская упаковка - коробка)

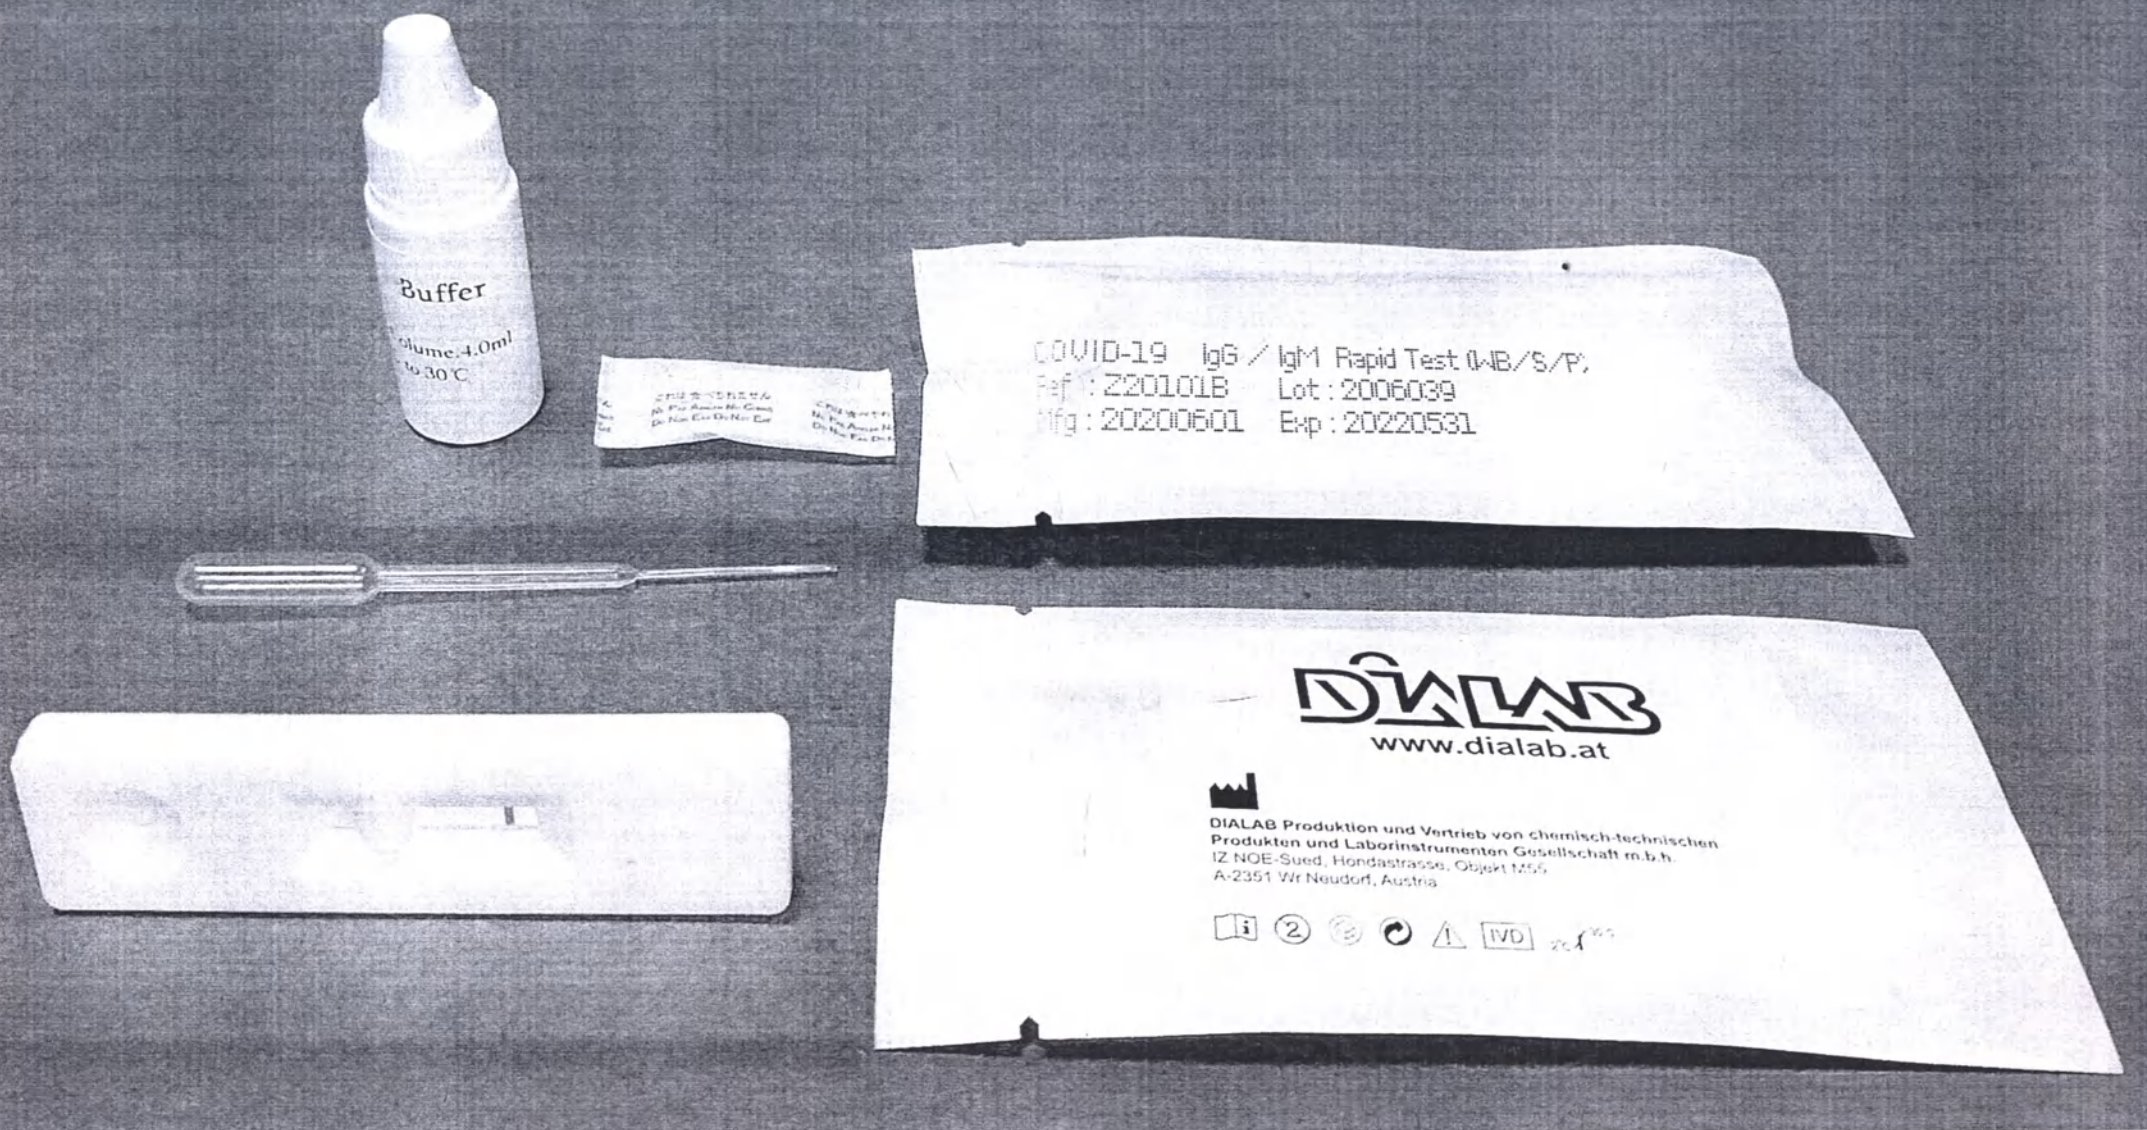

**“Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2006039
(блистер, тест-кассета, пипетка, буфер, влагопоглотитель)**


DIALAB  Общество с ограниченной ответственностью
DIALAB Производство и реализация
химико-технической продукции и лабораторных приборов
Промышленный центр Нижняя Австрия Юг, Хондантрассе, объект M55, 2351,
Винер-Нойдорф, Австрия

Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2006040
РУ

Комплект поставки:
- кассеты экспресс-теста в индивидуальной упаковке, в пленочных пакетах, с инструкцией и ватнопоглостителем - 25 шт.;
- аналитический буфер-1 шт.;
- инструкция по применению- 1шт.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ИКС-ТЕХ», 109044, Россия, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 14, офис 315
телефон +7 495 743-56 16, info@x-tech.ru, www.x-tech.ru
Номер партии, дата производства, срок годности -
на оригинальной упаковке производителя

DIALAB
www.dialab.at



Инструкция по применению медицинского изделия
«Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма)»


1. Производитель медицинского изделия

DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten
Gesellschaft m.b.H.
(Общество с ограниченной ответственностью DIALAB. Производство и реализация химико-
технической продукции и лабораторных приборов) Австрия.
Адрес: Промышленный центр Нижняя Австрия Юг, Хондантрассе, объект M55, 2351,
Винер-Нойдорф, Австрия
Тел. +43 (0) 2236 660910-0, факс +43 (0) 2236 660910-30, e-mail: office@dialab.at

2. Уполномоченный представитель производителя (изготовителя)

ООО «ИКС-ТЕХ»

«Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партии 2006040»
(общий вид изделия)

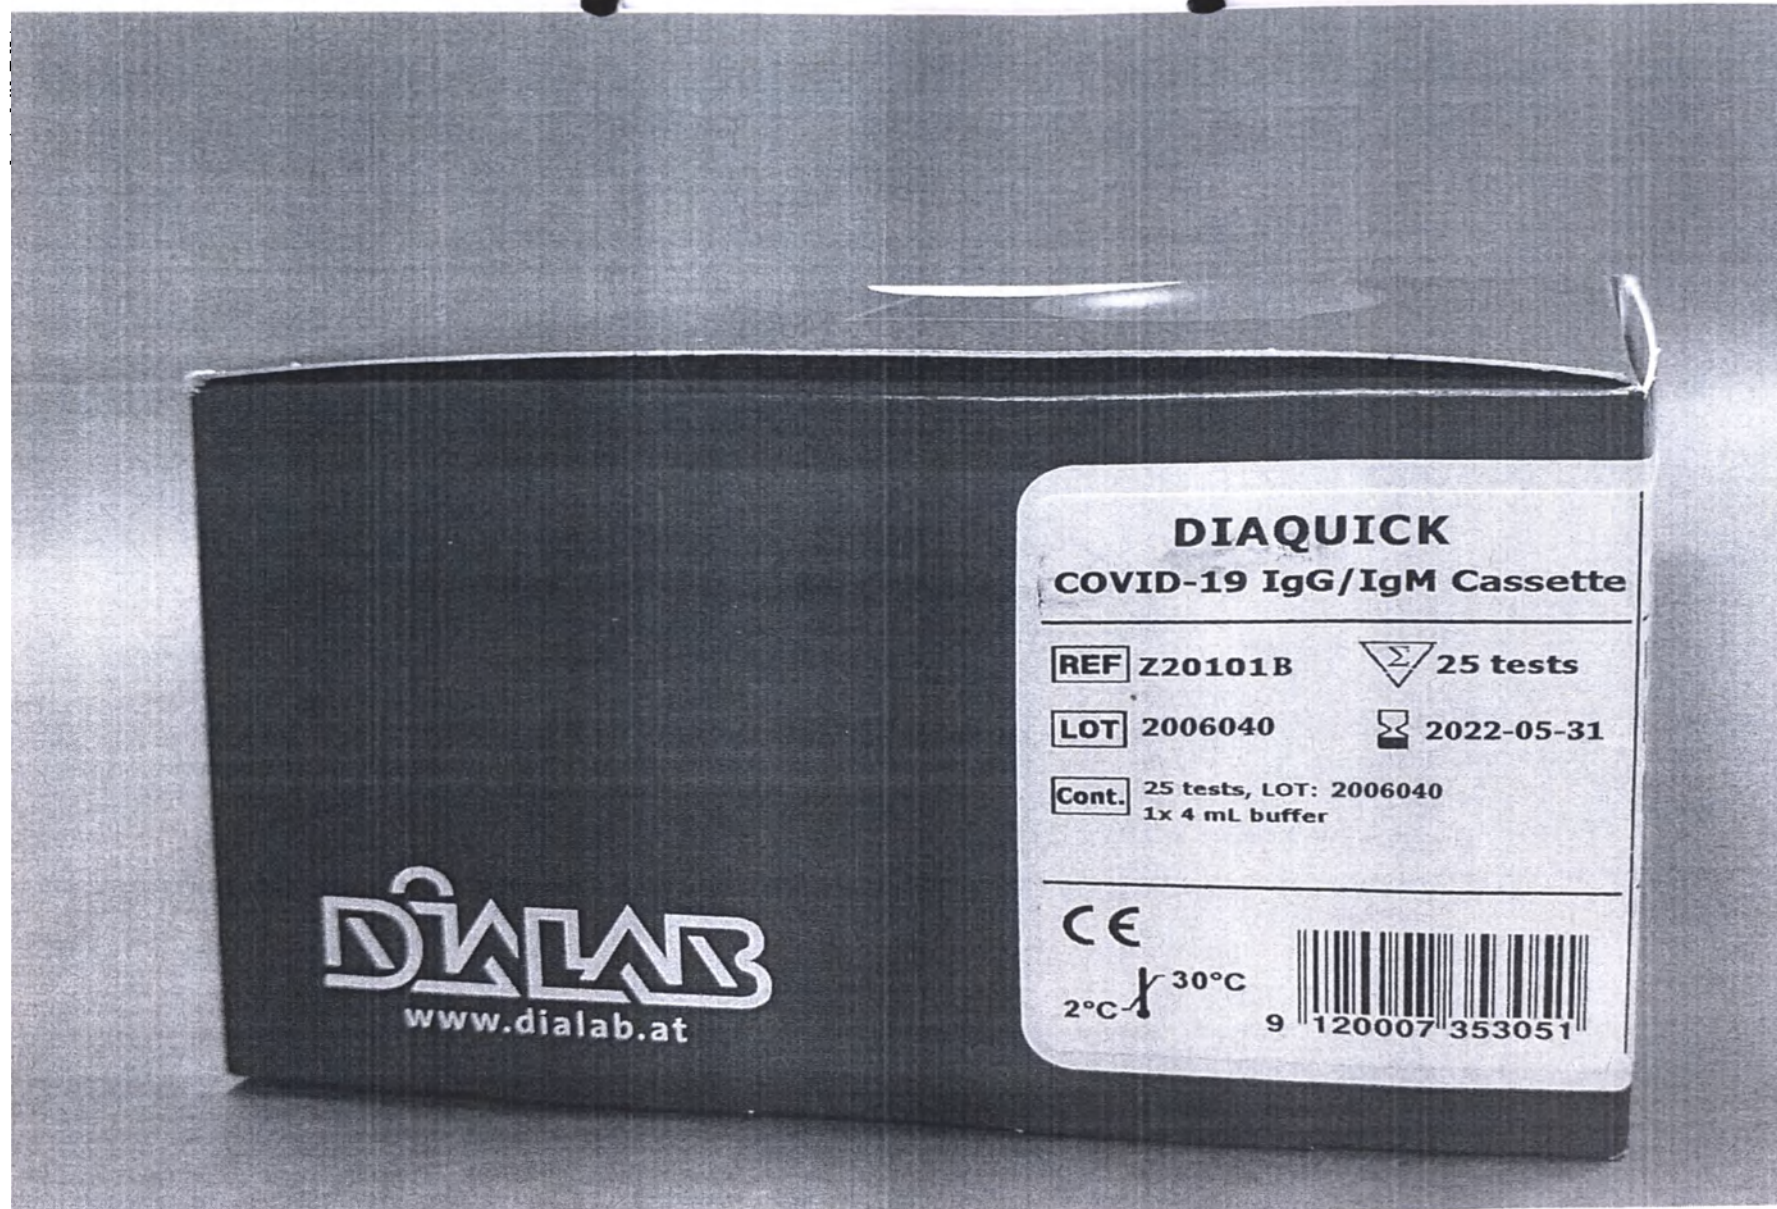

**Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2006040»
(потребительская упаковка- коробка)**

DIALAB

Общество с ограниченной ответственностью
DIALAB Производство и реализация
химико-технической продукции и лабораторных приборов

Промышленный центр Нижняя Австрия Юг, Хондаштрассе, объект M55, 2351,
Винер-Нойдорф, Австрия

Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2006040
РУ _____

Комплект поставки

- кассеты экспресс-теста в индивидуальной упаковке, в пленочных пакетах, с пипеткой и влагопоглотителем – 25 шт.;
- аналитический буфер-1 шт.;
- инструкция по применению- 1шт.




Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ИКС-ТЕХ». 109044, Россия, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 14, офис 315
телефон +7 495 748-56 16, info@x-tech.su. www.x-tech.su

*Номер партии, дата производства, срок годности –
на оригинальной упаковке производителя*

DIALAB
www.dialab.at

“Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2006040”
(потребительская упаковка - коробка)

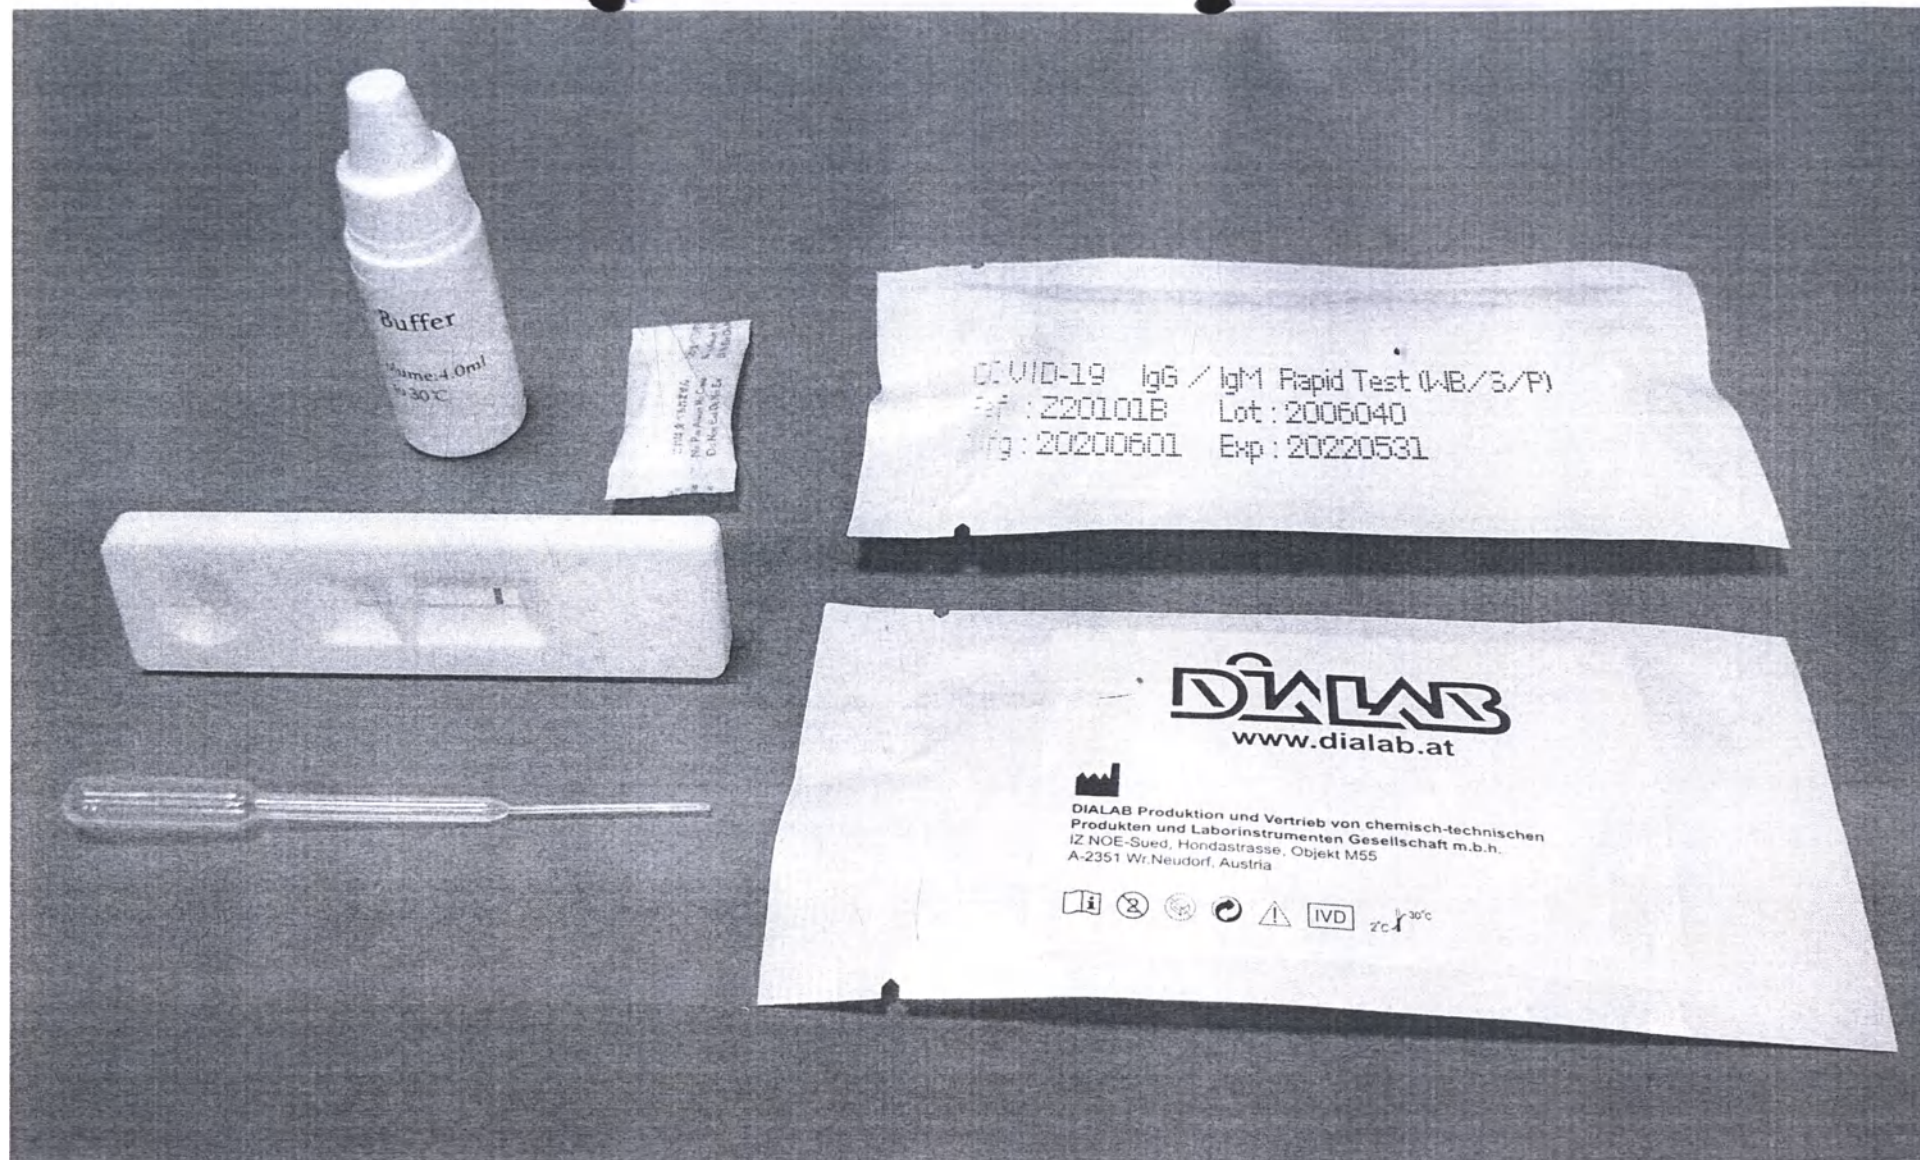

**“Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM
(Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия 2006040
(блистер, тест-кассета, пипетка, буфер, влагопоглотитель)”**

Макет маркировки потребительской упаковки (коробки)

		Общество с ограниченной ответственностью DIALAB Производство и реализация химико-технической продукции и лабораторных приборов Промышленный центр Нижняя Австрия Юг, Хондаштрассе, объект M55, 2351, Винер-Нойдорф, Австрия
Кассета экспресс-теста DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM (Цельная кровь, сыворотка и плазма), партия _____		
РУ _____		
Комплект поставки - кассеты экспресс-теста в индивидуальной упаковке, в пленочных пакетах, с пипеткой и влагопоглотителем – 25 шт.; - аналитический буфер-1 шт.; - инструкция по применению- 1 шт.		
		
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «ИКС-ТЕХ». 109044, Россия, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 14, офис 315 телефон +7 495 748-56 16, info@x-tech.su. www.x-tech.su		
<i>Номер партии, дата производства, срок годности – на оригинальной упаковке производителя</i>		

Присоединение
к договору



Переправлены документы
Получено: 11.01.2017