

Руководитель отдела качества
и корпоративных технологий
ООО «Сименс Здравоохранение»



И.Б. Медведева
2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**« Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM
Calibrator D (Atellica IM CAL D))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

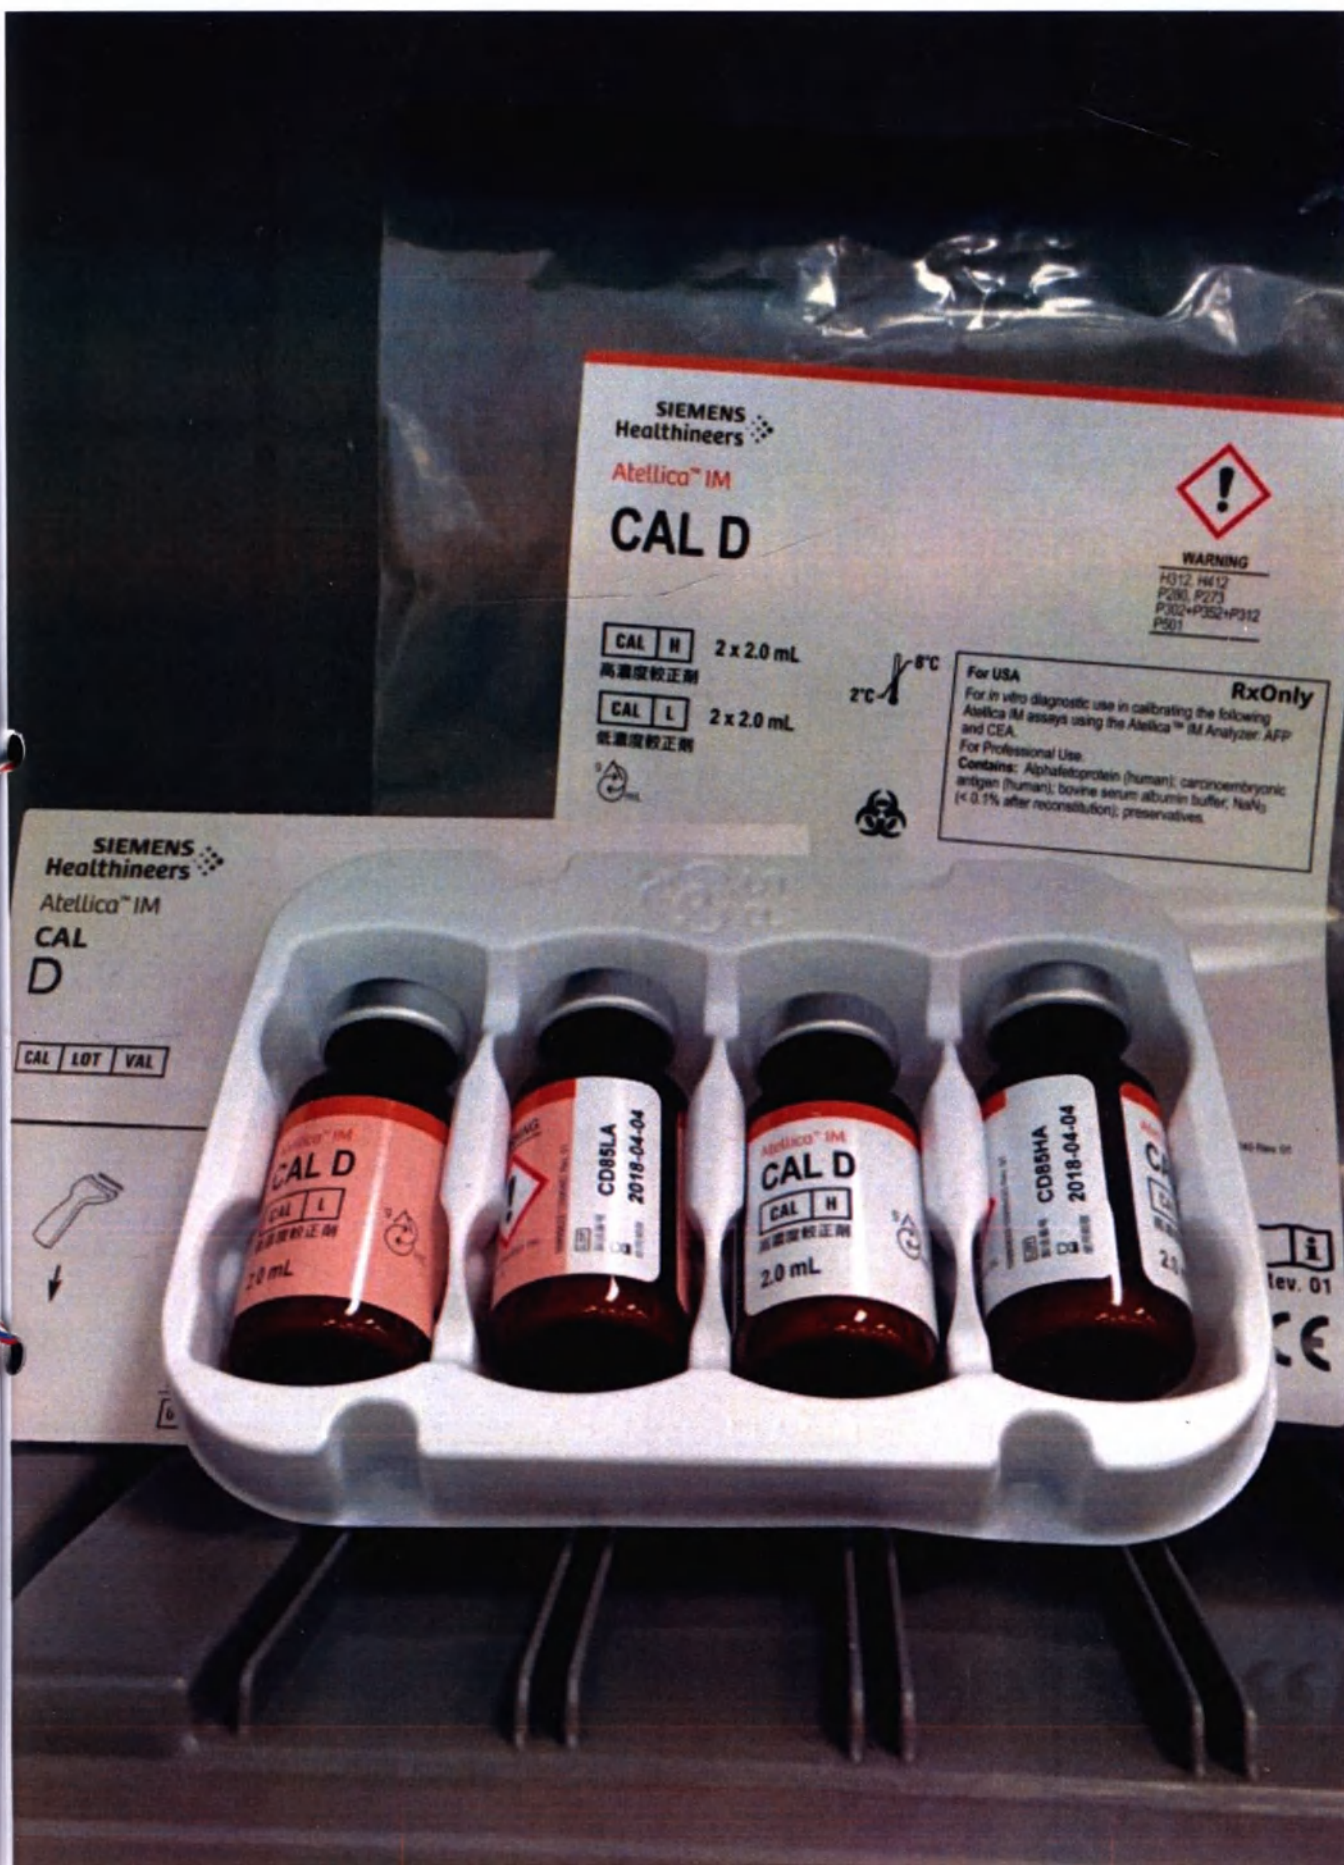


Рисунок 1. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Фасовка 2 уп. Общий вид

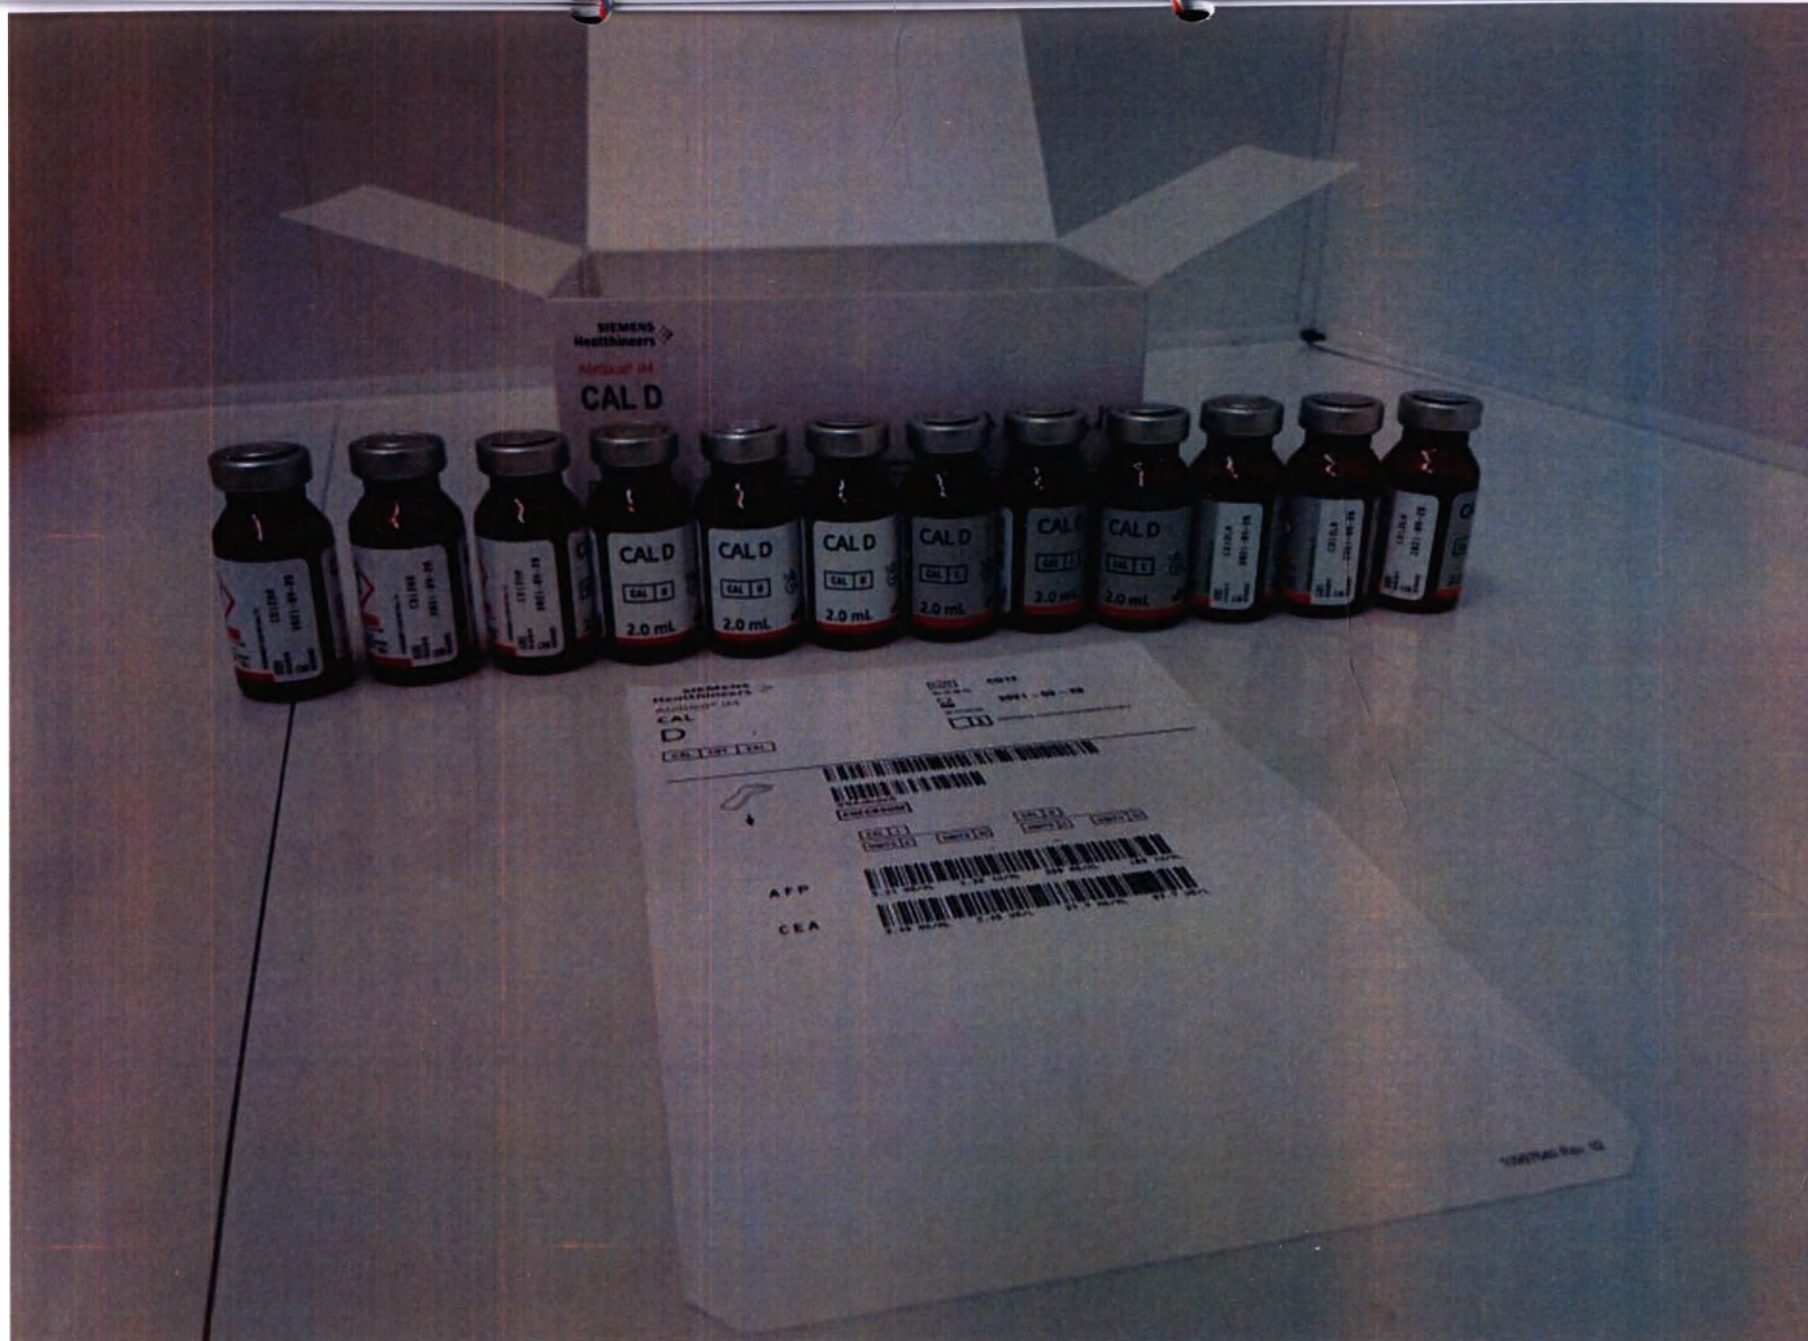


Рисунок 2. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Фасовка 6 уп. Общий вид

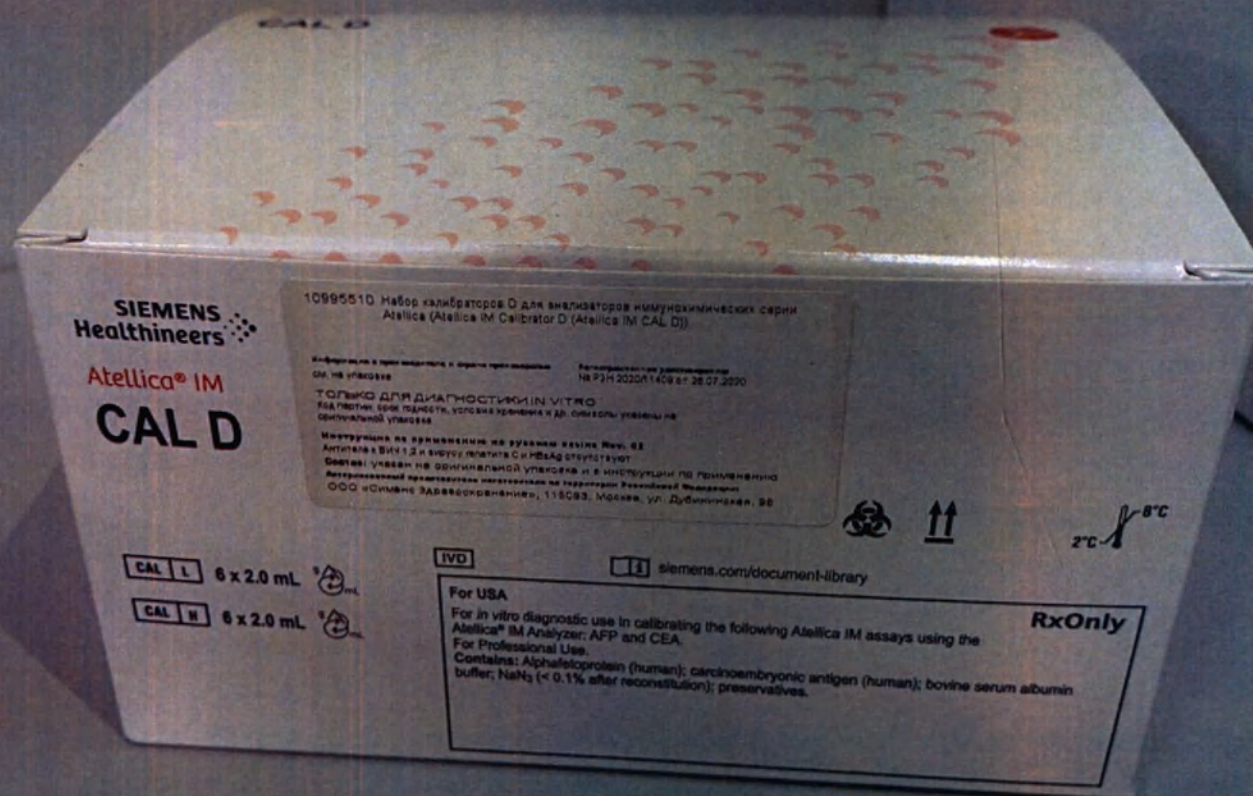


Рисунок 3. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Фасовка 6 уп. Маркировка для Российской Федерации

SIEMENS
healthineers

Atellica® IM

CAL D

10995510 Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии
Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D))

Информация о производителе и стране происхождения
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/11409 от 28.07.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель изготовителя на территории Российской Федерации

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96



CAL L 6 x 2.0 mL 

CAL H 6 x 2.0 mL 

IVD

 [siemens.com/document-library](https://www.siemens.com/document-library)

For USA

For *in vitro* diagnostic use in calibrating the following Atellica IM assays
Atellica® IM Analyzer: AFP and CEA.

For Professional Use

Рисунок 4. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Фасовка 6 уп. Маркировка для
Российской Федерации

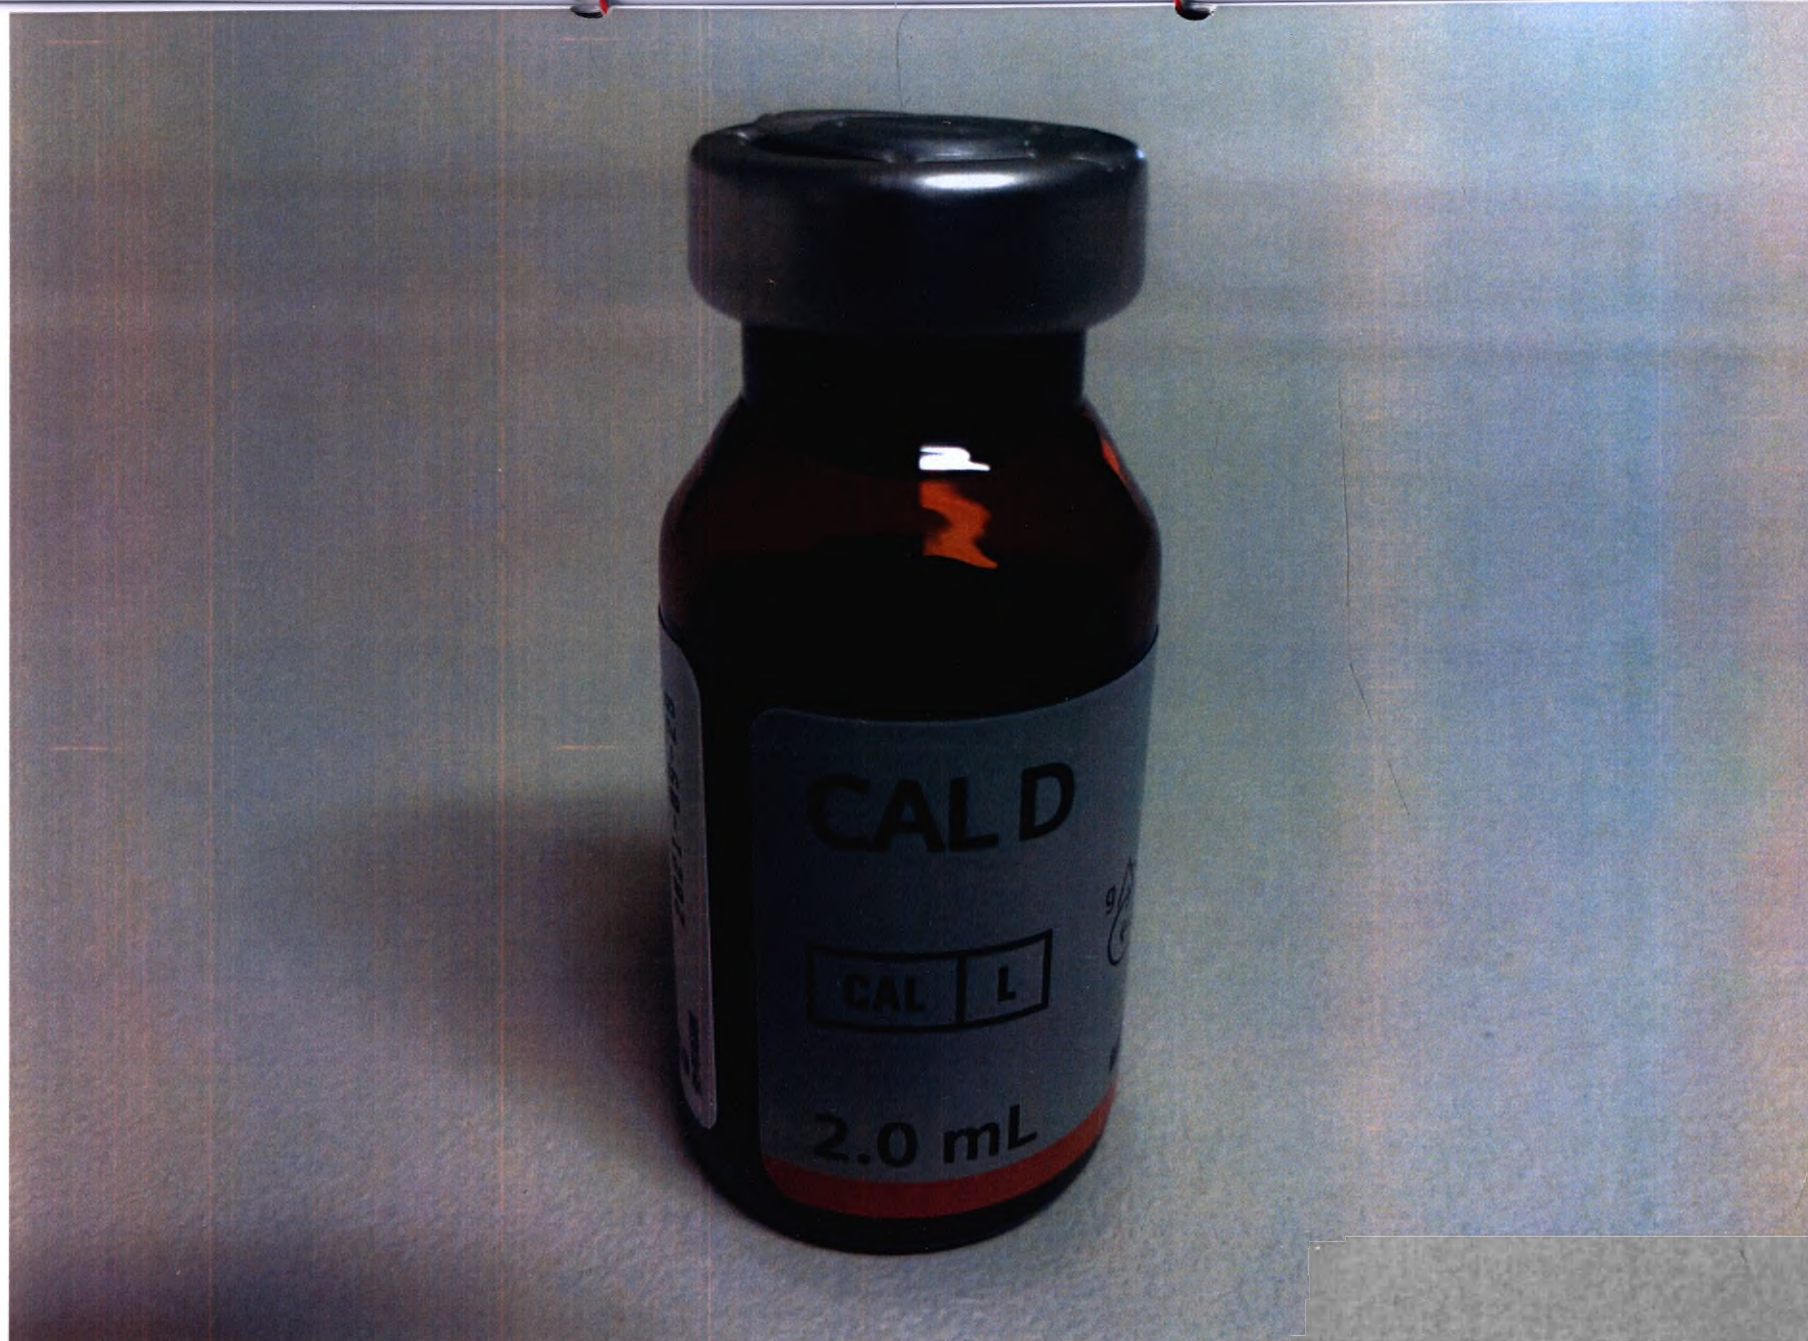


Рисунок 5. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CAL D L. 2.0 мл

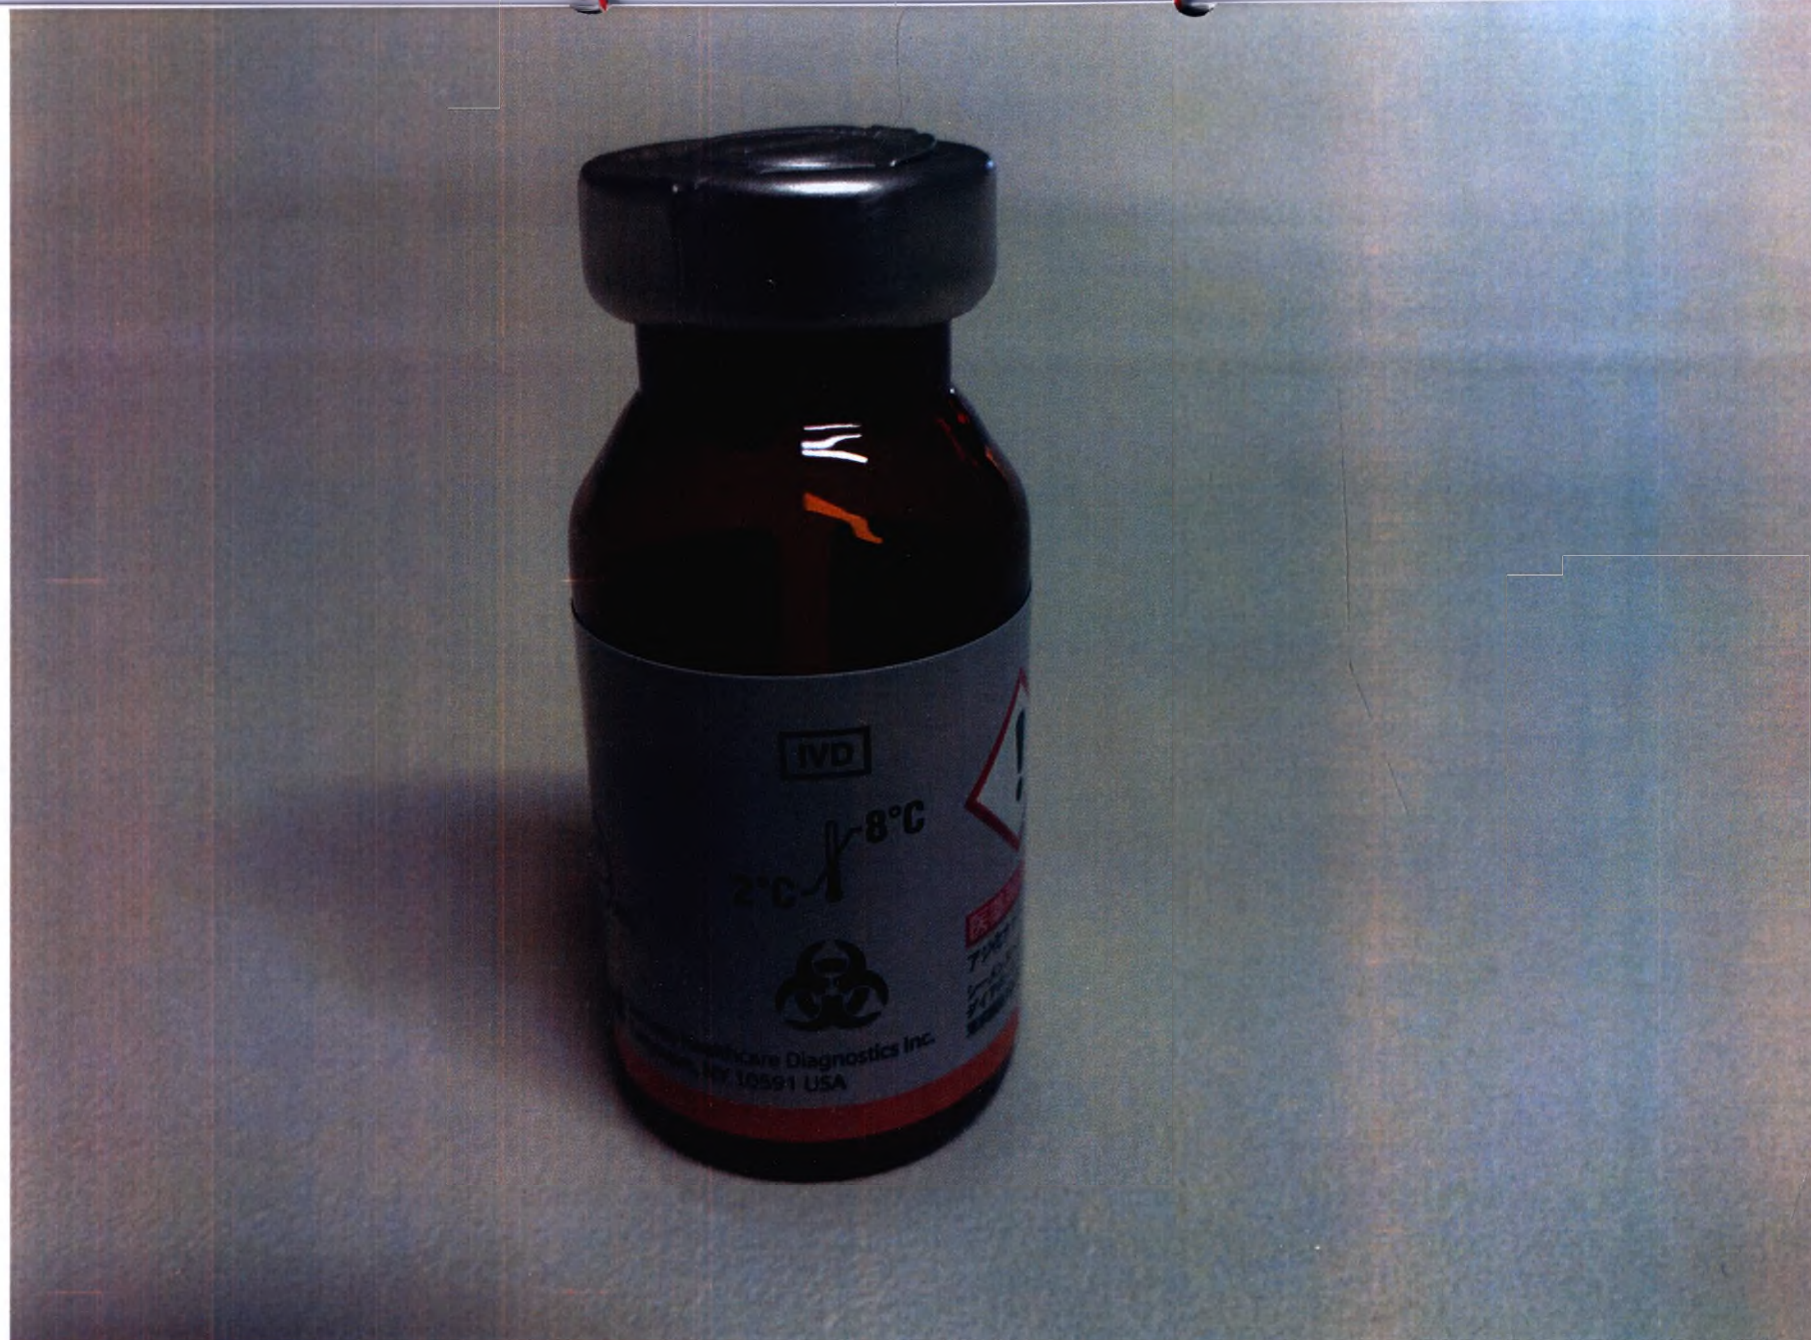


Рисунок 6. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CAL D L, 2.0 мл

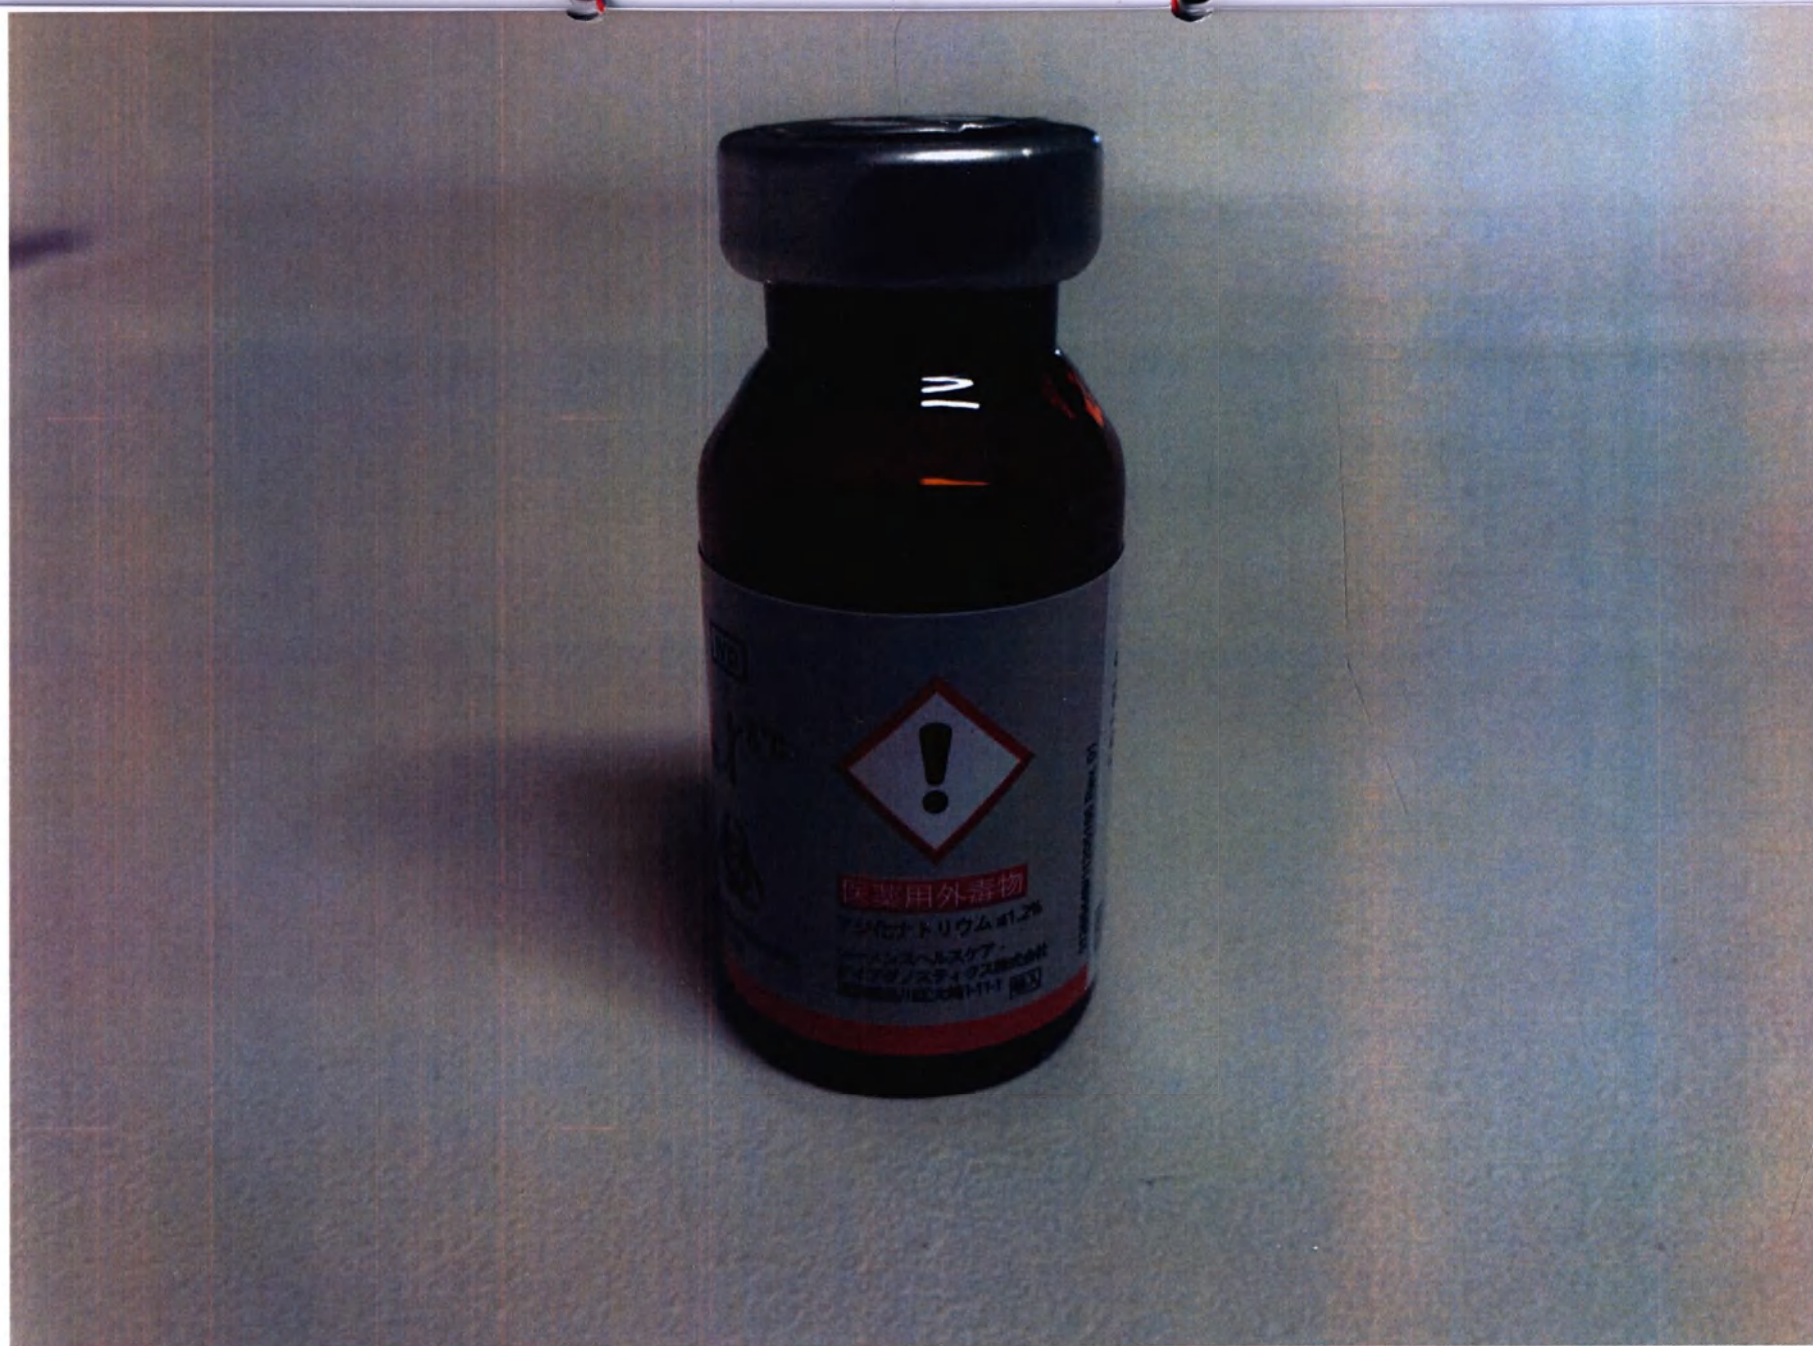


Рисунок 7. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Калибратор с низкой концентрацией
Atellica IM CAL D I 2.0 ml

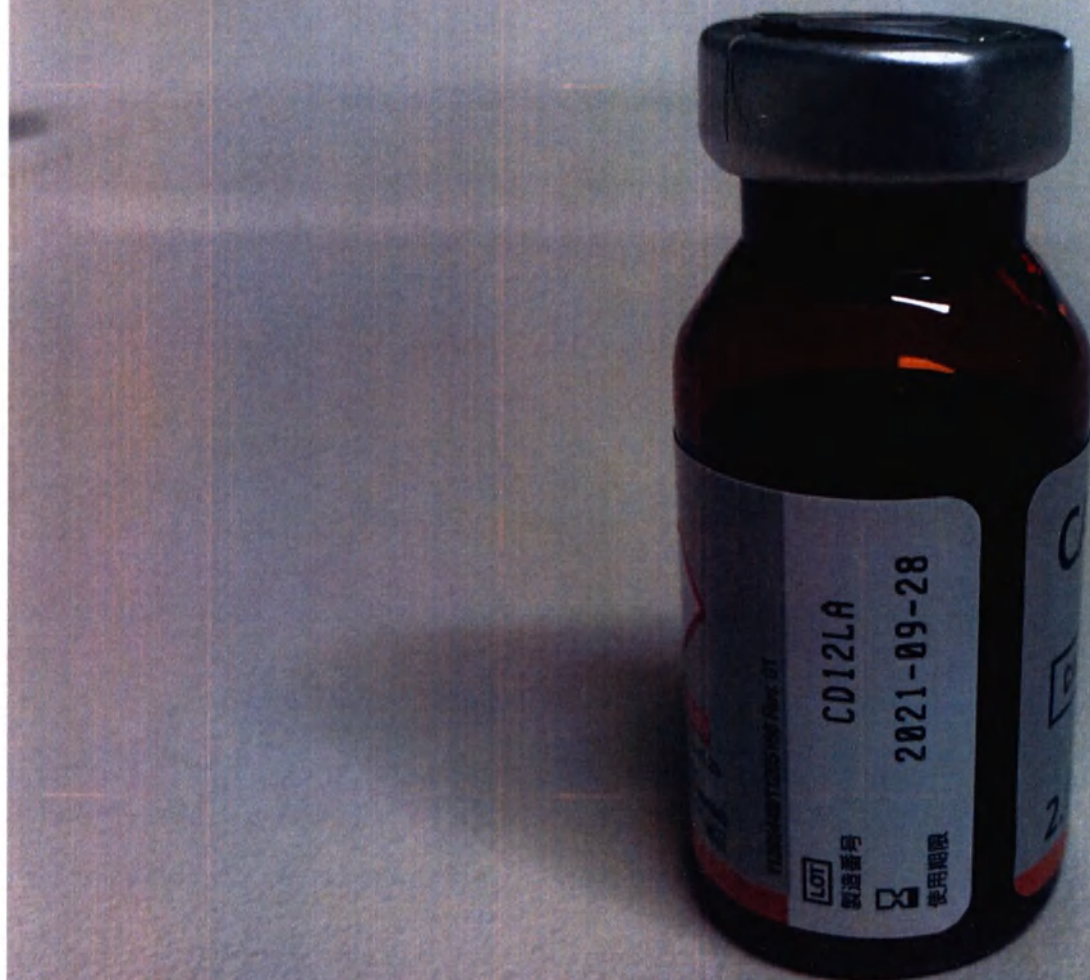


Рисунок 8. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CAL D L 2.0 мл



Рисунок 9. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Калибратор с высокой концентрацией
Atellica IM CAL D H 2.0 mL

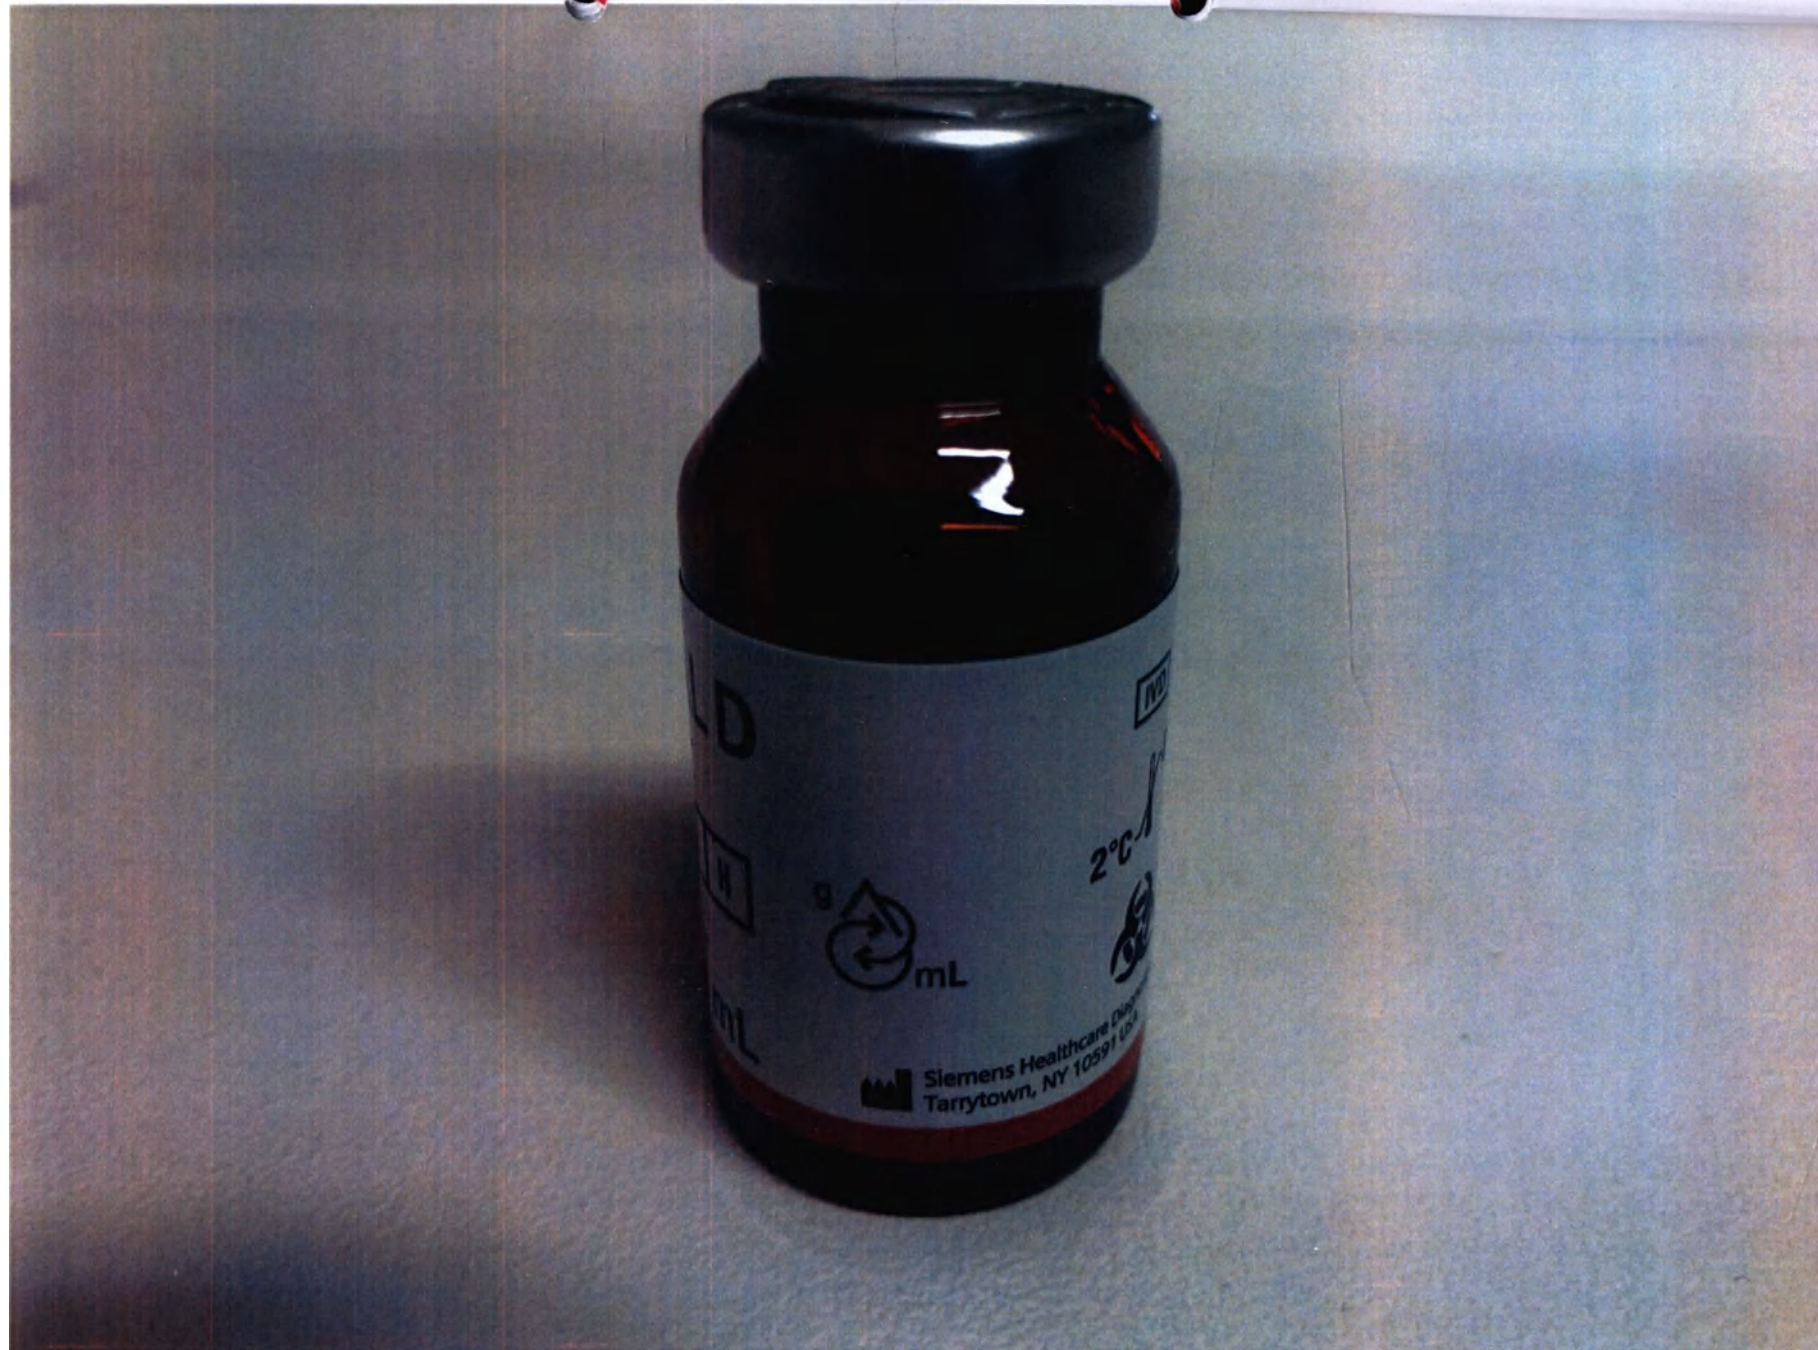


Рисунок 10. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Калибратор с высокой концентрацией

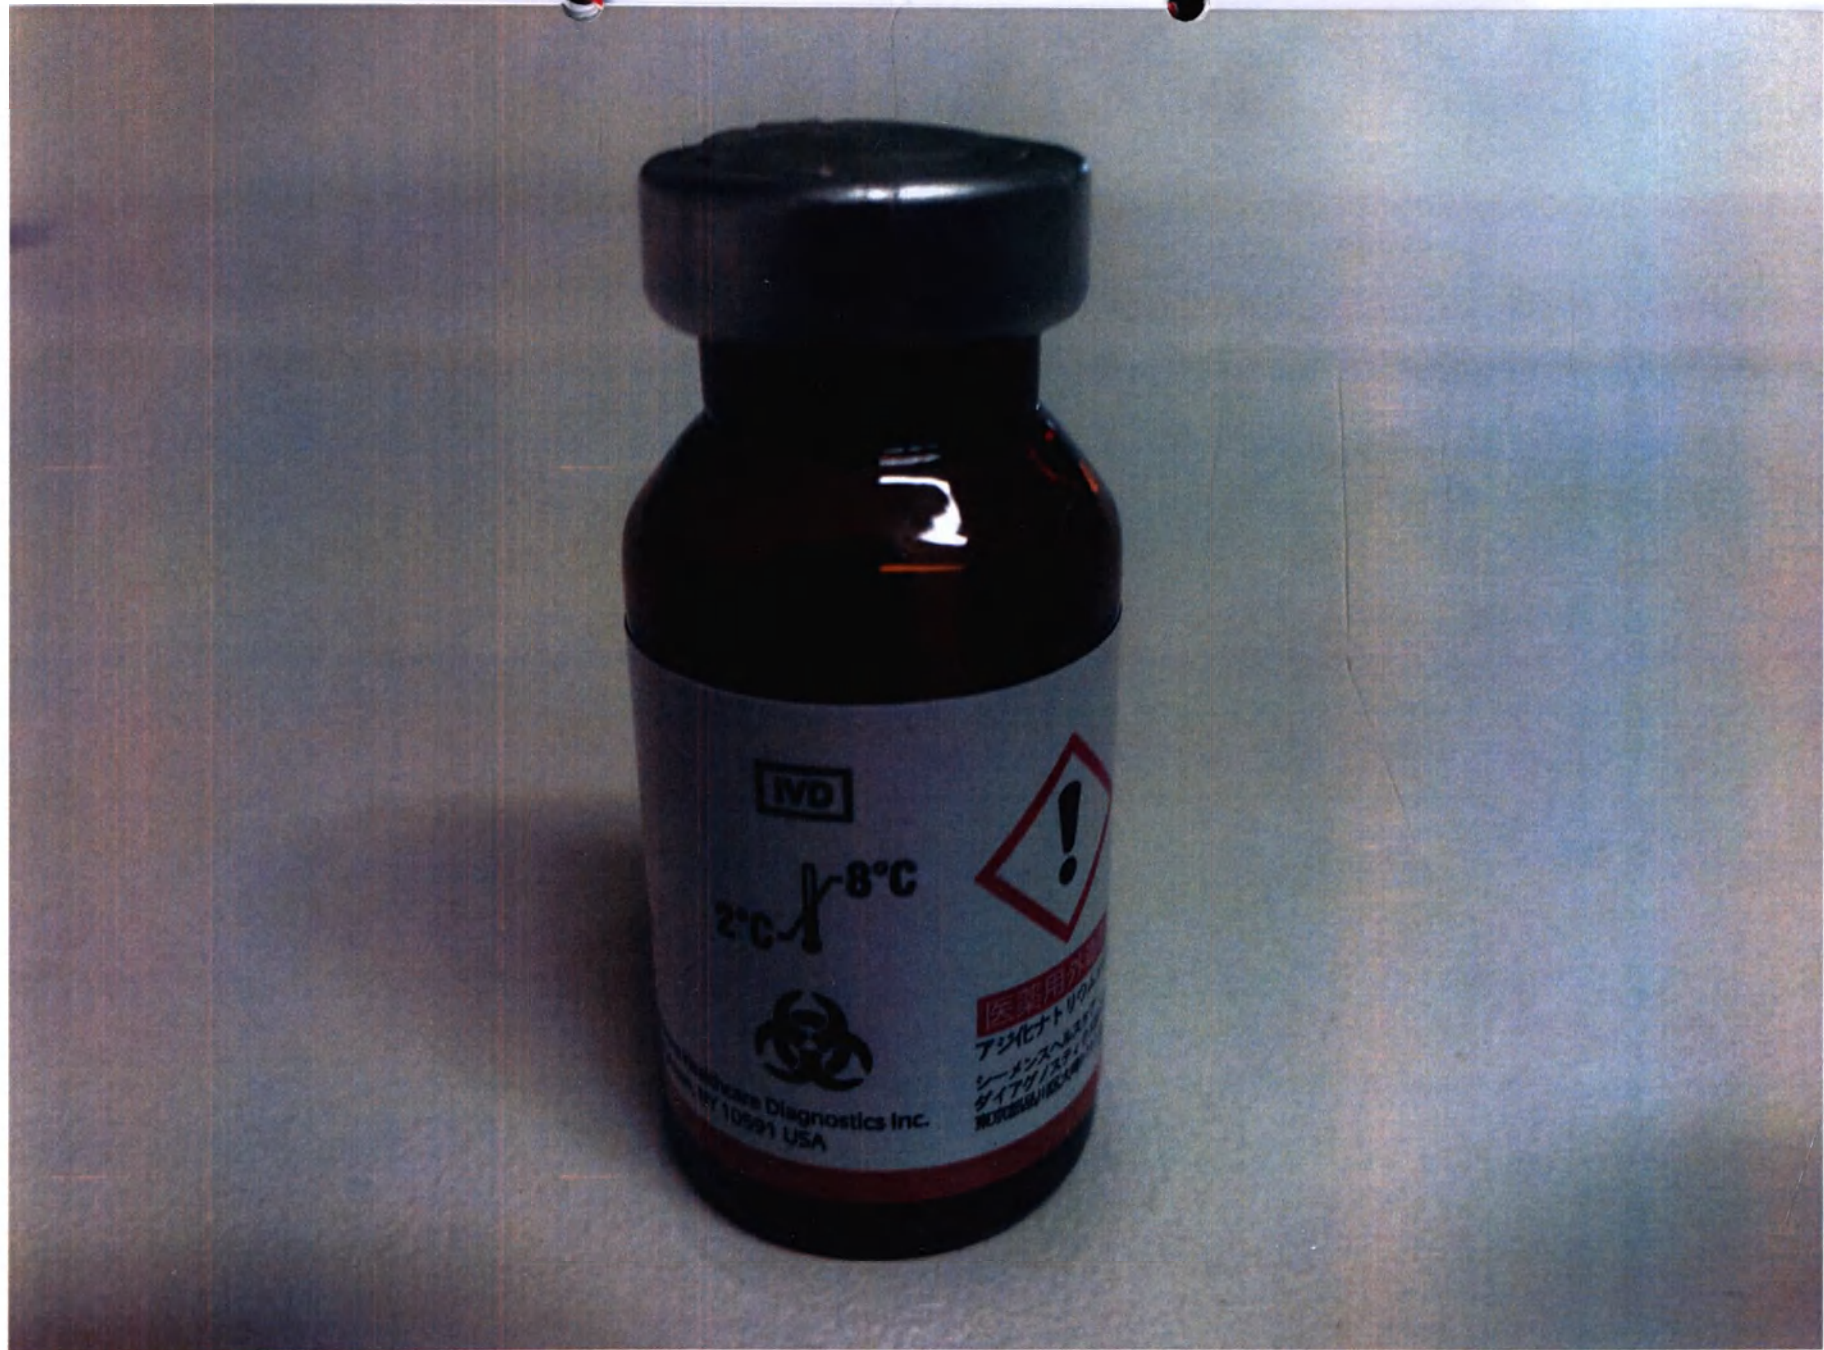


Рисунок 11. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Калибратор с высокой концентрацией
Atellica IM CAL D H 2.0 mg

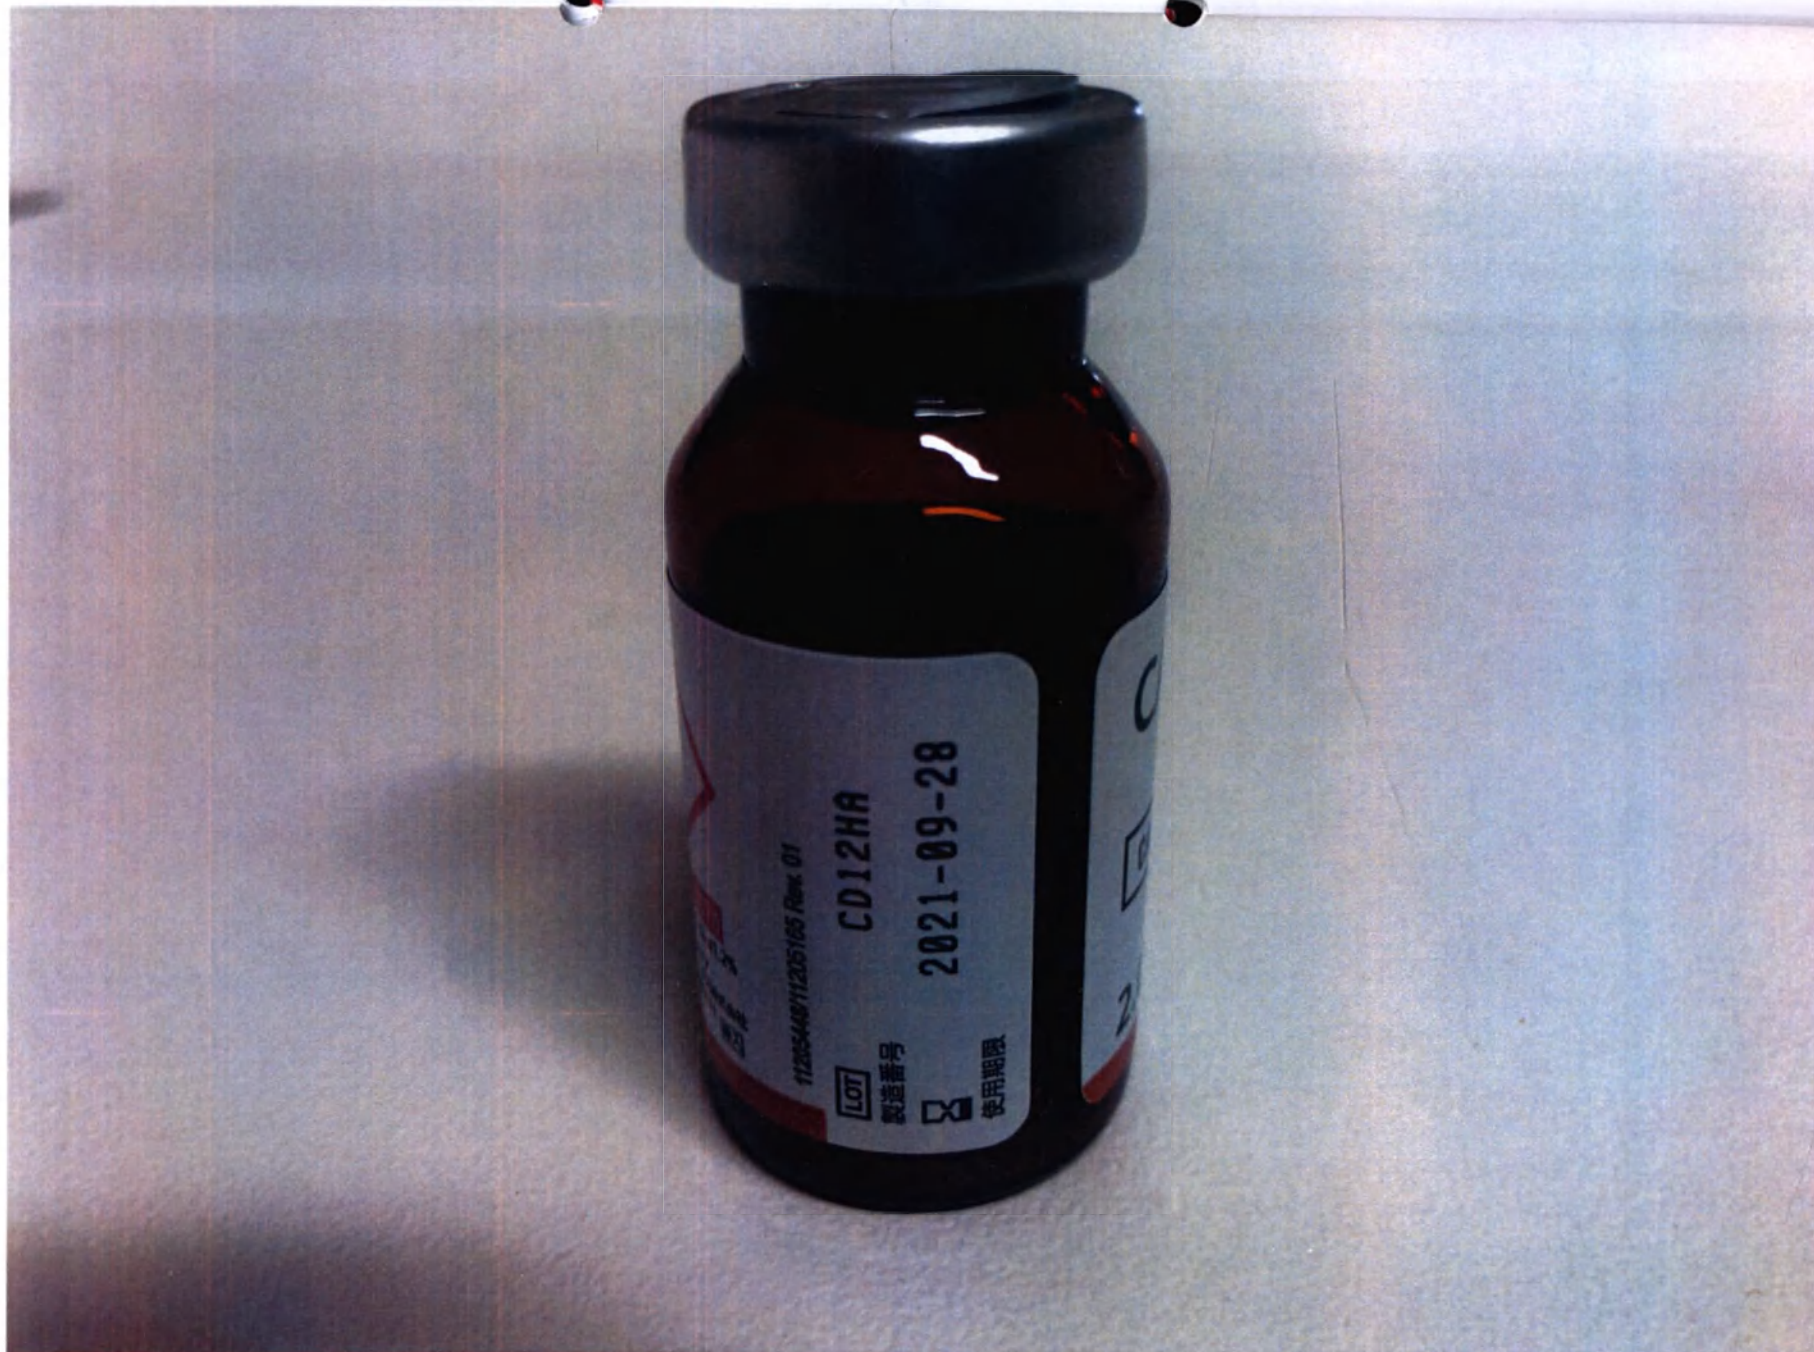


Рисунок 12. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)); Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CAL D H 20 мл

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CAL

D

CAL LOT VAL

LOT

CD12

製造番号



2021-09-28

使用期限



siemens.com/document-library



294dbdc5

CHECKSUM

CAL L

UNITS C

UNITS SI

CAL H

UNITS C

UNITS SI

AFP



5.21 NG/ML 4.32 IU/ML 220 NG/ML 183 IU/ML

CEA



3.45 NG/ML 3.45 UG/L 57.7 NG/ML 57.7 UG/L

10997640 Rev. 02

Рисунок 13. Набор калибраторов D для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator D (Atellica IM CAL D)): Лист значений параметров лота калибратора



Всего прошито и пронумеровано
74 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

