

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.

МП



10.06.2020



Фотографические изображения изделия:

Набор калибраторов для количественного определения антител к тиреоглобулину (Antibody to thyroglobulin (Anti-Tg CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд.»), Китай

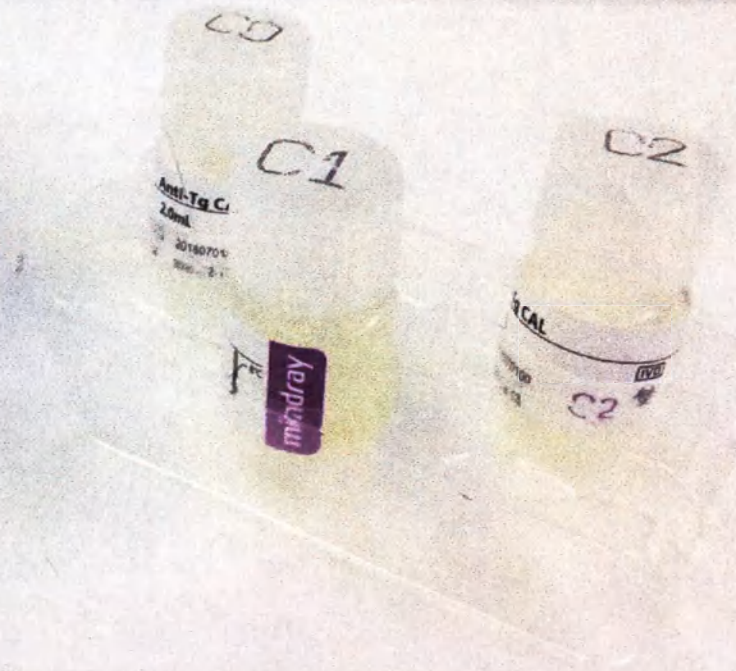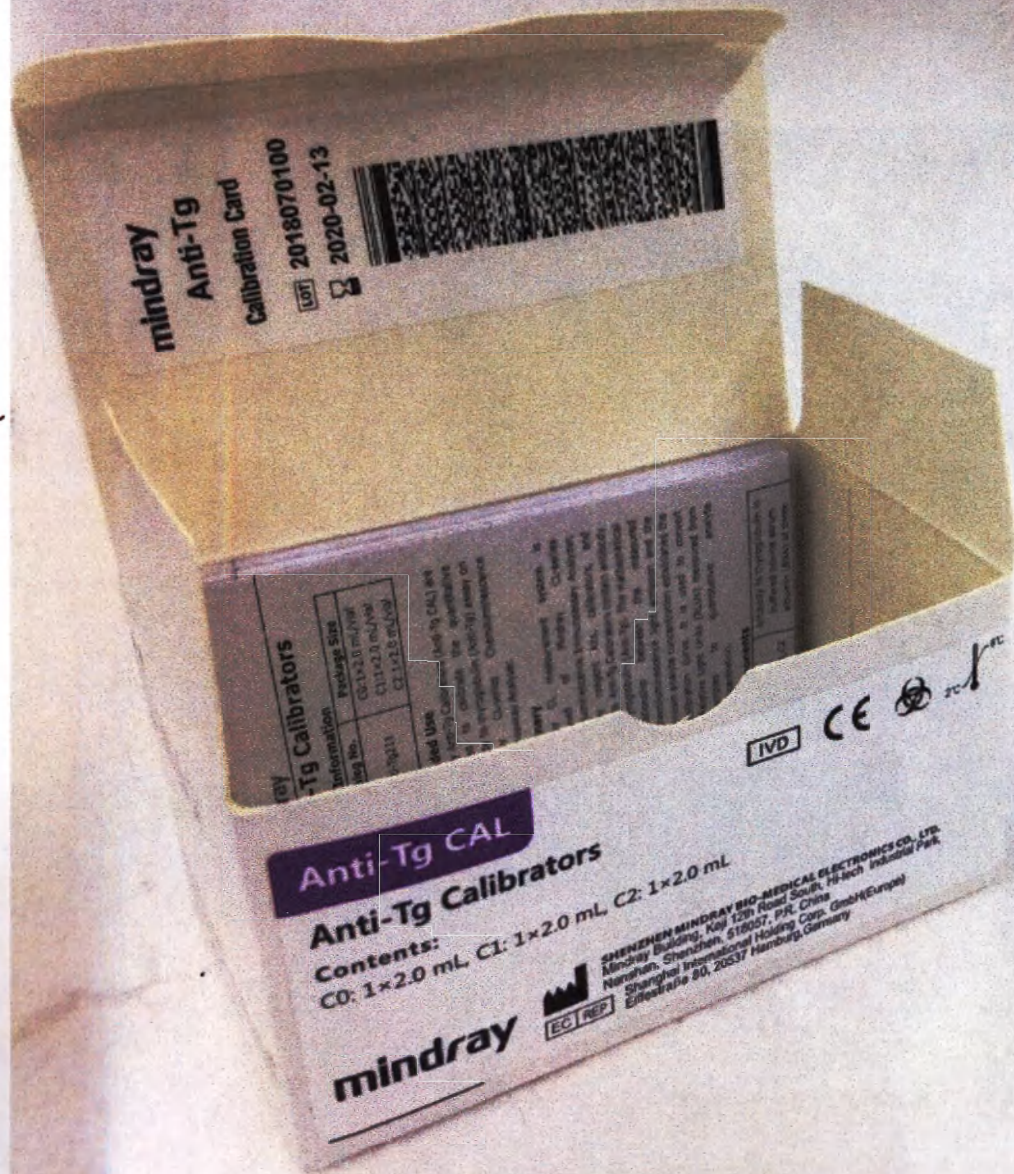

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 2 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А.
М.П.

