



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.

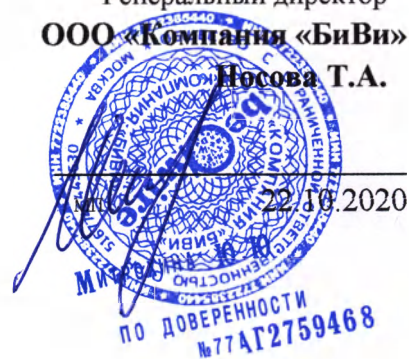


Фотографические изображения изделия:

Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control для контроля качества количественного определения антитиреоидных антител иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. »), Китай

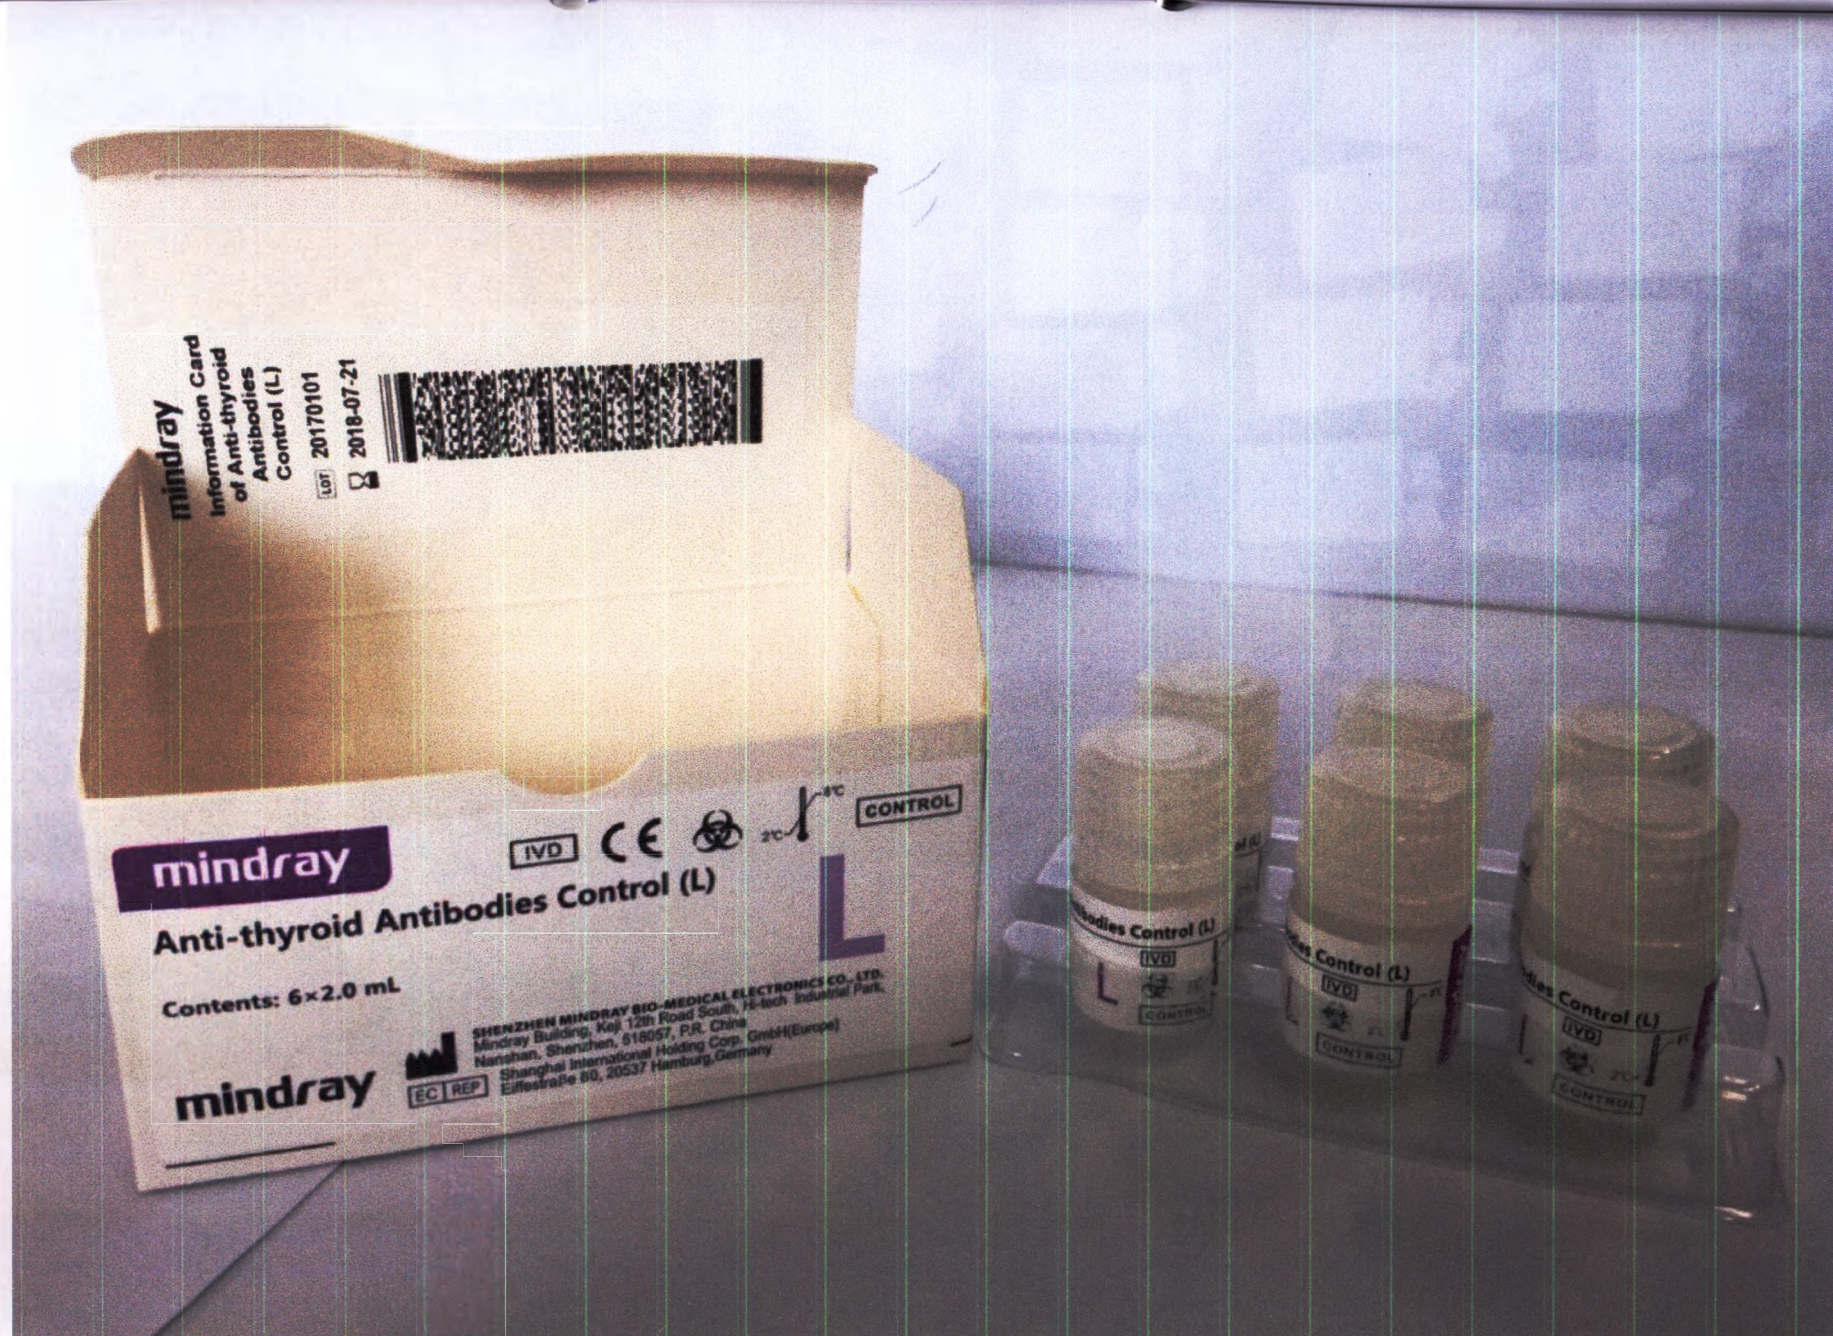

Общий вид медицинского изделия (Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control для контроля качества количественного определения антитиреоидных антител иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, в вариантах исполнения: Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control (L), 6 флаконов по 2,0 мл.)

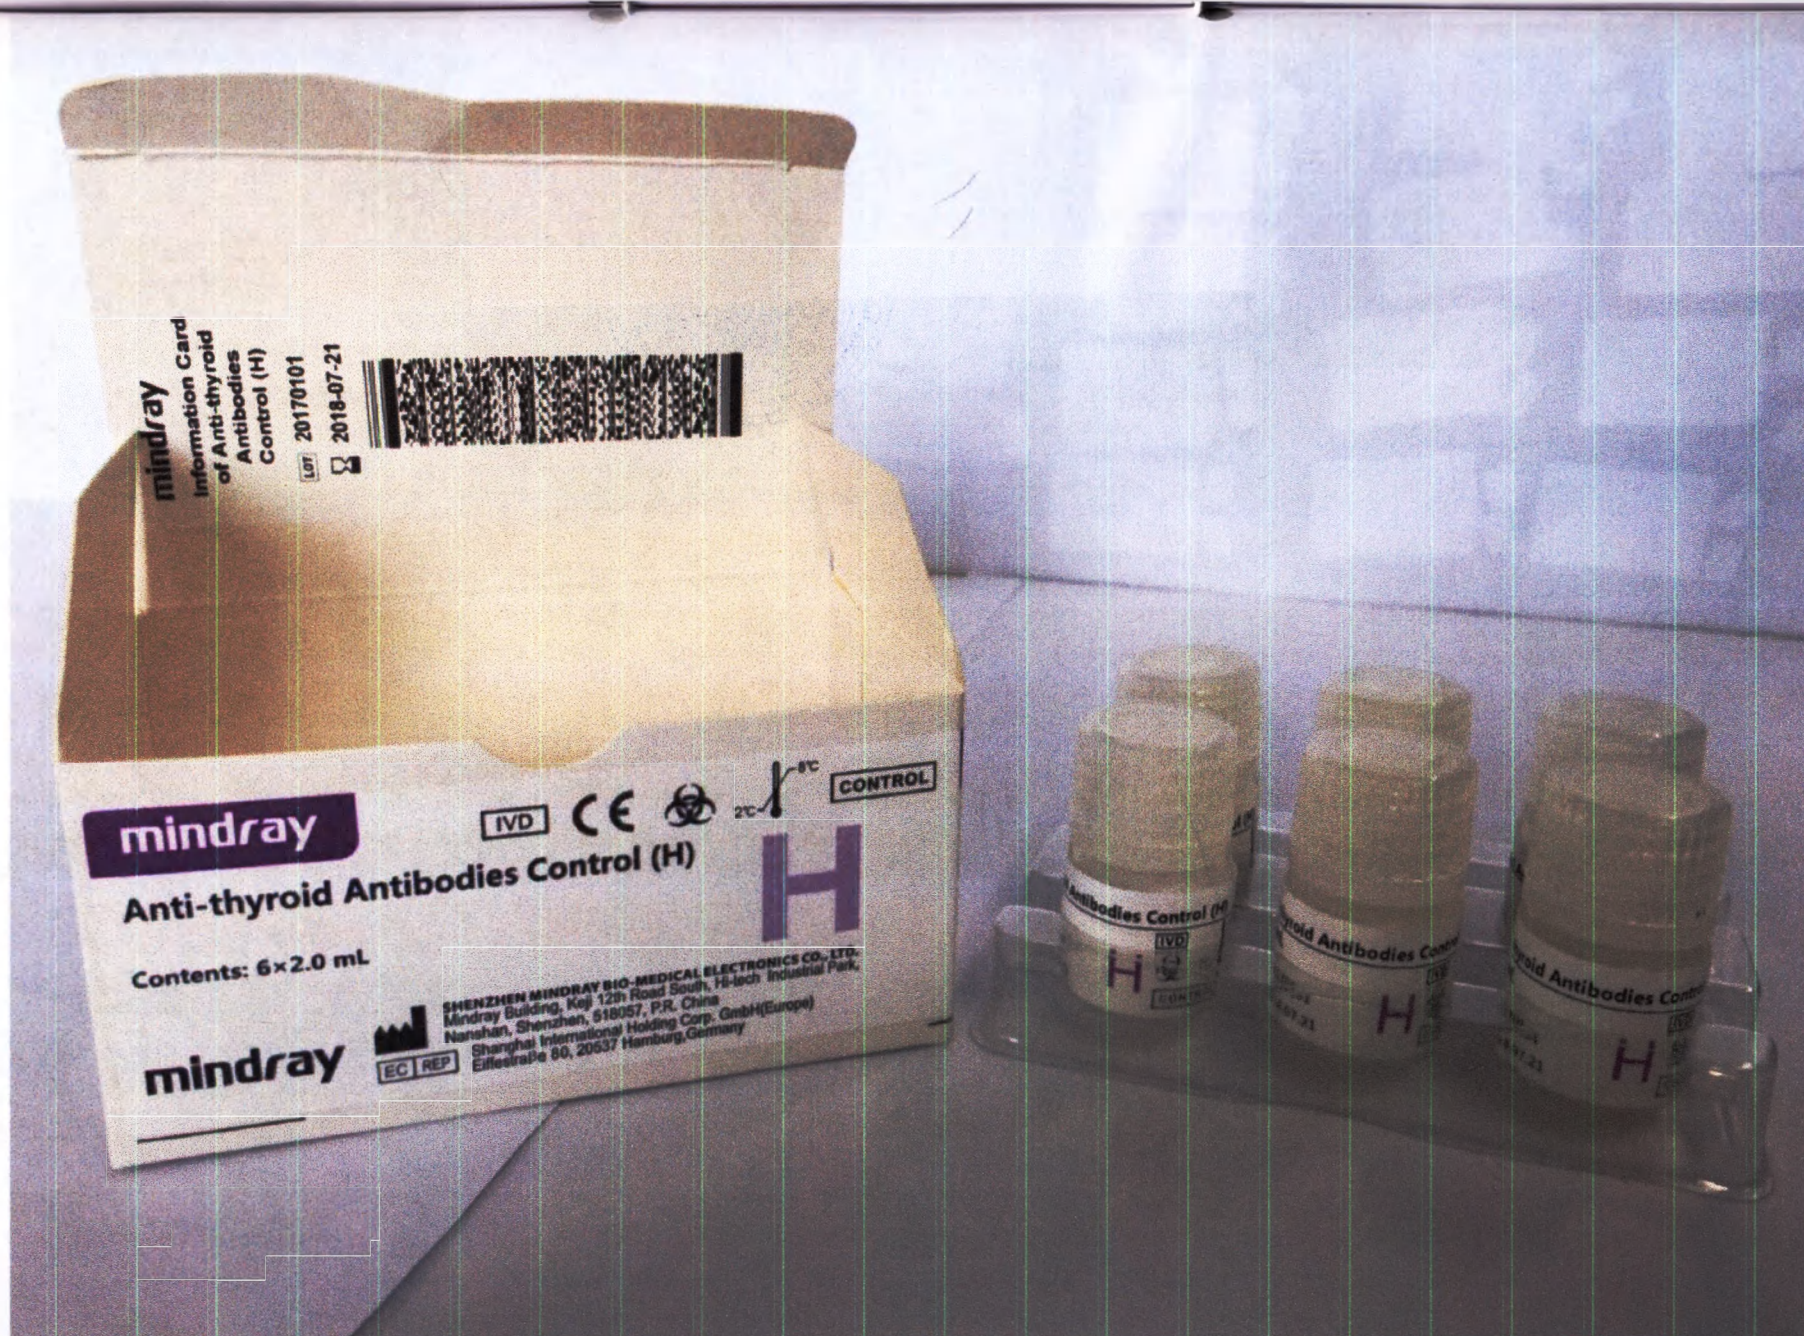

Общий вид медицинского изделия (Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control для контроля качества количественного определения антитиреоидных антител иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, в вариантах исполнения: Материал контрольный Anti-thyroid

Antibodies Control (H), 6 флаконов по 2,0 мл.)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 3 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А.
М.П.

