



127422 г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1,
Помещение 1, комната 2Б
+7(495) 780-0793
www.dixon.ru
info@dixon.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»





А.А. Яковлев


10.06.2020г.

**Фотографические изображения маркировки
медицинского изделия**

Фороптор автоматический РВК-9000 с принадлежностями

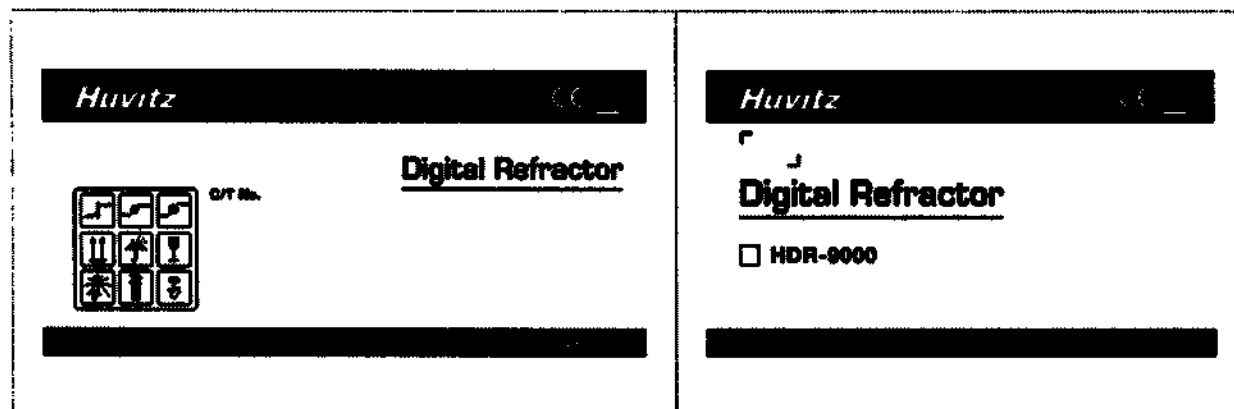

Внешний вид макета маркировки упаковки:

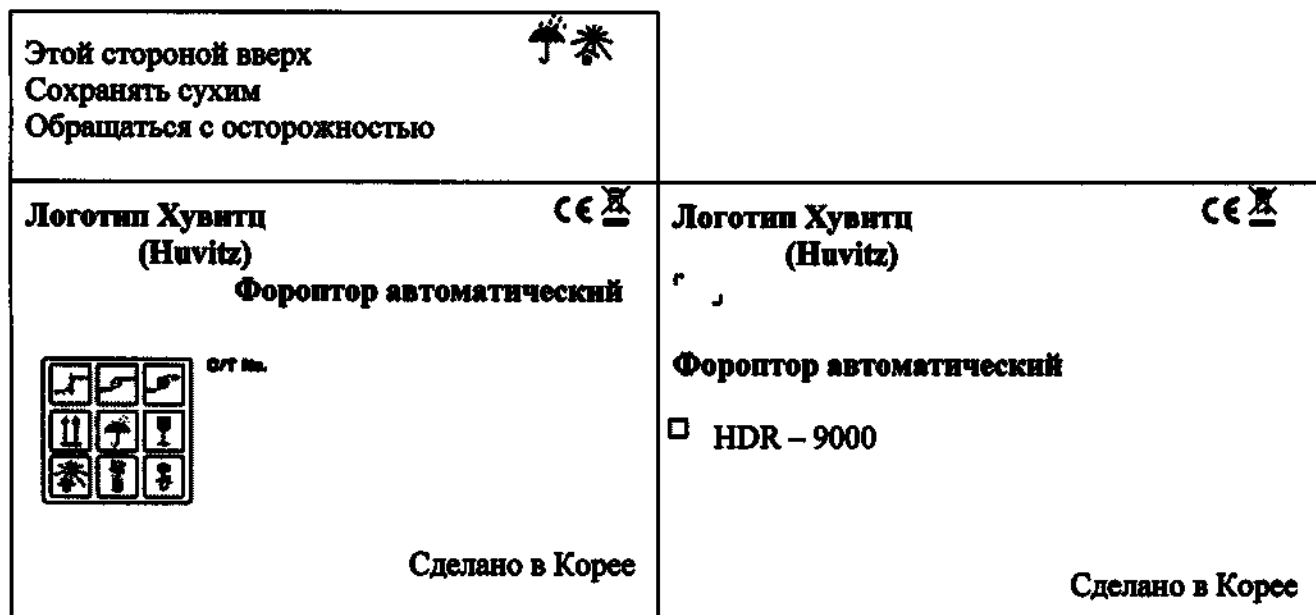

Перевод макета маркировки упаковки на русский язык




Макет маркировка блок фороптора основного

Хувитц (Huvitz)	Фороптора автоматического	HDR- 9000
Входное питание: 15V постоянного тока 1.5A 		 
Серийный номер (SN):		MSIP-RMM-HVZ-HDR-9000 KCC-CRM-TPN-TL-WN725N CE 0984  
 «Использовать только распределительную коробку «Фороптор автоматический HDR- 9000(JB)», производства Хувитц Ко., Лтд (Huvitz Co., Ltd) как источник питания»		
38, Бурим-ро 170пон-гиль, Донган-гу, Анян-си, Кёнги-до, 14055, Республика Корея (38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055 Republic of Korea)		
Дата производства:	Хувитц Ко., Лтд (Huvitz Co., Ltd)	
Сделано в Корее		


Перевод макета маркировки блока фороптора основного



Макет марки пульта управления

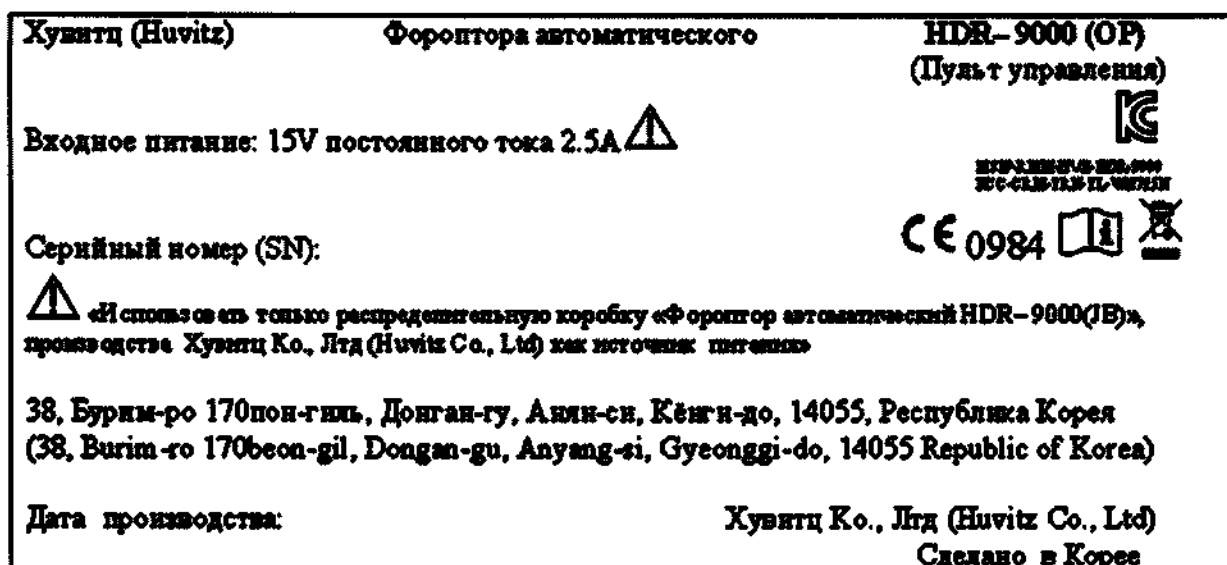

Перевод макета маркировки пульта управления

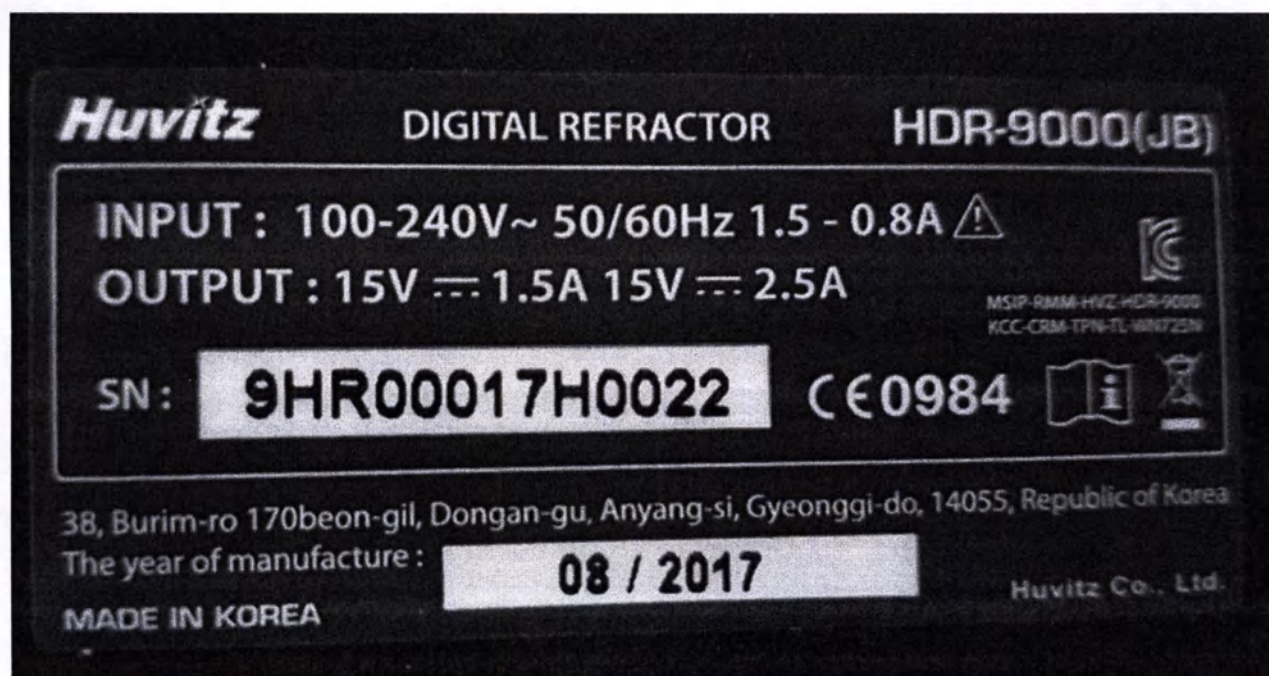

Макет маркировки коробки распределительной

Хувитц (Huvitz)	Фороптора автоматического	HDR- 9000 (JB) (распределительная коробка)
Входное питание: 100-240В, переменного тока; 50/60 Гц, 1,0-0,8А ⚠		 MSIP-RMM-HVZ-HDR-9000 KCC-CRM-TPN-TL-WN725N
Выходное питание: 15В постоянного тока, 1,5А; 15В постоянного тока, 2.5А		
Серийный номер (SN):		CE0984  
38, Бурим-ро 170пон-гиль, Донган-гу, Анян-си, Кёнги-до, 14055, Республика Корея (38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055 Republic of Korea)		
Дата производства: Сделано в Корее		Хувитц Ко., Лтд (Huvitz Co., Ltd)

Перевод макета маркировки коробки распределительной

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
_____ ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»
Яковлев А.А.





127422 г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1,
Помещение I, комната 2Б
+7(495) 780-0793
www.dixon.ru
info@dixon.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»




Яковлев А.А.

10.06.2020 г.


Фотографические изображения медицинского изделия

Фороптор автоматический HDR-9000 с принадлежностями.

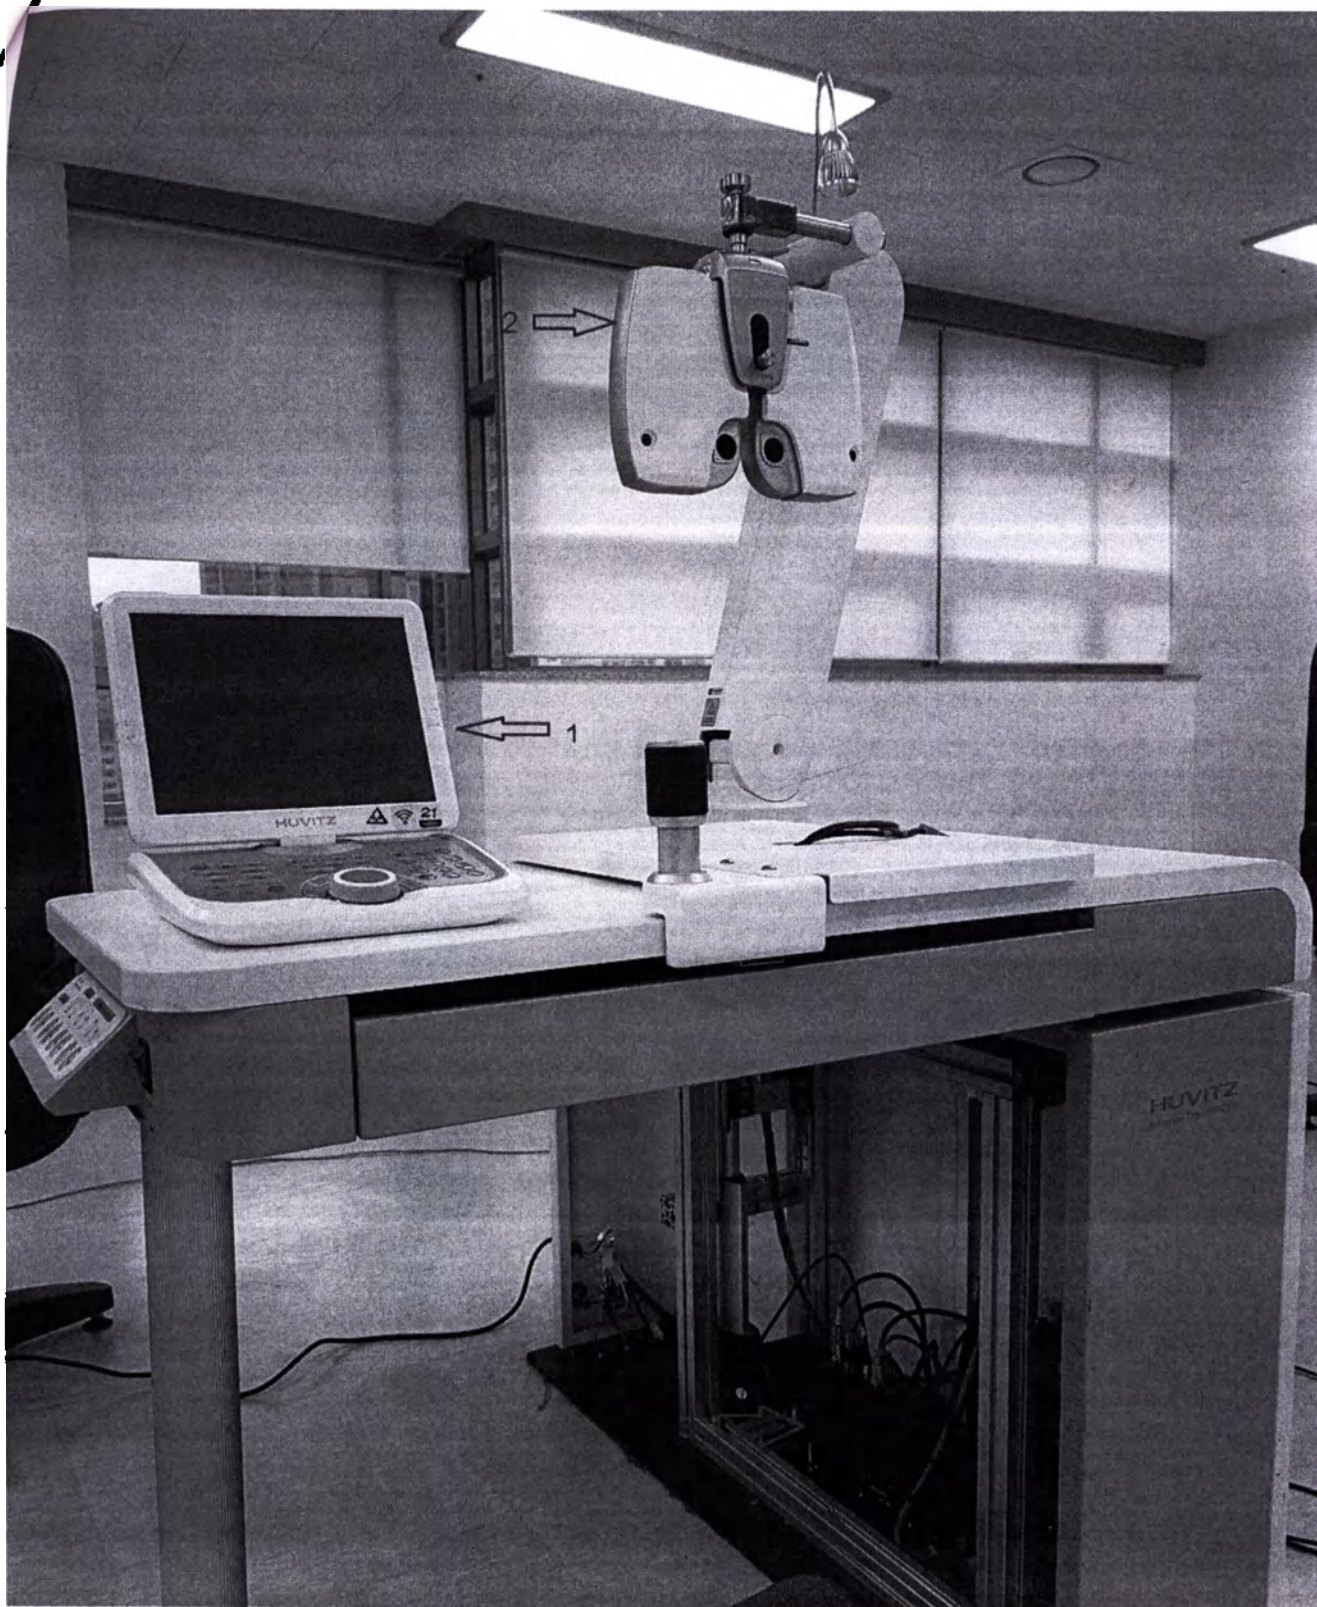

Фороптор автоматический HDR-9000 в собранном виде.

- 1.. Пульт управления**
- 2 Фороптор автоматический HDR-9000**
- 3. Коробка Распределительная**

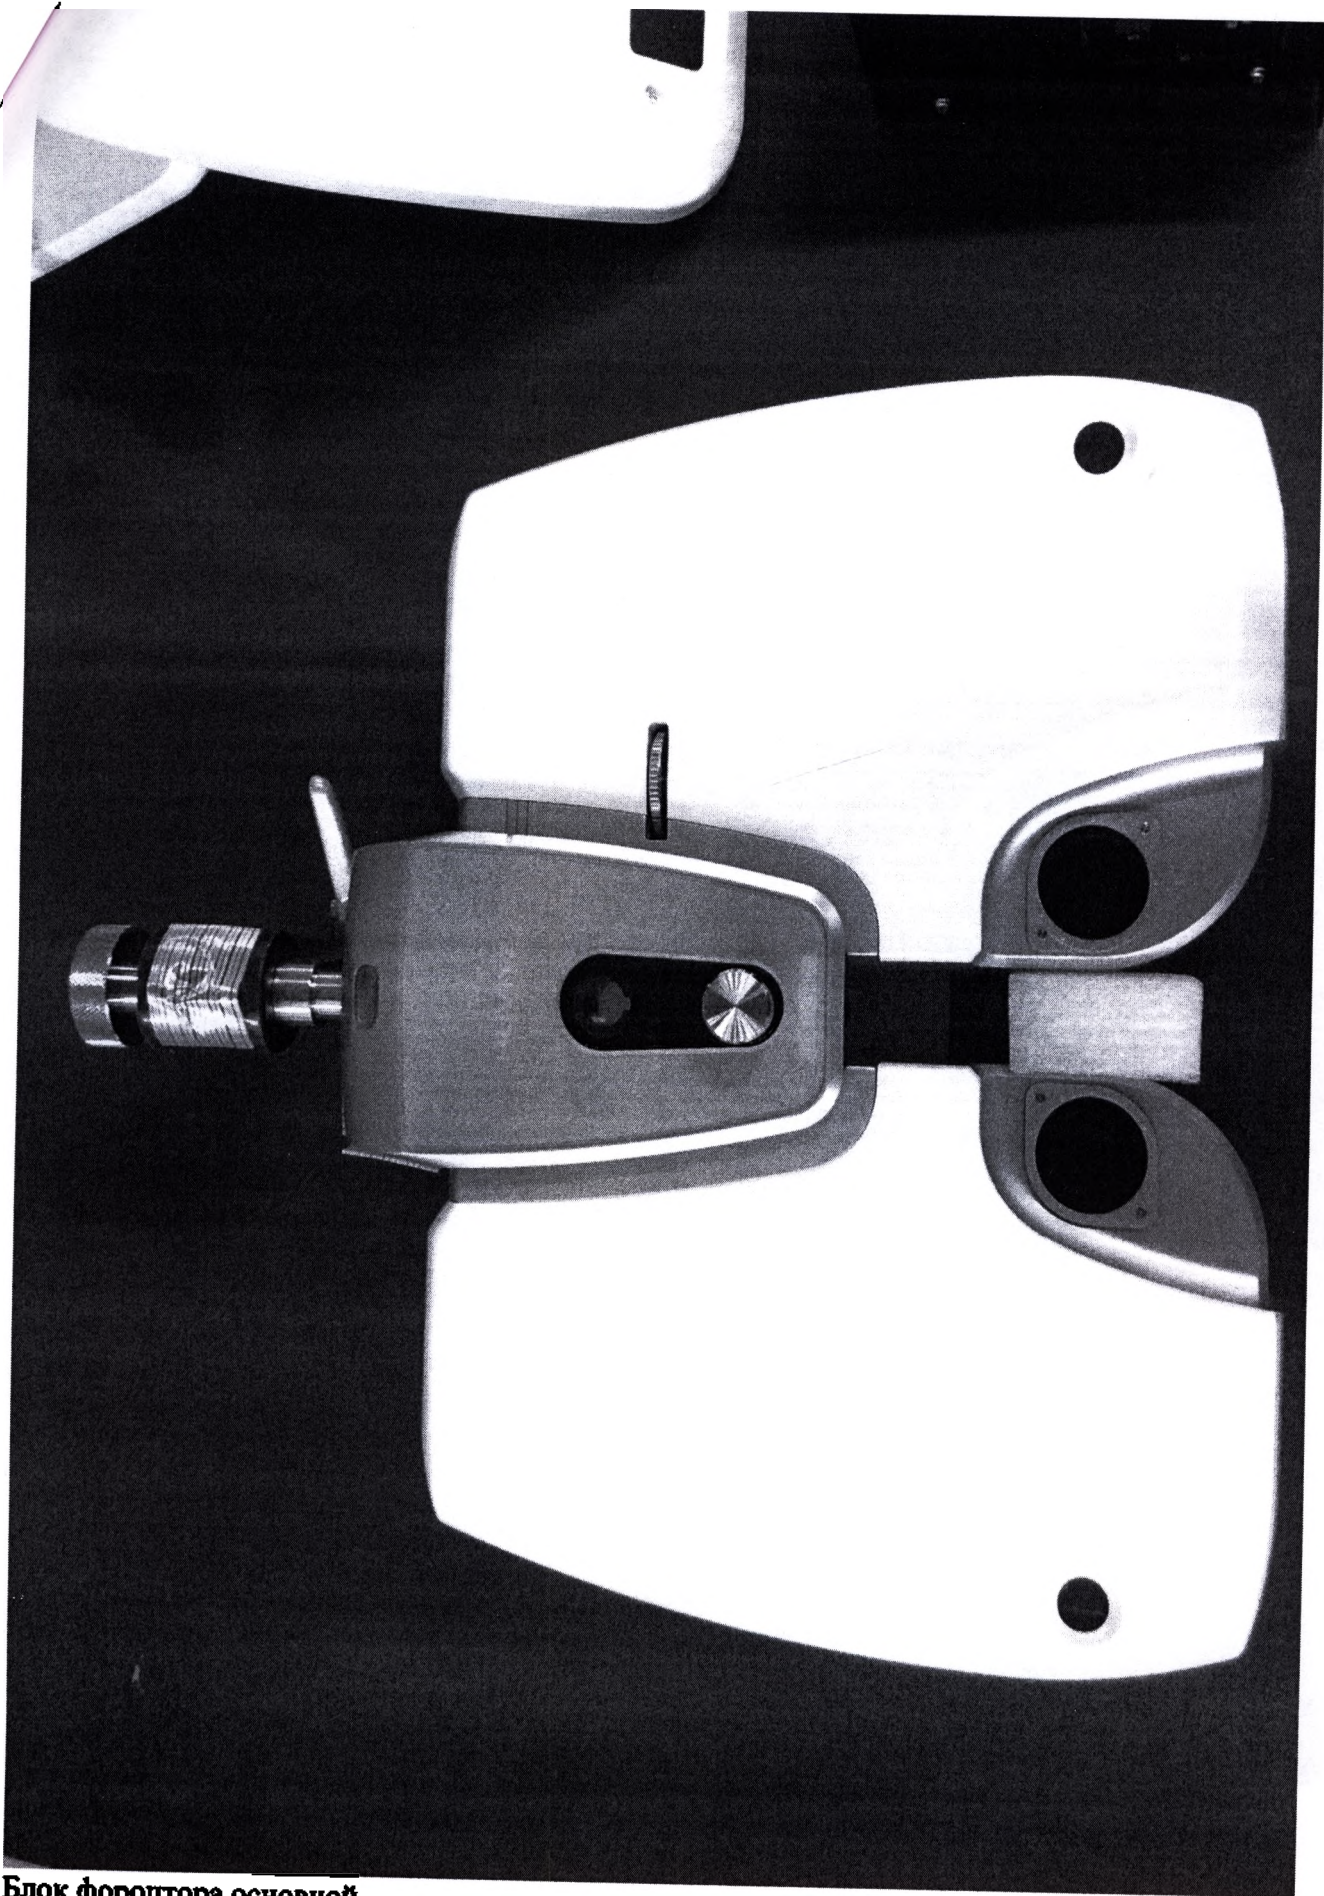

Блок флюоратора основной




Пульт управления



Коробка распределительная



Коробка распределительная

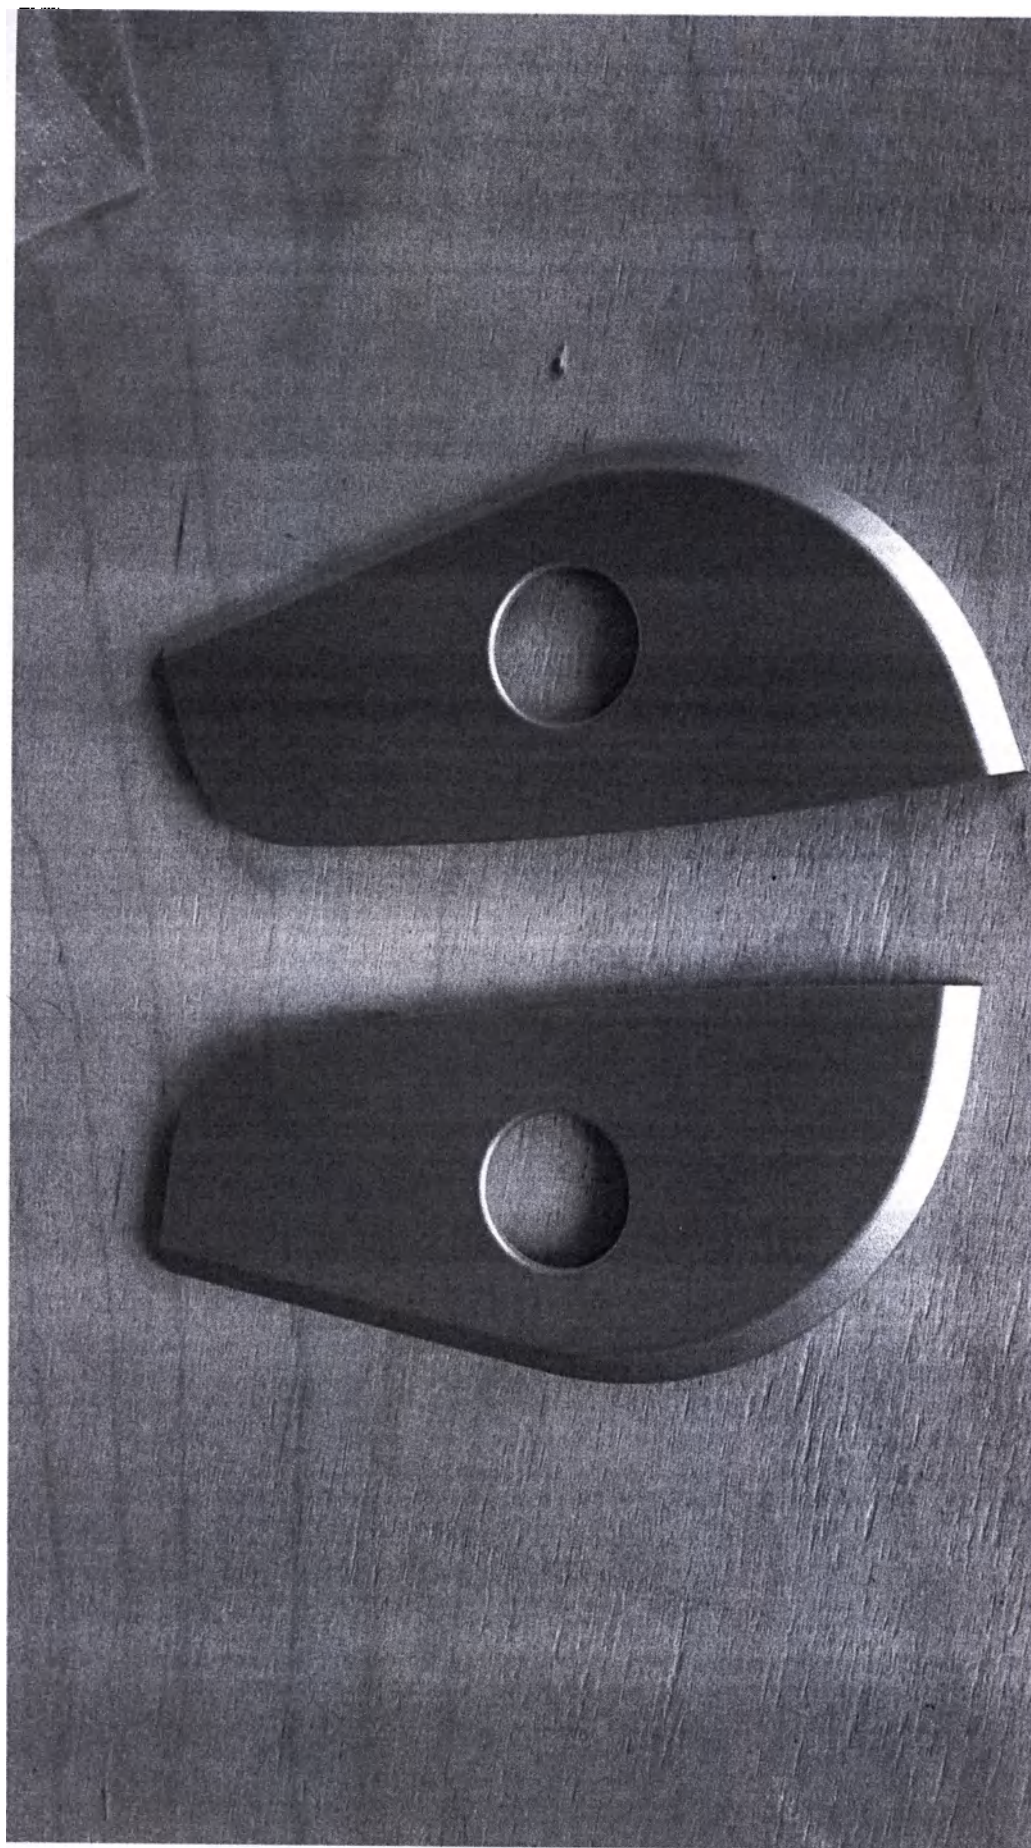

Щиток лицевой


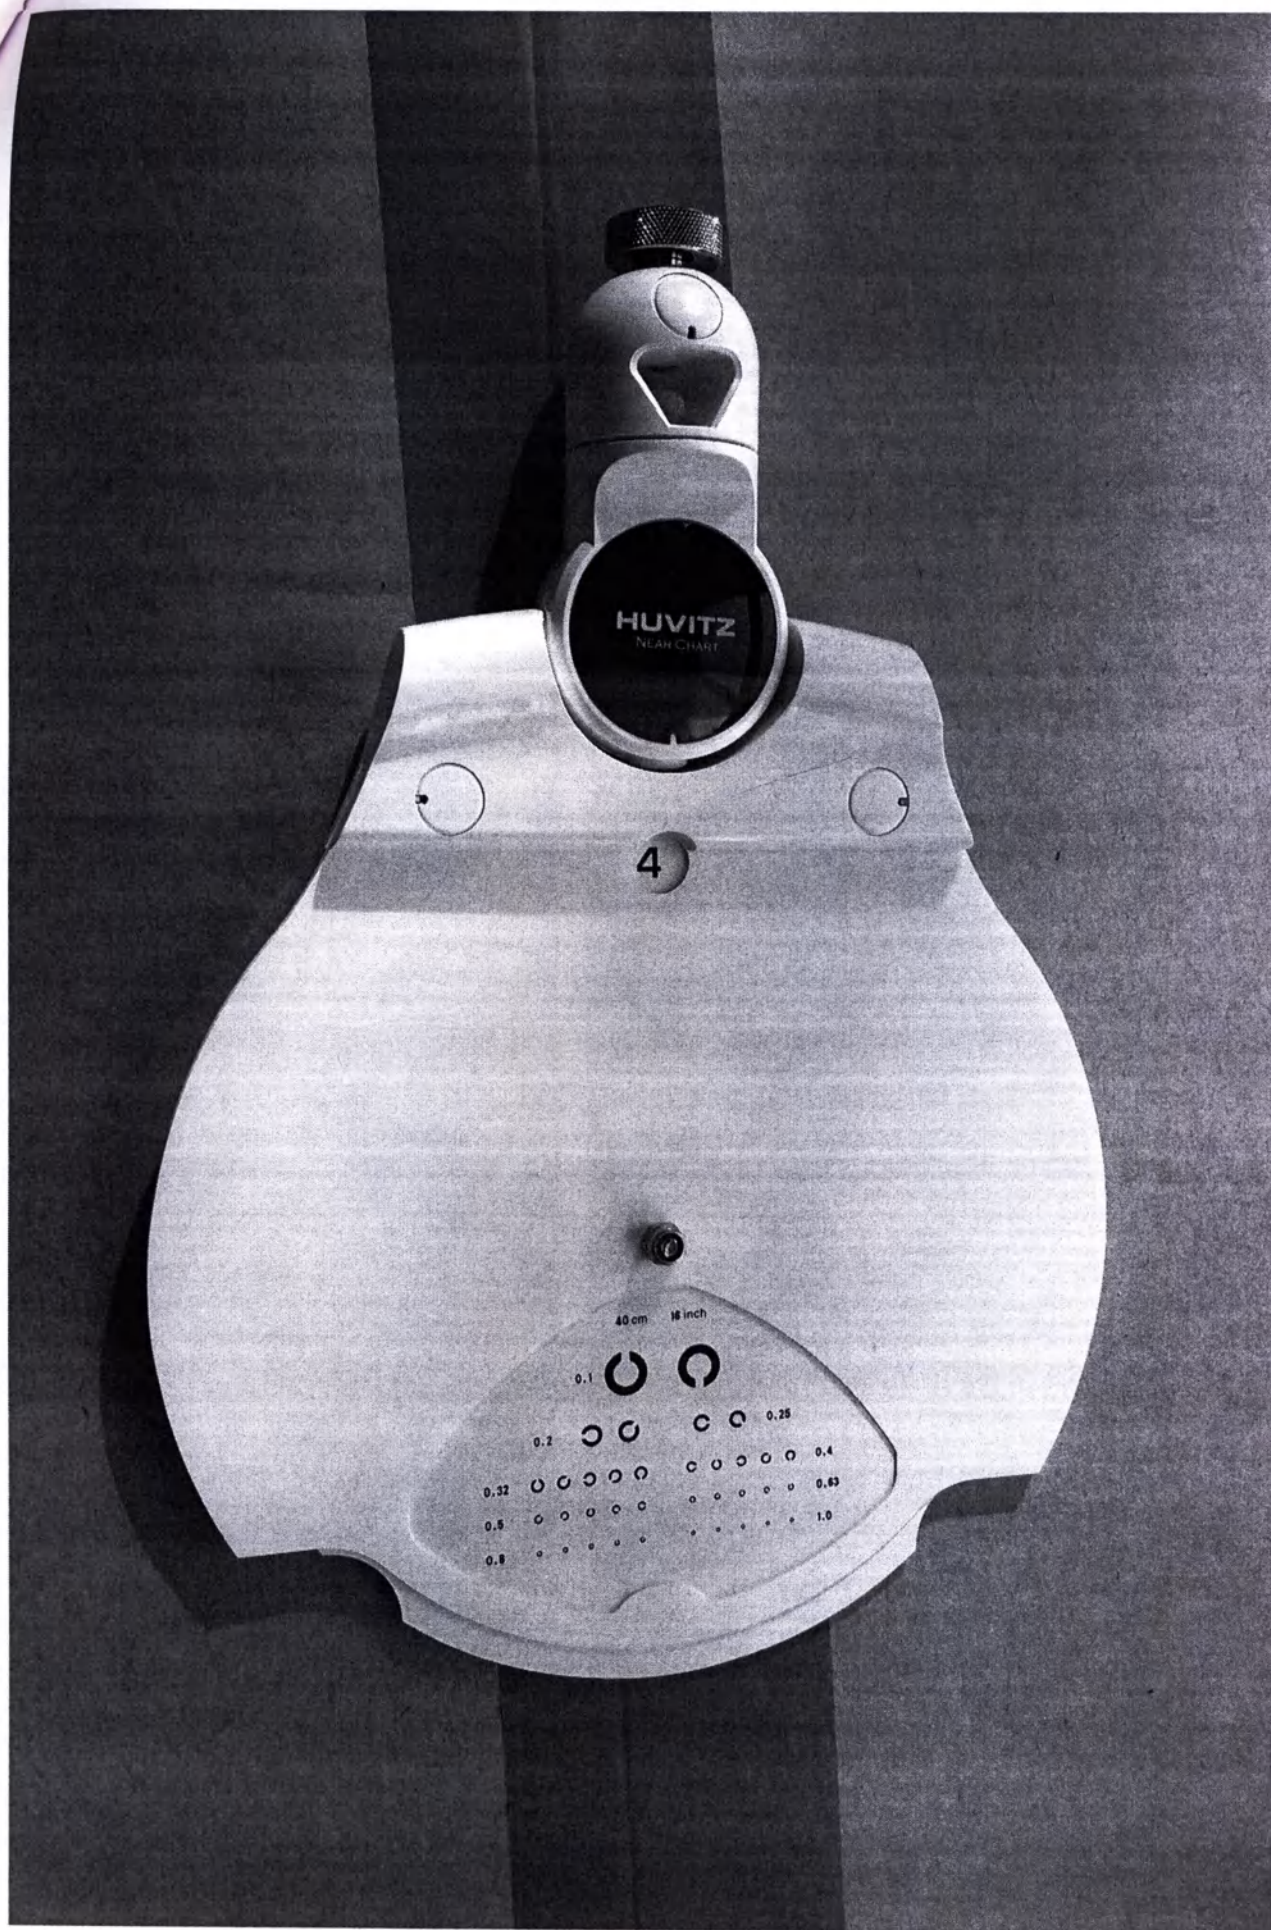



Таблица для зрения вблизи




Стержень металлический

Болт

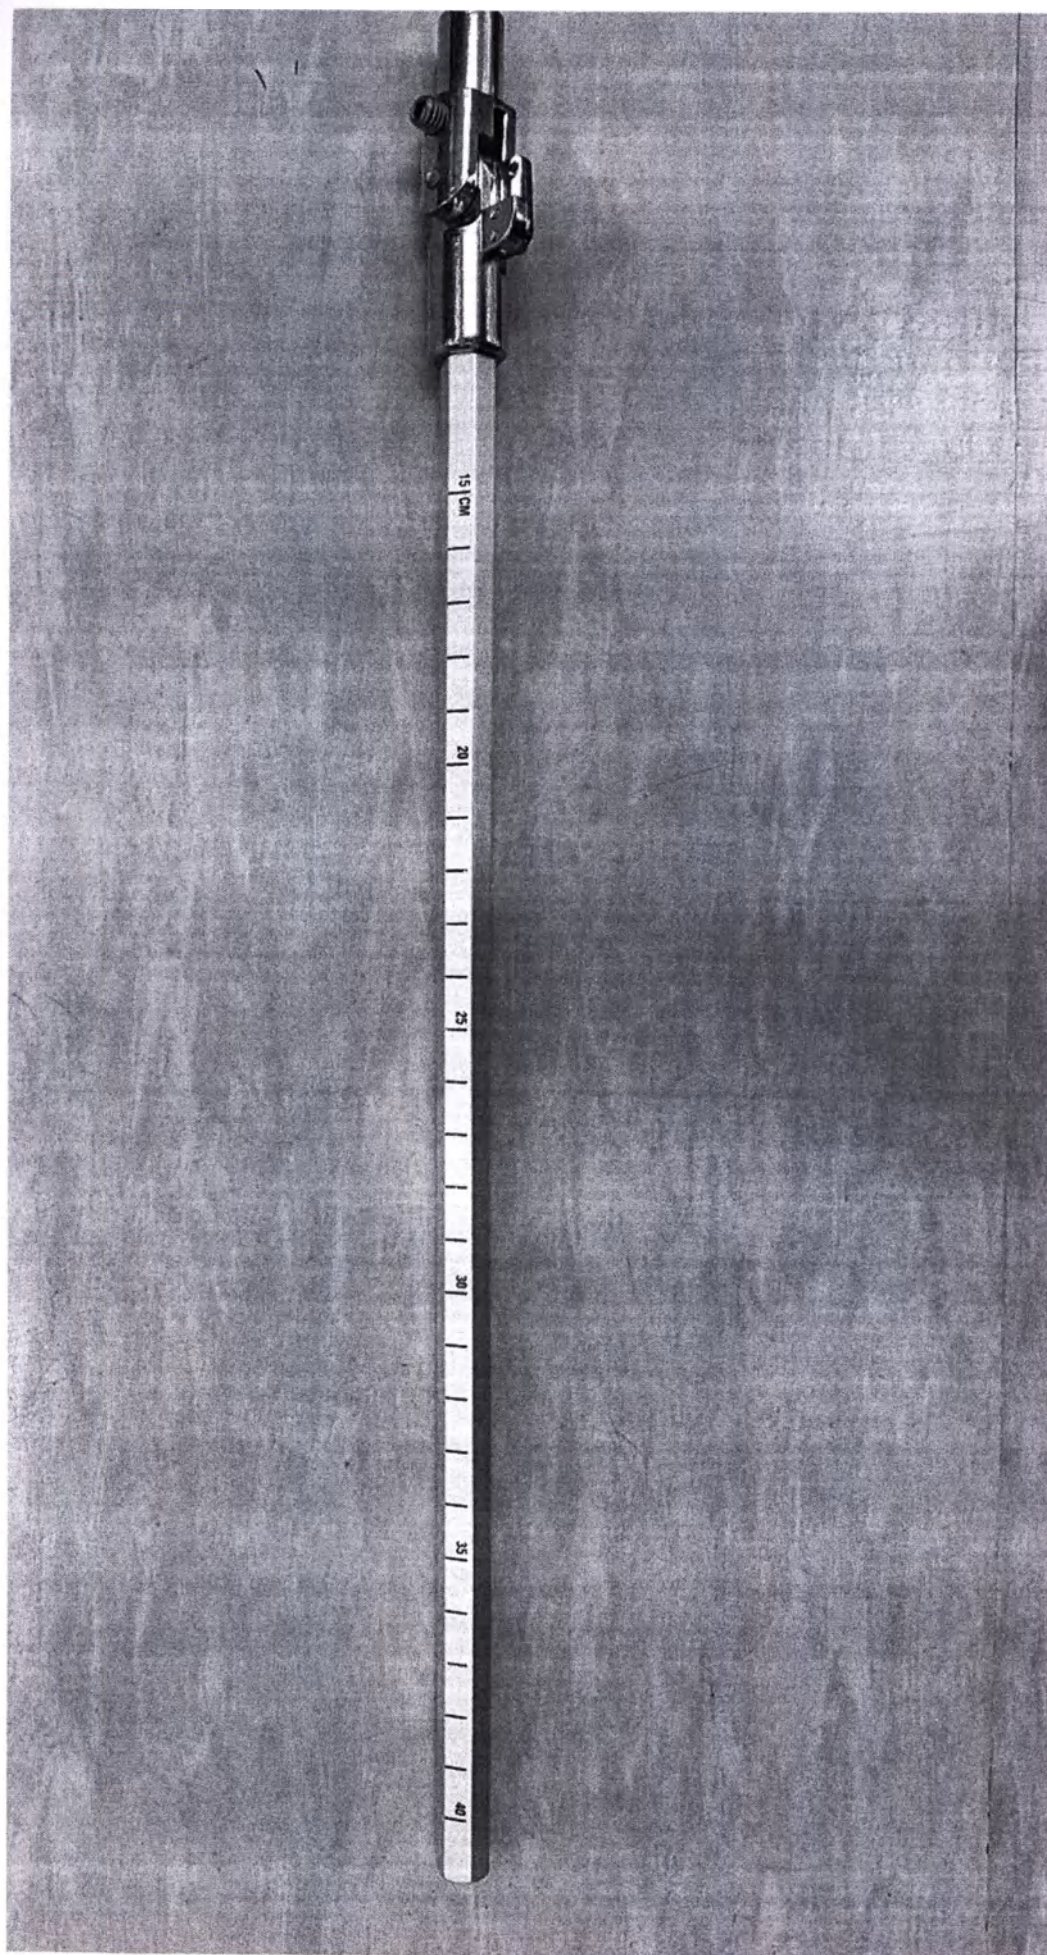


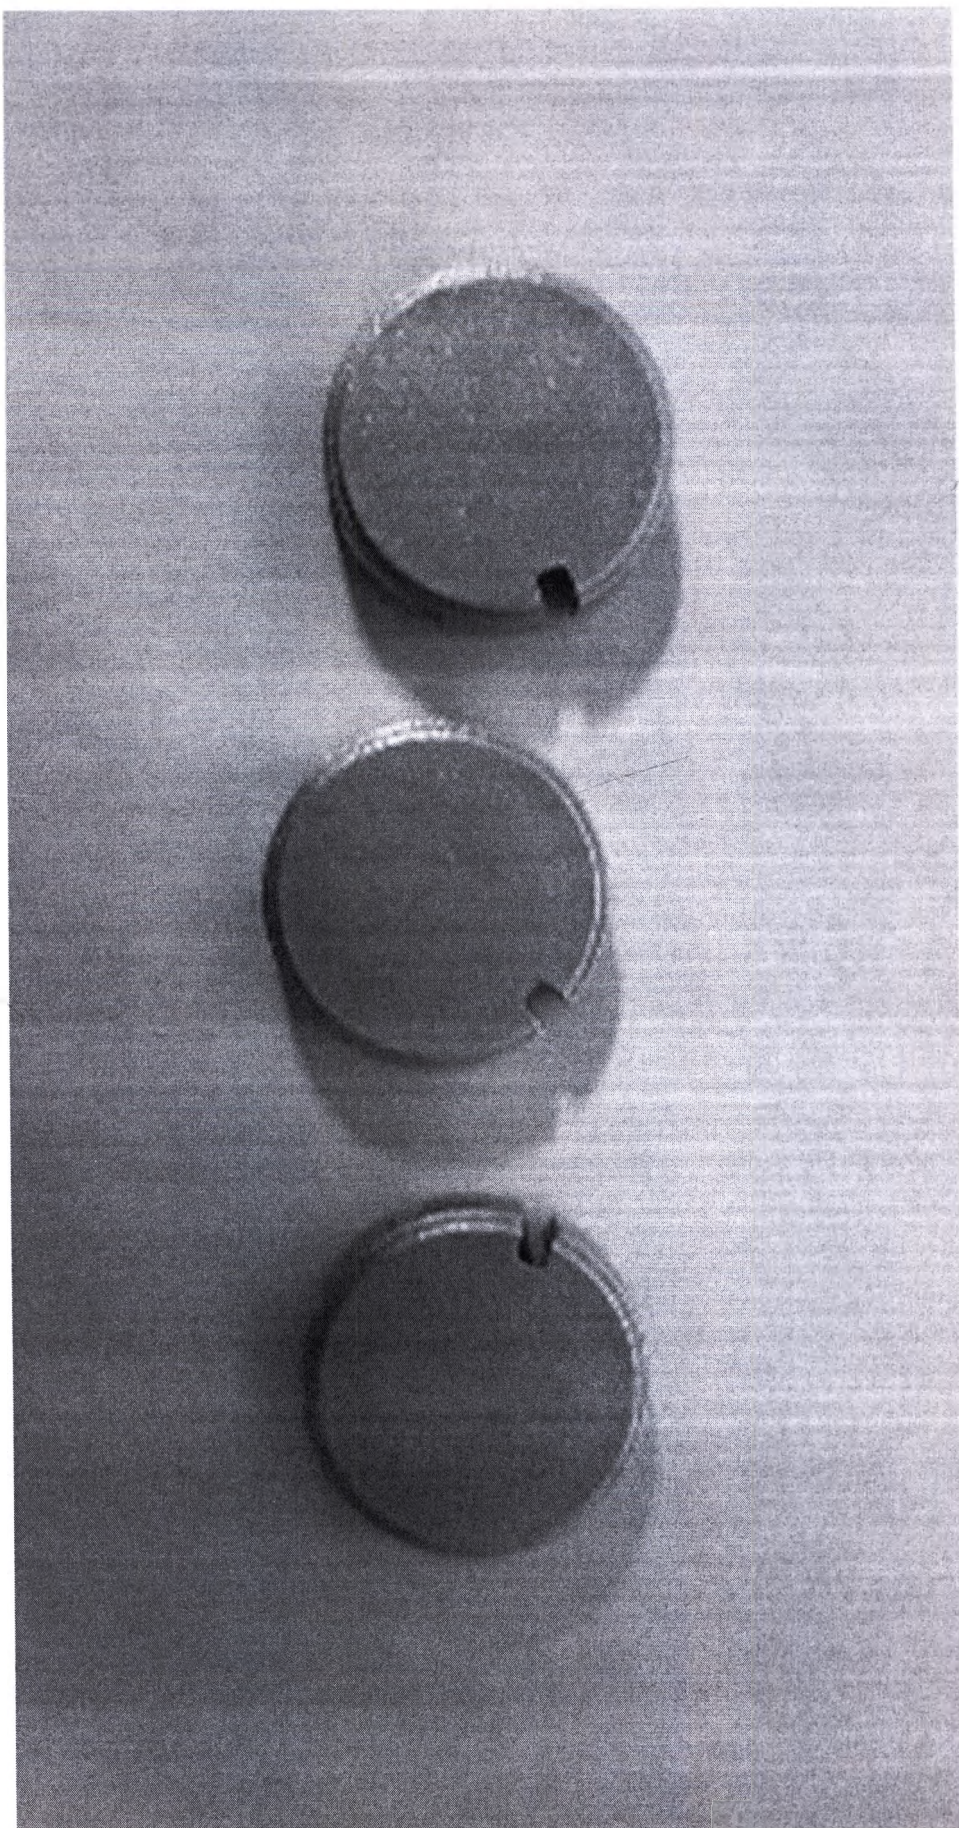


Заглушка болта

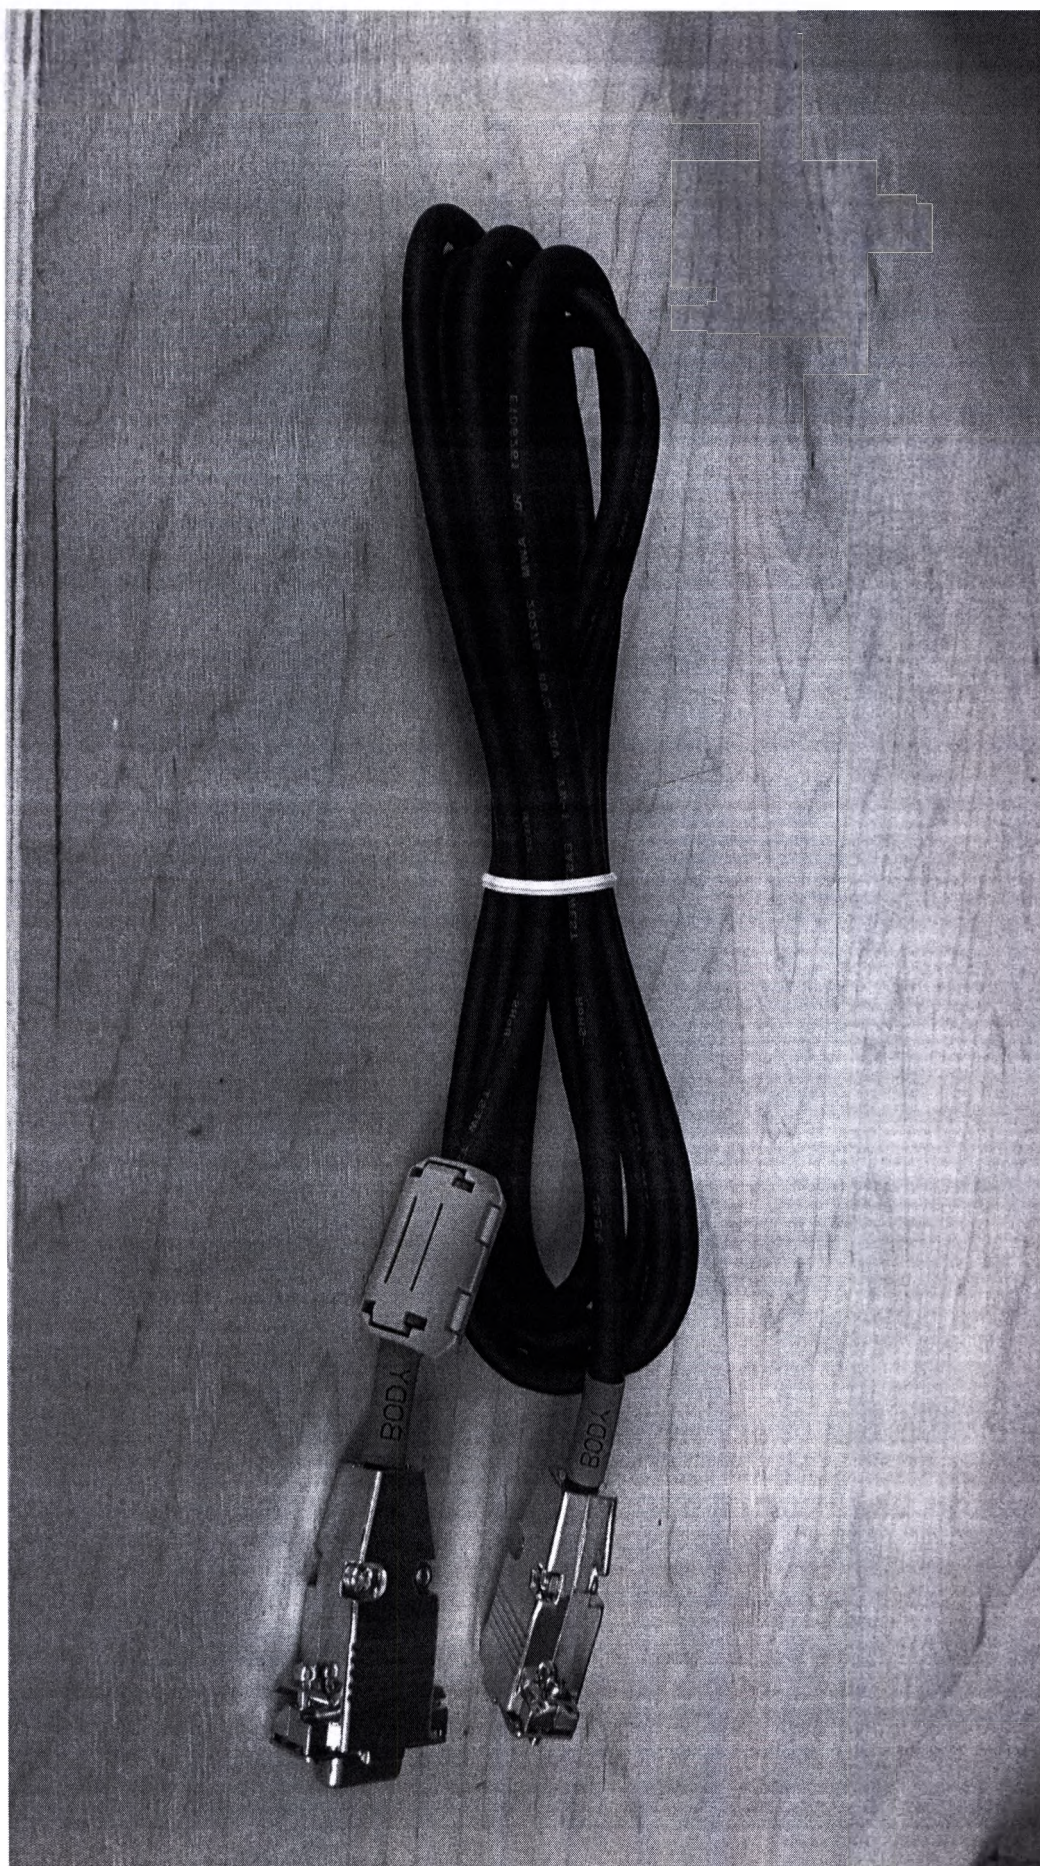


Кабель интерфейсный (15-пиновый, D-SUB) для основного блока

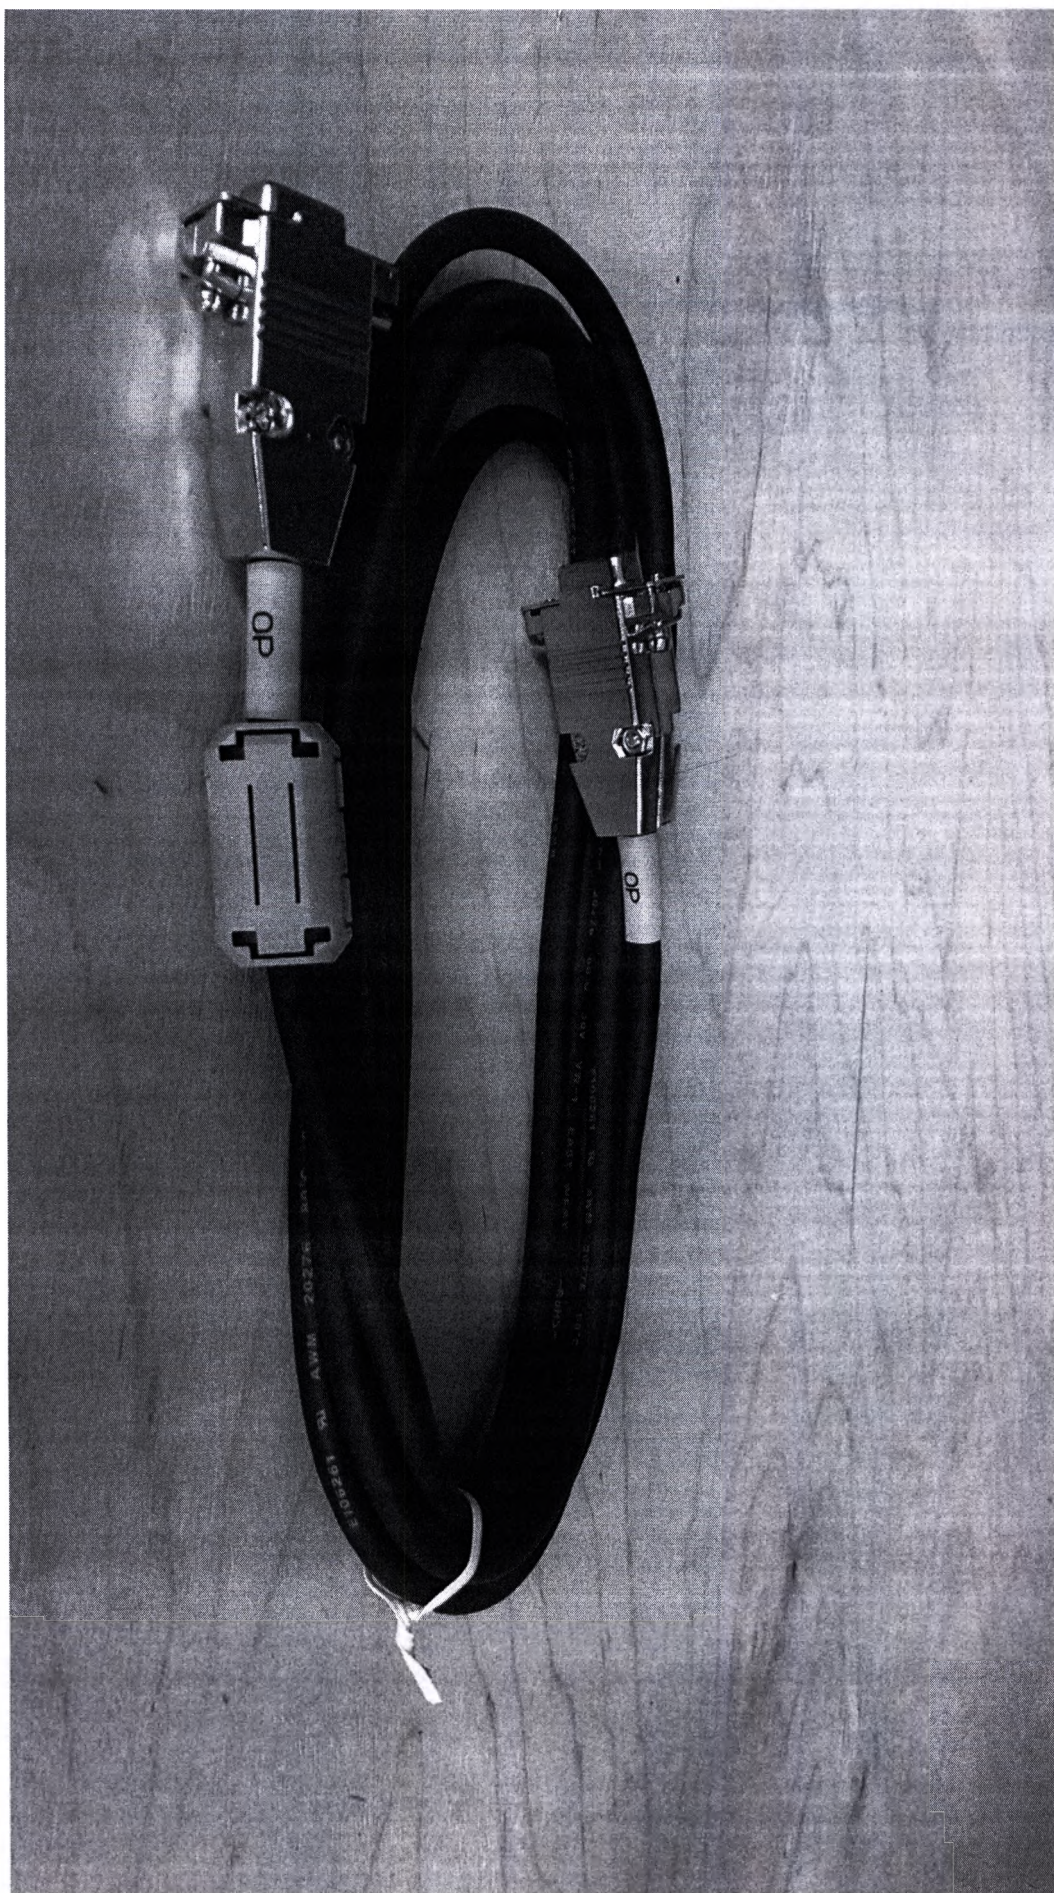


Кабель интерфейсный (15-пиновый, D-SUB) для пульта управления

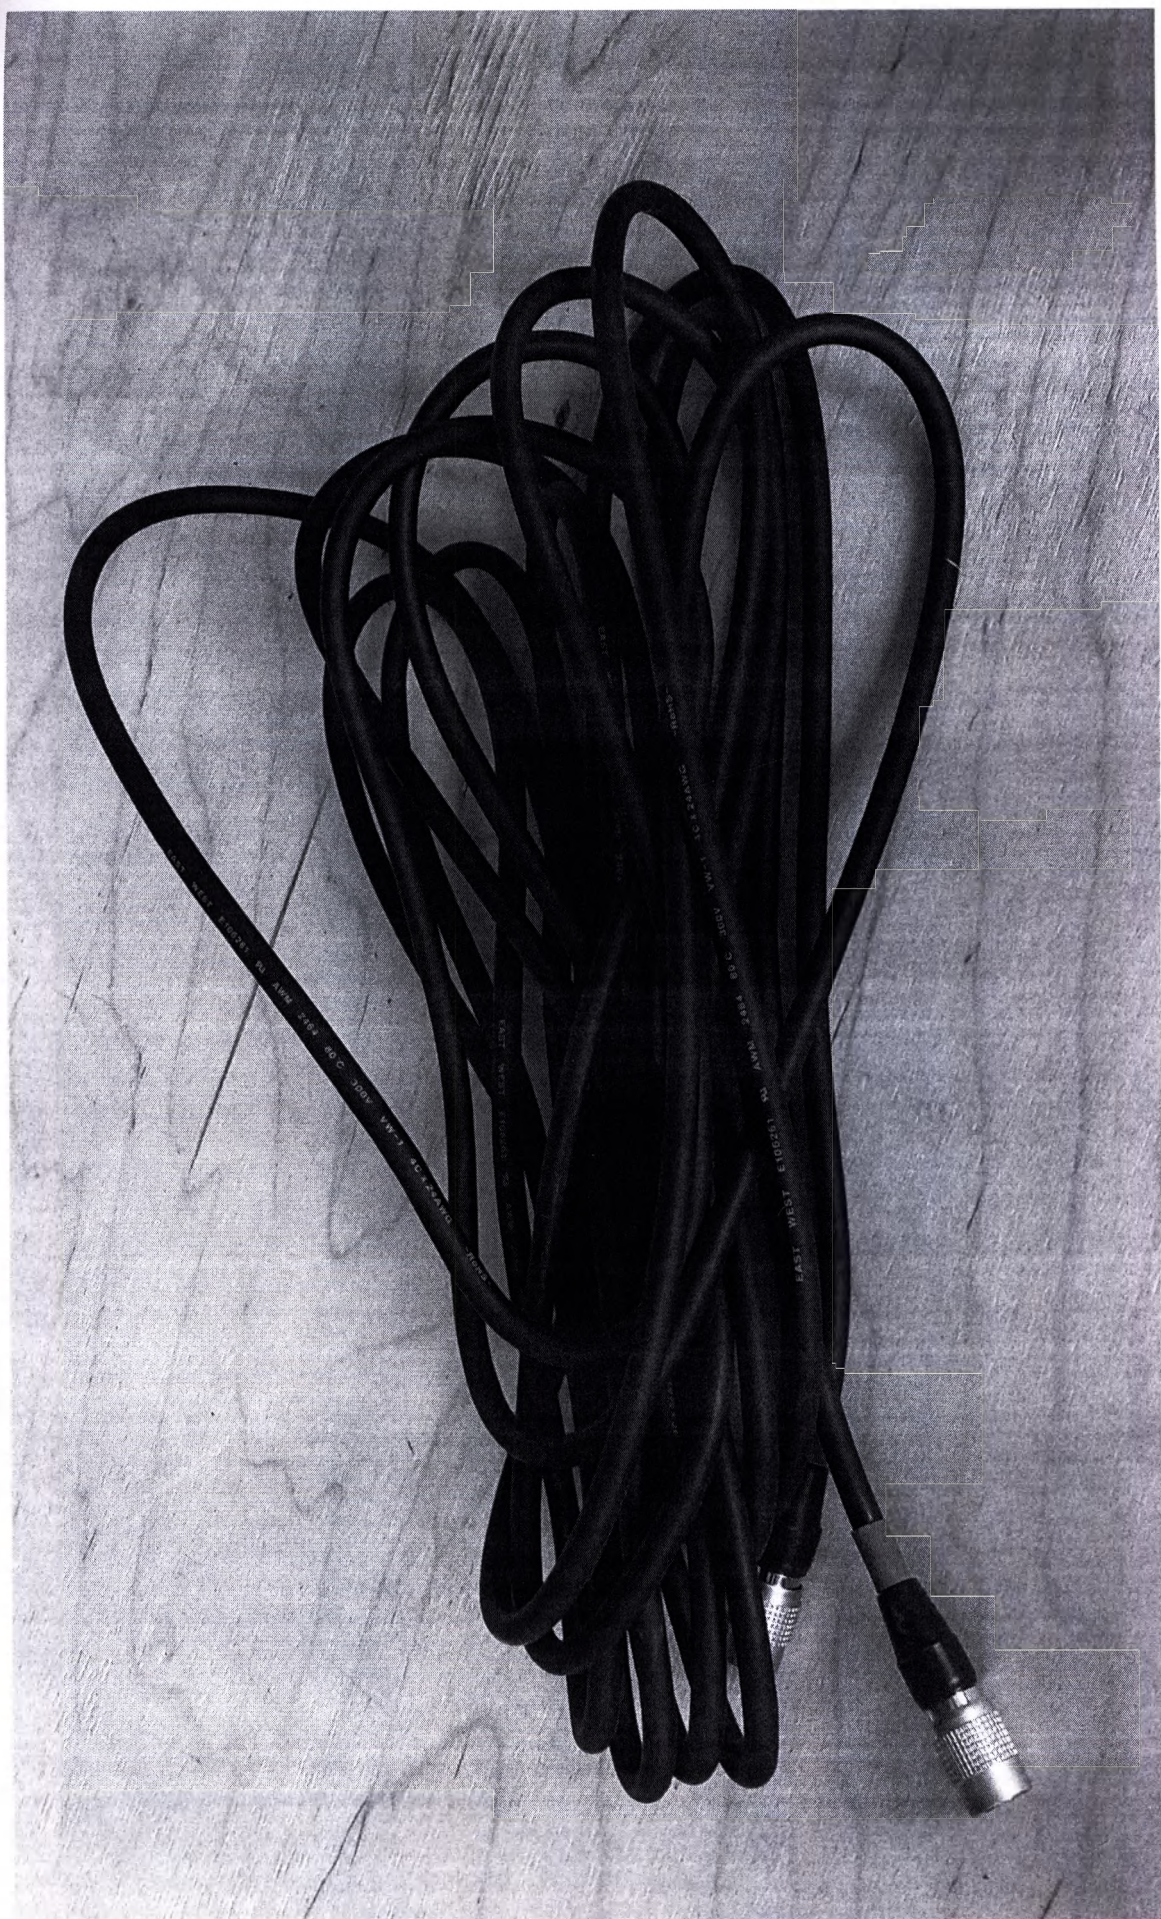

Кабель интерфейсный (4-пиновый, CAN)

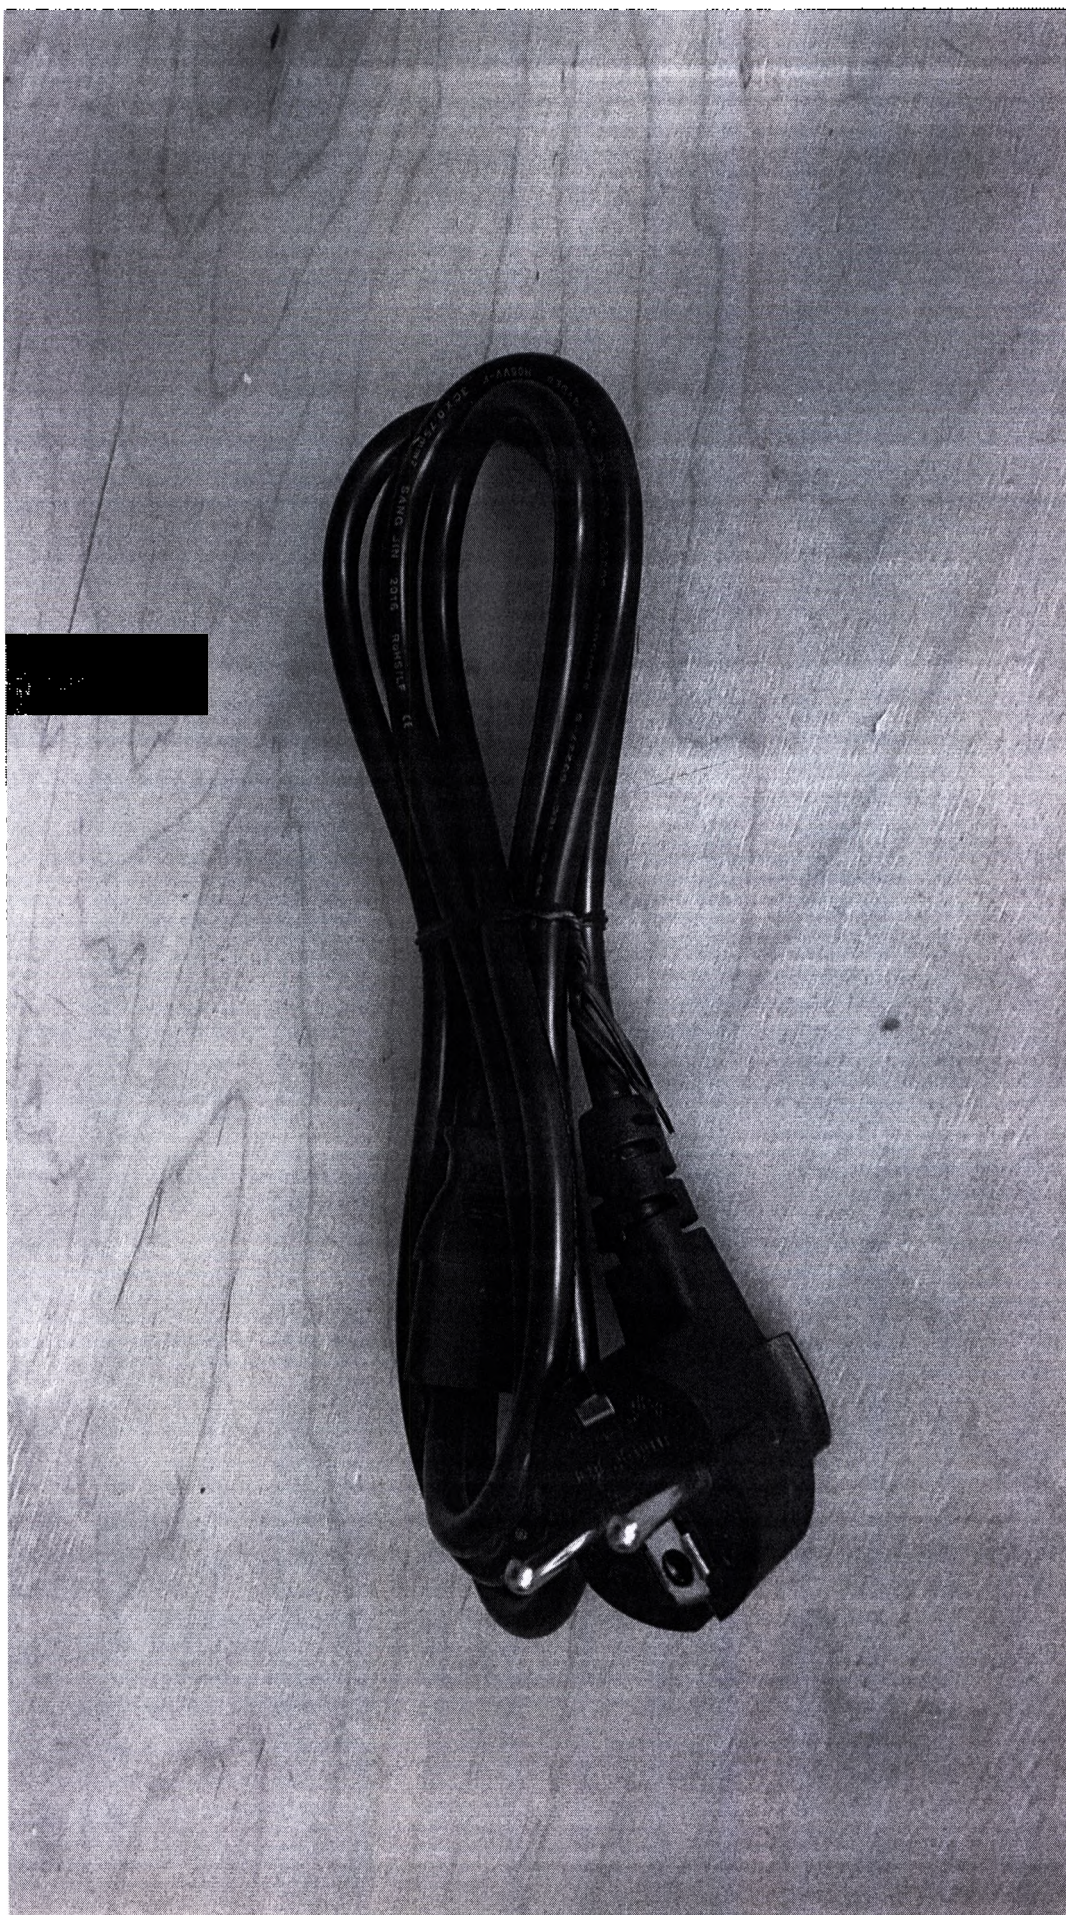


Кабель питания

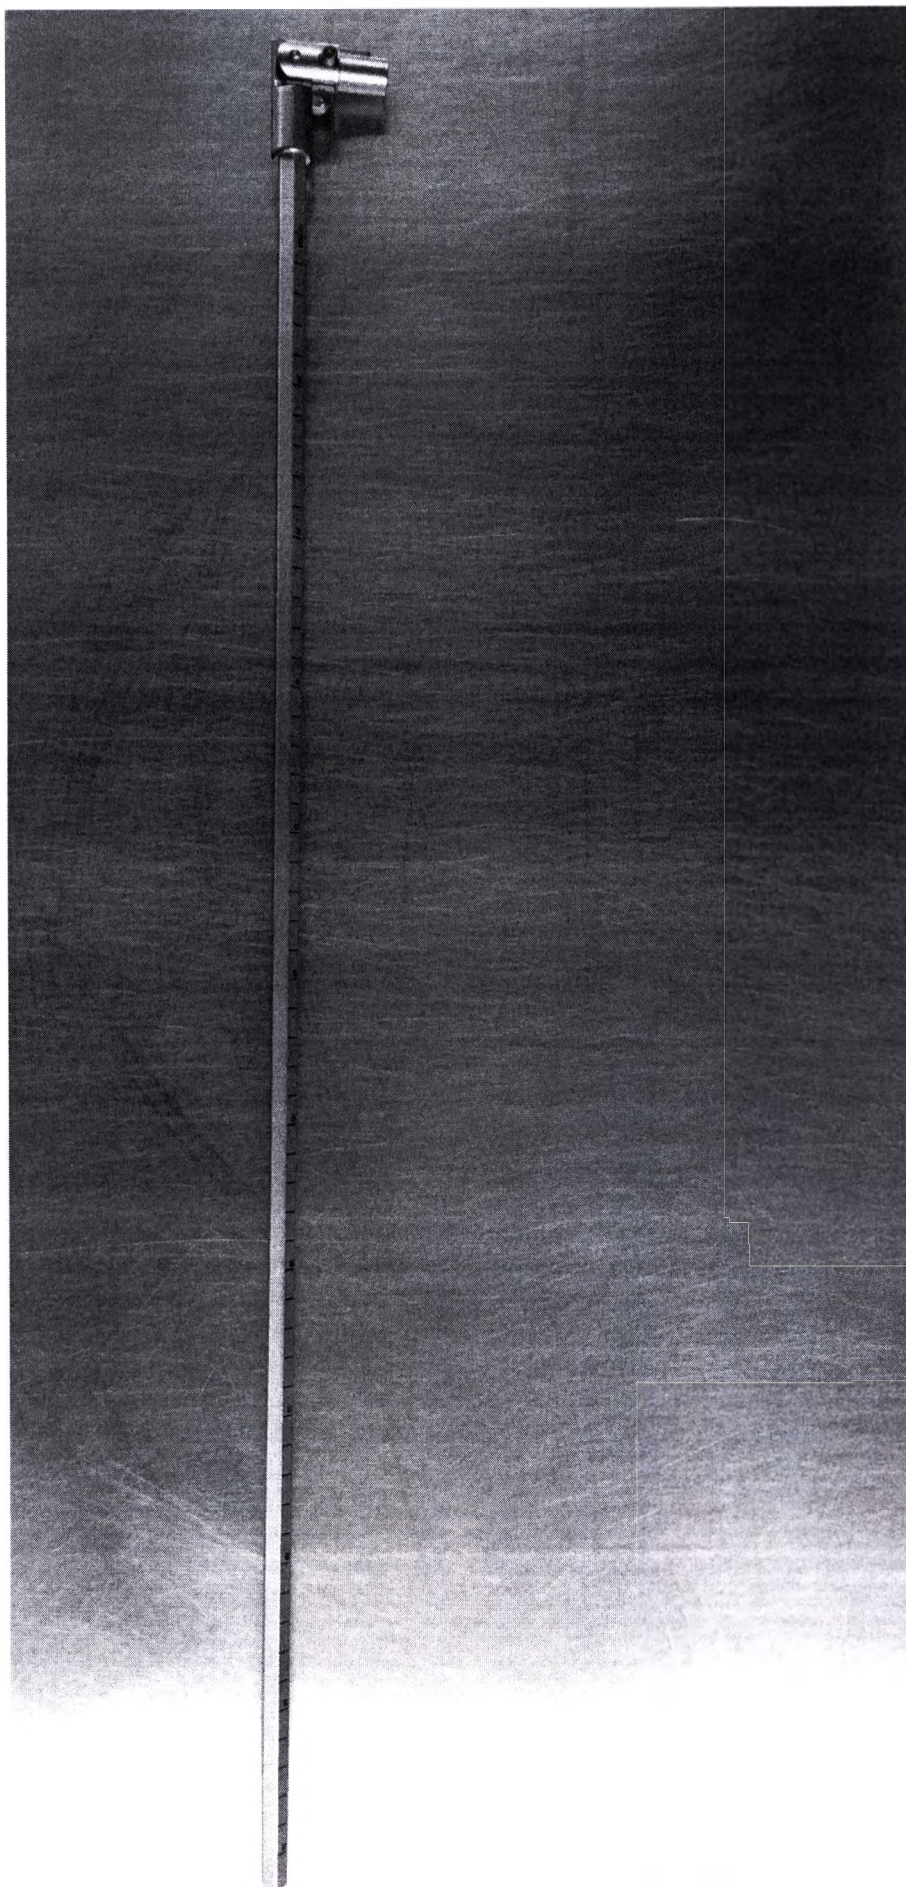


Стержень металлический удлиненный



Бумага для принтера дополнительная

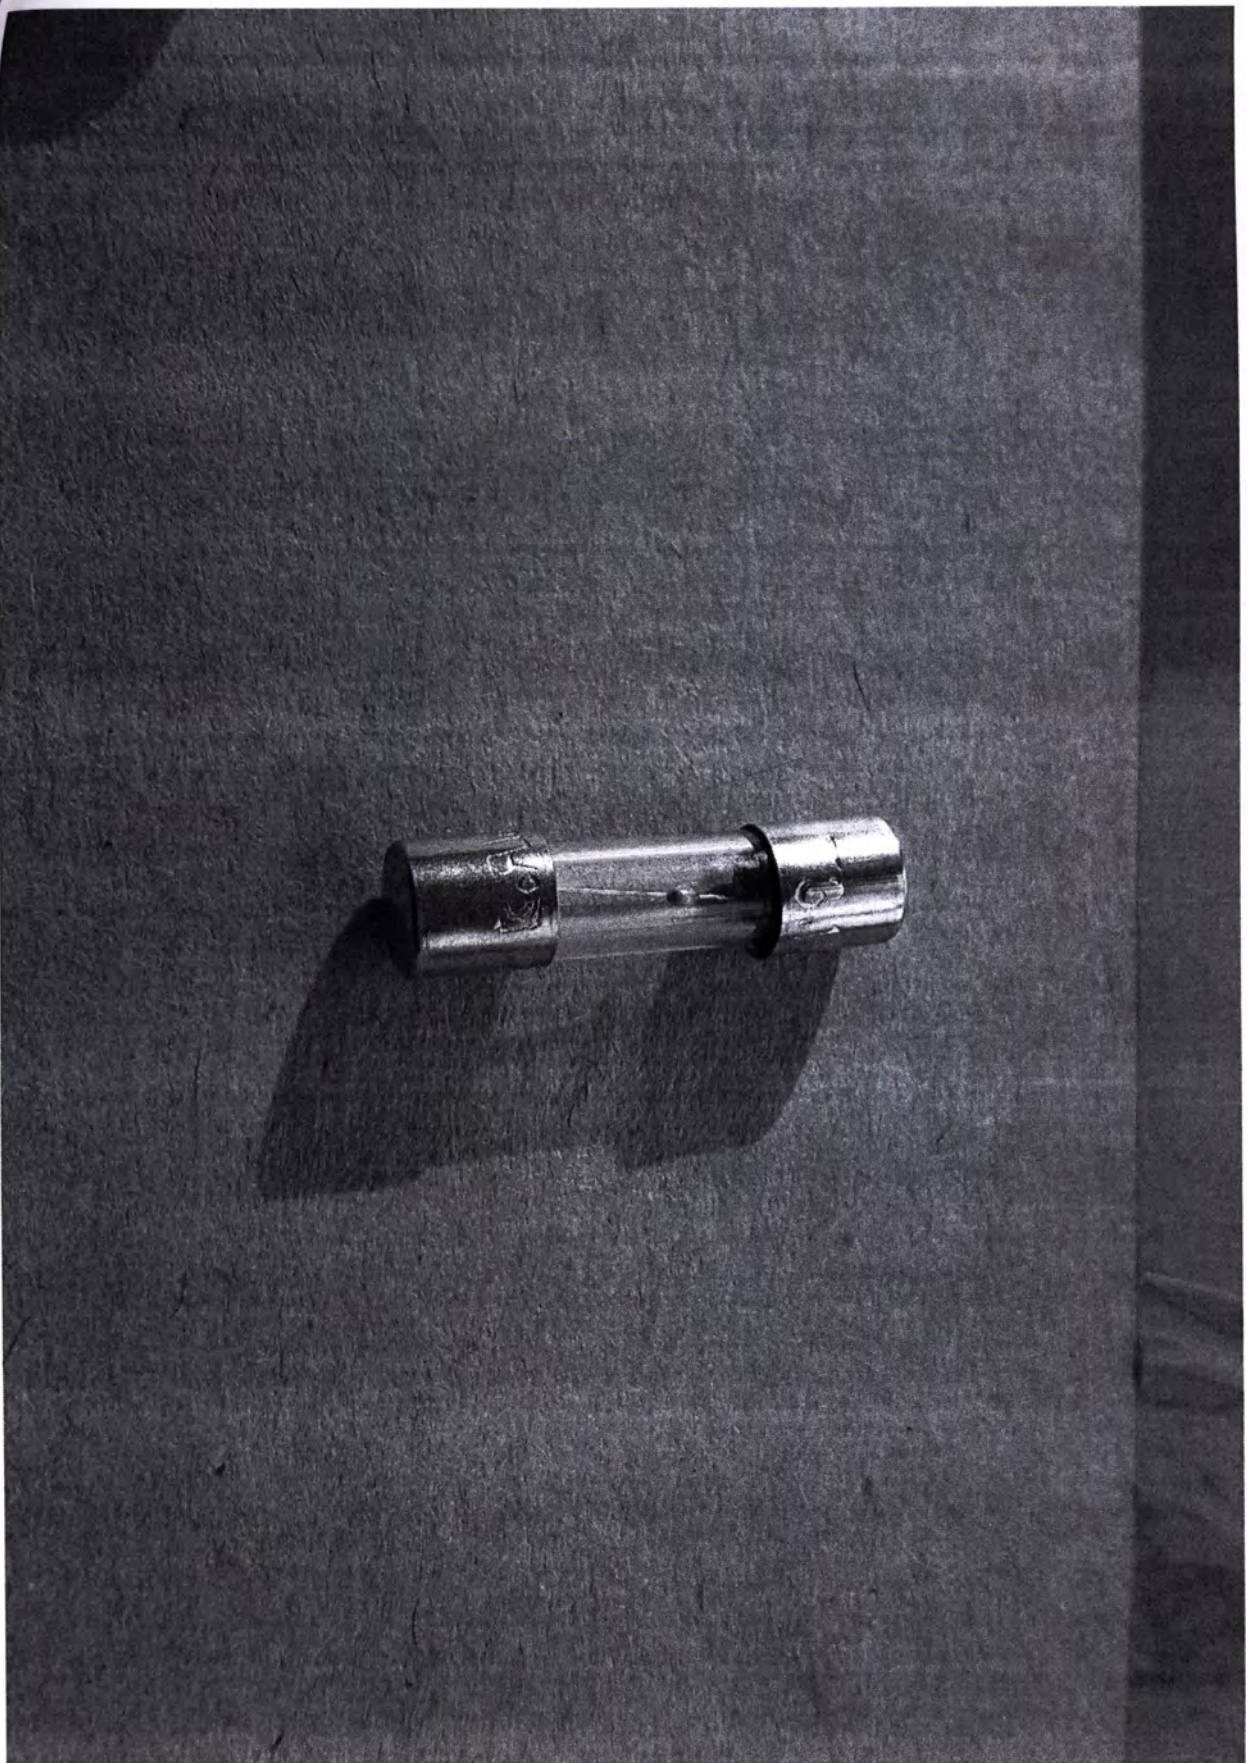

Предохранитель запасной

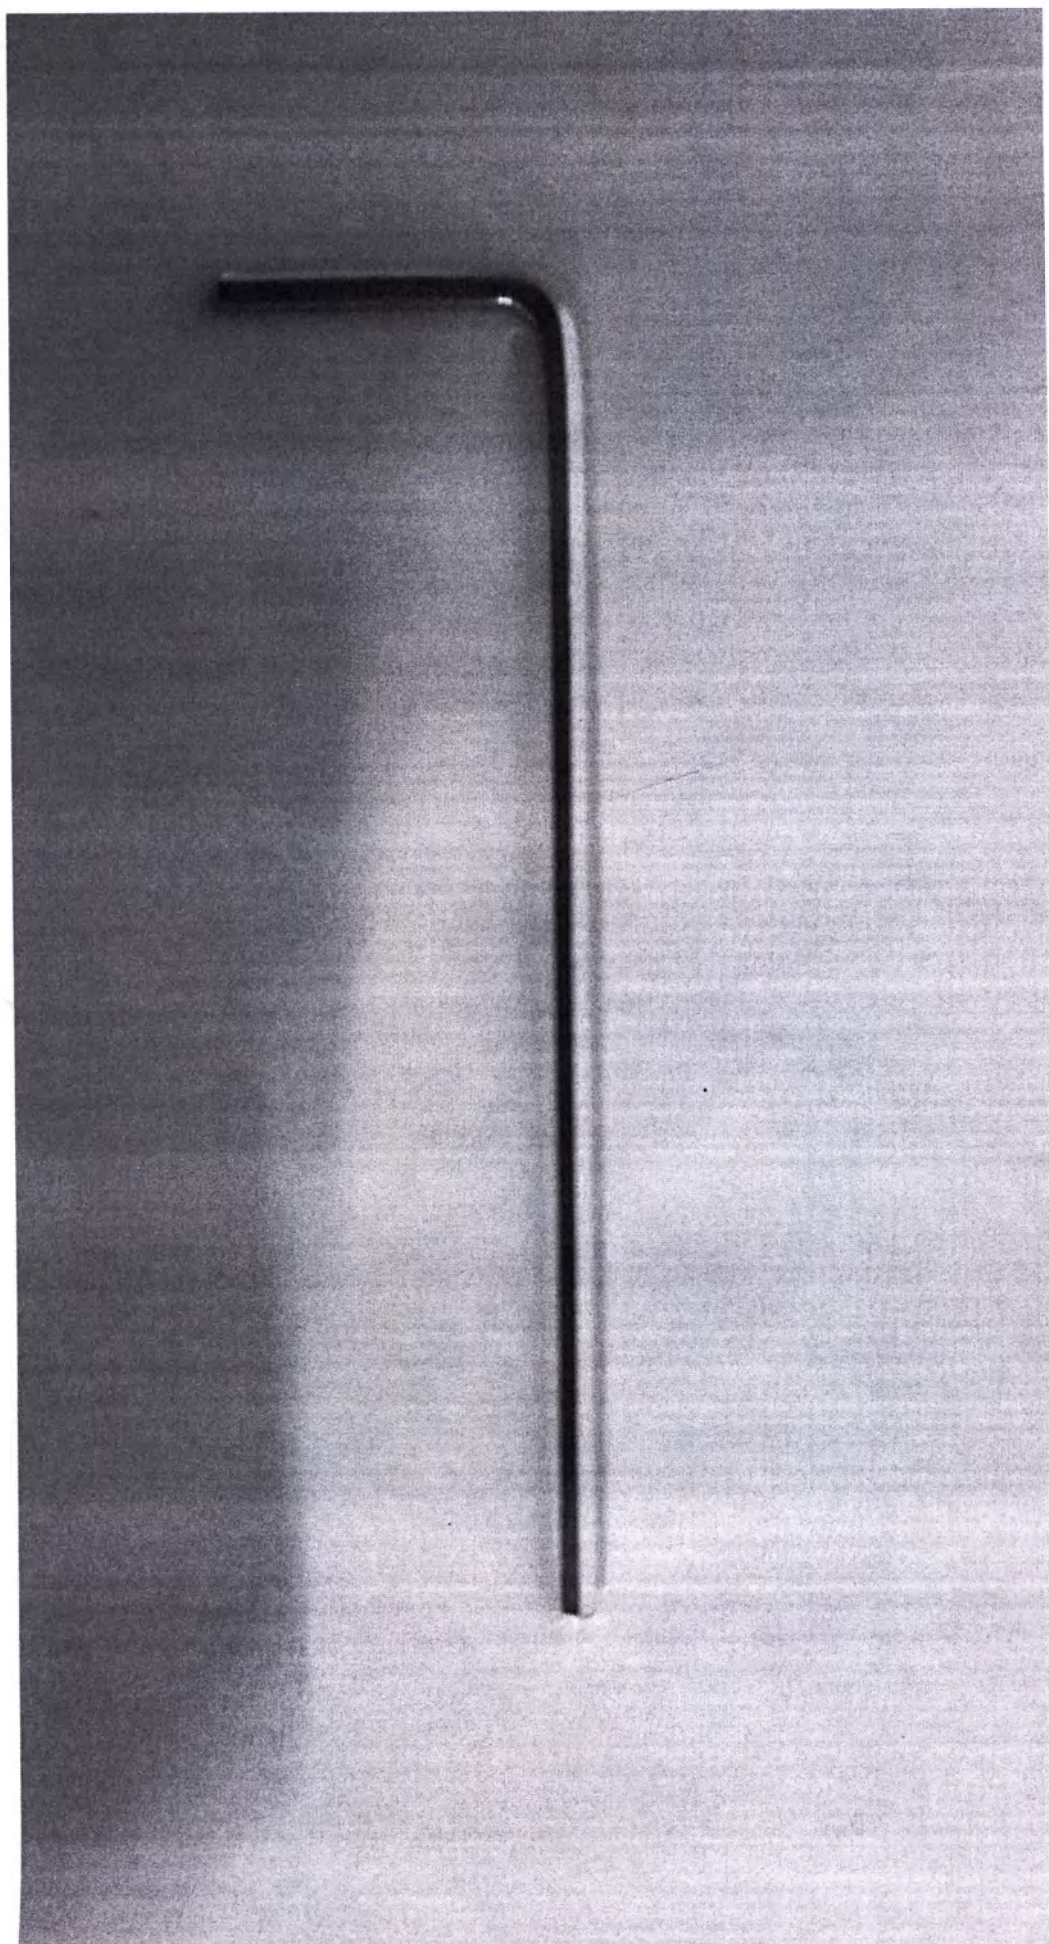


Ключ шестигранный



Чехол пылезащитный



Стилус для сенсорного экрана

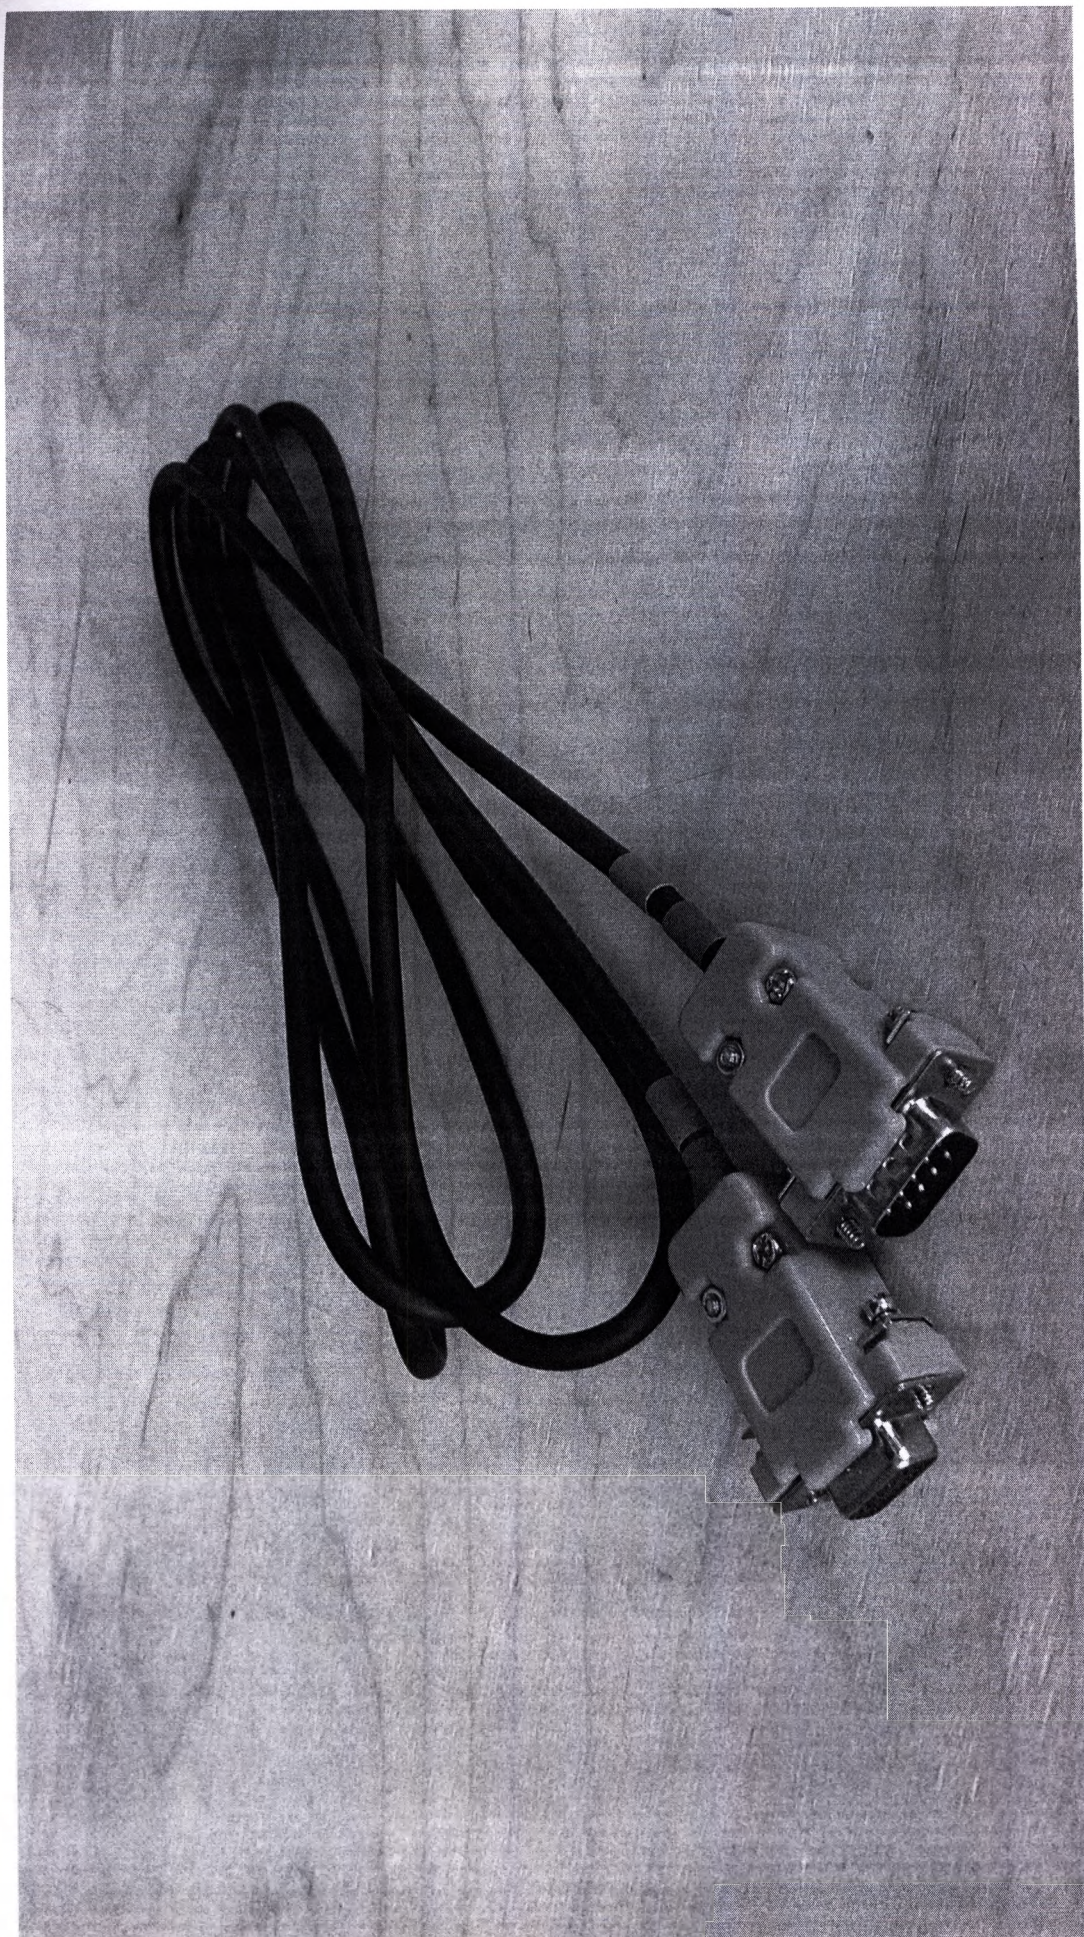

Кабель интерфейсный (9-пиновый, D-SUB)



Кабель интерфейсный длинный (9-пиновый, D-SUB)

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
_____ ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»
Яковлев А.А.

