

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»

«*Н.А. Горшкова*»
И.А. Горшкова
2021 г.
QT № 18
МОСКВА

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

«Мульти-Дилуэнт 2 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 2)»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США



Рисунок 1. Мульти-Дилуент 2 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 2)

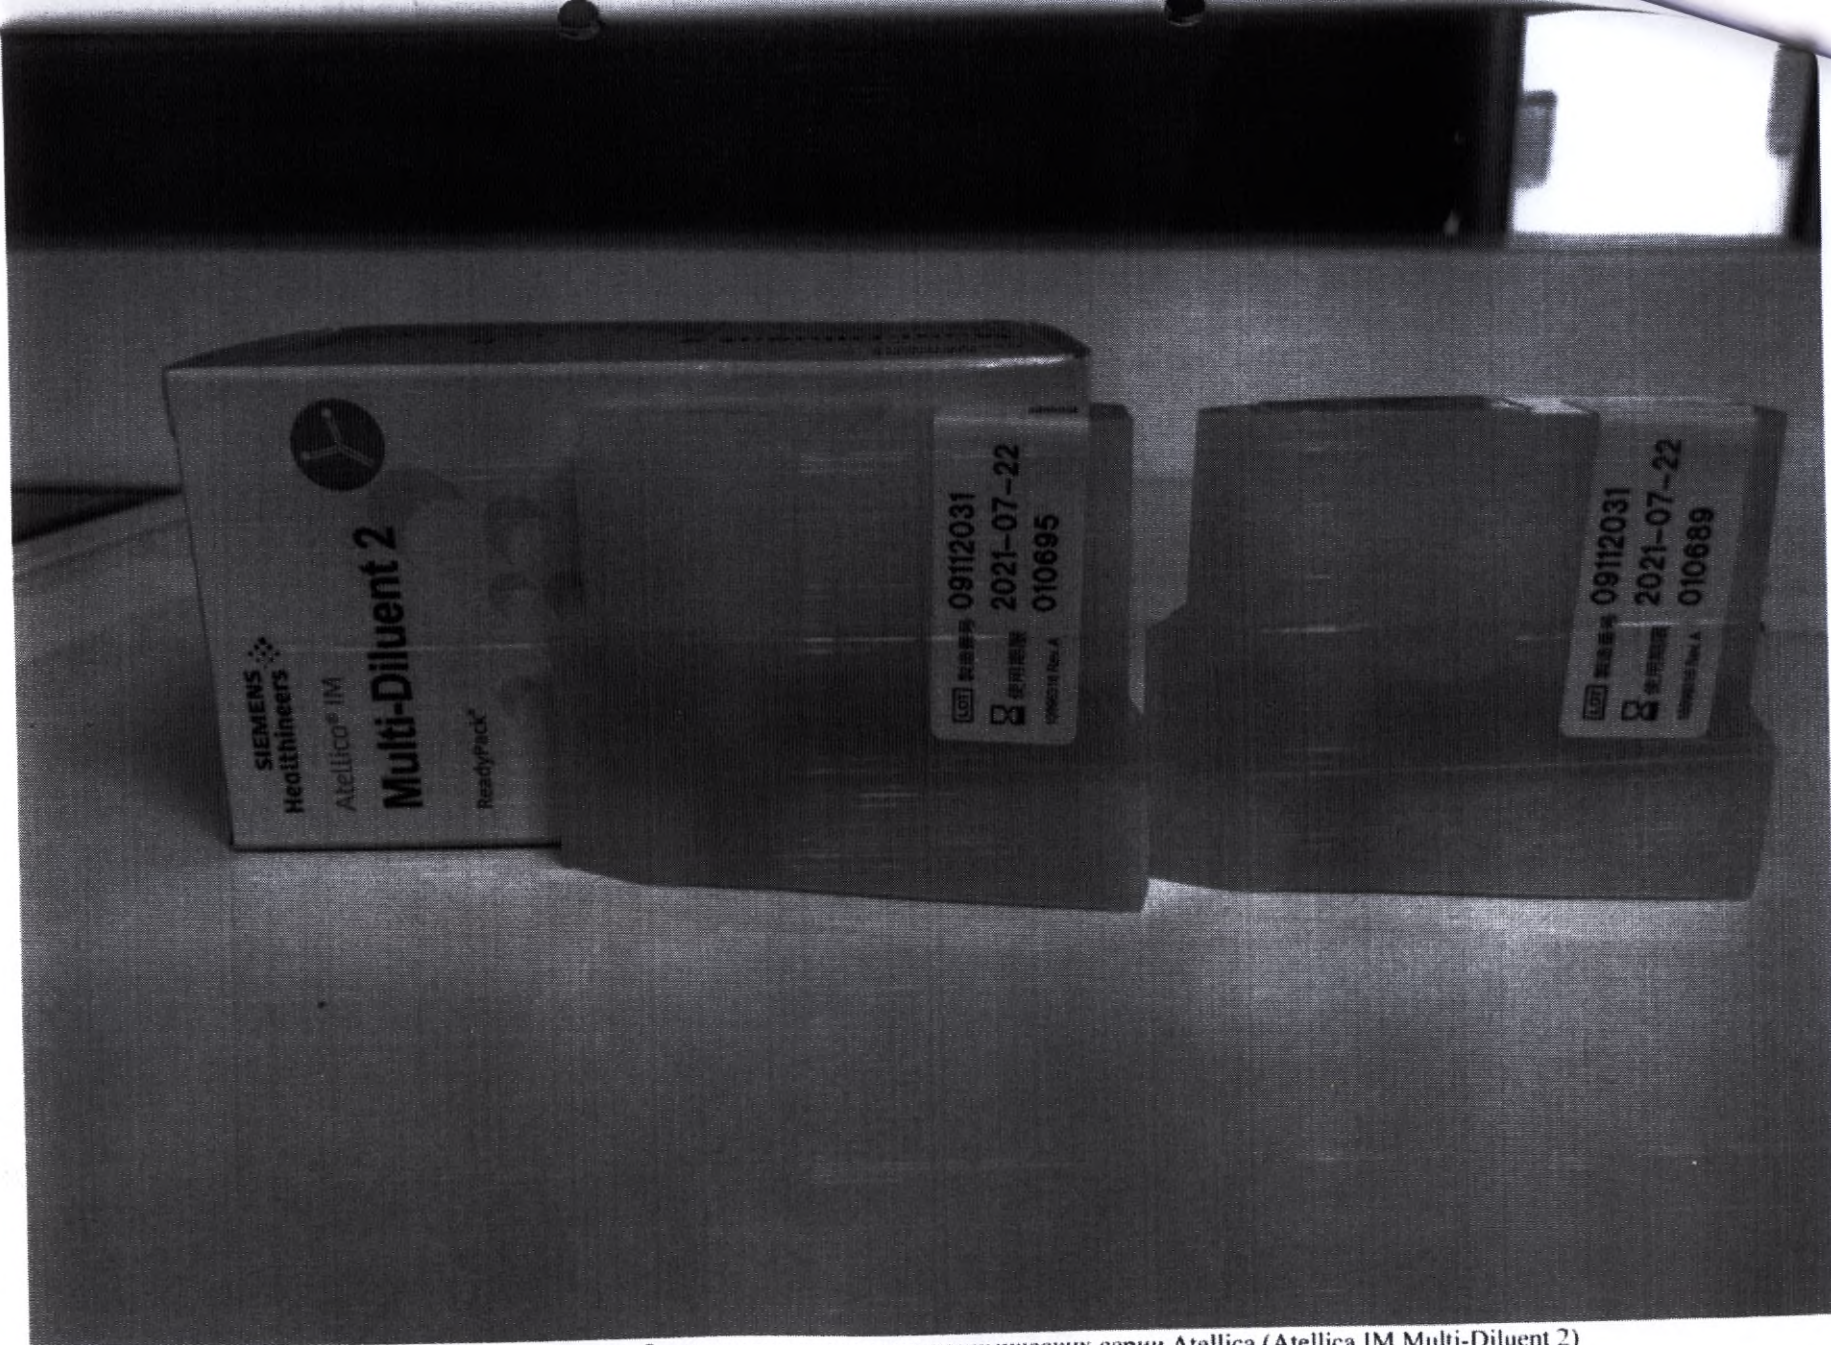


Рисунок 2. Мульти-Дилуэнт 2 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 2)

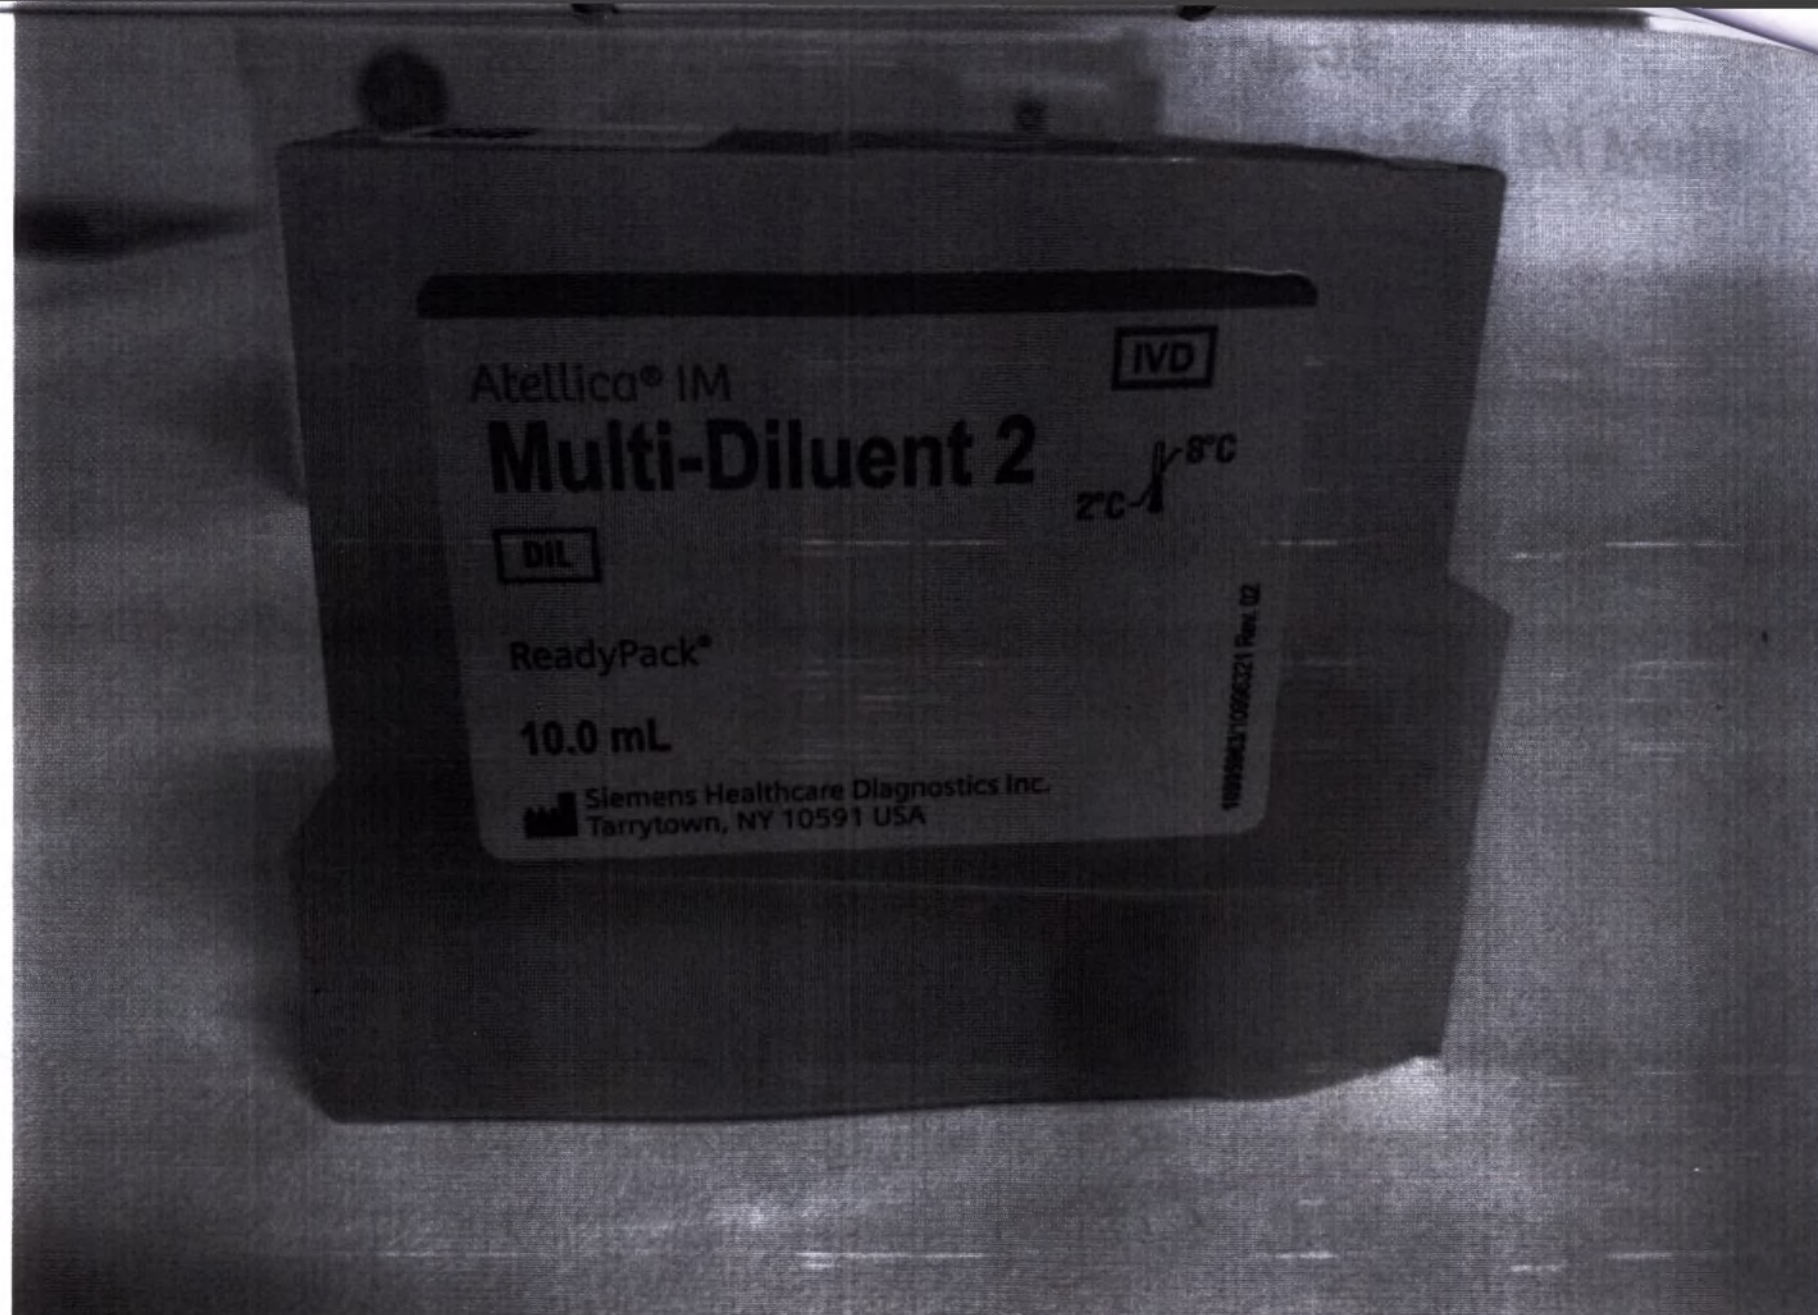


Рисунок 3. Мульти-Дилуент 2 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 2): 1. Мульти-Дилуент 2 (Atellica IM Multi-Diluent 2) – 10,0 мл/упаковка

10995644

**Мульти-Дилуент 2 для анализаторов
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-
Diluent 2)**

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2020/11861 от 07.09.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

**Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке**

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 4. Мульти-Дилуент 2 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 2): Маркировка для Российской Федерации

Всего прошито и пронумеровано
_____ листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

