

Руководитель направления по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимии, гематологии и гемостаз
ООО «Сименс Здоровоохранение»

Е.А. Чигринец



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для определения лютеинизирующего гормона на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Luteinizing Hormone (Atellica IM LH))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.»,
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

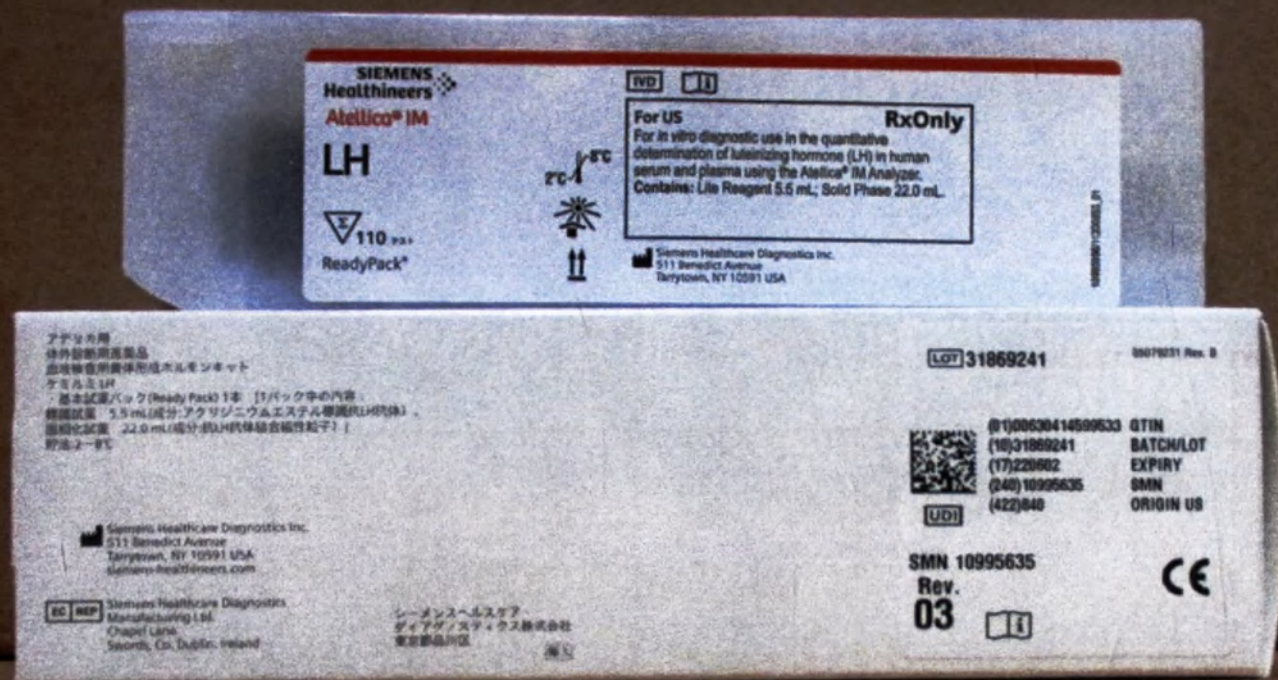


Рисунок 1. «Набор реагентов для определения лютеинизирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Luteinizing Hormone (Atellica IM LH))», Общий вид, Фасовка - 110 тестов.

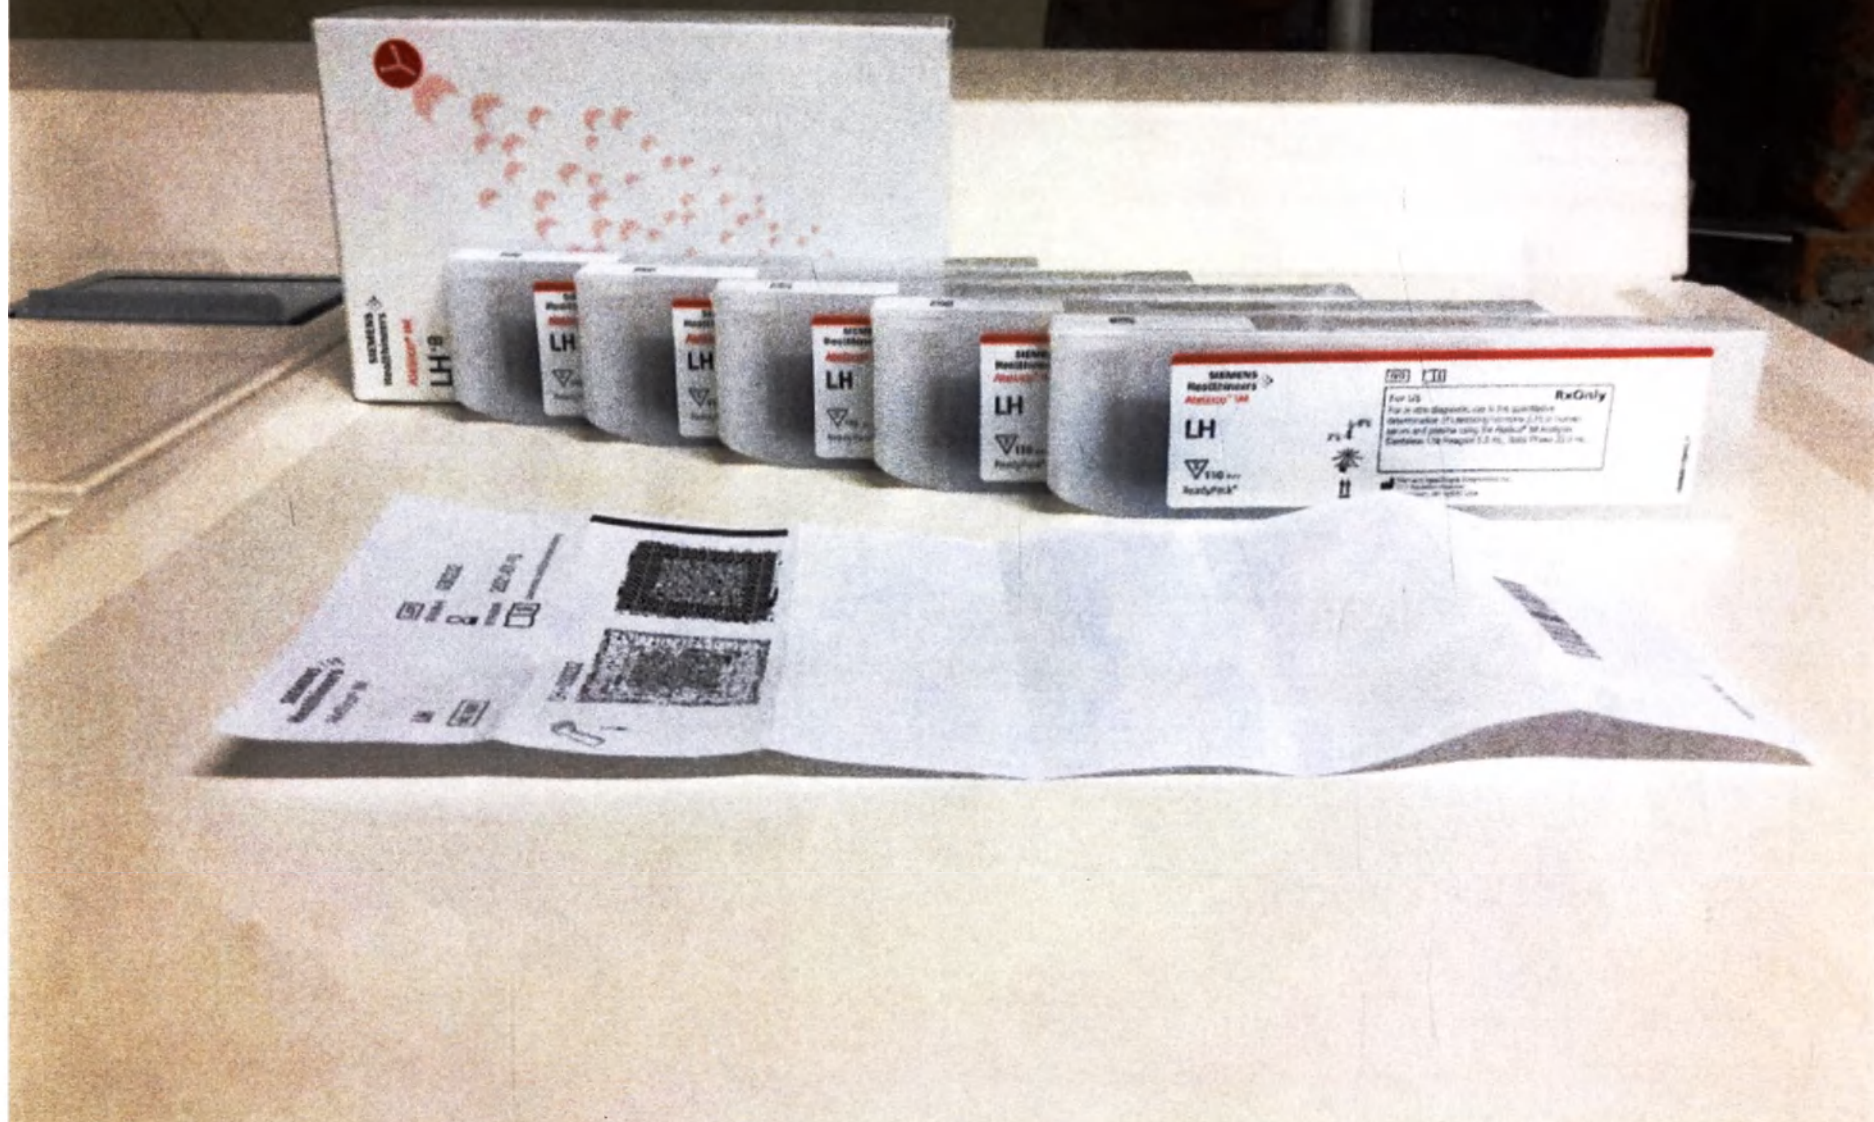


Рисунок 2. «Набор реагентов для определения лютеинизирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Luteinizing Hormone (Atellica IM

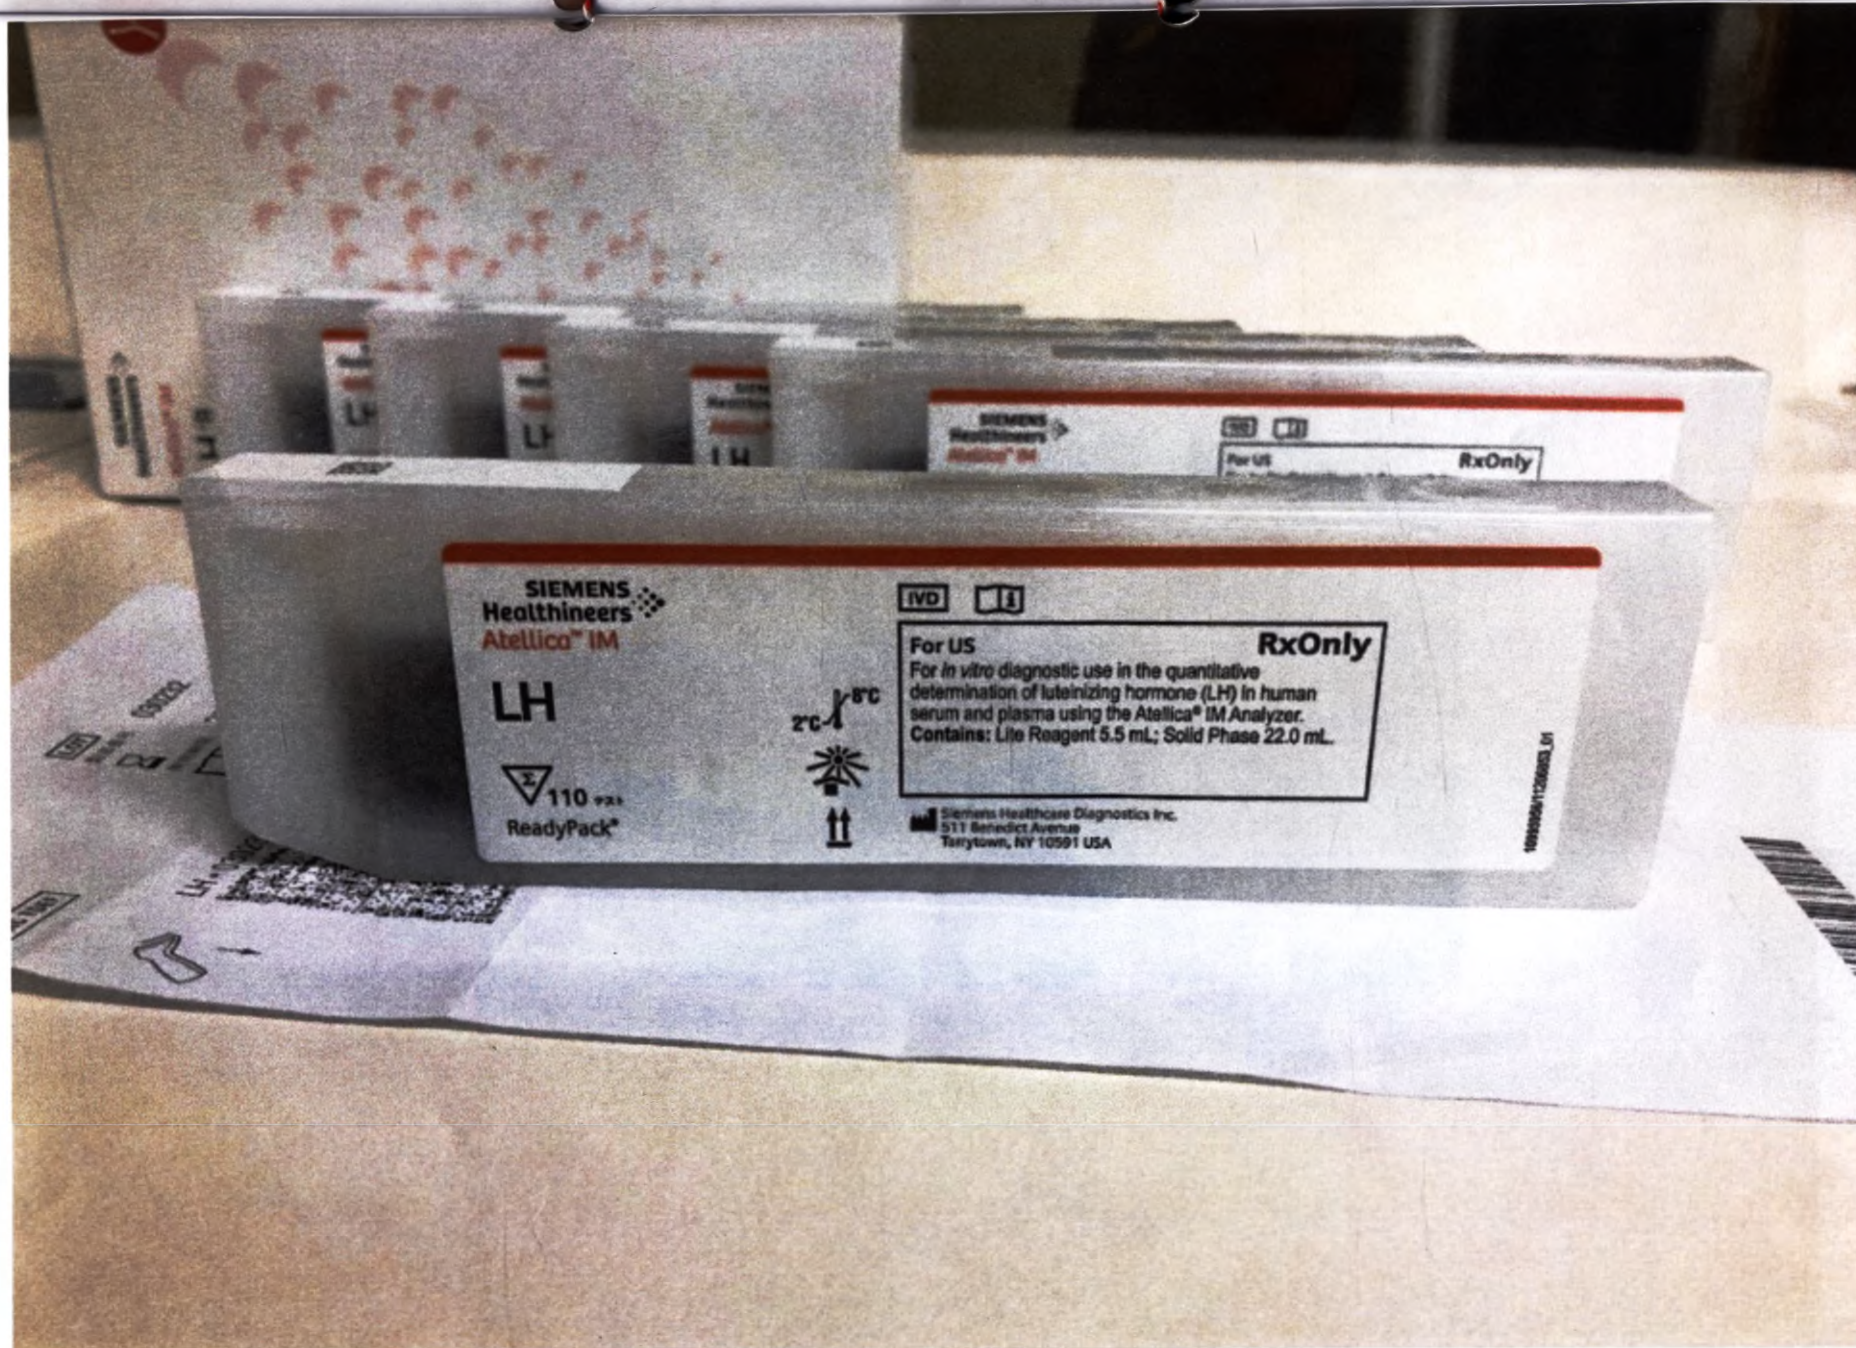


Рисунок 3. Набор реагентов для определения лютеинизирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Luteinizing Hormone (Atellica IM LH)):

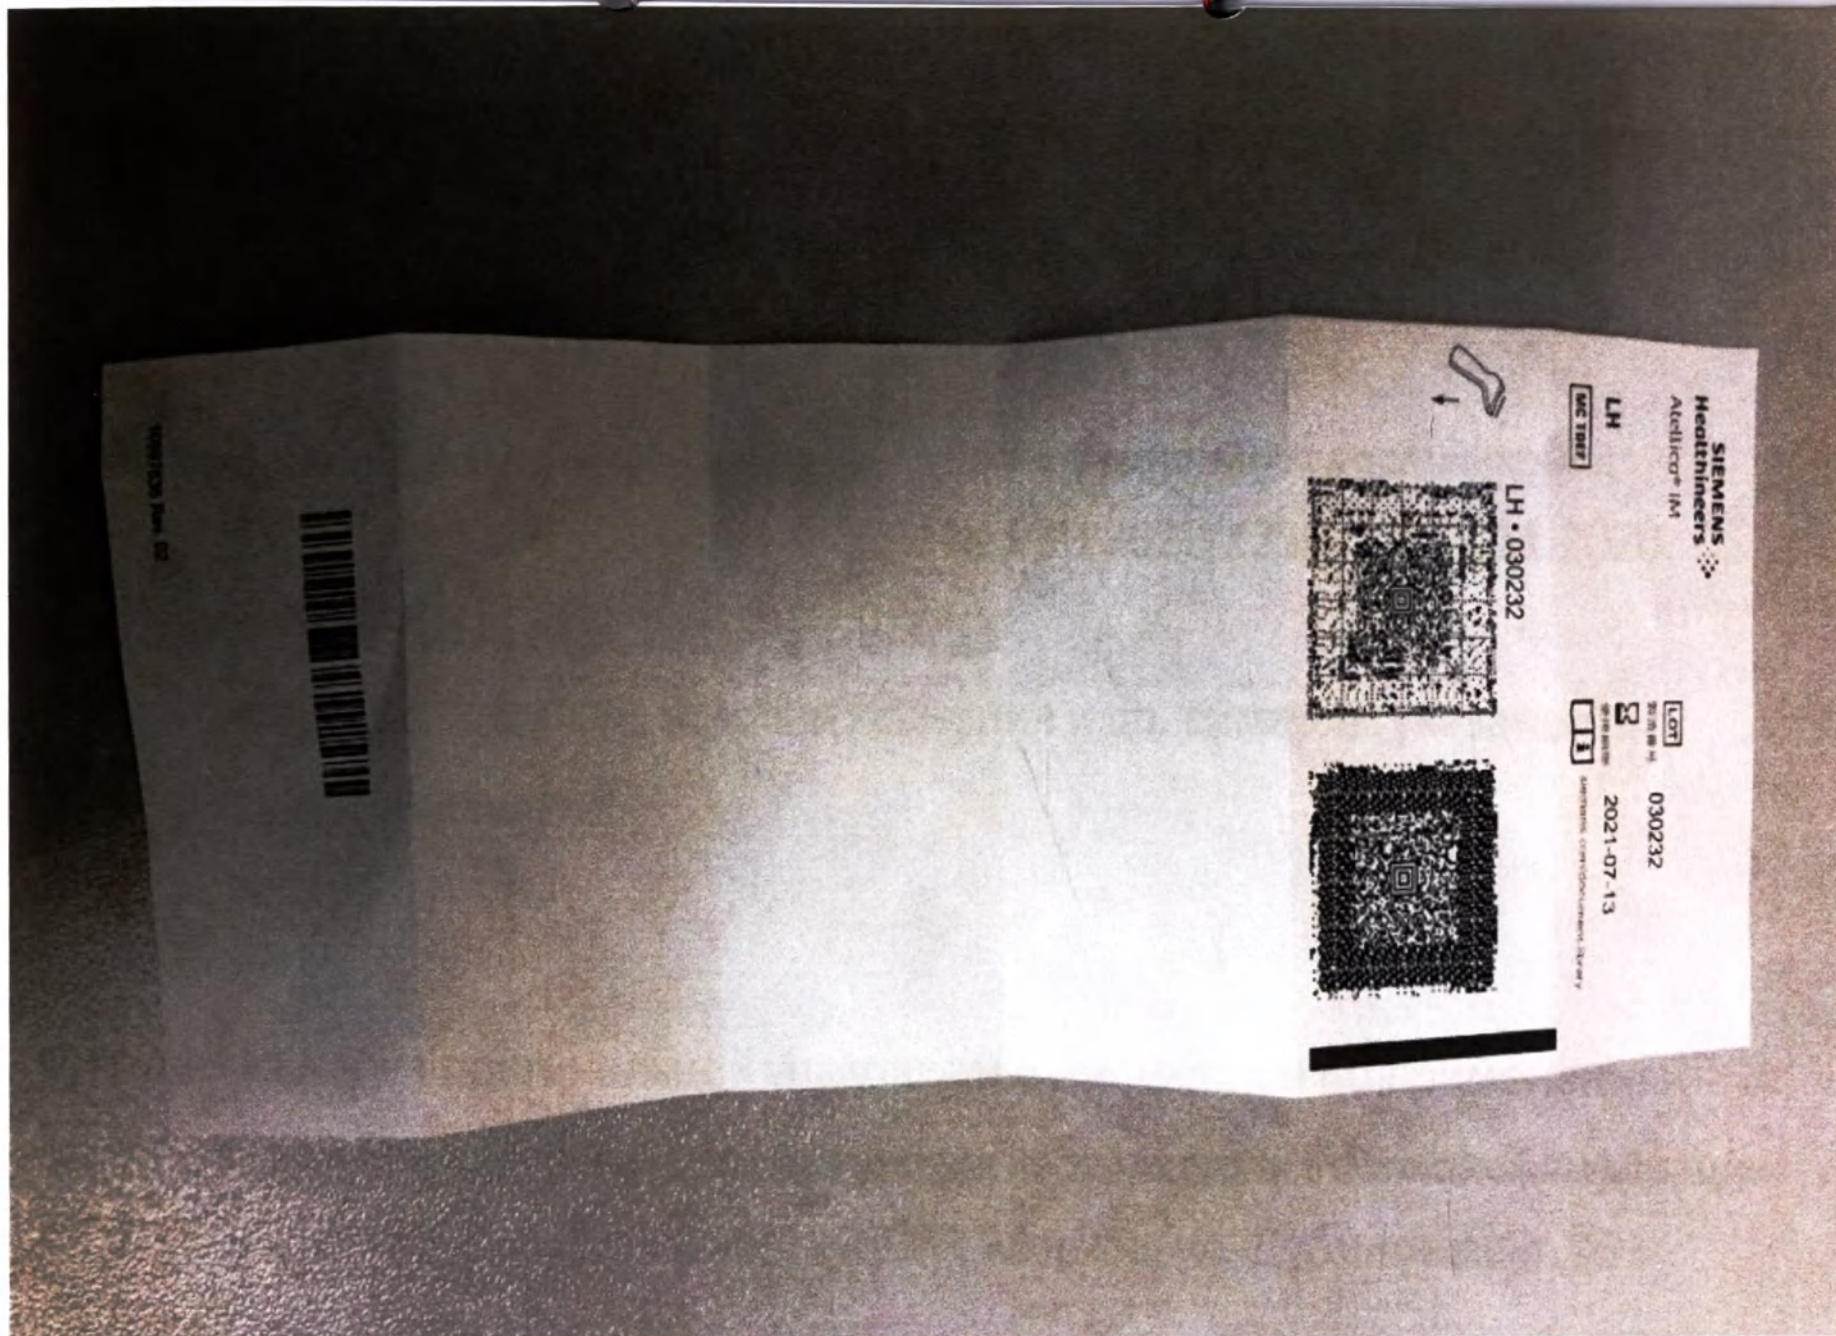


Рисунок 4. «Набор реагентов для определения лютеинизирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Luteinizing Hormone (Atellica IM LH))»:

Видальши со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM LH

10995634

Набор реагентов для определения лютеинизирующего
гормона на анализаторах иммунохимических серии
Atellica (Atellica IM Luteinizing Hormone (Atellica IM LH))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2020/12592 от 18.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 5. Макет маркировки, содержащей информацию на русском языке для «Набор реагентов для определения лютеинизирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Luteinizing Hormone (Atellica IM LH))», Фасовка 550 тестов.

10995635

**Набор реагентов для определения лютеинизирующего
гормона на анализаторах иммунохимических серии
Atellica (Atellica IM Luteinizing Hormone (Atellica IM LH))**

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2020/12592 от 18.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

**Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке**

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 6. Макет маркировки, содержащей информацию на русском языке для «Набор реагентов для определения лютеинизирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Luteinizing Hormone (Atellica IM LH))», Фасовка 110 тестов.

Всего прошито и пронумеровано
7 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

