


Фотографические изображения медицинского изделия:

**«Сканер цифровой для гистологических и цитологических микропрепаратов
Napozoomer S360 в составе, с принадлежностями»**


Сканер цифровой для гистологических и цитологических микропрепаратов Nanozoomer S360




Мобильное основание для сканера

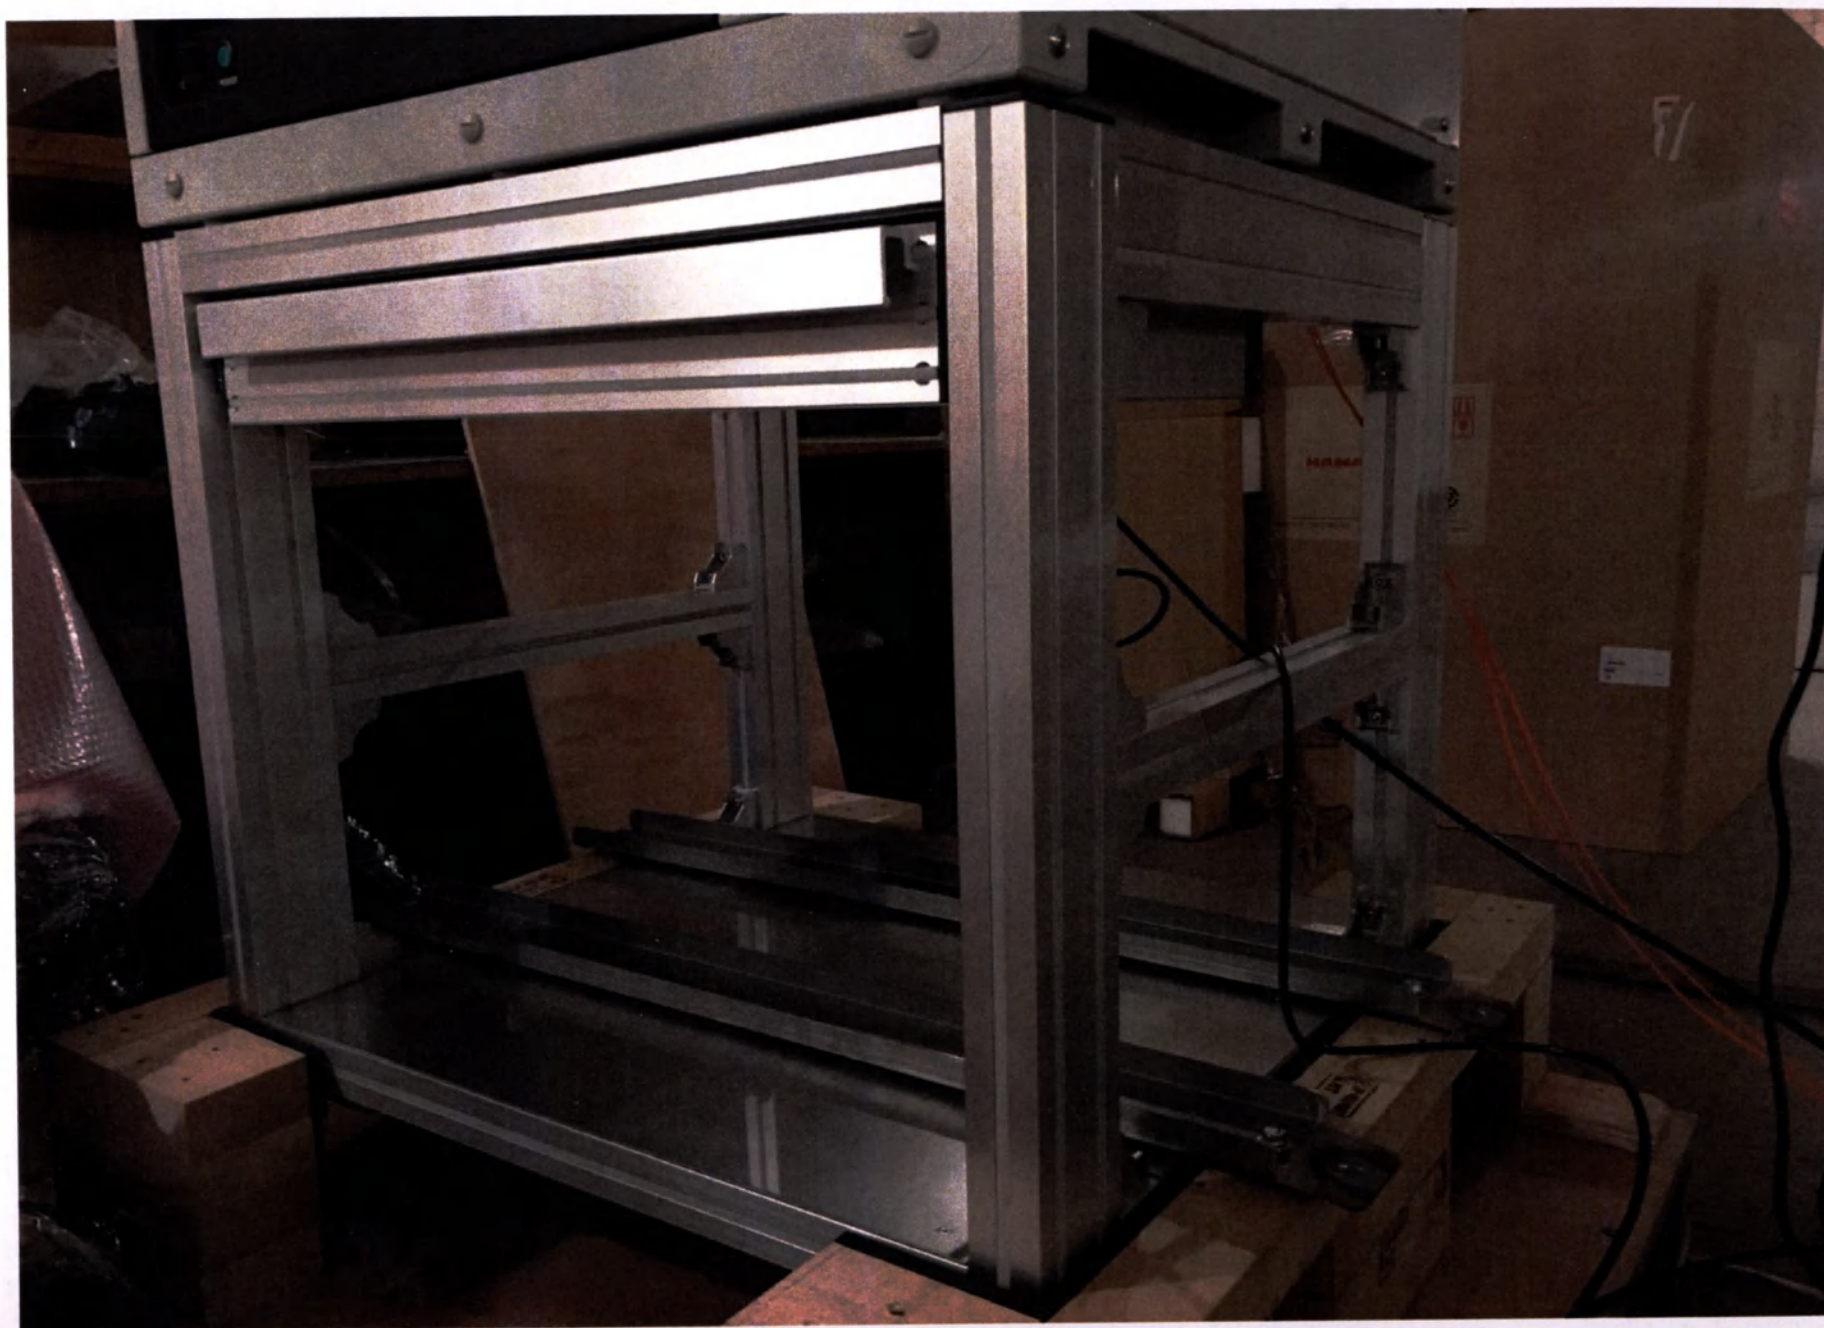


Держатель для предметных стекол А14353 для сканера S360

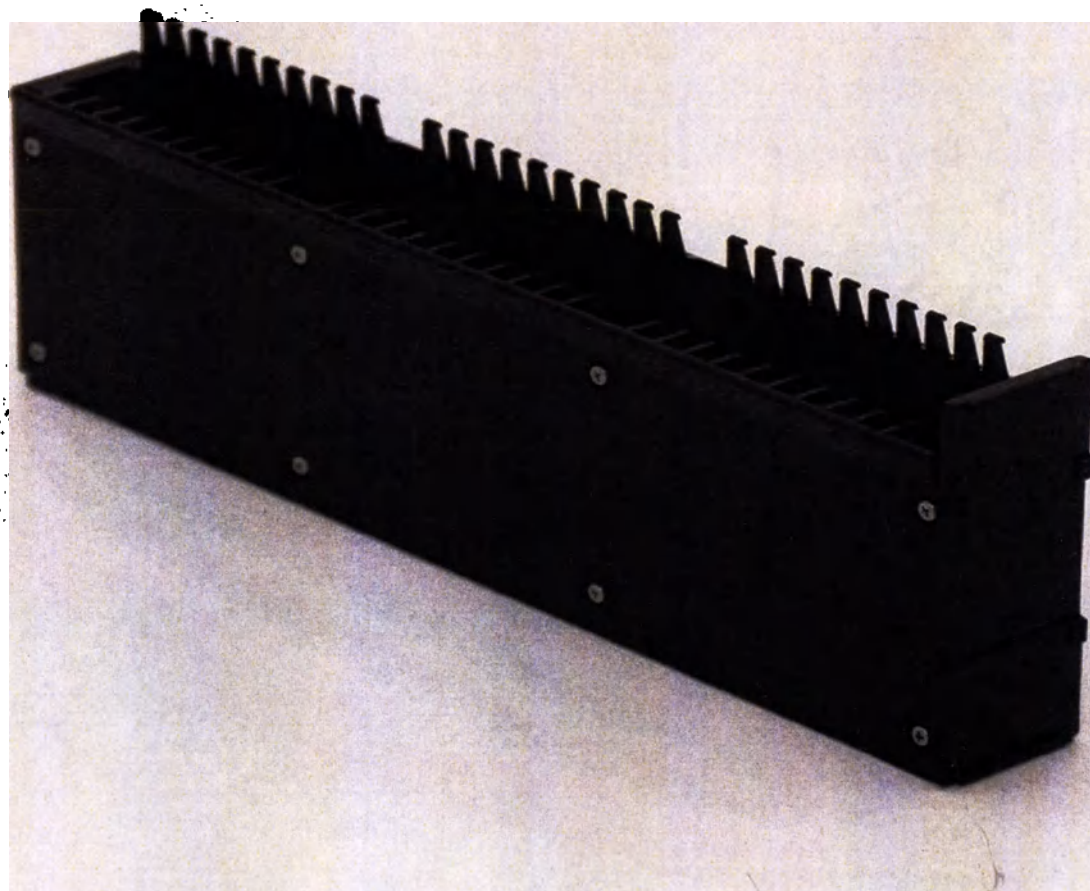


Плата высокоскоростной передачи данных по оптическому каналу

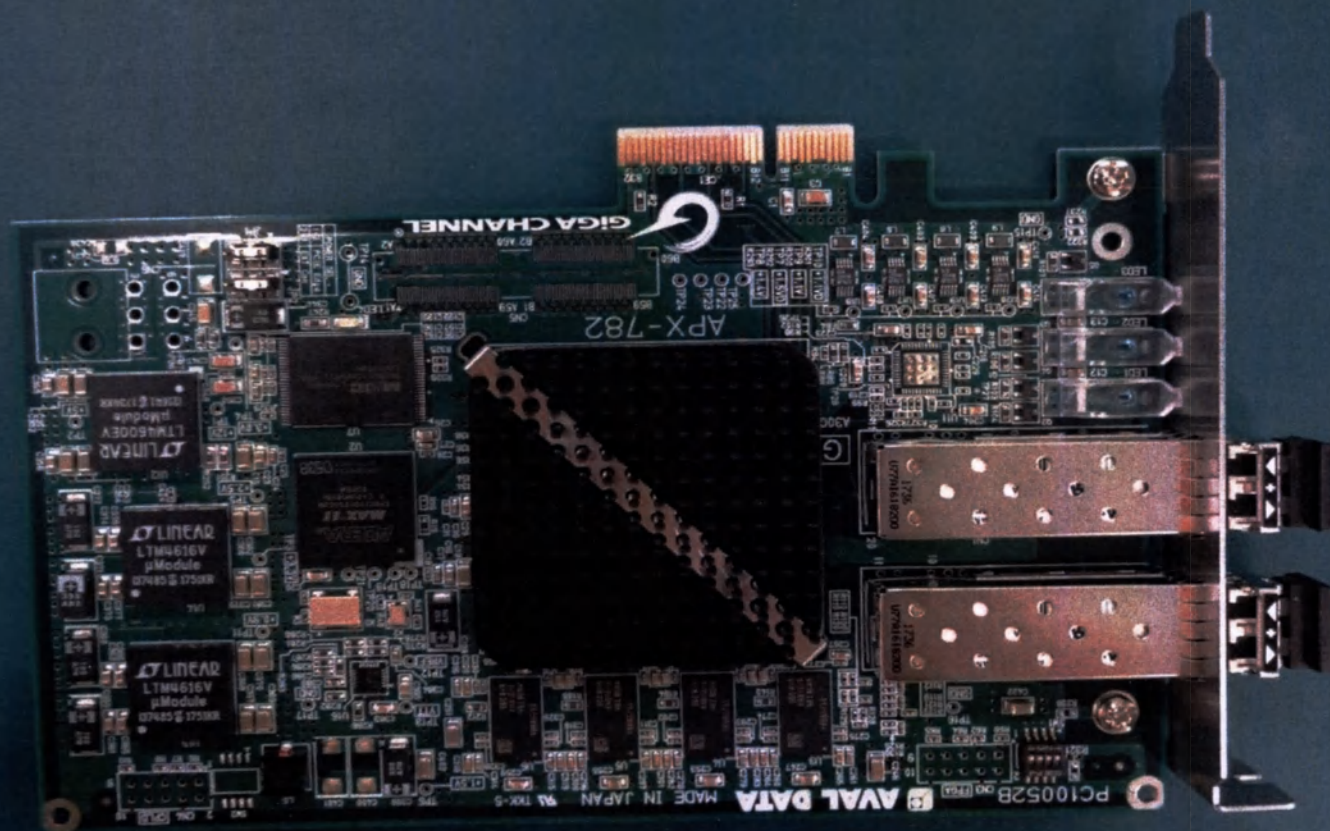

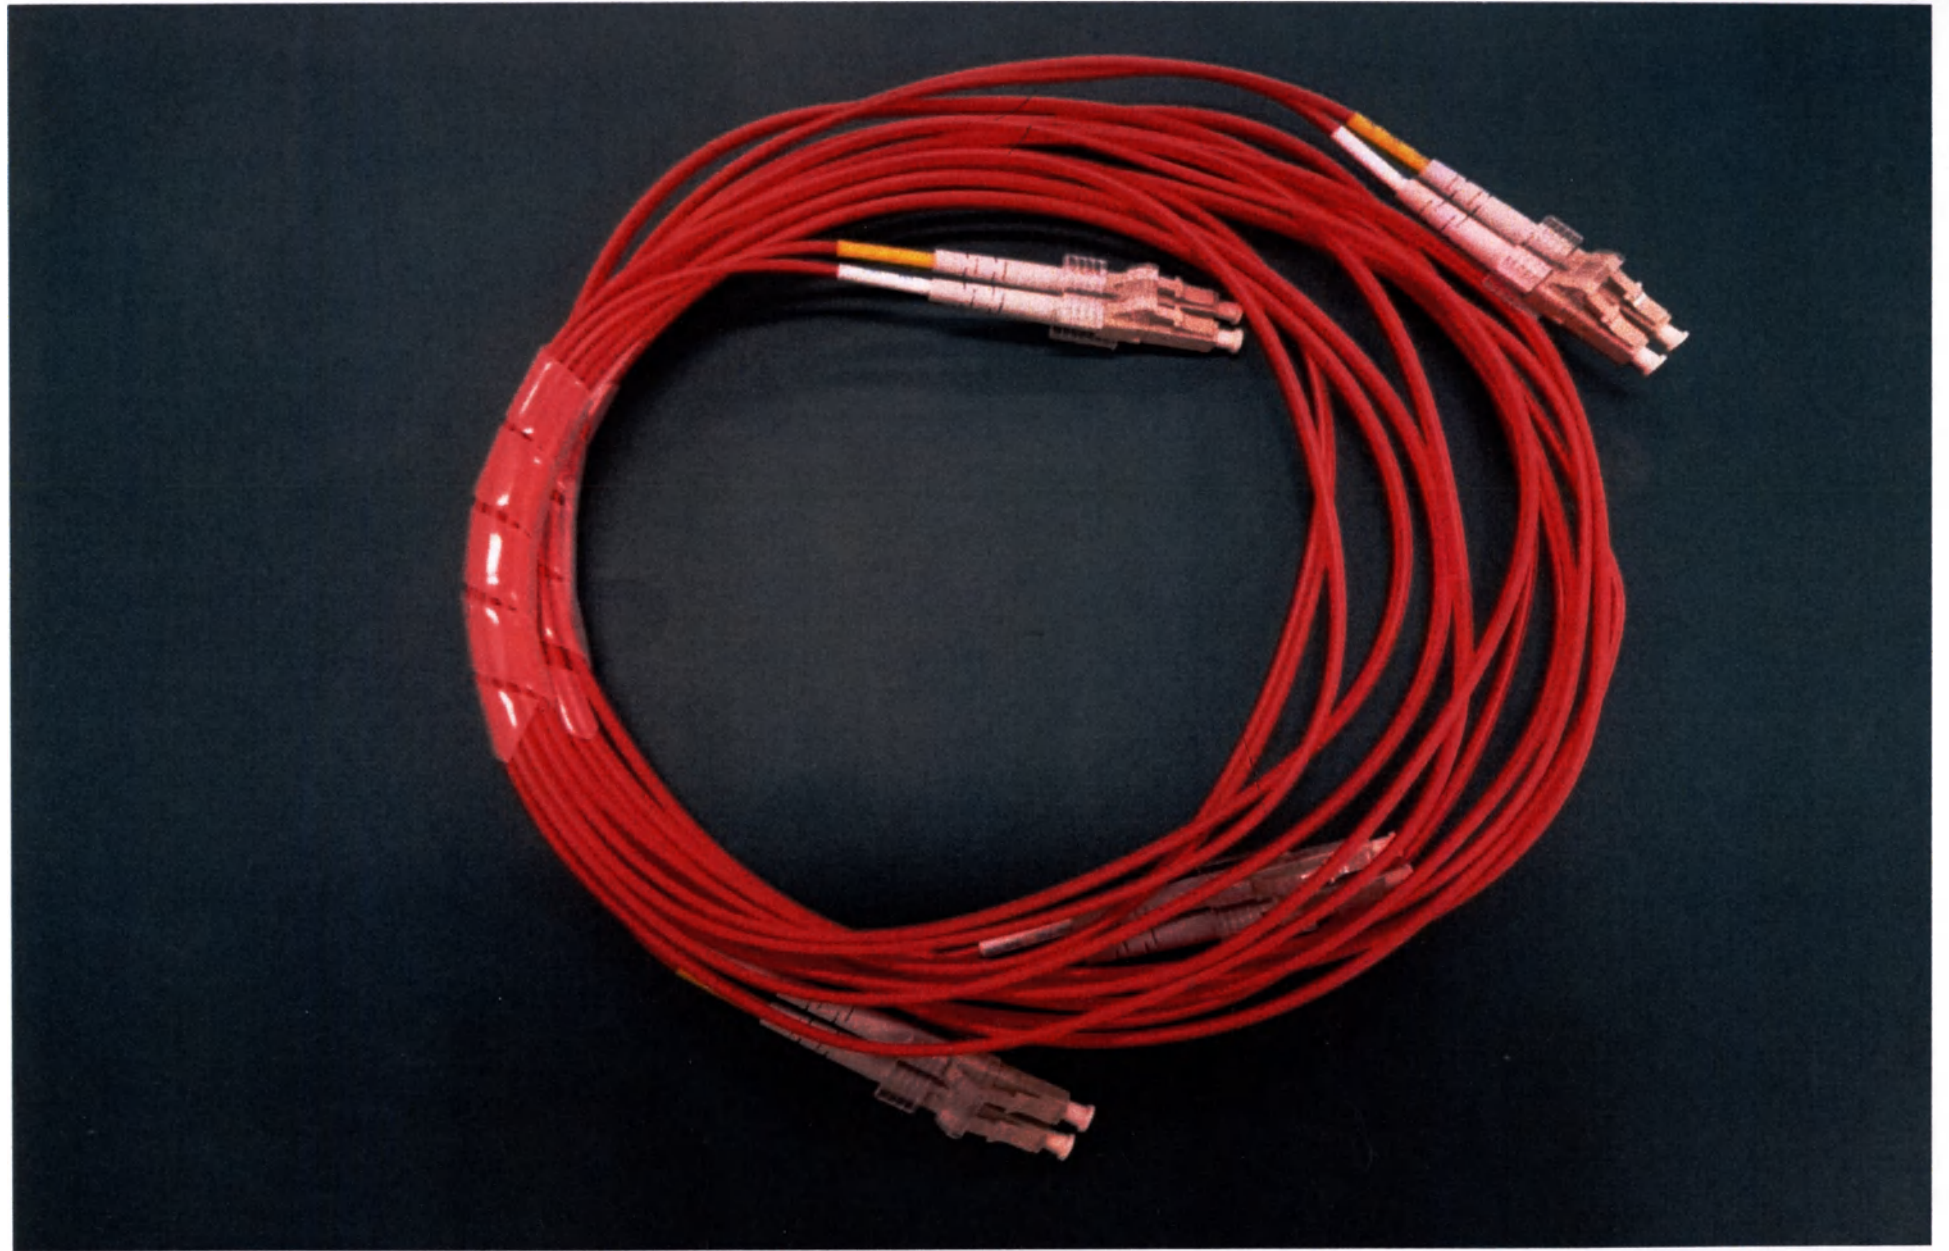

Объектив с 20-кратным увеличением

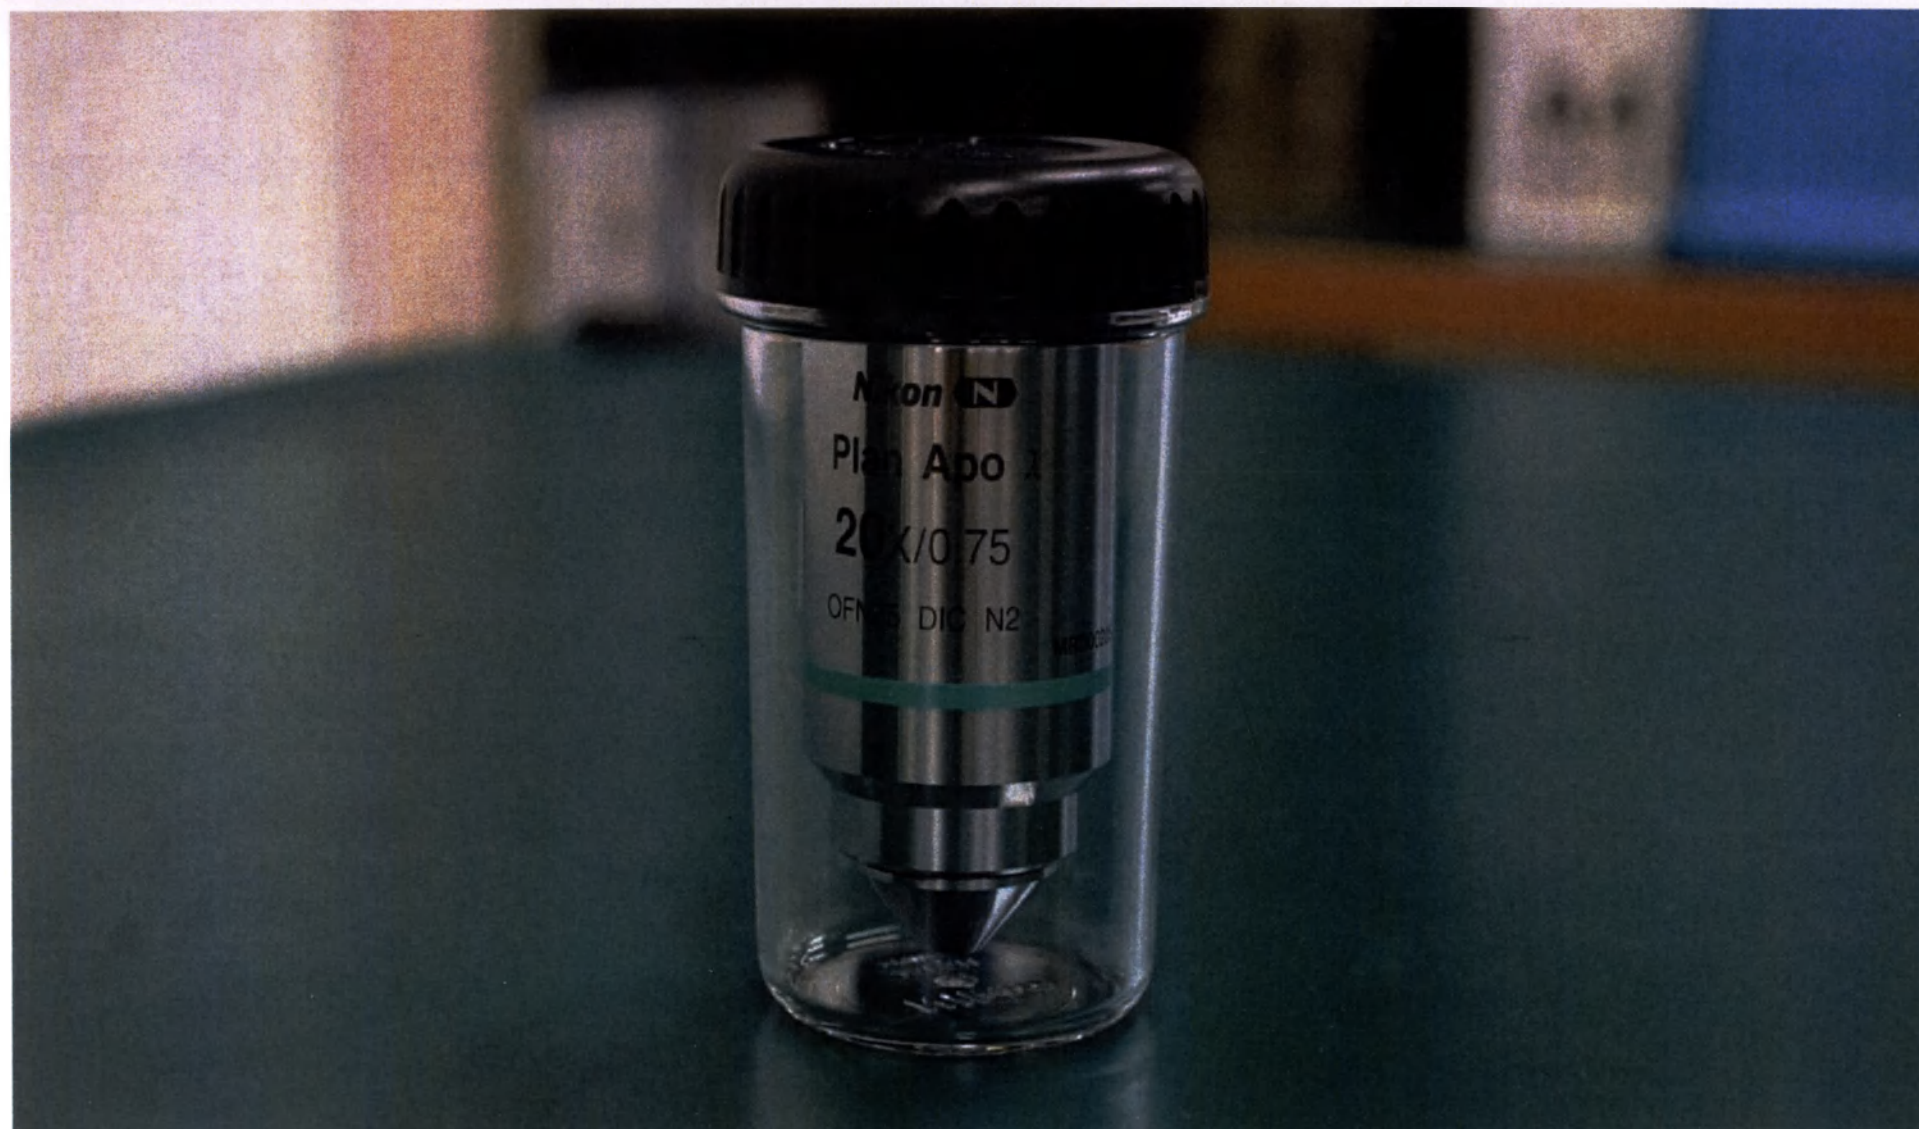


Карты со штрих кодами (синие) A14354-01 для кассет (120 карт/коробка)




Диск 1 с драйвером для платы высокоскоростной передачи данных по оптическому каналу



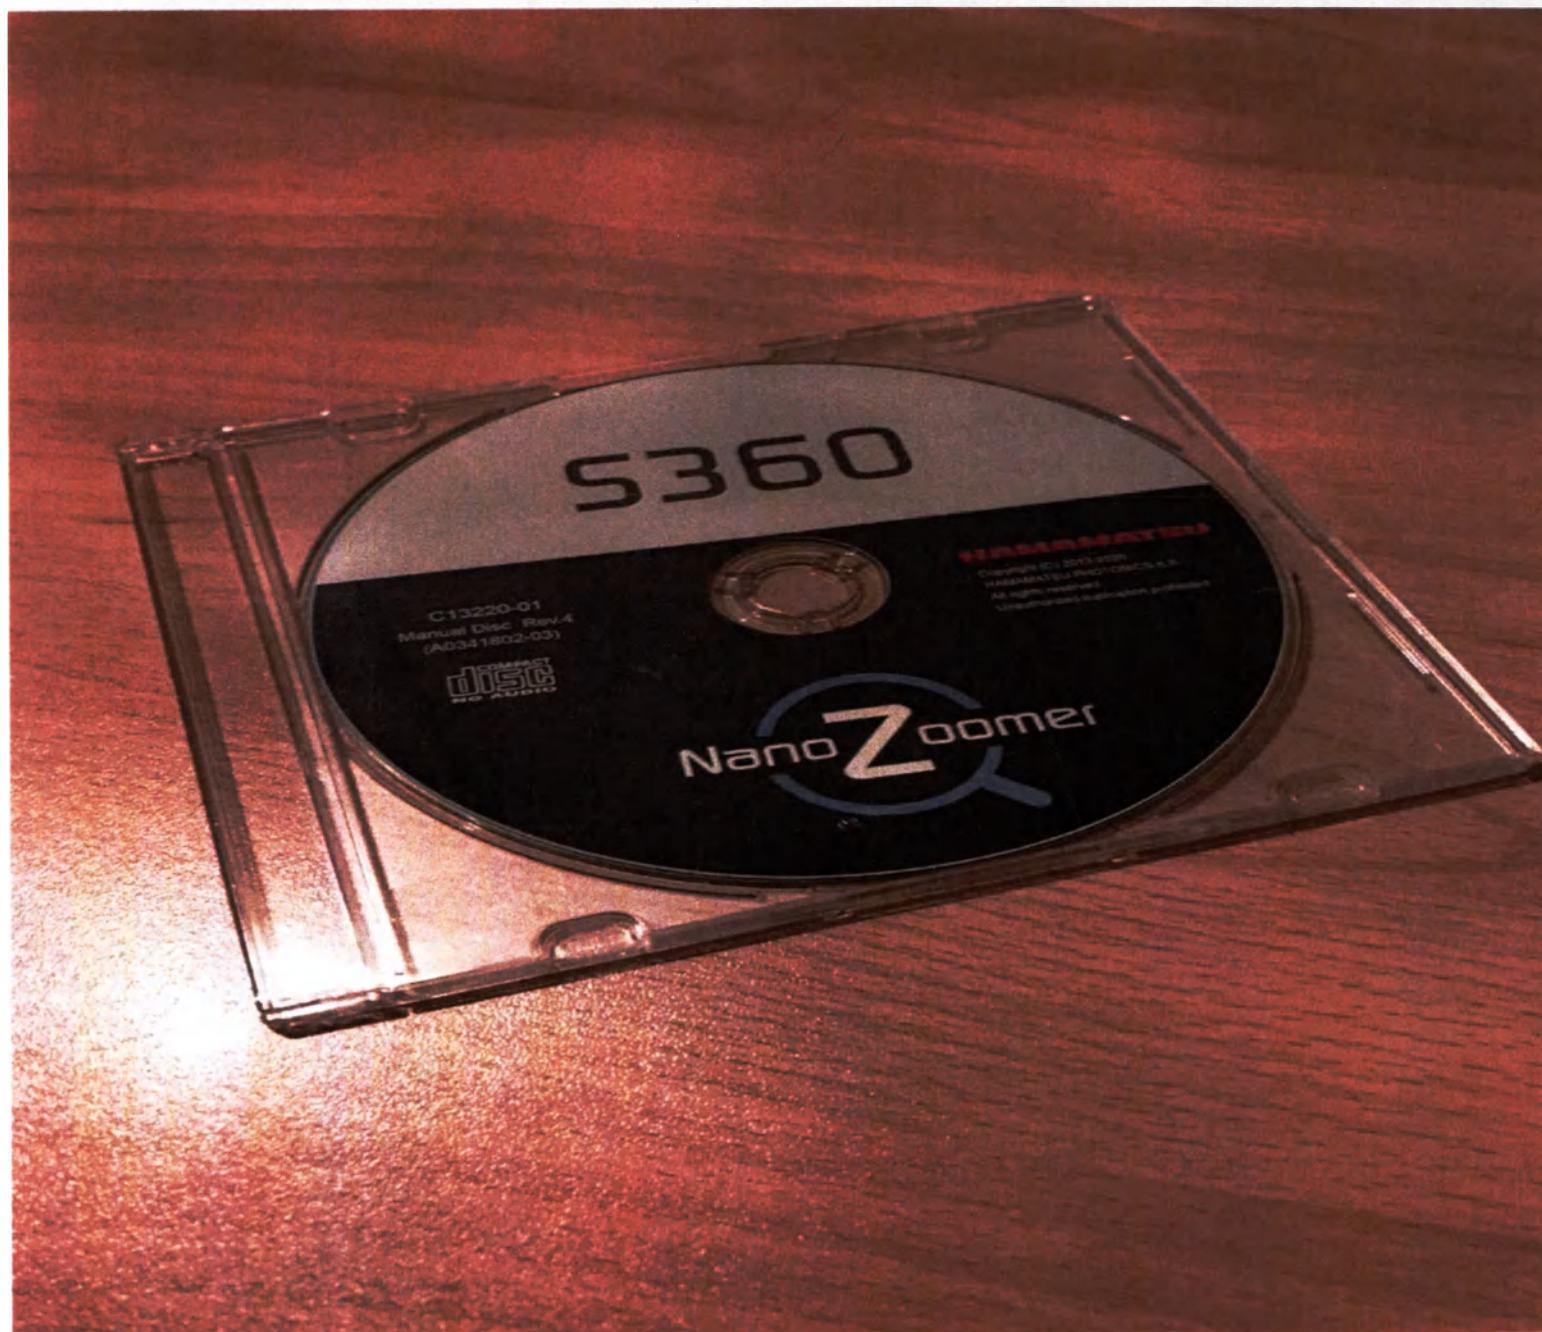


Диск 3 с программным обеспечением NZAcquire



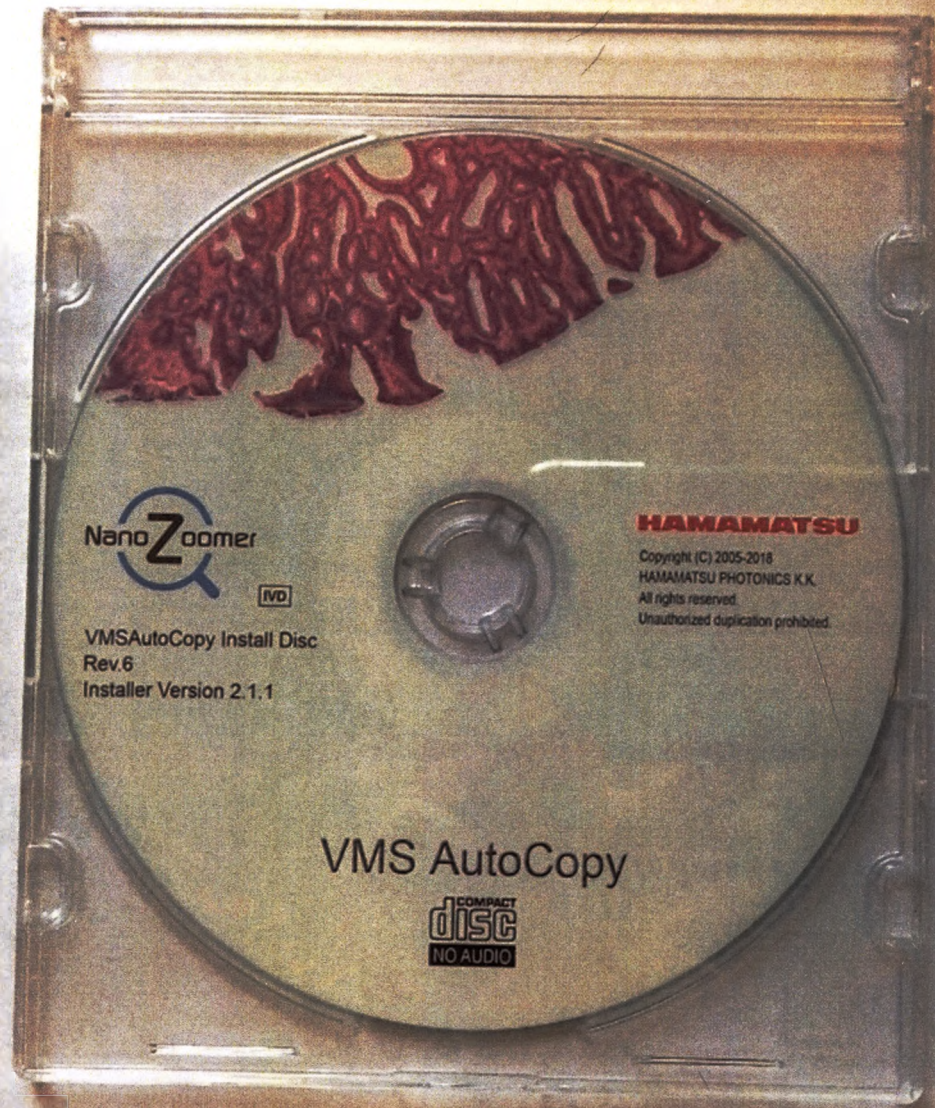

Диск 5 с программным обеспечением NDP.view 2 (при необходимости)

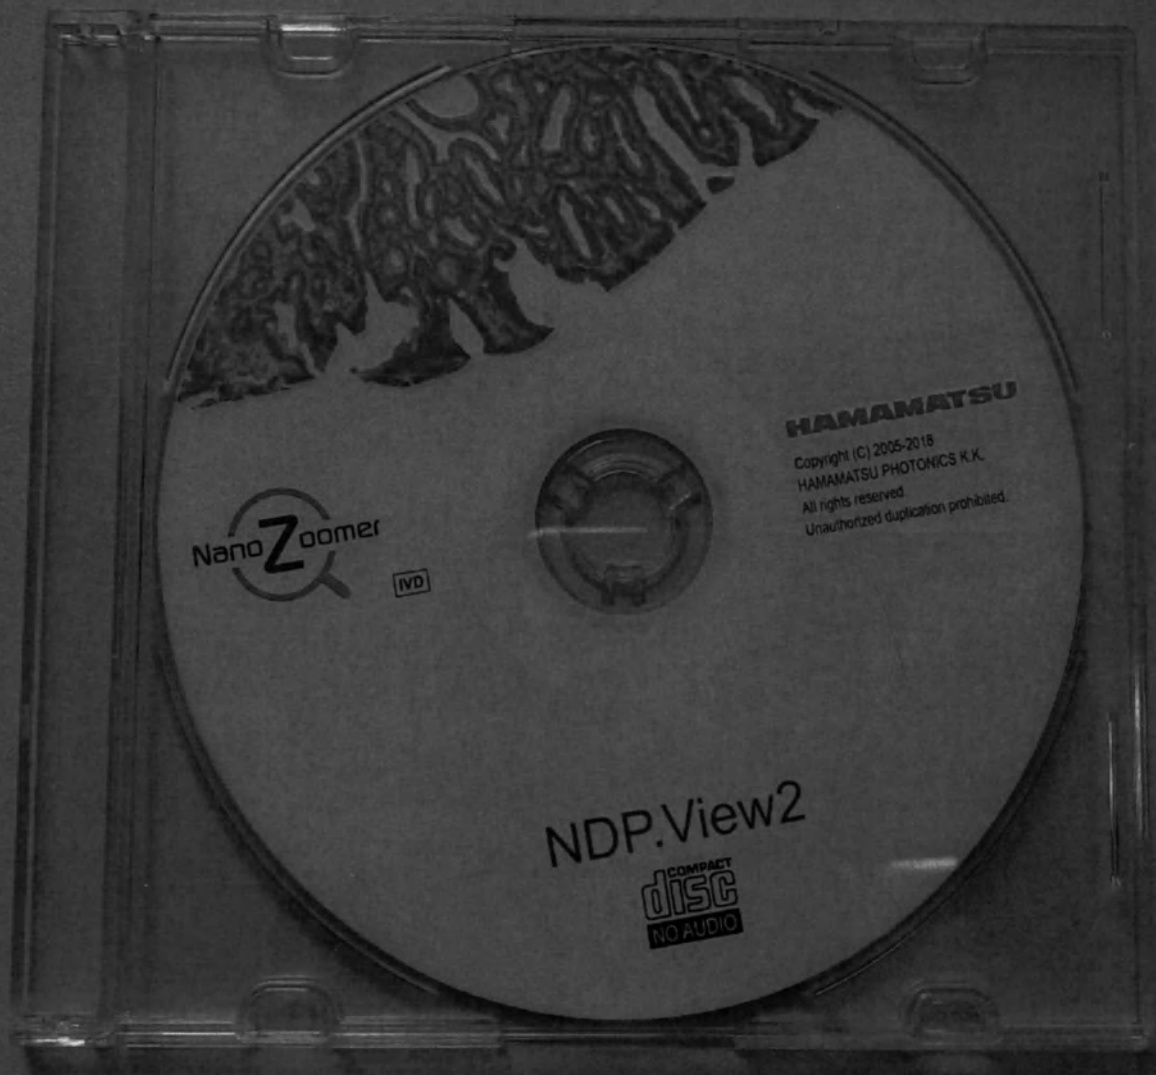


Принадлежности.

Сетевой шнур для сканера Nanozoomer S360




Запасной предохранитель: Т 5,0 А

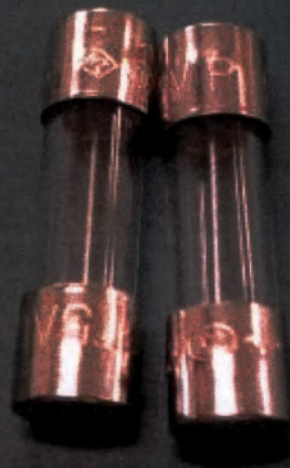


Кабель USB 3.0 (3 м)




Конденсор с числовой апертурой 0,2

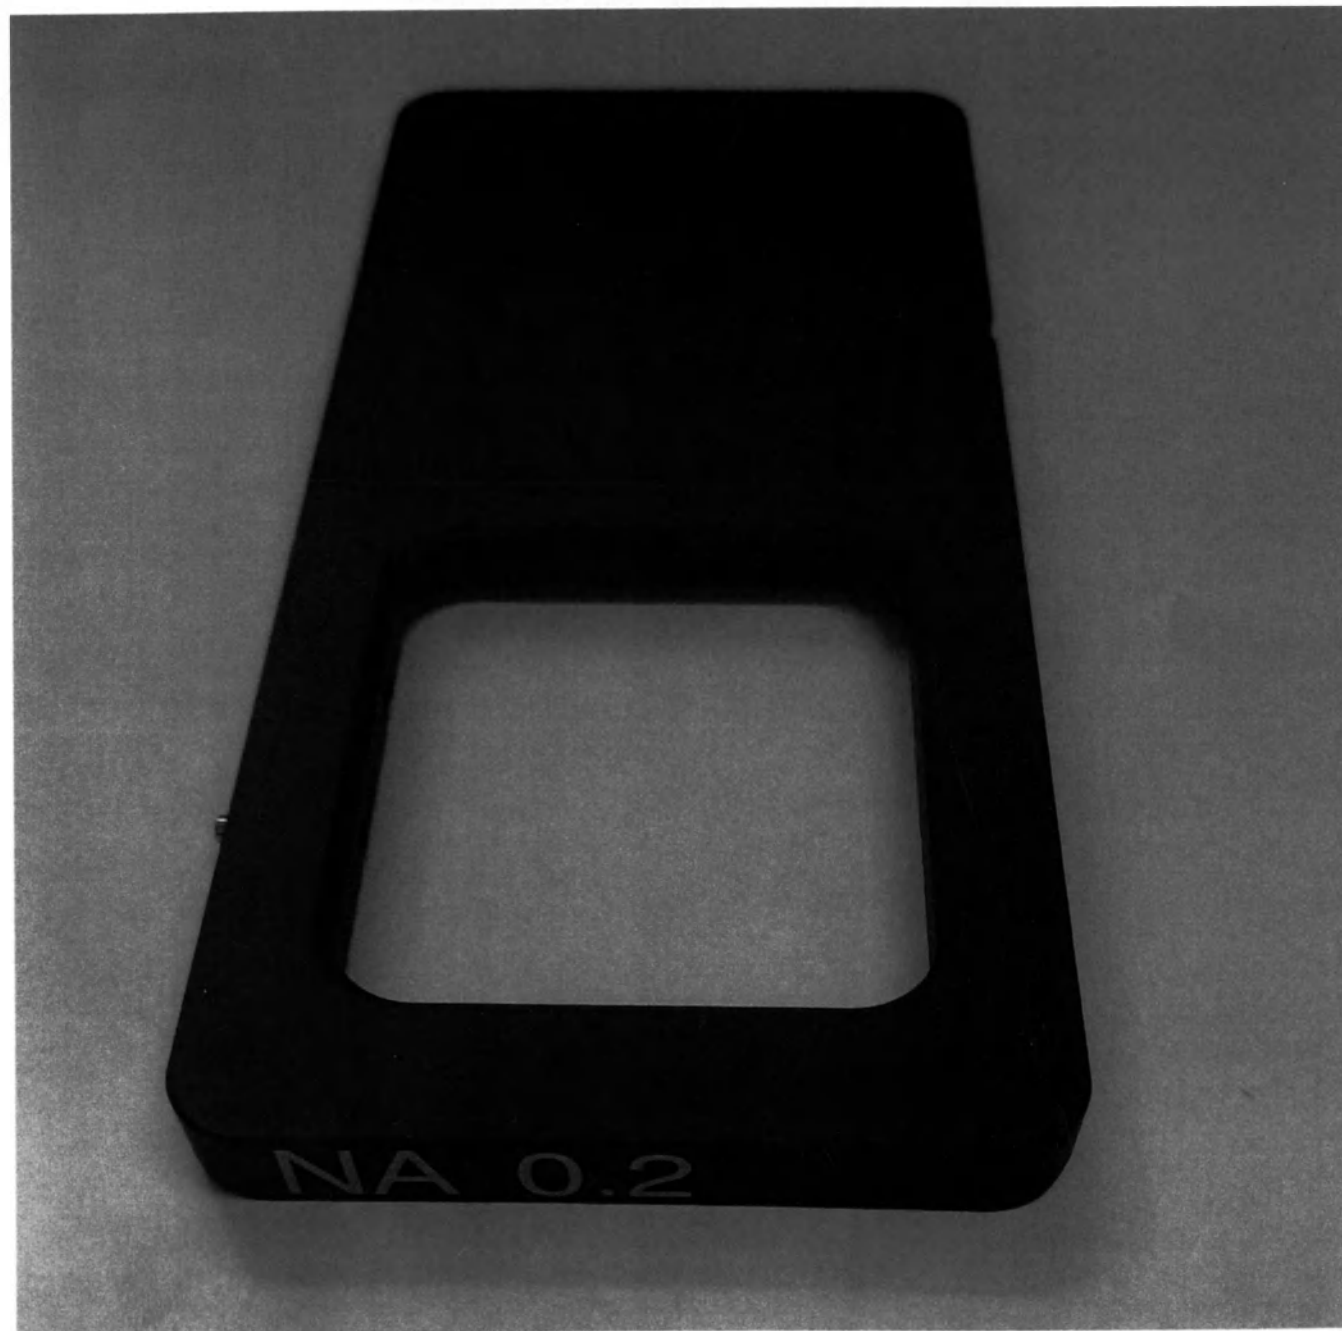


Конденсор с числовой апертурой 0,33

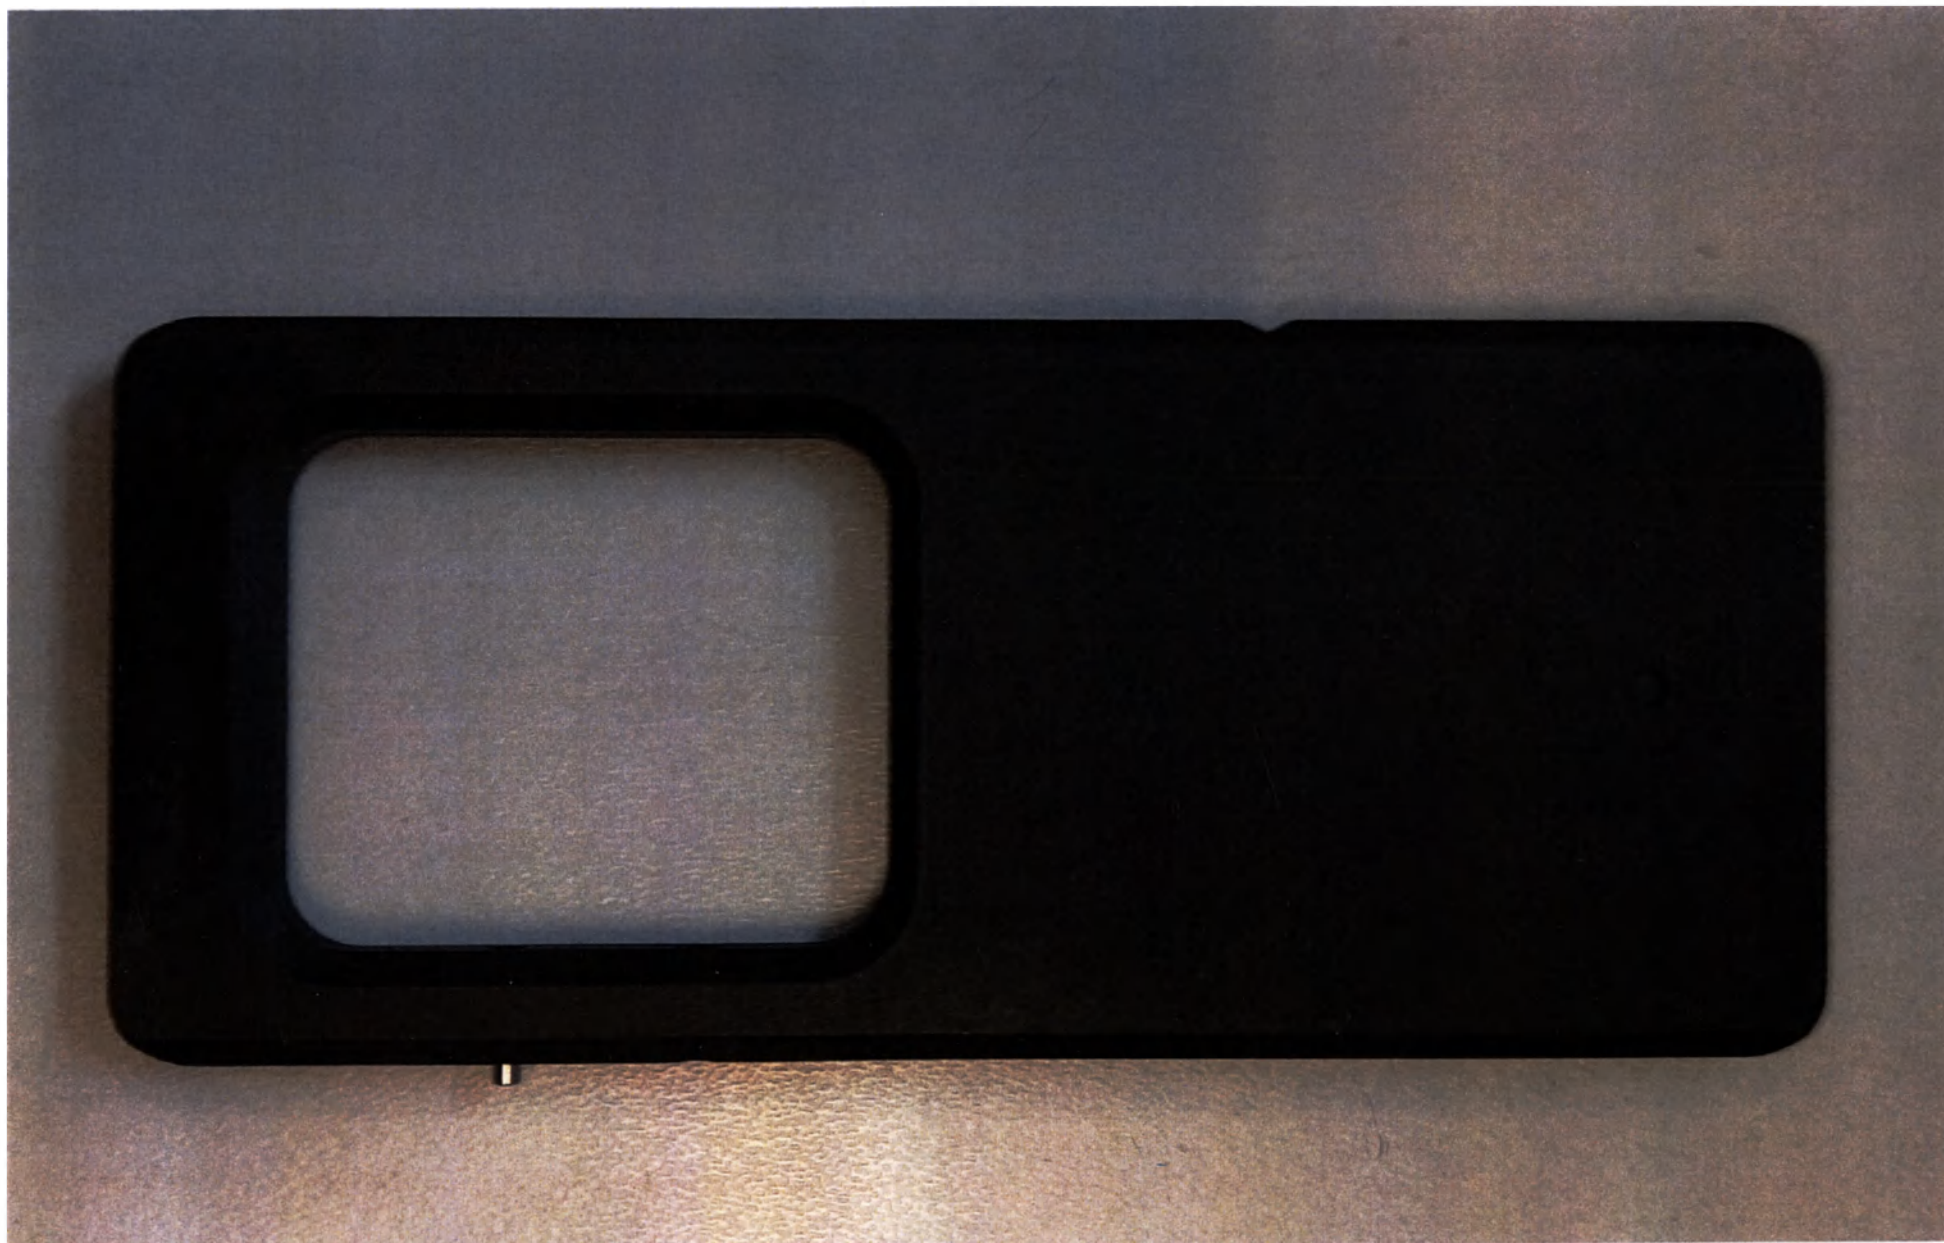

Конденсор с числовой апертурой 0,5

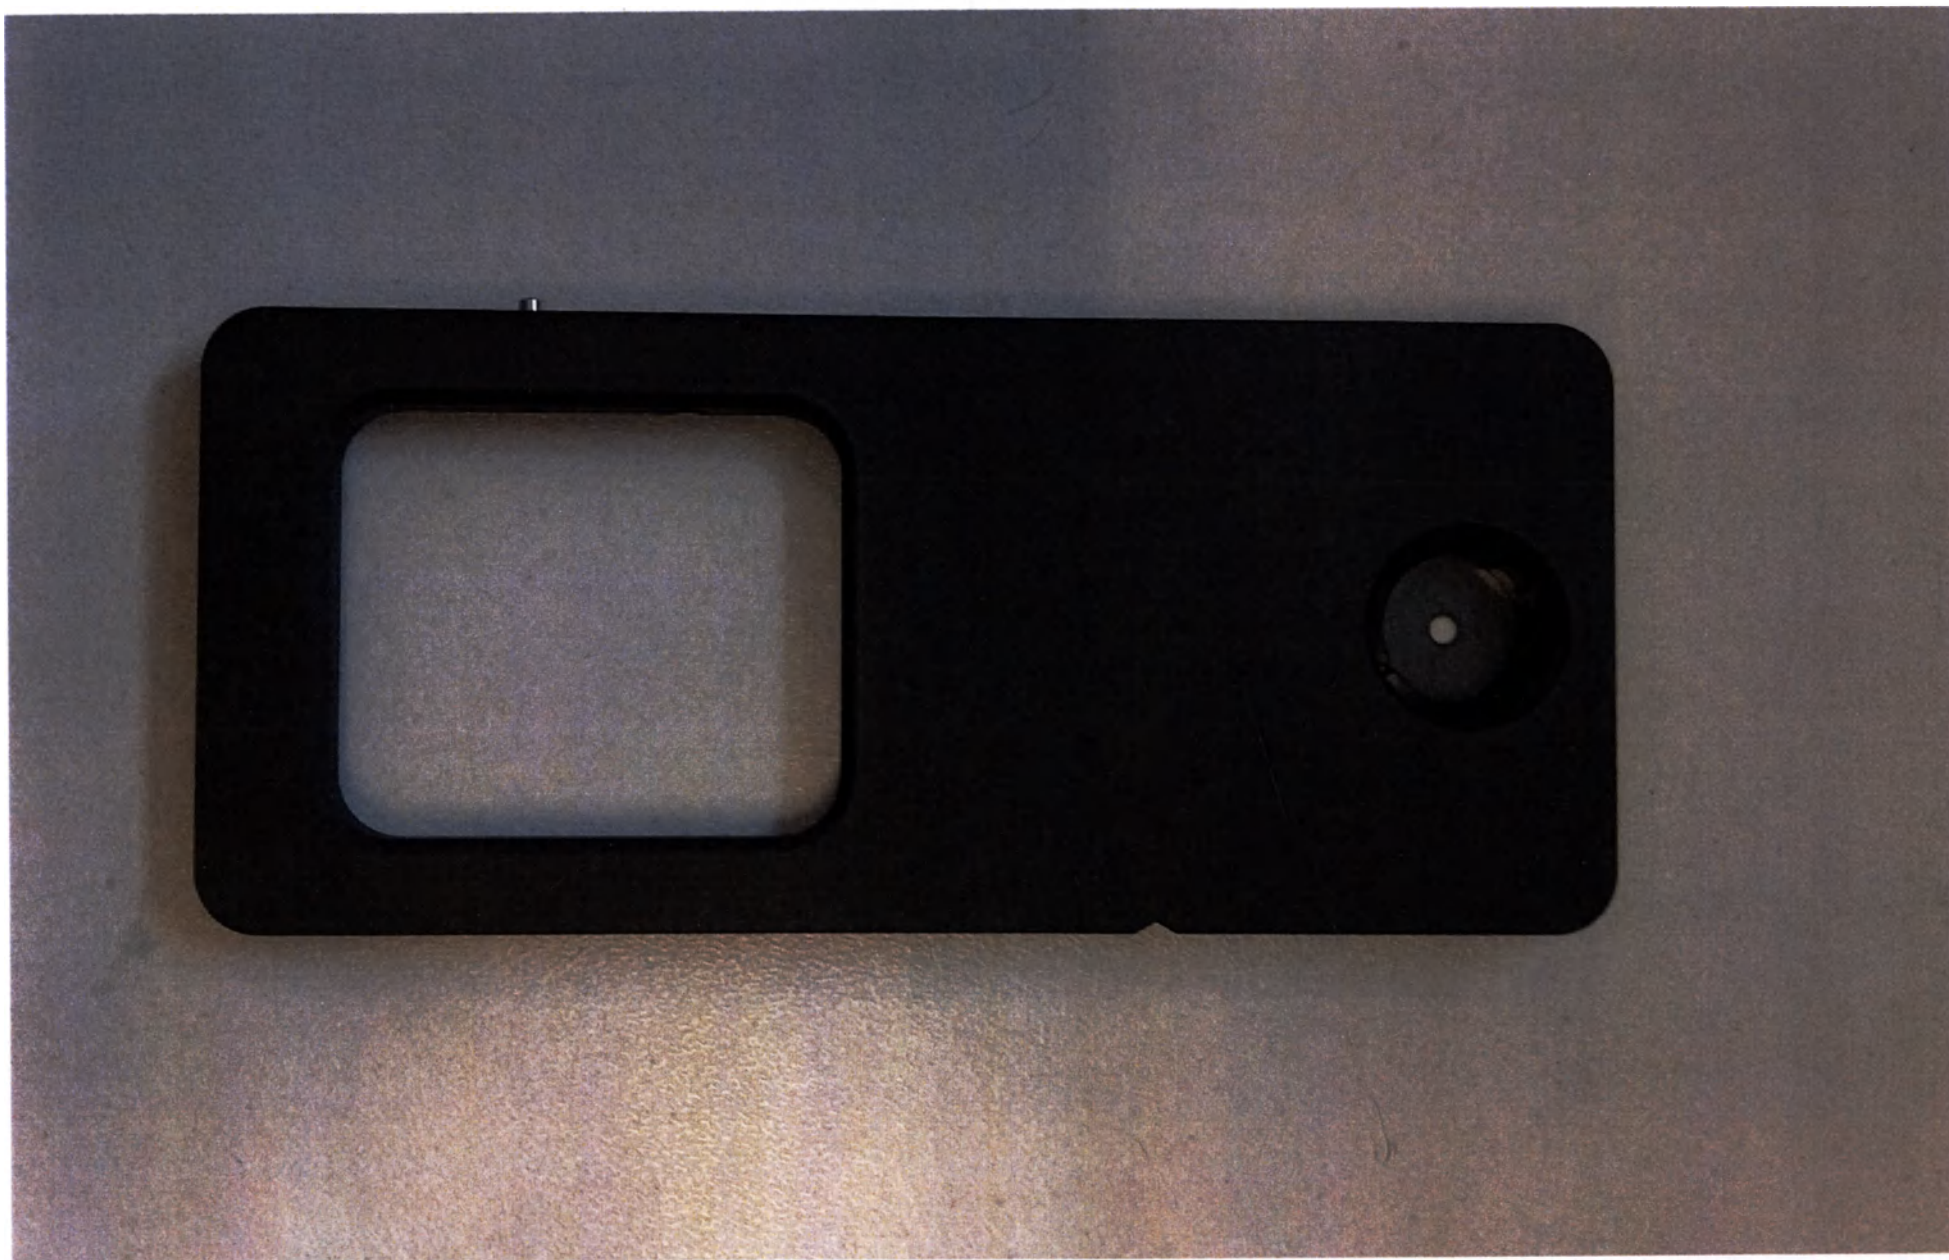

Специальное калибровочное стекло

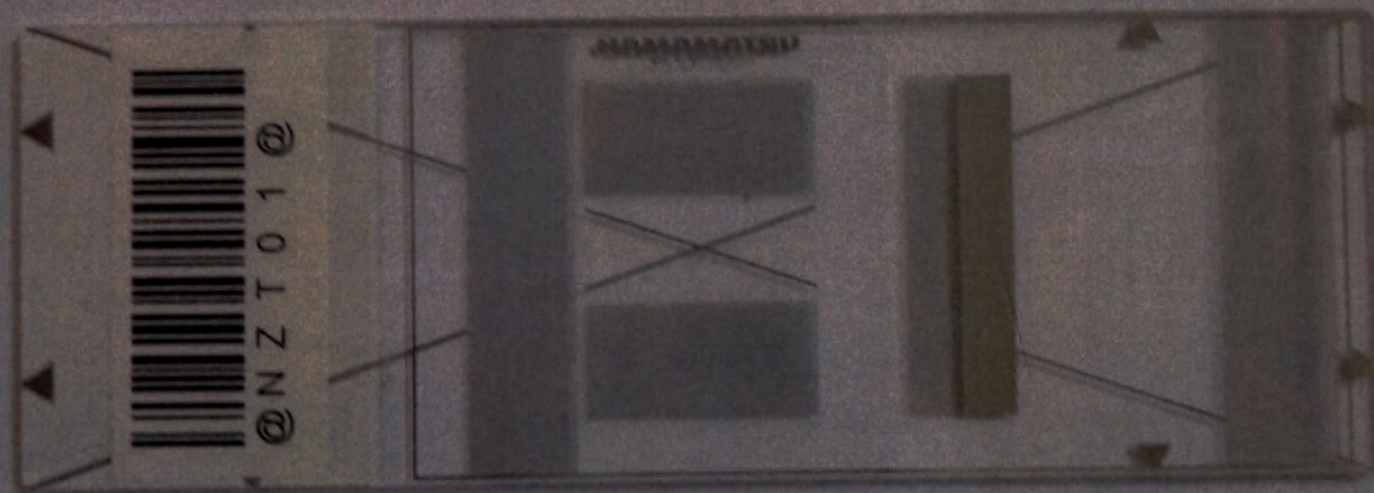

Резервный диск с параметрами оборудования



Прошито и пронумеровано

21

листа (ов)

Генеральный директор

ООО «БиоВитрум»

В.В. Цимберг

