

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здоровоохранение»

« _____ » _____ 2021 г.
« _____ » _____ 2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Follicle Stimulating Hormone (Atellica IM FSH))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.»,
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

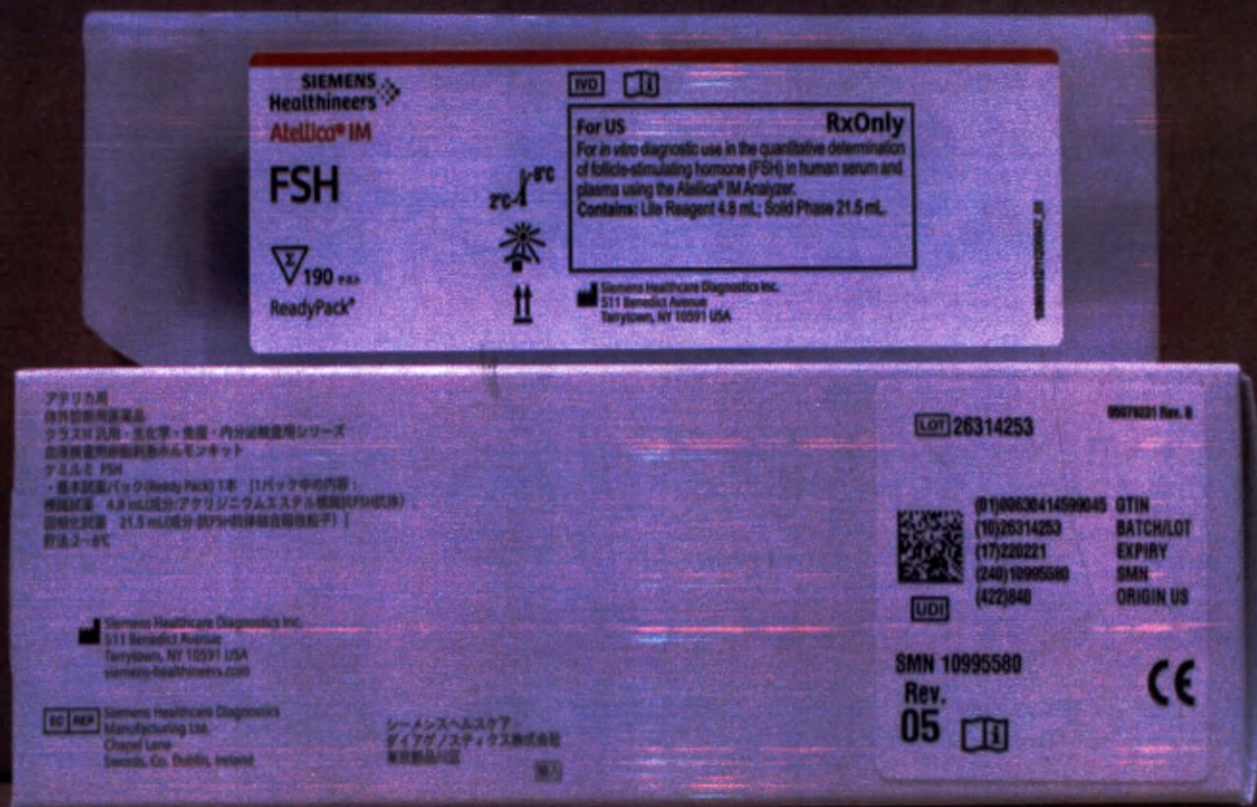


Рисунок 1. Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Follicle Stimulating Hormone (Atellica IM FSH)). Фасовка 190 тестов. Общий вид I

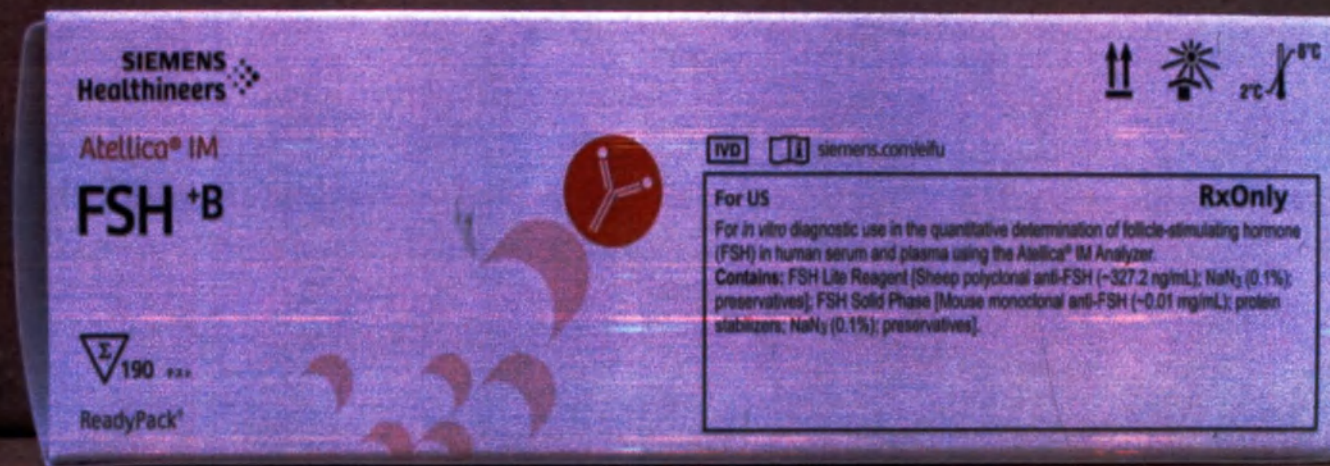


Рисунок 2. Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Follicle Stimulating Hormone (Atellica IM FSH)). Фасовка 190 тестов. Общий вид 2

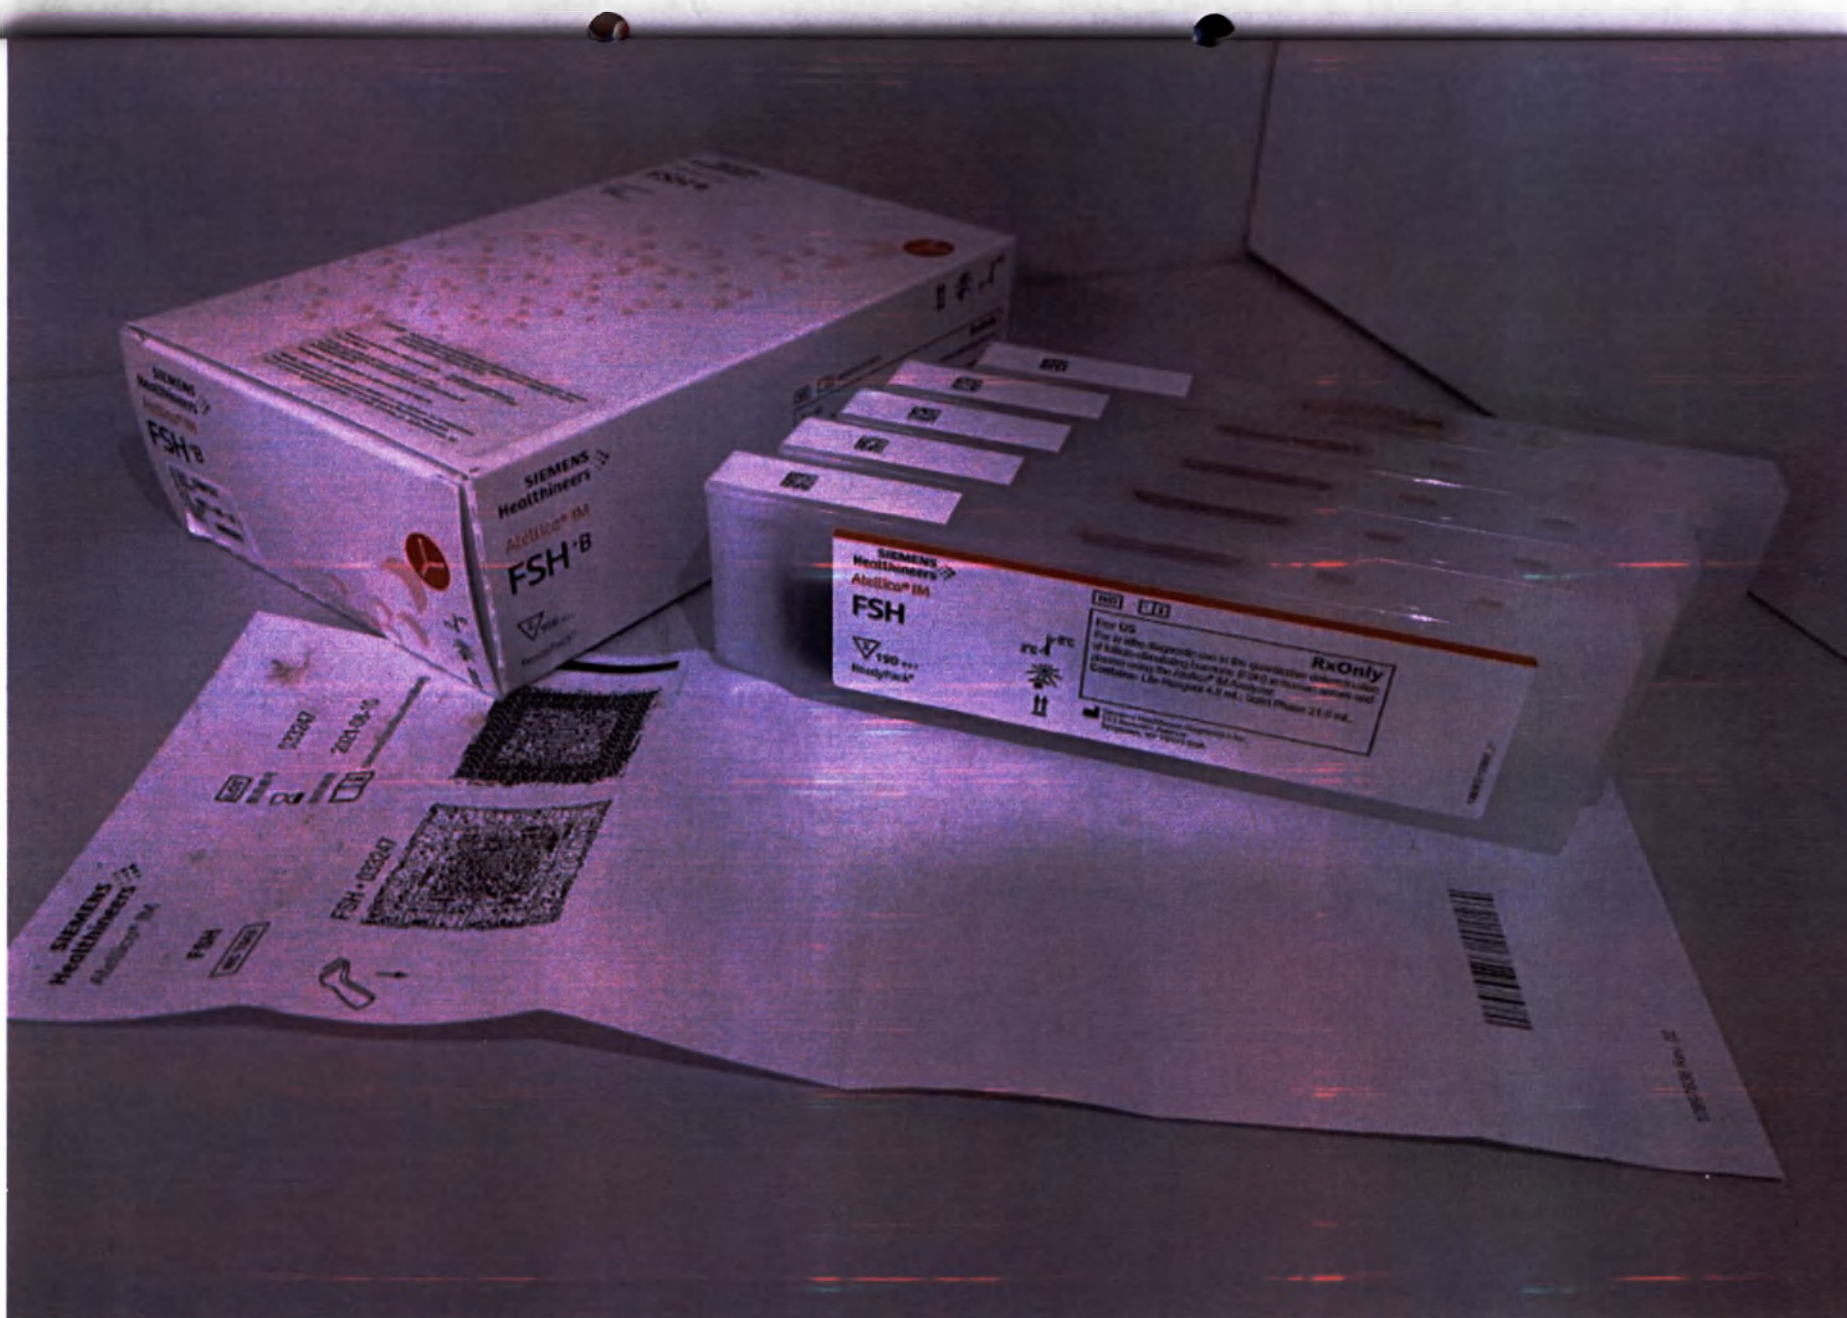


Рисунок 3. Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Follicle Stimulating Hormone (Atellica IM FSH)). Фасовка 950 тестов. Общий вид

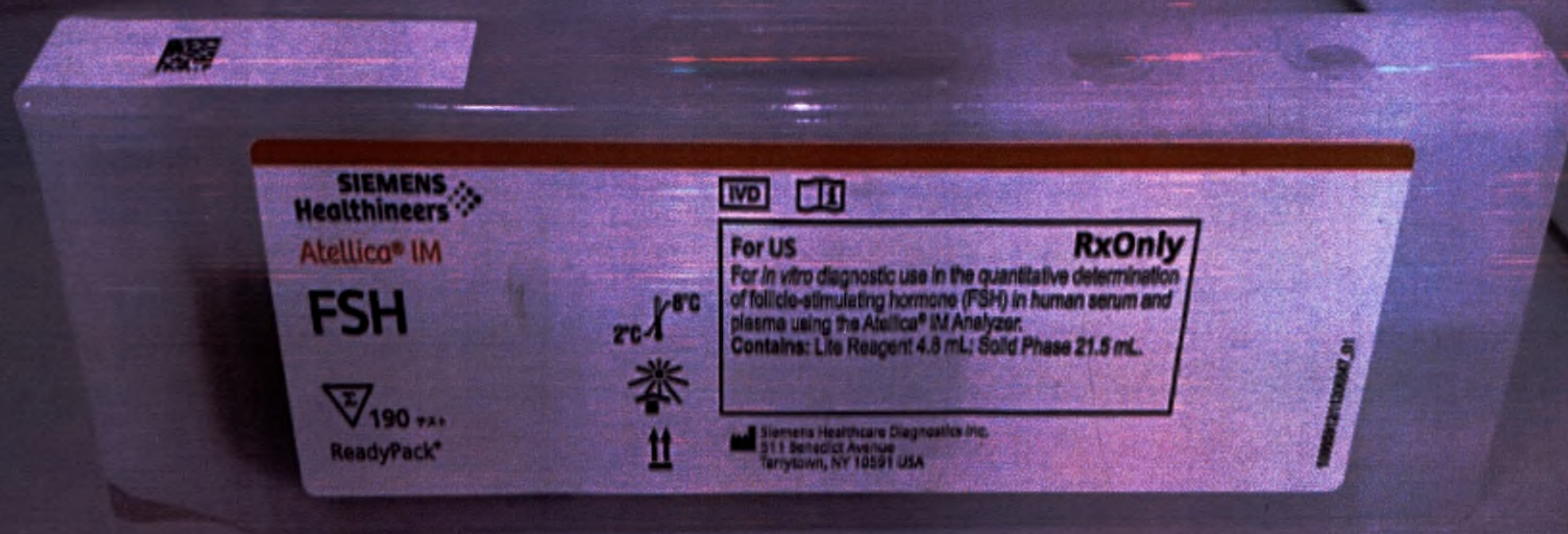


Рисунок 4. Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Follicle Stimulating Hormone (Atellica IM FSH)). Основной реагент Atellica IM FSH

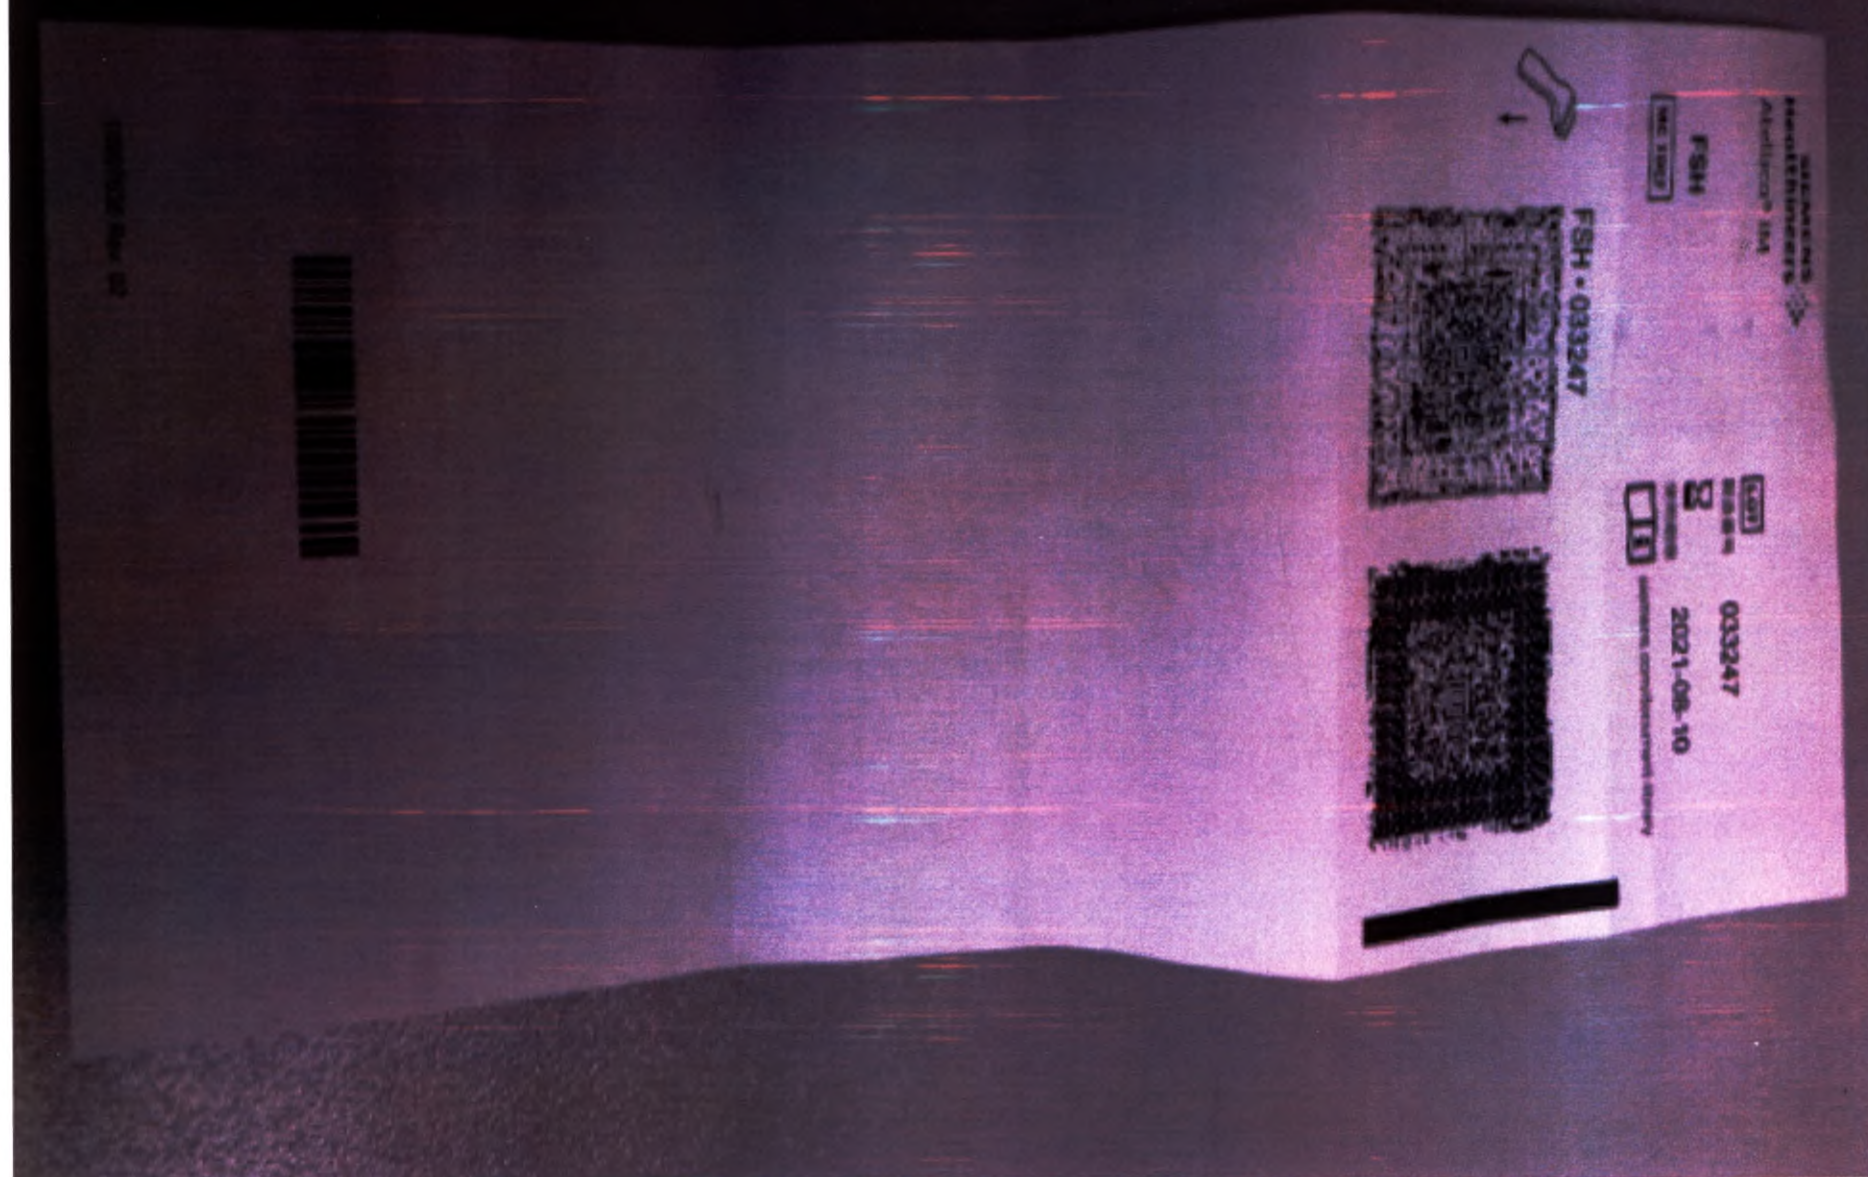


Рисунок 5. Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Follicle Stimulating Hormone (Atellica IM FSH)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM FSH



Рисунок 6. Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Follicle Stimulating Hormone (Atellica IM FSH)) с русскоязычной маркировкой

10995581 Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона
на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Follicle
Stimulating Hormone (Atellica IM FSH))

Информация о производителе и стране происхождения
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/2533 от 11.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель изготовителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 7. Набор реагентов для определения фолликулостимулирующего гормона на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Follicle Stimulating Hormone (Atellica IM FSH)): Стикер с русскоязычной маркировкой



всего прошито и пронумеровано
листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»