


Фотографические изображения медицинского изделия и макет маркировки



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23
013-29792921-2019 (60 мл)

42045
19.06.2020

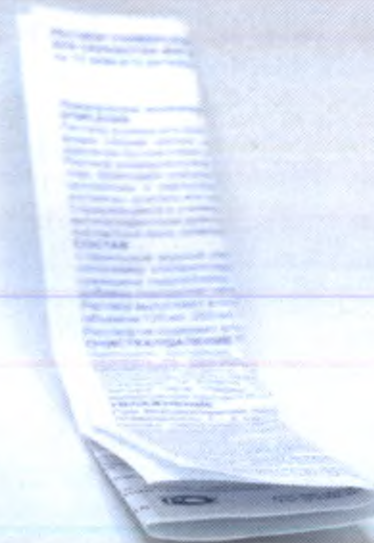

Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



ADRIA

РАСТВОР
универсальный
для обработки
мягких
контактных линз

- Очистка
- Промывка
- Увлажнение
- Хранение
- Удаление
протеиновых
отложений

125 мл

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)

- Очистка
- Промывка
- Увлажнение
- Хранение
- Удаление
протеиновых
отложений

Предупреждение!

Необходимо соблюдать правила по уходу за линзами, рекомендованные Вашим врачом. Несоблюдение указаний может привести к серьезным заболеваниям глаз. Во избежание загрязнения раствора не допускать соприкосновения наконечника флакона с посторонними предметами. Не использовать по истечении указанного срока годности. Не использовать в случае нарушения целостности упаковки. Использование каких-либо лекарственных препаратов для глаз одновременно с раствором допускается только под наблюдением врача. Хранить при температуре от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

STERILE A




Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23
013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

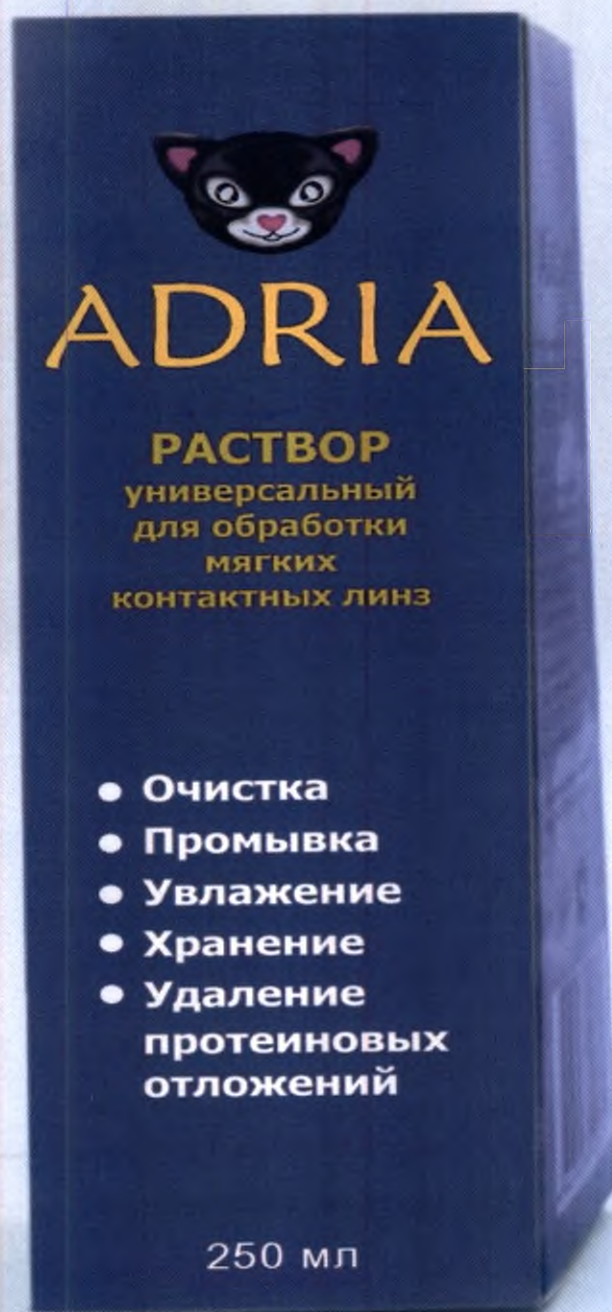

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

- Очистка
- Промывка
- Увлажнение
- Хранение
- Удаление
протеиновых
отложений

Предупреждение!

Необходимо соблюдать правила по уходу за линзами, рекомендованные Вашим врачом. Несоблюдение указаний может привести к серьезным заболеваниям глаз. Во избежание загрязнения раствора не допускать соприкосновения наконечника флакона с посторонними предметами. Не использовать по истечении указанного срока годности. Не использовать в случае нарушения целостности упаковки. Использование каких-либо лекарственных препаратов для глаз одновременно с раствором допускается только под наблюдением врача. Хранить при температуре от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

STERILE A



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



ADRIA

РАСТВОР
универсальный
для обработки мягких
контактных линз

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (60 мл)



**РАСТВОР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЯГКИХ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ**

ЯНТАРНАЯ
КИСЛОТА
насыщение
кислородом


ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА
природный
увлажнитель

- Очистка
- Промывка
- Увлажнение
- Хранение
- Удаление
протеиновых
отложений



**New
Natural
Contact**

Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ
21.20.23-013-29792921-2019 (60 мл)

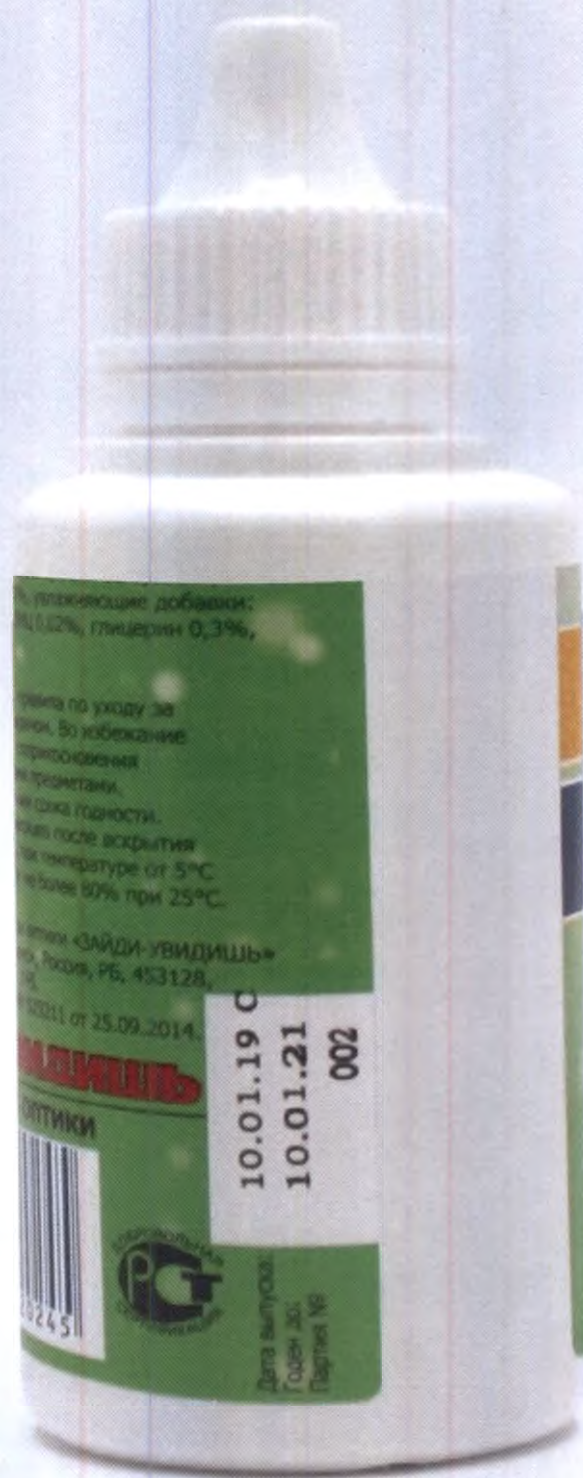

Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (60 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)

**РАСТВОР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
для обработки мягких
контактных линз**

**ЯНТАРНАЯ
КИСЛОТА
насыщение
кислородом**

**ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА
природный
увлажнитель**

**New
Natural
Contact**



125 мл

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл))

- Очистка
- Промывка
- Увлажнение
- Хранение
- Удаление
протеиновых
отложений

ВНИМАНИЕ!

Необходимо соблюдать
правила по уходу за линзами,
рекомендованные
Вашим врачом.
Во избежание загрязнения
раствора не допускать
соприкосновения
наконечника флакона
с посторонними предметами.
Не использовать раствор по
истечении срока годности.
Использовать раствор
не более 6 месяцев
после вскрытия флакона.
Беречь от детей!
Хранить при температуре
от 5°C до 30°C
и относительной влажности
не более 80% при 25°C.


Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)

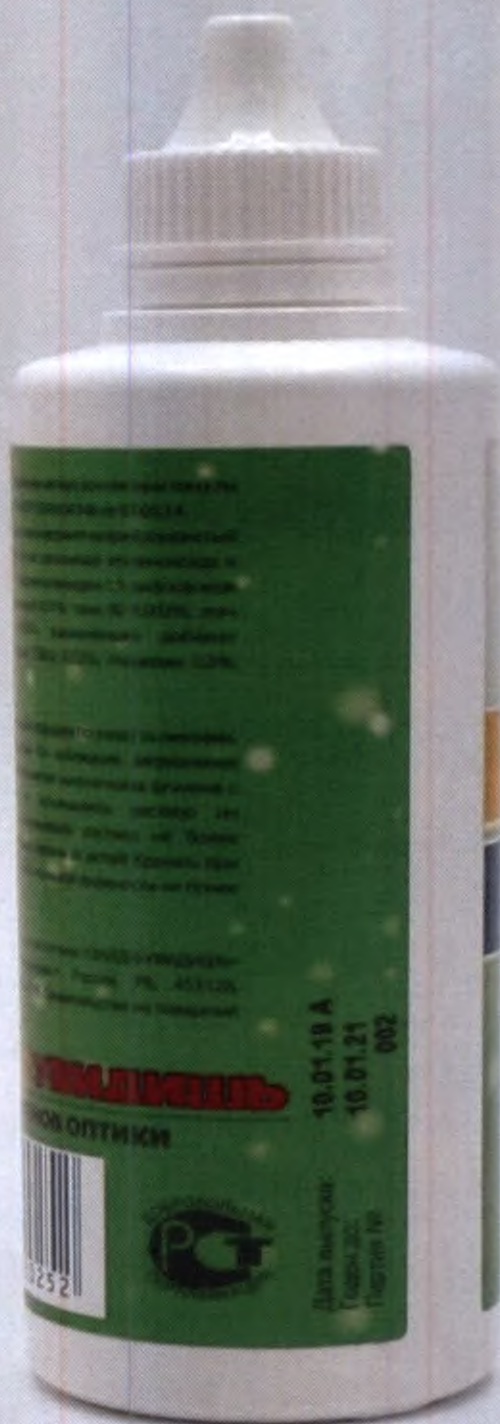

Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

**РАСТВОР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
для обработки мягких
контактных линз**

**ЯНТАРНАЯ
КИСЛОТА**
насыщение
кислородом

**ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА**
природный
увлажнитель

**New
Natural
Contact**



250 мл

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

- Очистка
- Промывка
- Увлажнение
- Хранение
- Удаление
протеиновых
отложений


ВНИМАНИЕ!

Необходимо соблюдать
правила по уходу за линзами,
рекомендованные
вашим врачом.

Во избежание загрязнения
раствора не допускать
соприкосновения
наконечника флакона
с посторонними предметами.
Не использовать раствор по
истечении срока годности.
Использовать раствор
не более 6 месяцев
после вскрытия флакона.

Беречь от детей!
Хранить при температуре
от 5°C до 30°C
и относительной влажности
не более 80% при 25°C.

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз
по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

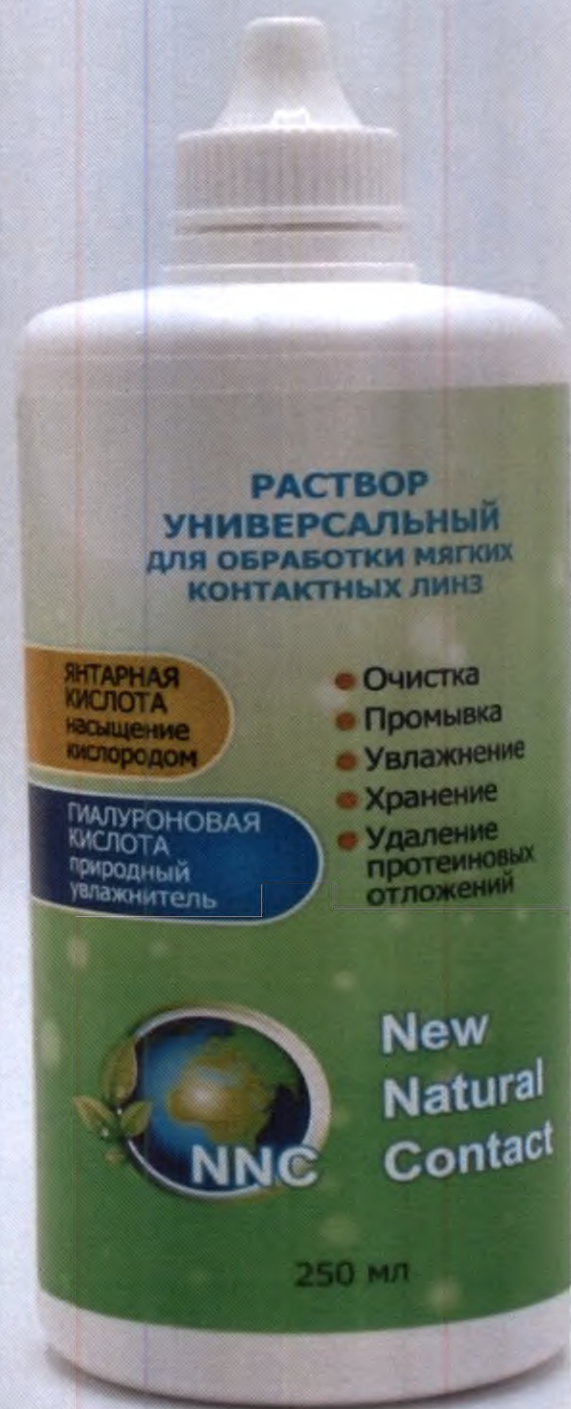

Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (60 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (60 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)

AirZONE

ВНИМАНИЕ!

Необходимо соблюдать правила
по уходу за линзами,
рекомендованные Вашим врачом.

Во избежание загрязнения
раствора не допускать
соприкосновения
наконечника флакона
с посторонними предметами.

Не использовать по истечении
срока годности.

Использовать раствор
не более 6 месяцев
после вскрытия флакона.

Беречь от детей!

Хранить при температуре
от 5°C до 30°C и
относительной влажности
не более 80% при 25°C.

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

AirZONE

**РАСТВОР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**
для обработки мягких
контактных линз

- Очищение
- Промывание
- Увлажнение
- Хранение
- Удаление
протеиновых
отложений

O₂
Насыщение
кислородом

250 мл

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

AirZONE

ВНИМАНИЕ!

Необходимо соблюдать
правила по уходу за линзами,
рекомендованные Вашим врачом.

Во избежание загрязнения
раствора не допускать
соприкосновения
наконечника флакона
с посторонними предметами.

Не использовать по истечении
срока годности.

Использовать раствор
не более 6 месяцев
после вскрытия флакона.

Беречь от детей!

Хранить при температуре
от 5°C до 30°C и
относительной влажности
не более 80% при 25°C.

Свидетельство по товарному
знаку AirZONE № 536342
от 05.03.15

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 ((250 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



AirZONE

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (60 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (60 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)

AIRWAY®

- > очистка
- > промывка
- > увлажнение
- > хранение
- > удаление
протеиновых
отложений

ВНИМАНИЕ!

Необходимо соблюдать
правила по уходу за линзами,
рекомендованные
Вашим врачом.

Во избежание загрязнения
раствора не допускать
соприкосновения
наконечника флакона
с посторонними предметами.

Не использовать по истечении
срока годности.

Использовать раствор
не более 6 месяцев
после вскрытия флакона.

Беречь от детей!

Хранить при температуре
от 5°C до 30°C и
относительной влажности
не более 80% при 25°C.

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)




10.02.19 A
10.02.21
002

Дата выпуска:
Годен до:
Партия №:

Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

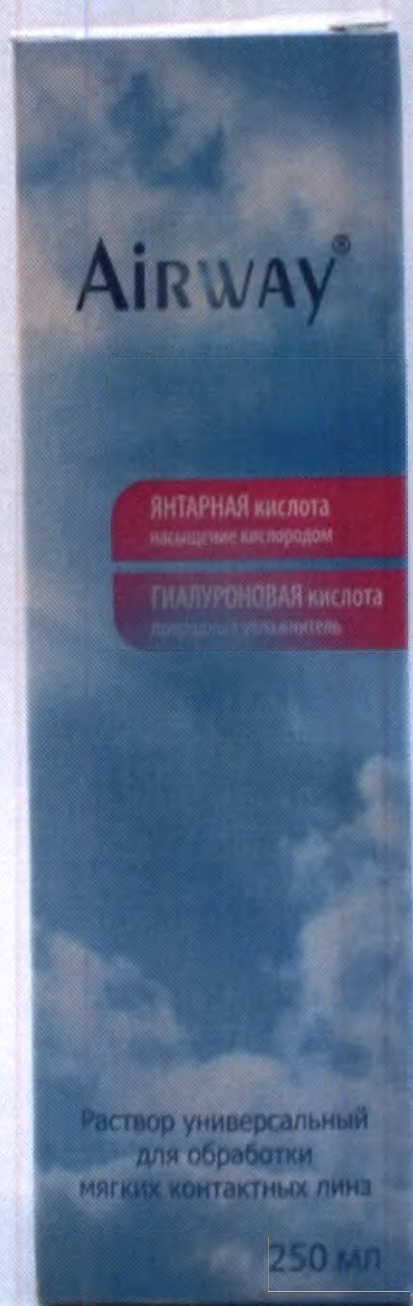

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

AIRWAY®

- > очистка
- > промывка
- > увлажнение
- > хранение
- > удаление
протеиновых
отложений

ВНИМАНИЕ!

Необходимо соблюдать
правила по уходу за линзами,
рекомендованные
Вашим врачом.

Во избежание загрязнения
раствора не допускать
соприкосновения
наконечника флакона
с посторонними предметами.

Не использовать по истечении
срока годности.

Использовать раствор
не более 6 месяцев
после вскрытия флакона.

Беречь от детей!

Хранить при температуре
от 5°C до 30°C и
относительной влажности
не более 80% при 25°C.

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (60 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (60 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)

- Очистка
- Промывка
- Увлажнение
- Хранение
- Удаление
протеиновых
отложений

ВНИМАНИЕ!

Необходимо соблюдать правила по уходу за линзами, рекомендованные Вашим врачом. Во избежание загрязнения раствора не допускать соприкосновения наконечника флакона с посторонними предметами. Не использовать по истечении срока годности. Использовать раствор не более 6 месяцев после вскрытия флакона. Беречь от детей! Хранить при температуре от 5°C до 30°C и относительной влажности не более 80% при 25°C.

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

Biosoft[®]
ACTIVE

РАСТВОР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЯГКИХ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

ЯНТАРНАЯ
КИСЛОТА
насыщение
кислородом

ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА
природный
увлажнитель

250 мл

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

- Очистка
- Промывка
- Увлажнение
- Хранение
- Удаление
протеиновых
отложений

ВНИМАНИЕ!

Необходимо соблюдать правила по уходу за линзами, рекомендованные Вашим врачом. Во избежание загрязнения раствора не допускать соприкосновения наконечника флакона с посторонними предметами. Не использовать по истечении срока годности. Использовать раствор не более 6 месяцев после вскрытия флакона. Беречь от детей! Хранить при температуре от 5°C до 30°C и относительной влажности не более 80% при 25°C.


Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

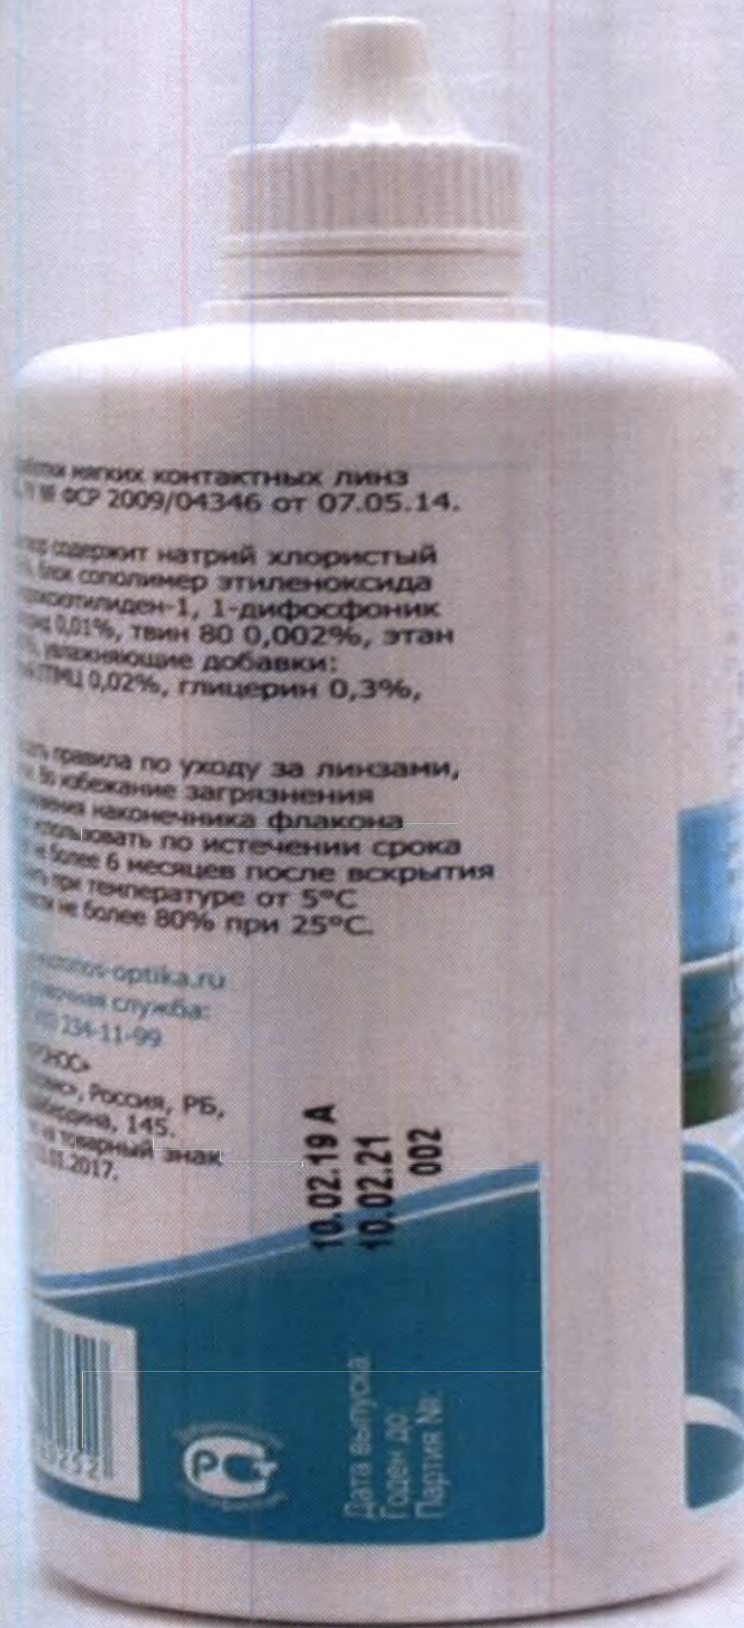

Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (60 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (60 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)

Pro Active

- Очистка
- Промывка
- Увлажнение
- Хранение
- Удаление
протеиновых
отложений

ВНИМАНИЕ
Представимые флаконы
предназначены для ухода за контактными
линзами, одобренными Вашим врачом.
В использовании флаконения
флакона не допускать
загрязнения флаконения
флакона и контактных
предметами, не использовать
раствор по истечении срока
годности. Использовать раствор
не более 6 месяцев после
открытия флакона. Беречь от
детей! Хранить при температуре
от 5°C до 30°C и относительной
влажности не более 80%
при 25°C.



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (125 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

Pro Active



РАСТВОР
универсальный
для обработки
мягких
контактных линз

природный
увлажнитель
**ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА**



O₂

**ЯНТАРНАЯ
КИСЛОТА**
насыщение
кислородом

250 мл

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)

- Очистка
- Промывка
- Увлажнение
- Хранение
- Удаление
протеиновых
отложений

ВНИМАНИЕ!

Необходимо соблюдать
правила по уходу за линзами,
рекомендованные Вашим врачом.

Во избежание загрязнения
раствора не допускать
соприкосновения наконечника
флакона с посторонними
предметами. Не использовать
раствор по истечении срока
годности. Использовать раствор
не более 6 месяцев после
вскрытия флакона. Беречь от
детей! Хранить при температуре
от 5°C до 30°C и относительной
влажности не более 80% при 25°C.



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Общий вид медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019 (250 мл)



Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019

Дата выпуска:

Срок годности:

Партия №:

Упаковка медицинского изделия: Раствор универсальный для обработки мягких контактных линз по ТУ 21.20.23-013-29792921-2019

Наименование: _____

Применение: _____

Состав: _____

Номер регистрационного удостоверения: _____



STERILE A

Макет маркировки

ЗАО «Оптимедсервис»

Прочито и срочно по печатию

Генеральный директор

Б. М. Азиебаев

