

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Физиотехника"



А.Е. Лапаев

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» по ТУ 9444-011-
76228444-2013»**


Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Физиотехника»

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО МАССАЖА «АКВАСПА»

ТУ 9444-011-76228444-2013


Исполнение - 28Г8Х

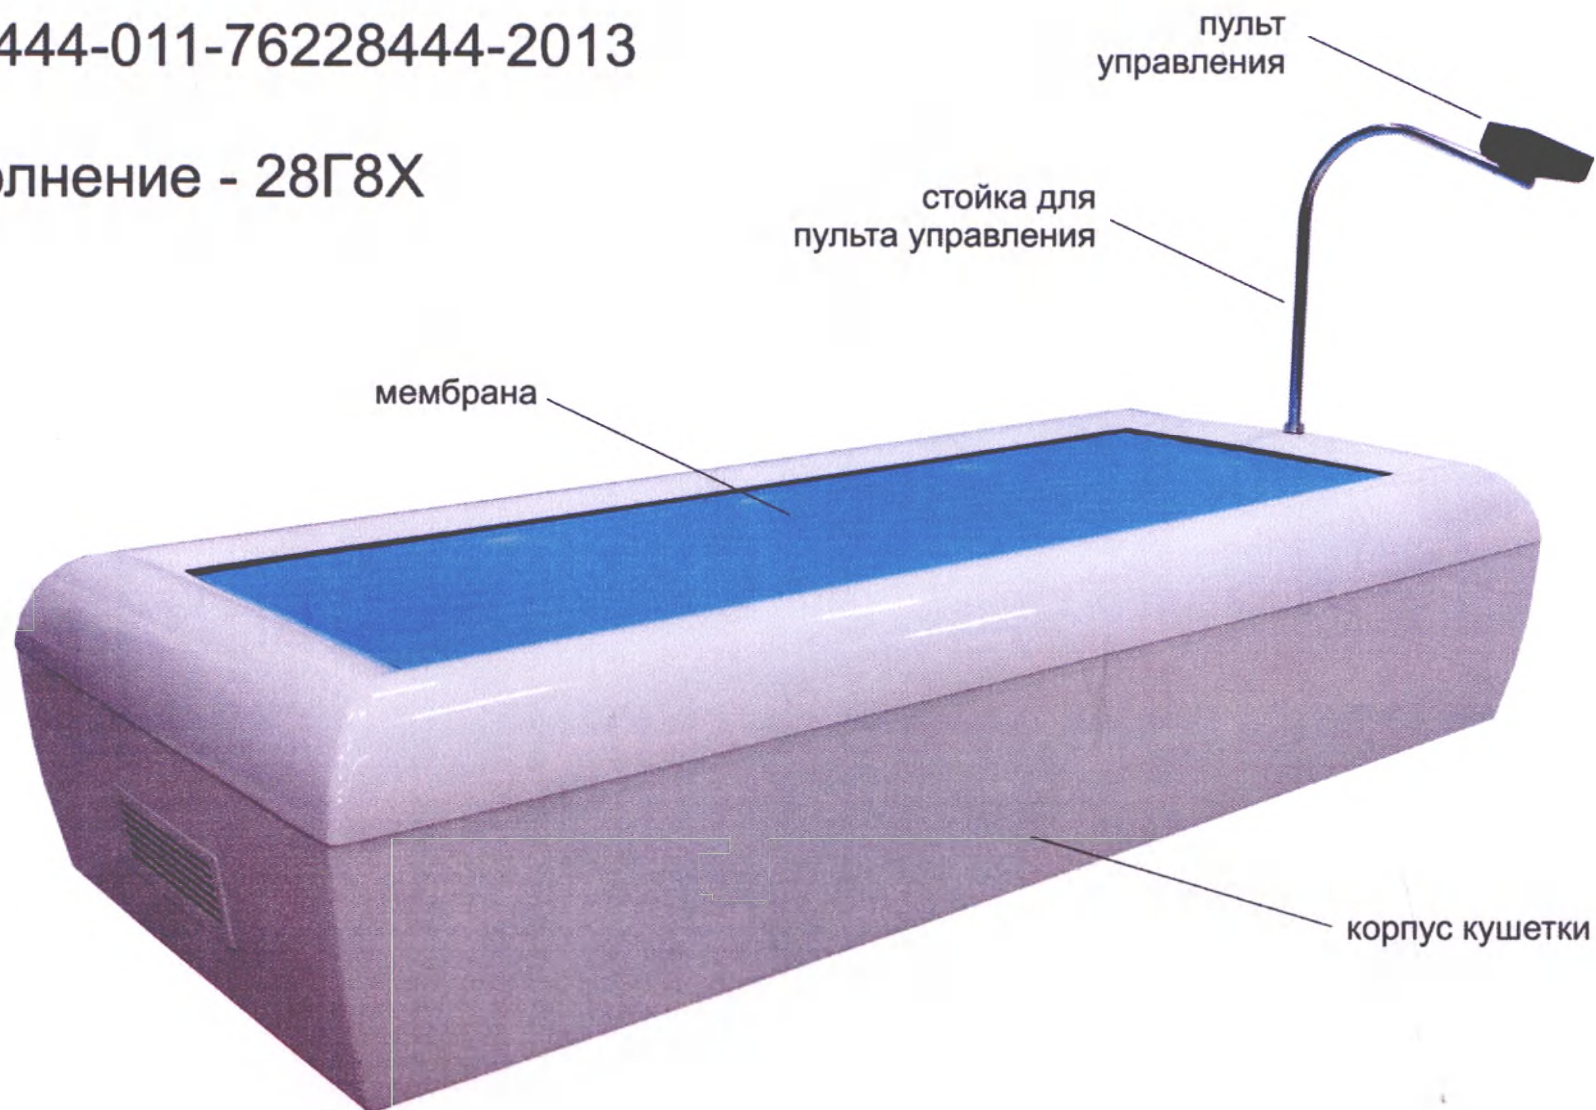

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО МАССАЖА «АКВАСПА»

ТУ 9444-011-76228444-2013


Исполнение - 24Г8Х

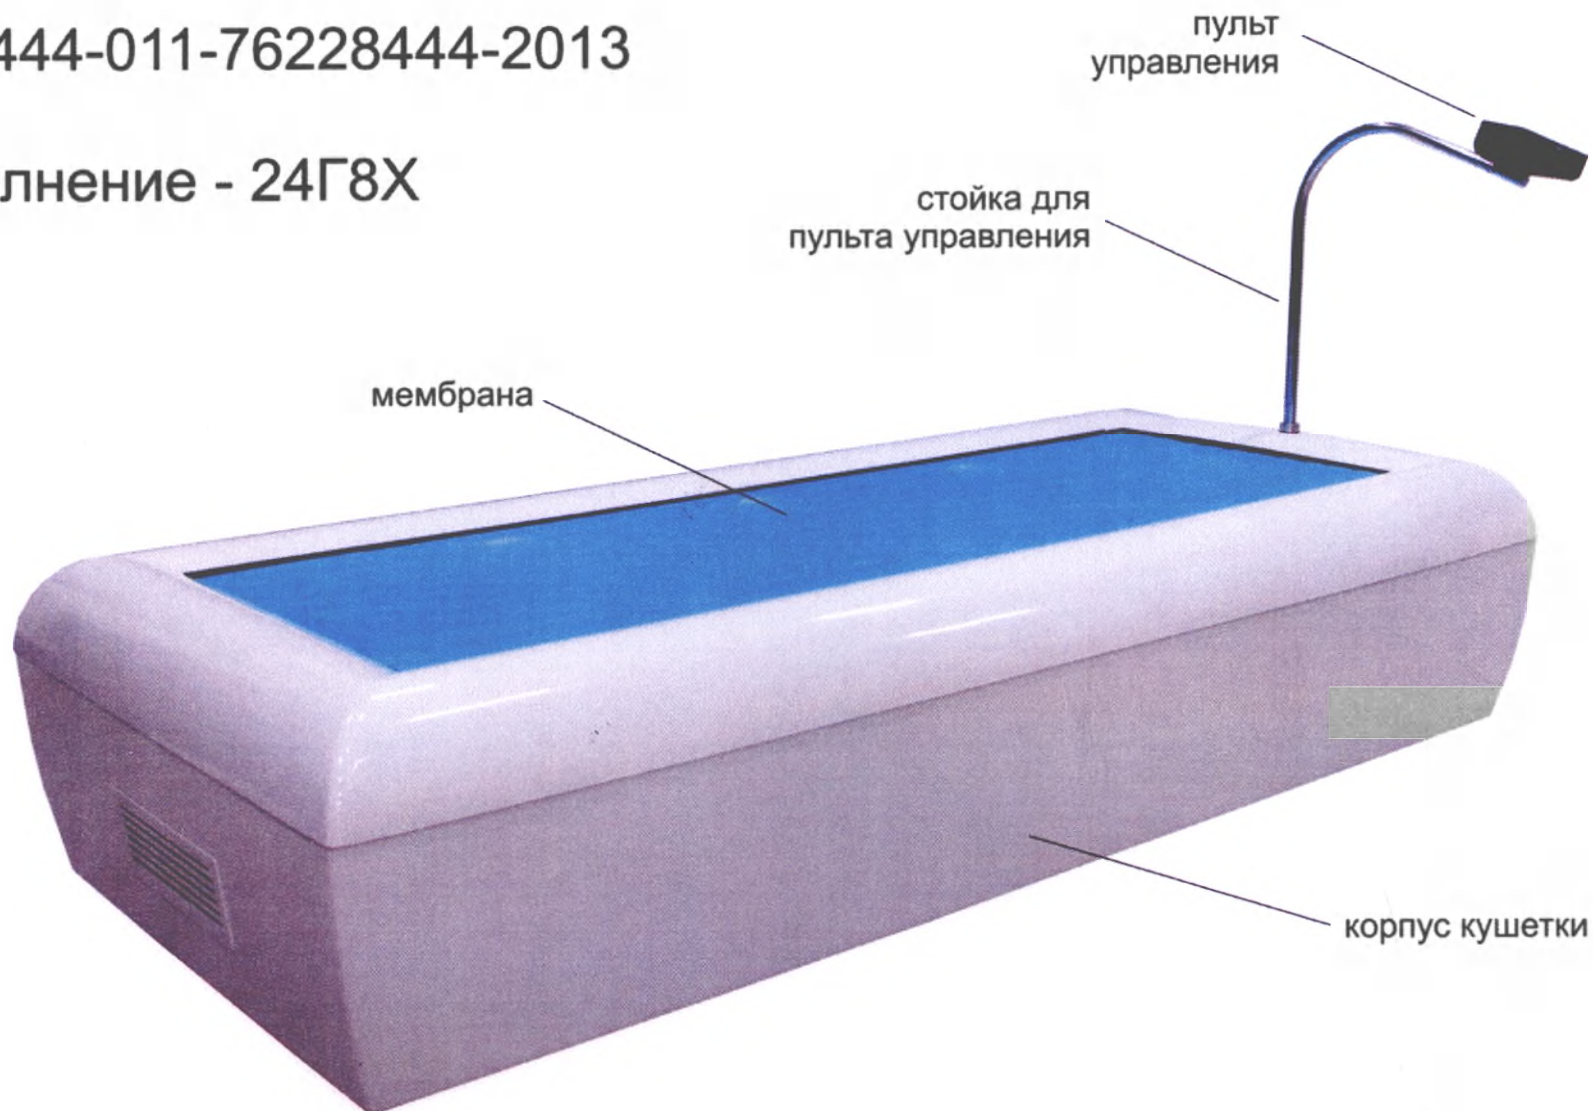

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО МАССАЖА «АКВАСПА»

ТУ 9444-011-76228444-2013


Исполнение - 28Г

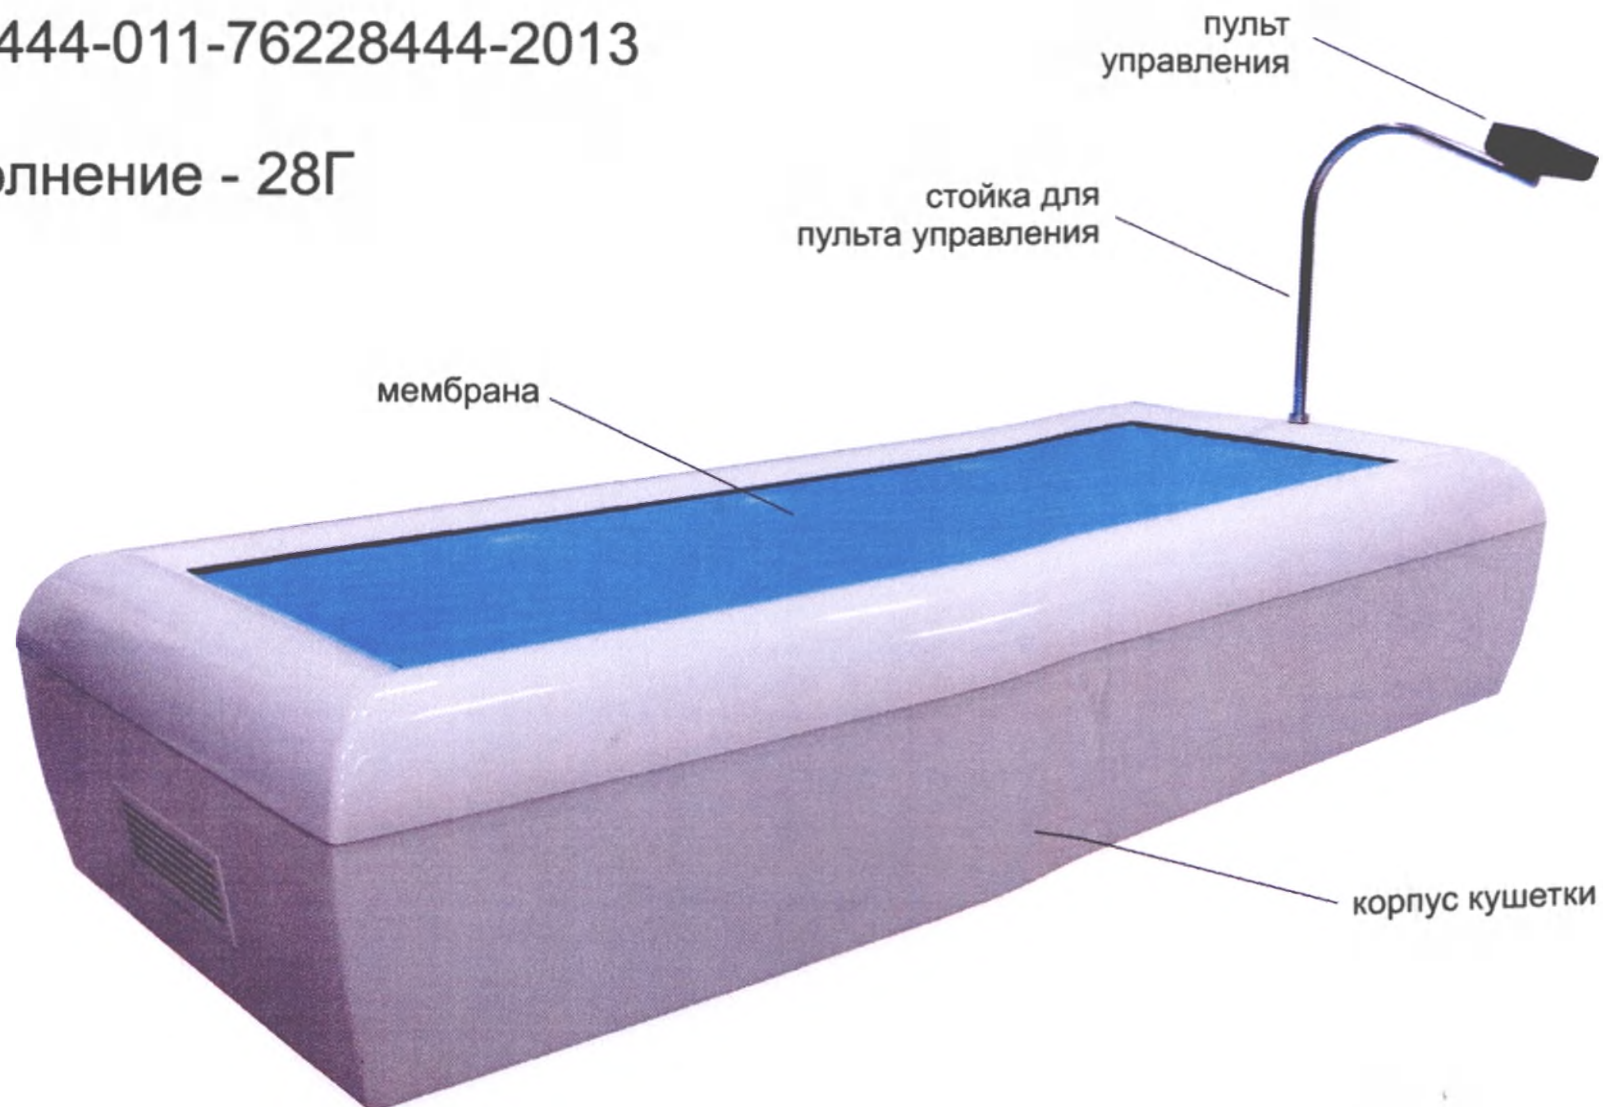

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО МАССАЖА «АКВАСПА»

ТУ 9444-011-76228444-2013


Исполнение - 28Г

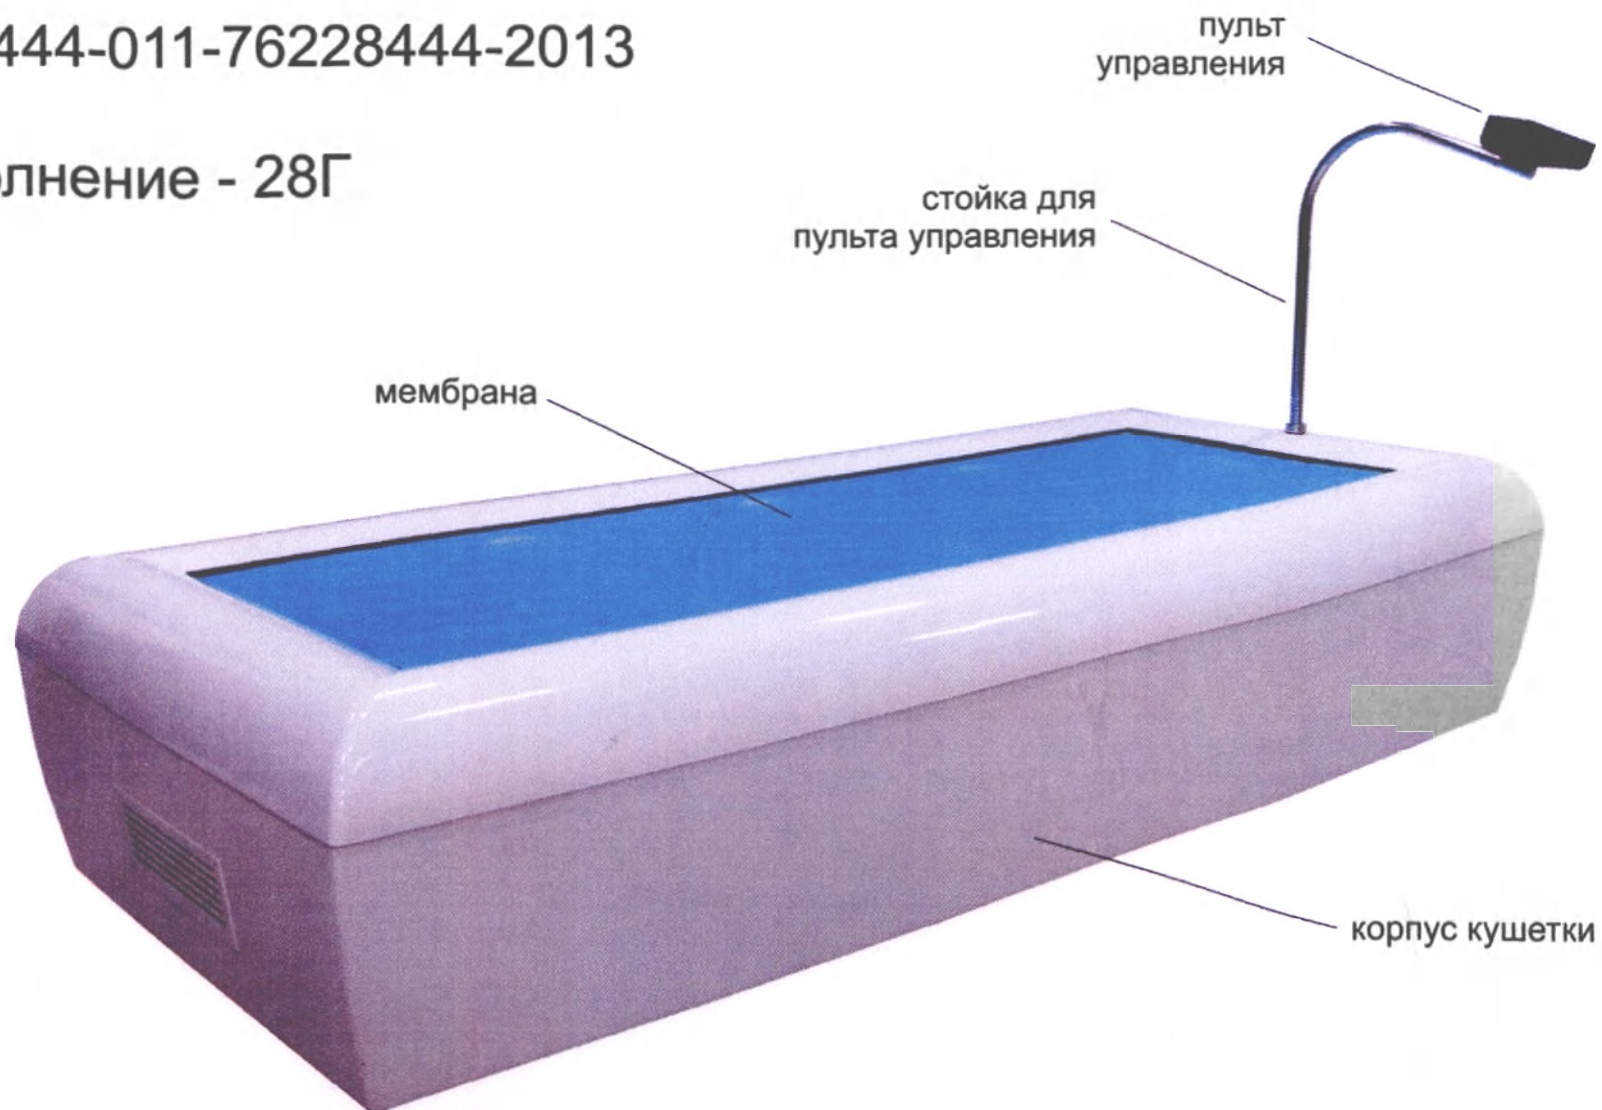

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО МАССАЖА «АКВАСПА»

ТУ 9444-011-76228444-2013


Исполнение - 24Г

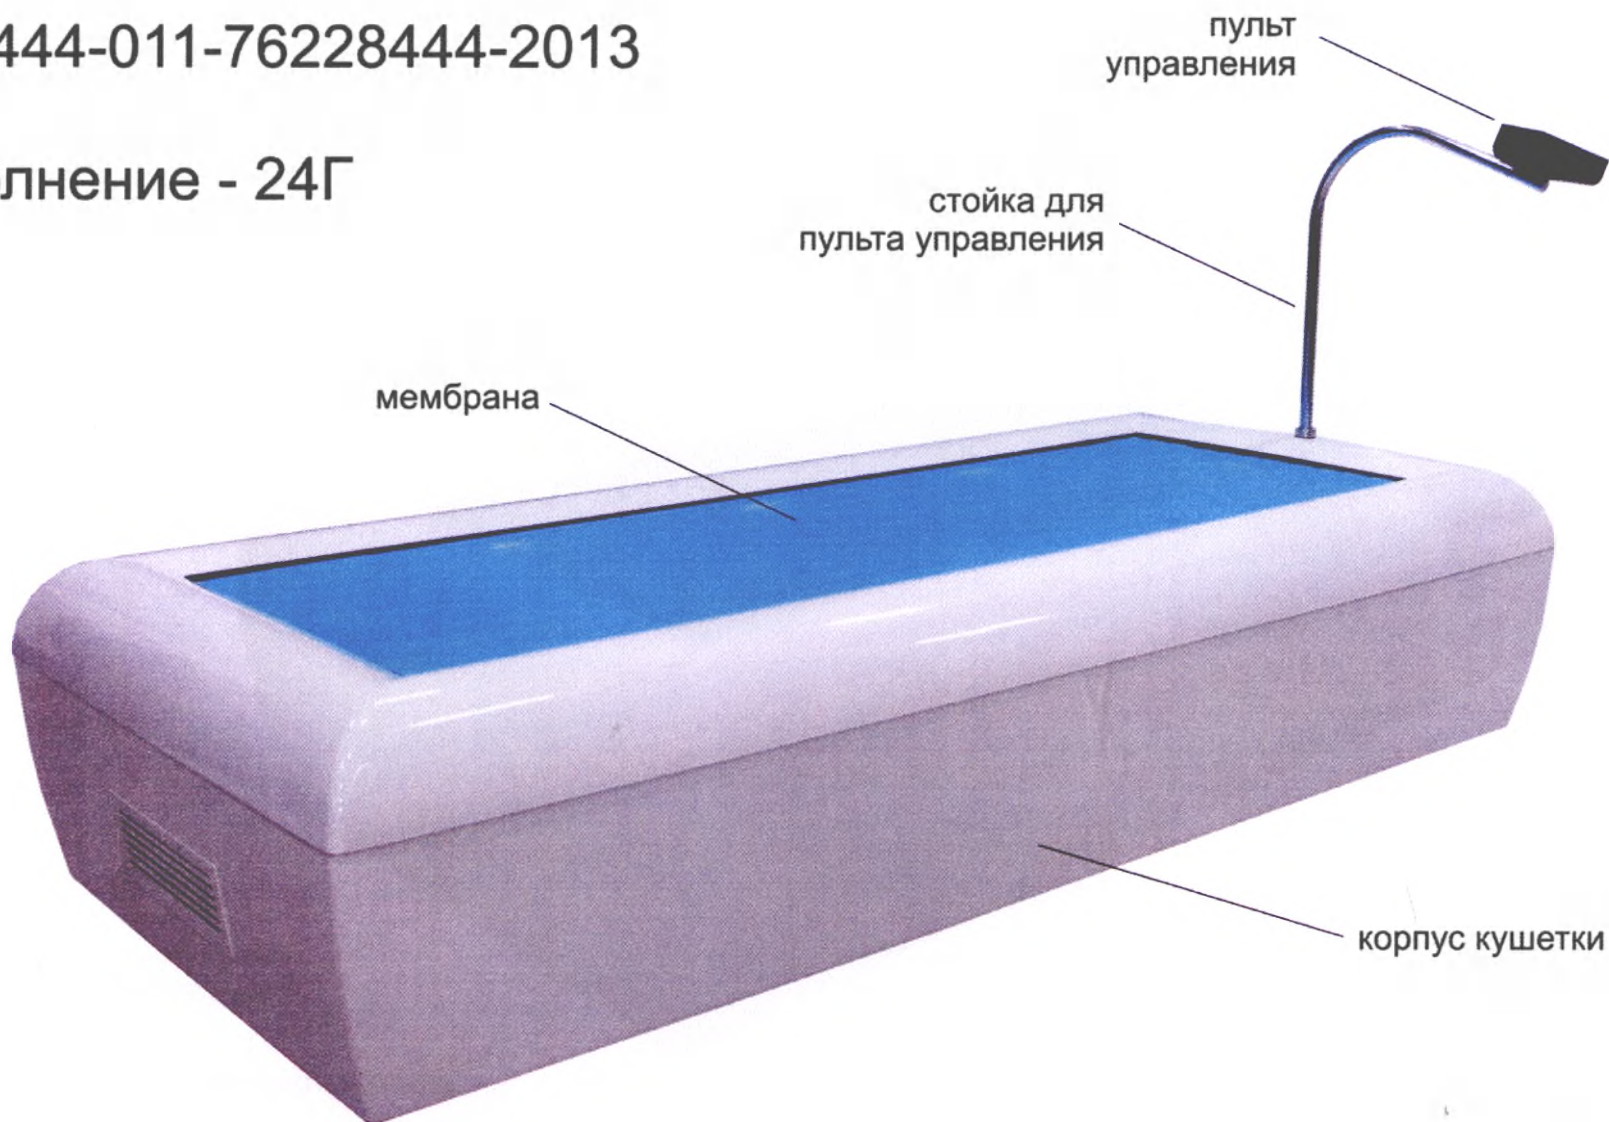

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО МАССАЖА «АКВАСПА»

ТУ 9444-011-76228444-2013


Исполнение - 12Г8Х

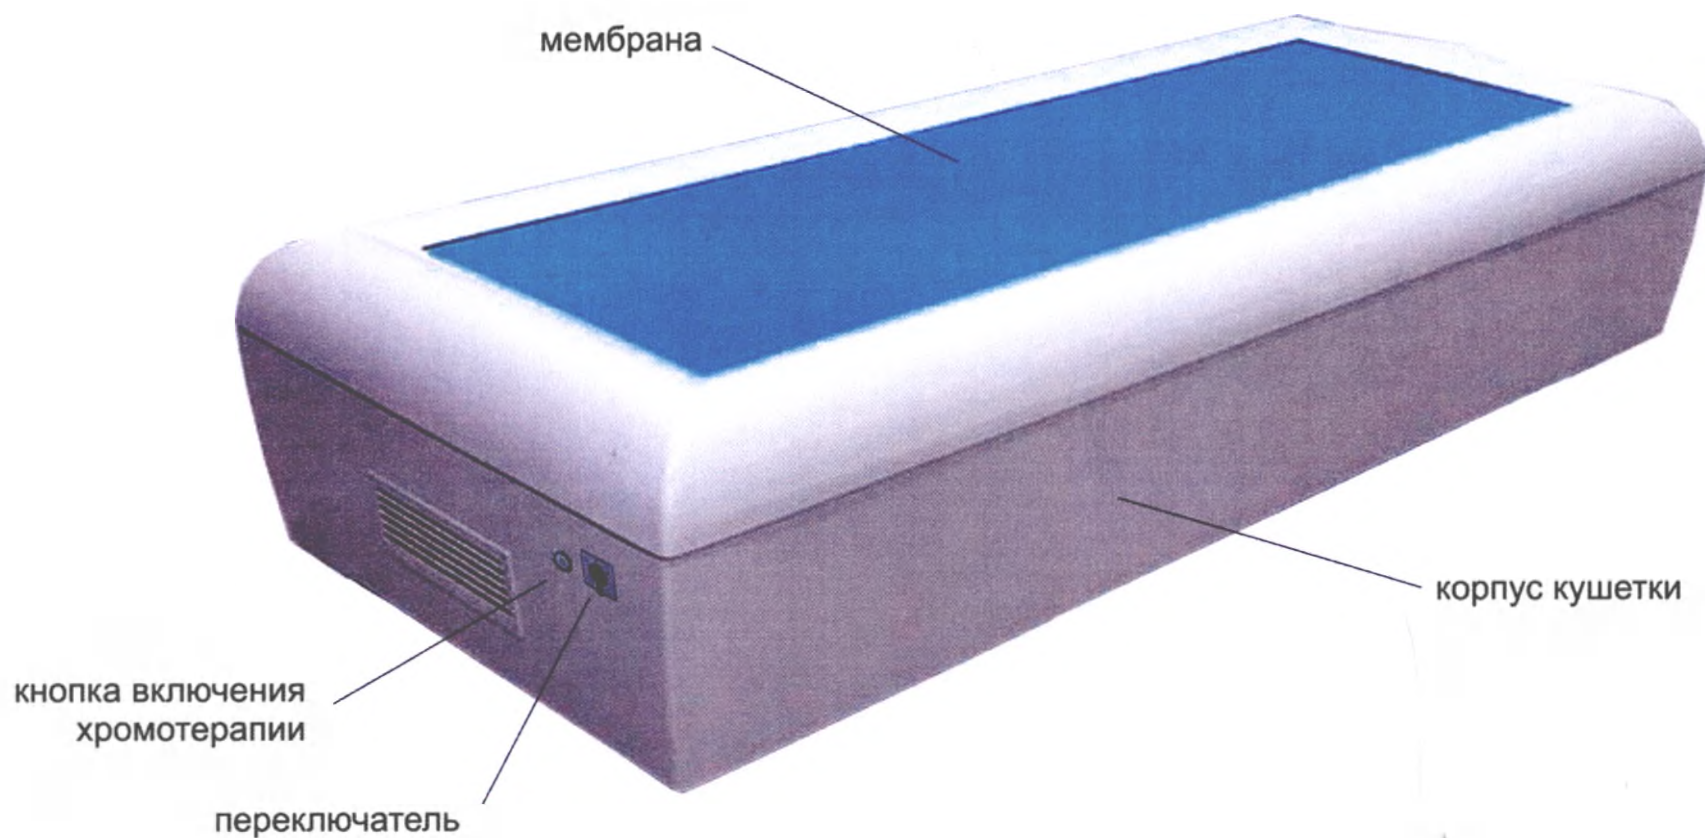

КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО МАССАЖА «АКВАСПА»

ТУ 9444-011-76228444-2013


Исполнение - 12Г

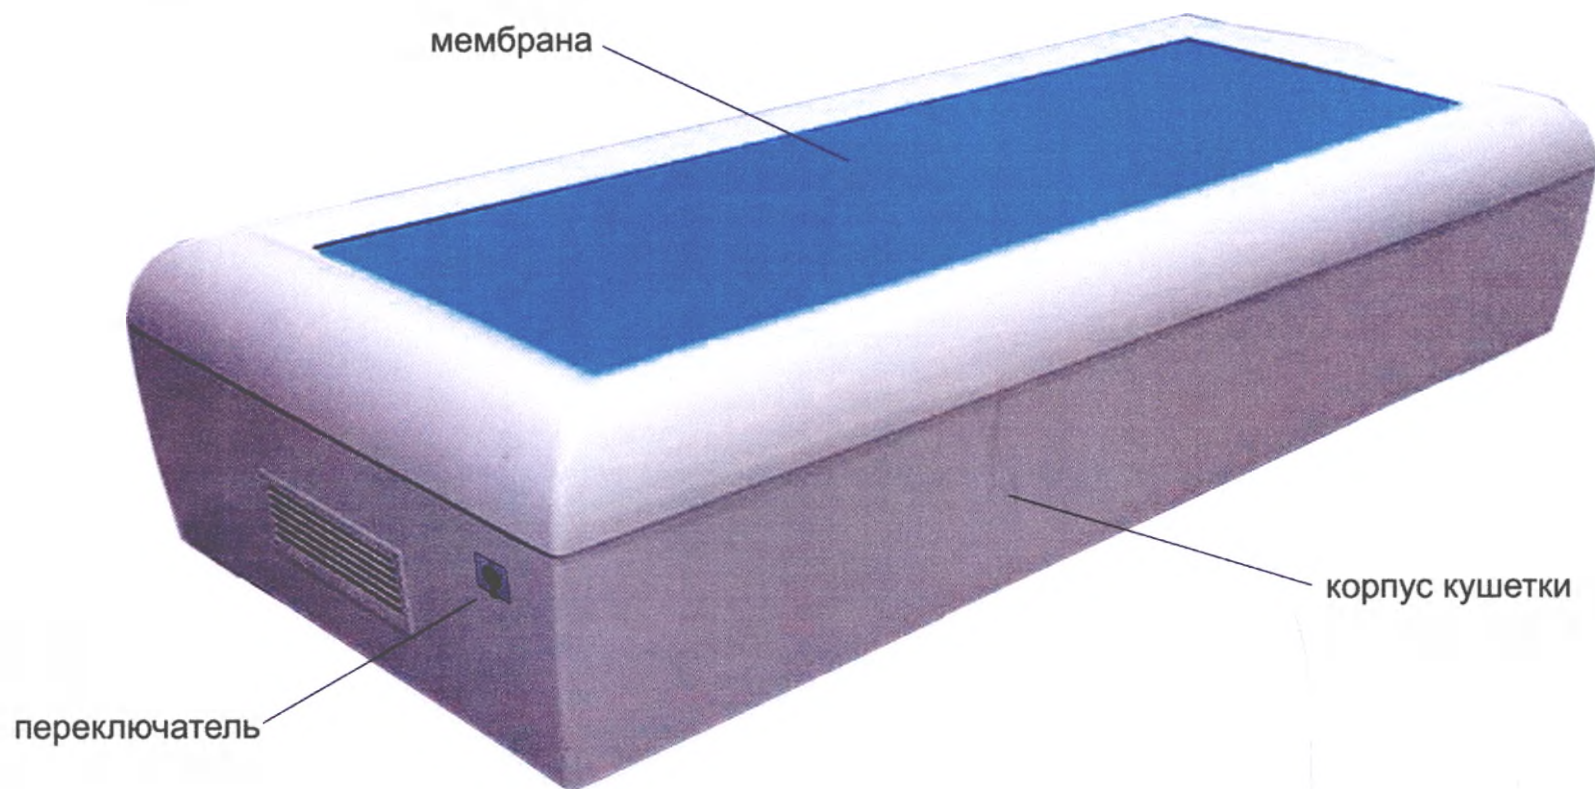


КУШЕТКА БЕСКОНТАКТНОГО МАССАЖА «АКВАСПА»


ТУ 9444-011-76228444-2013

Исполнение - 8Г6Х

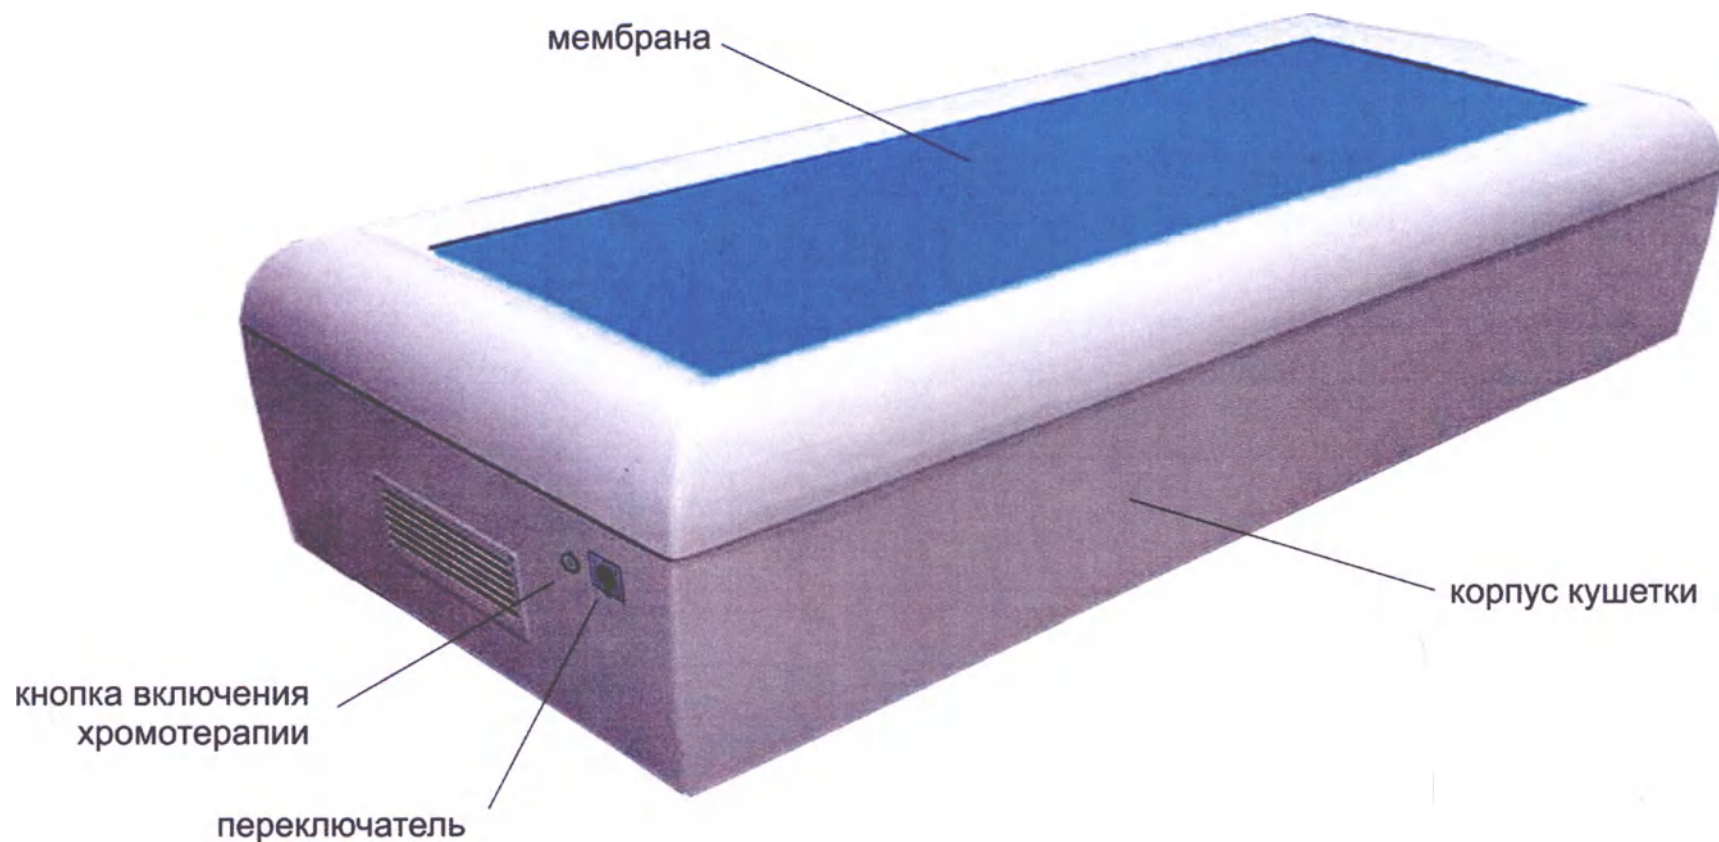

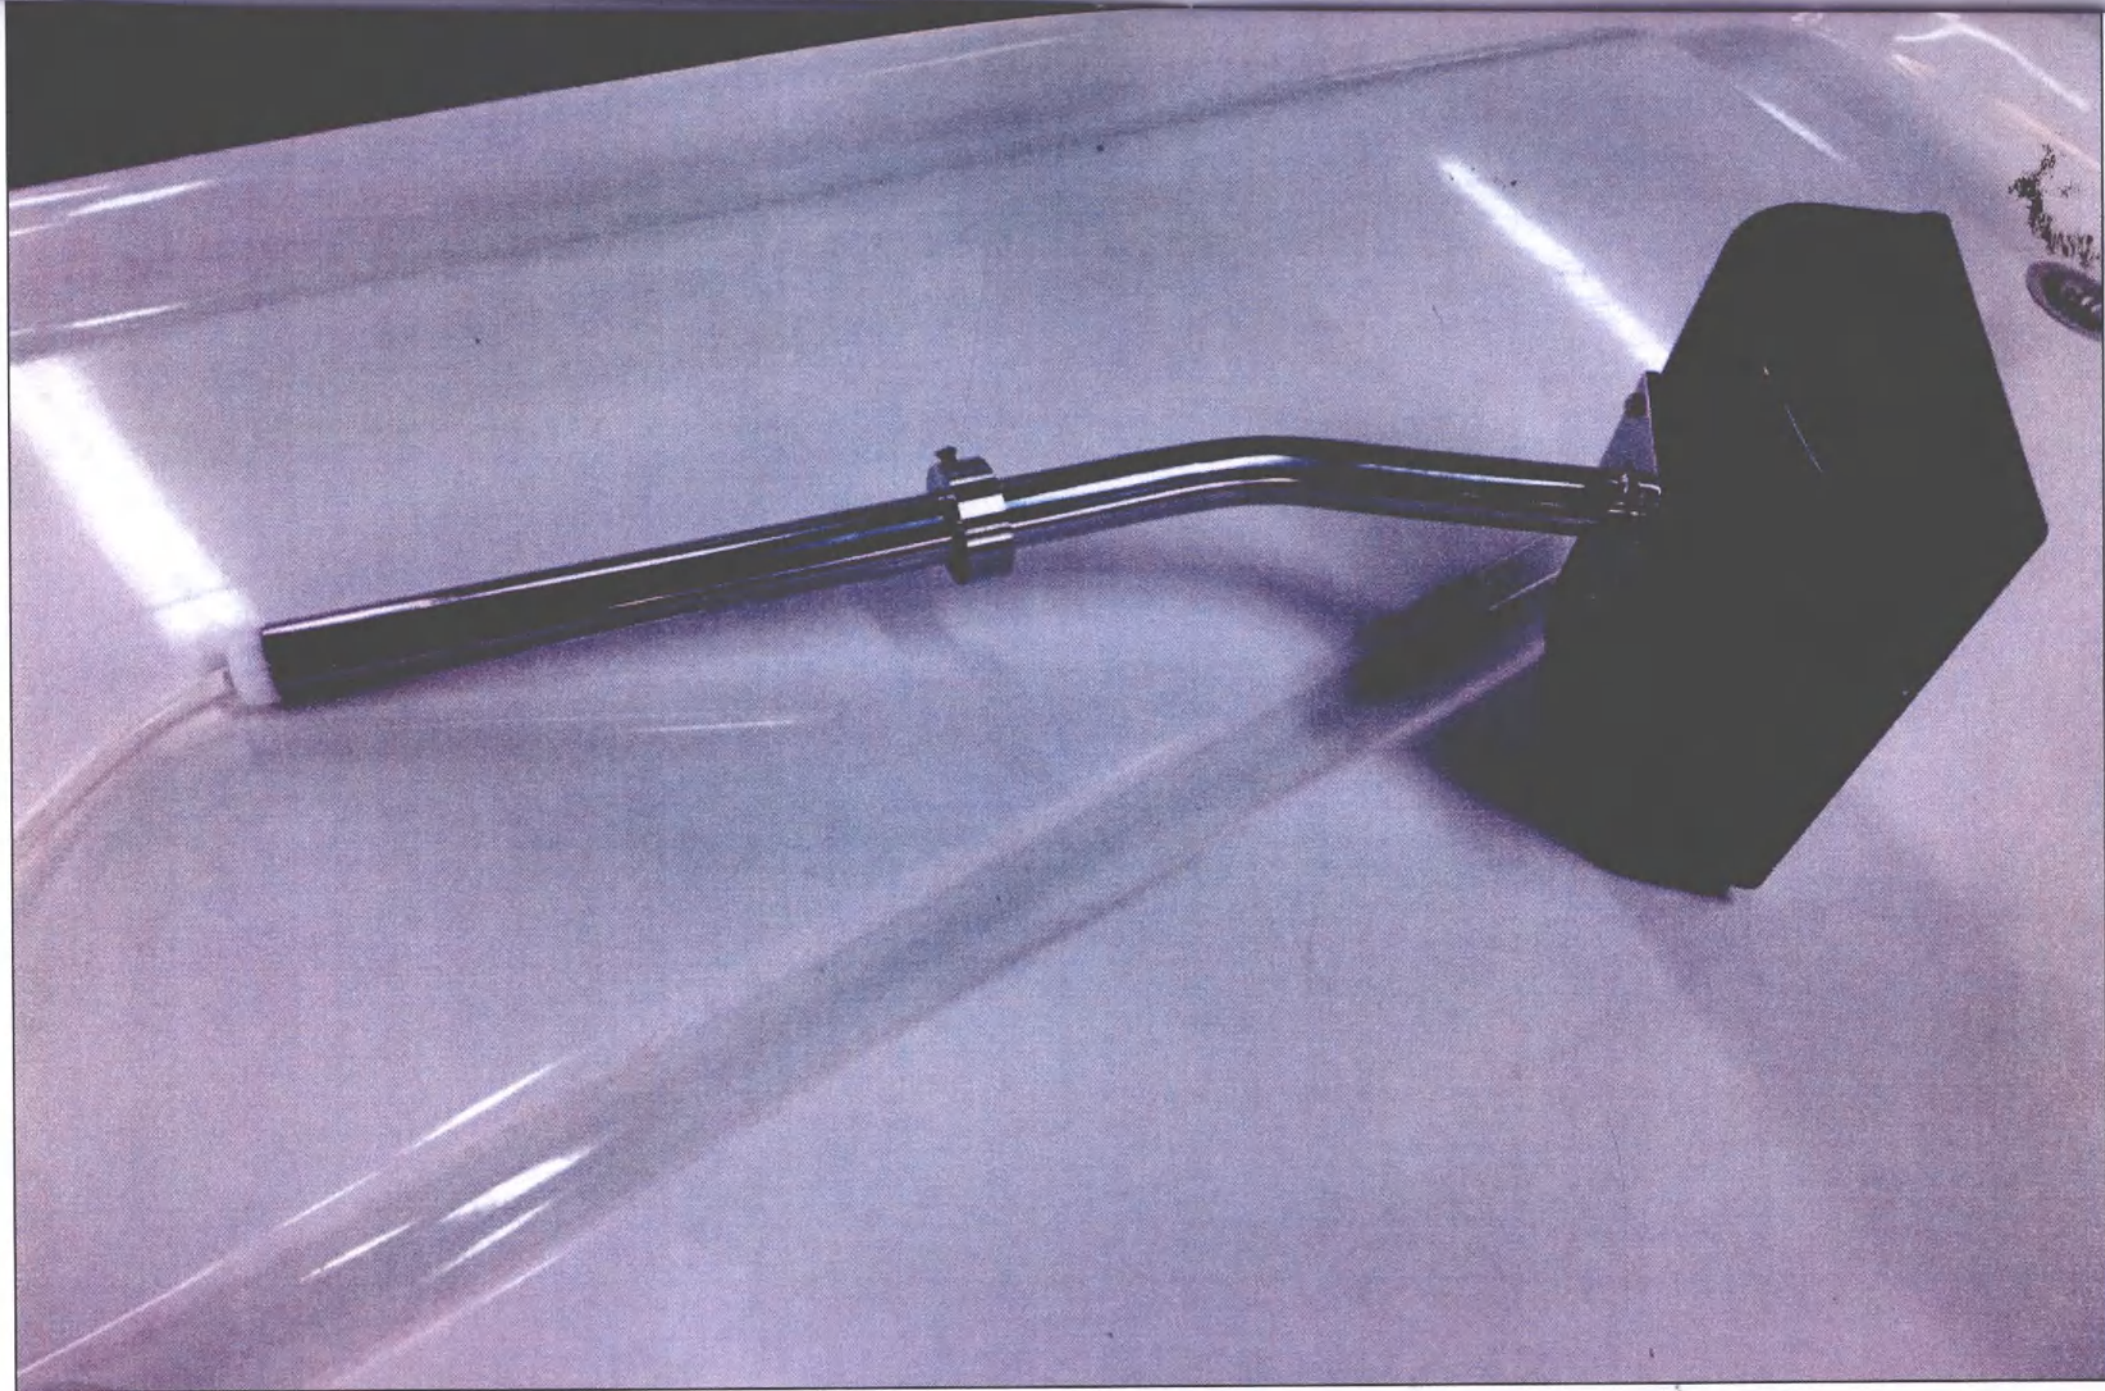

Пульт управления на короткой стойке

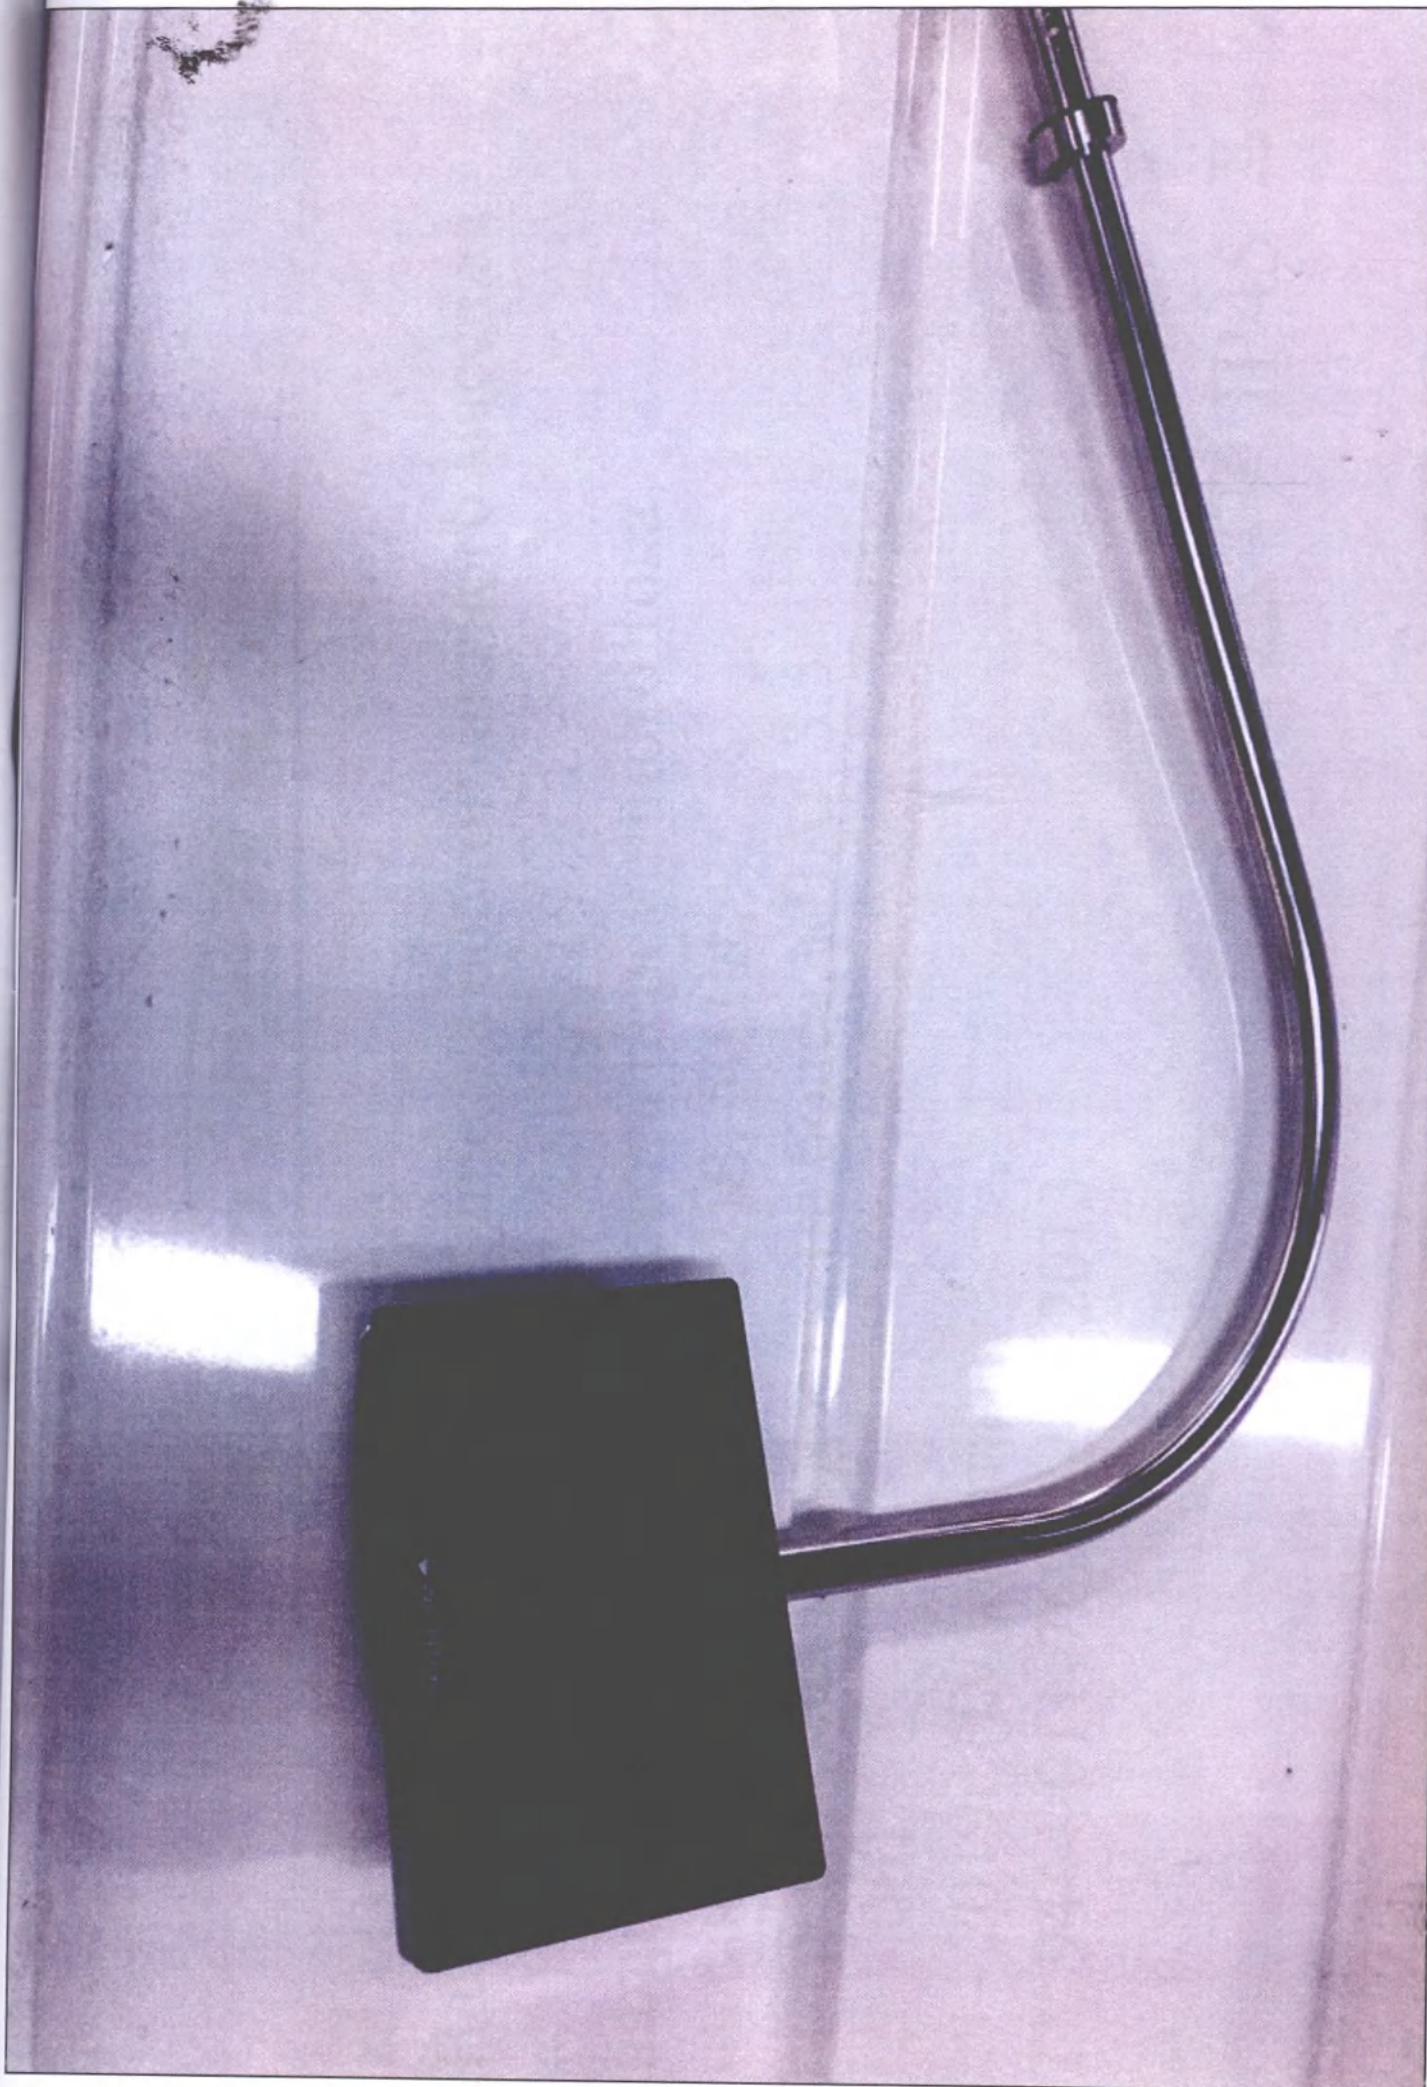

Пульт управления на длинной стойке

Рхуsиотесийниса

 - ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного массажа
«АКВАСПА», исполнение 28Г8Х

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - $\sim(220\pm 22)\text{В}$, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,5

 - 001

 - 2019Г (IV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013

   IP45 

Physiotecnica

 - ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного массажа
«АКВАСПА», исполнение 24Г8Х

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - $\sim(220\pm 22)\text{В}$, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,5

 - 001

 - 2019г (IV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013

   IP45 

Physiotecnica

 - ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного массажа
«АКВАСПА», исполнение 28Г

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - $\sim(220\pm 22)\text{В}$, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,05

 SN - 001

 - 2019г (IV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013

   IP45 

Physiotecnica

 - ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного массажа
«АКВАСПА», исполнение 24Г

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - $\sim(220\pm 22)\text{В}$, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,05

 - 001

 - 2019Г (IV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013



Ркусіотесніса

 - ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного массажа
«АКВАСПА», исполнение 12Г8Х

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - $\sim(220\pm 22)\text{В}$, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,5

 - 001

 - 2019г (IV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013



Рхуsиотесhниса

 - ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного массажа
«АКВАСПА», исполнение 12Г

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - $\sim(220\pm 22)\text{В}$, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,05

 - 001

 - 2019г (IV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013



Physiotecnica

 - ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного массажа
«АКВАСПА», исполнение 8Г6Х

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - $\sim(220\pm 22)\text{В}$, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 1,9

 - 001

 - 2019г (IV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013



Прошито и пронумеровано

Кол-во: 17 (сильдиста)

Подпись

Ген. дир Лапаев А.Е



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Физиотехника"



А.Е. Лапаев

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МАРКИРОВКИ, УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» по ТУ 9444-011-
76228444-2013»**

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Физиотехника»

Фотографические изображения закрепленной таблички в соответствии с п.1.3.2 ТУ.

Physiotecnica

 - ООО «Физiotехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного
массажа «АКВАСПА», исполнение 28Г8Х

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - (220 ± 22) В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,5

 SN - 001

 - 2019г (IV квартал)

TU 9444-011-76228444-2013

▲ ▲  IP 45 X

Physiotecnica



- ООО «Физиотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного
массажа «АКВАСПА», исполнение 24Г8Х

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - (220 ± 22) В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВА: 3,5



- 001



- 2019г (IV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013

↑ Δ □ IP 45 X

Ресурсы

M - 000 «Физiotехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного
массажа «АКВАСЛА», исполнение 28Г
напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - (220±22)В, 50 Гц;

SN - 001
потребляемая мощность, не более, кВт: 3,05

TV - 2019г (IV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013

★ Δ IP 45 X

Physiotherapy

№ - 000 «Физиотерапия»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА», исполнение 24Г

Напряжение питания и частота переменного тока питающей сети - (220±22)В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВт: 3,05

№ - 001

№ - 2019г (IV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013

А Δ ђ ђ IP 45 X

Мушкетер

М - ООО «Физiotехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА», исполнение 12Т8Х
напряжение питания и частота переменного тока питающей сети - $(220 \pm 22) В$, 50 Гц;
потребляемая мощность, не более, кВА: 3,5

SN - 001

 - 2019г (TV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013

★   IP 45 

Ручиотактика

М - 0000 «Физיותרεπικεα»

Наименование изделия: Купшета бесшотатного
массага «АКВАСТАА», исполнение 12Г

напряжение питания и частота переменного тока
питающей сети - (220±22)В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВт: 3,05

SN - 001

Г - 2019г (IV квартал)

TV 9444-011-76228444-2013

▲ Δ **IP 45** ☒

Ручейская

ООО «Физмотехника»

Наименование изделия: Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА», исполнение 8Г6Х

напряжение питания и частота переменного тока питающей сети - (220±22)В, 50 Гц;

потребляемая мощность, не более, кВт: 1,9

SN - 001

TV - 2019г (IV квартал)

ТУ 9444-011-76228444-2013

▲ **IP 45**

Фотографические изображения надписи на боковой (торцевой) части кушетки в соответствии с п. 1.3.3 ТУ

КУШЕТКА АКВАСТА, ИСПОЛНЕНИЕ 281Г8Х

КУШЕТКА АКВАСПА, исполнение 24Г8Х

КУЩЕНКА АКВАСТИА, исполнение 281Г

КУШЕТКА АКВАСПА, ИСПОЛНЕНИЕ 241

Куплетка АКВАСПА, исполнение 12Г8Х

КУШЕТКА АКВАСТА, ИСПОЛНЕНИЕ 12Г

Купетка АКВАСПА, исполнение 8Г6Х

**Фотографические изображения упаковки медицинского изделия, в соответствии с
п.1.4 ТУ**





Условия хранения 2

Прошито и пронумеровано
Кол-во: 20 (двадцать) листа
Подпись
Ген. дир. Лапаев А.Е

