

«СОГЛАСОВАНО»
ООО «ТК Азия»

Р.В. Мешеряков.
2020 г.


«18»



Фотографические изображения изделия:

Набор Leccuratetm для ИВД экспресс-анализа антител к SARS-CoV2 IgG / IgM методом иммунохроматографии.
Партия № 20CG2520X

«Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.»
(«Бейджин Лепу Медикал Технолоджи Ко., Лтд.»)

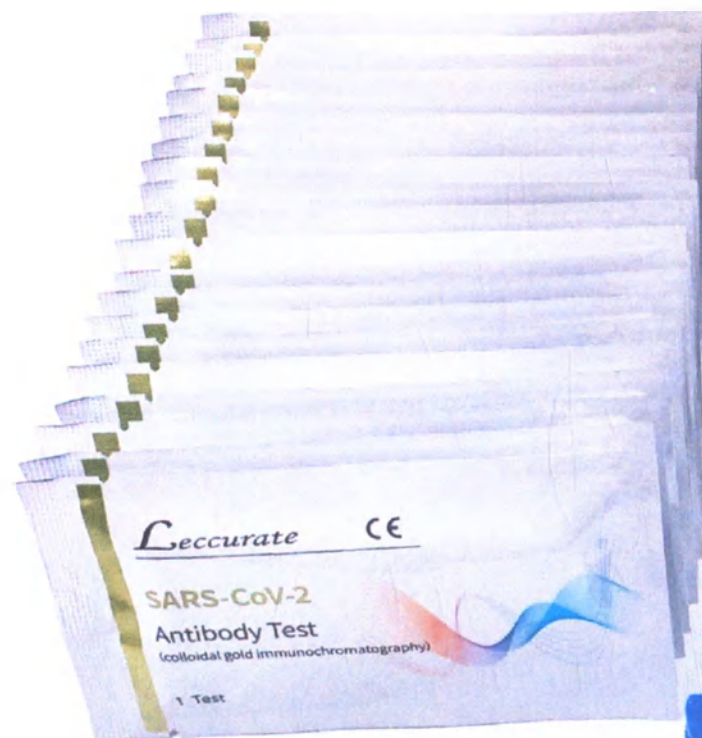

иммунохроматографический метод. Вести также документацию о том, как на тесте производится оценка фоточувствительного слоя.

На основании этих сведений в течение нескольких минут (10-15 мин) можно получить результат теста. В течение нескольких минут (10-15 мин) можно получить результат теста. В течение нескольких минут (10-15 мин) можно получить результат теста.

1. ЦЕЛЕСОБНОСТЬ И МЕТОДЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Целесообразность и методы выполнения теста основаны на принципе иммунохроматографии. В тесте используется (коллоидный) золотой наночастицы, которые связываются с антителами SARS-CoV-2. В результате взаимодействия образуются комплексы, которые видны невооруженным глазом.

В течение нескольких минут (10-15 мин) можно получить результат теста. В течение нескольких минут (10-15 мин) можно получить результат теста.

1. ЦЕЛЕСОБНОСТЬ И МЕТОДЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Целесообразность и методы выполнения теста основаны на принципе иммунохроматографии. В тесте используется (коллоидный) золотой наночастицы, которые связываются с антителами SARS-CoV-2. В результате взаимодействия образуются комплексы, которые видны невооруженным глазом.

В течение нескольких минут (10-15 мин) можно получить результат теста. В течение нескольких минут (10-15 мин) можно получить результат теста.

Набор Leccurate™ для ИВД экспресс-анализа антител к SARS-CoV2 IgG / IgM методом иммунохроматографии

Продукция: Leccurate™ для ИВД экспресс-анализа антител к SARS-CoV2 IgG / IgM методом иммунохроматографии

Упаковочный материал: 1000 шт. в упаковке

Хранить при температуре от -4°C до +30°C

Дата изготовления указана на упаковке. Срок годности 12 мес.

Сделано в Китае

**Набор Leccurate™ для ИВД экспресс-анализа антител
к SARS-CoV2 IgG / IgM методом иммунохроматографии**

Р/У № _____ от _____

Производитель: «Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.»,
№ 37 CHAOQIAN ROAD, CHANGPING DISTRICT, BEIJING, CHINA


Уполномоченный представитель: ООО «ТК Алия»
129626, Россия, г. Москва, ул. Старомалеевская, д. 5, пом. 364 Б


Номер партии указан на упаковке

Хранить при температуре от +4 С до +30 С

Дата изготовления указана на упаковке. Срок годности 12 мес

Сделано в Китае

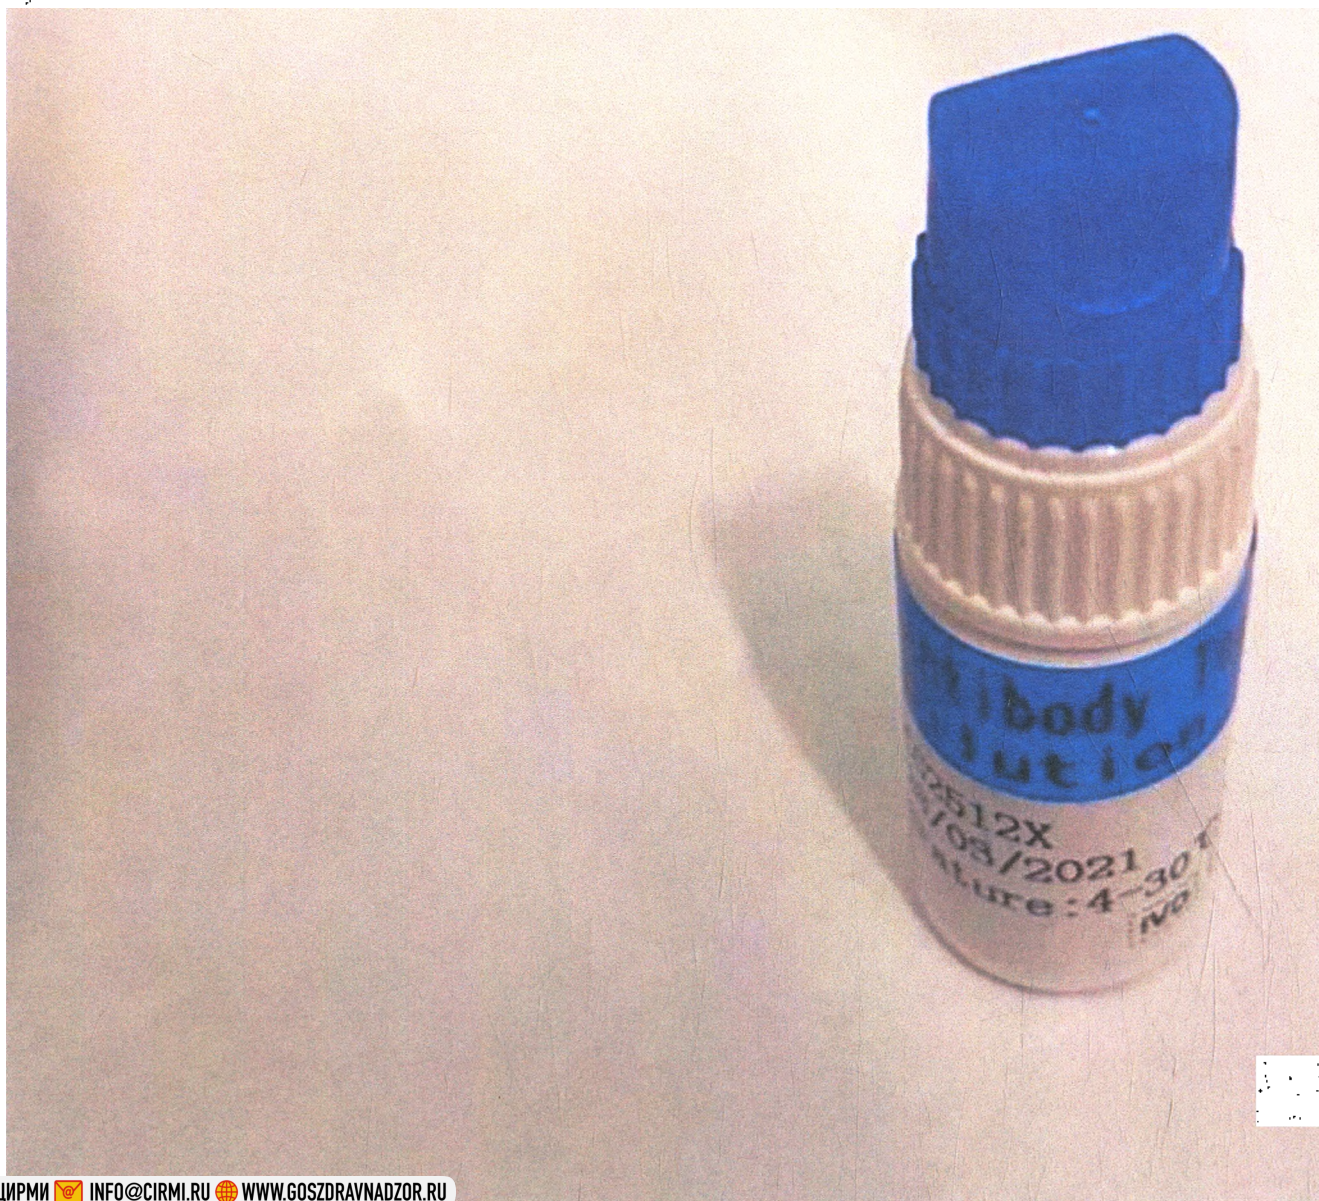

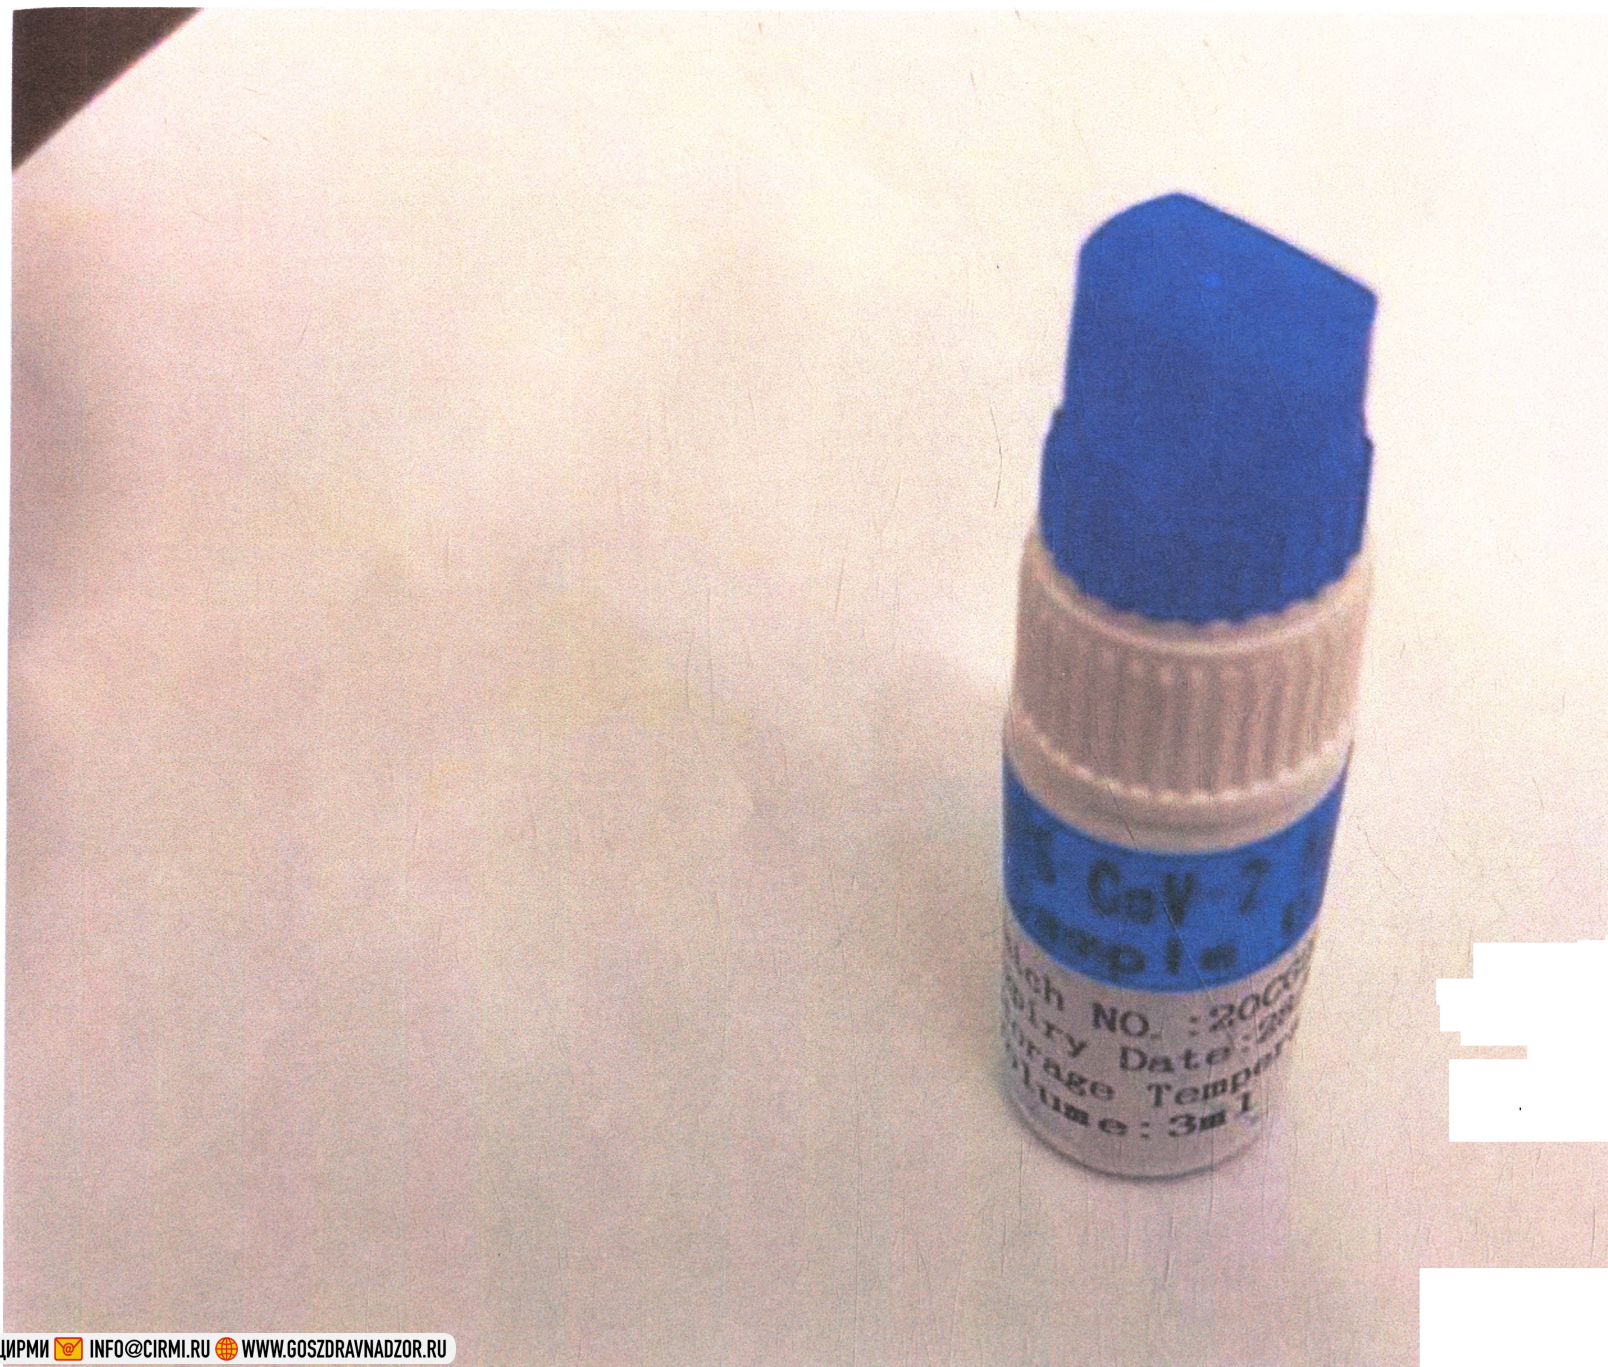







Product Name:

SARS-CoV-2 Antibody Test (colloidal gold immunochromatography)

BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
Building 7-1 No.37 Chaoqian Road, Changping District,
Beijing, 102200, P.R.China
Tel: +86-10-80123100
Email: international@lepumedical.com
www.en.lepumedical.com

Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A.
EC REP Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen,
The Netherlands
Tel: +31-515-573399
Fax: +31-515-760020



Фотографическое изображение 7. Набор Lesscurate™ для ИВД экспресс-анализа антител к SARS-CoV2 IgG / IgM методом иммунохроматографии
Партия №20CG2520X Упаковка тест карты с маркировкой

