

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Белла»



М.К. Ковальчик

«15» июня 2020 г.

ЭТИКЕТКА (проект)

**Набор гинекологический процедурный, стерильный под товарным знаком matopat
по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019**

- товарный знак производителя



- наименование Изделия: _____;
- вариант исполнения Изделия;
- ТУ 32.50.13-067-11736425-2019;
- состав Набора (с указанием количества штук составляющих и размера);
- графический символ «стерилизация оксидом этилена»;
- указание о том, что медицинское изделие не подлежит повторной стерилизации;
- номер и дата регистрационного удостоверения: № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг.;
- номер партии (LOT): _____;
- дата изготовления (ггггммдд);
- годен до (ггггмм);
- дата стерилизации (мм/гггг);
- не использовать после окончания срока годности;
- назначение Изделия;
- медицинское изделие предназначено для однократного применения;
- хранить в сухих помещениях, при температуре от +5°C до +25°C;
- информация о сертификации или декларировании (при наличии) в виде знака соответствия;
- штриховой код (при наличии);
- артикул Изделия (при наличии);

- способ применения: плавным движением вскрыть упаковку, извлечь содержимое упаковки, использовать содержимое по прямому назначению в том порядке, в котором это необходимо. После использования по назначению - утилизировать;
- противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия;
- не использовать при поврежденной упаковке;
- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию. Утилизировать использованное Изделие как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10»;
- графический символ «апирогенно»;
- Изделие нетоксично внутри;
- «Производитель: ООО «Белла», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9», с применением символа «Изготовитель»;
- «Продавец: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9».



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью


_____) листа(ов)
Генеральный директор ООО «Белла»
_____ М.К. Ковальчик

Фотоизображения медицинского изделия

**Набор гинекологический
процедурный, стерильный
под товарным знаком matorat
по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019**

2. Общий вид составляющих Набора гинекологического процедурного, стерильного под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019, производства ООО «Белла», Россия.

2.1. Пеленка.

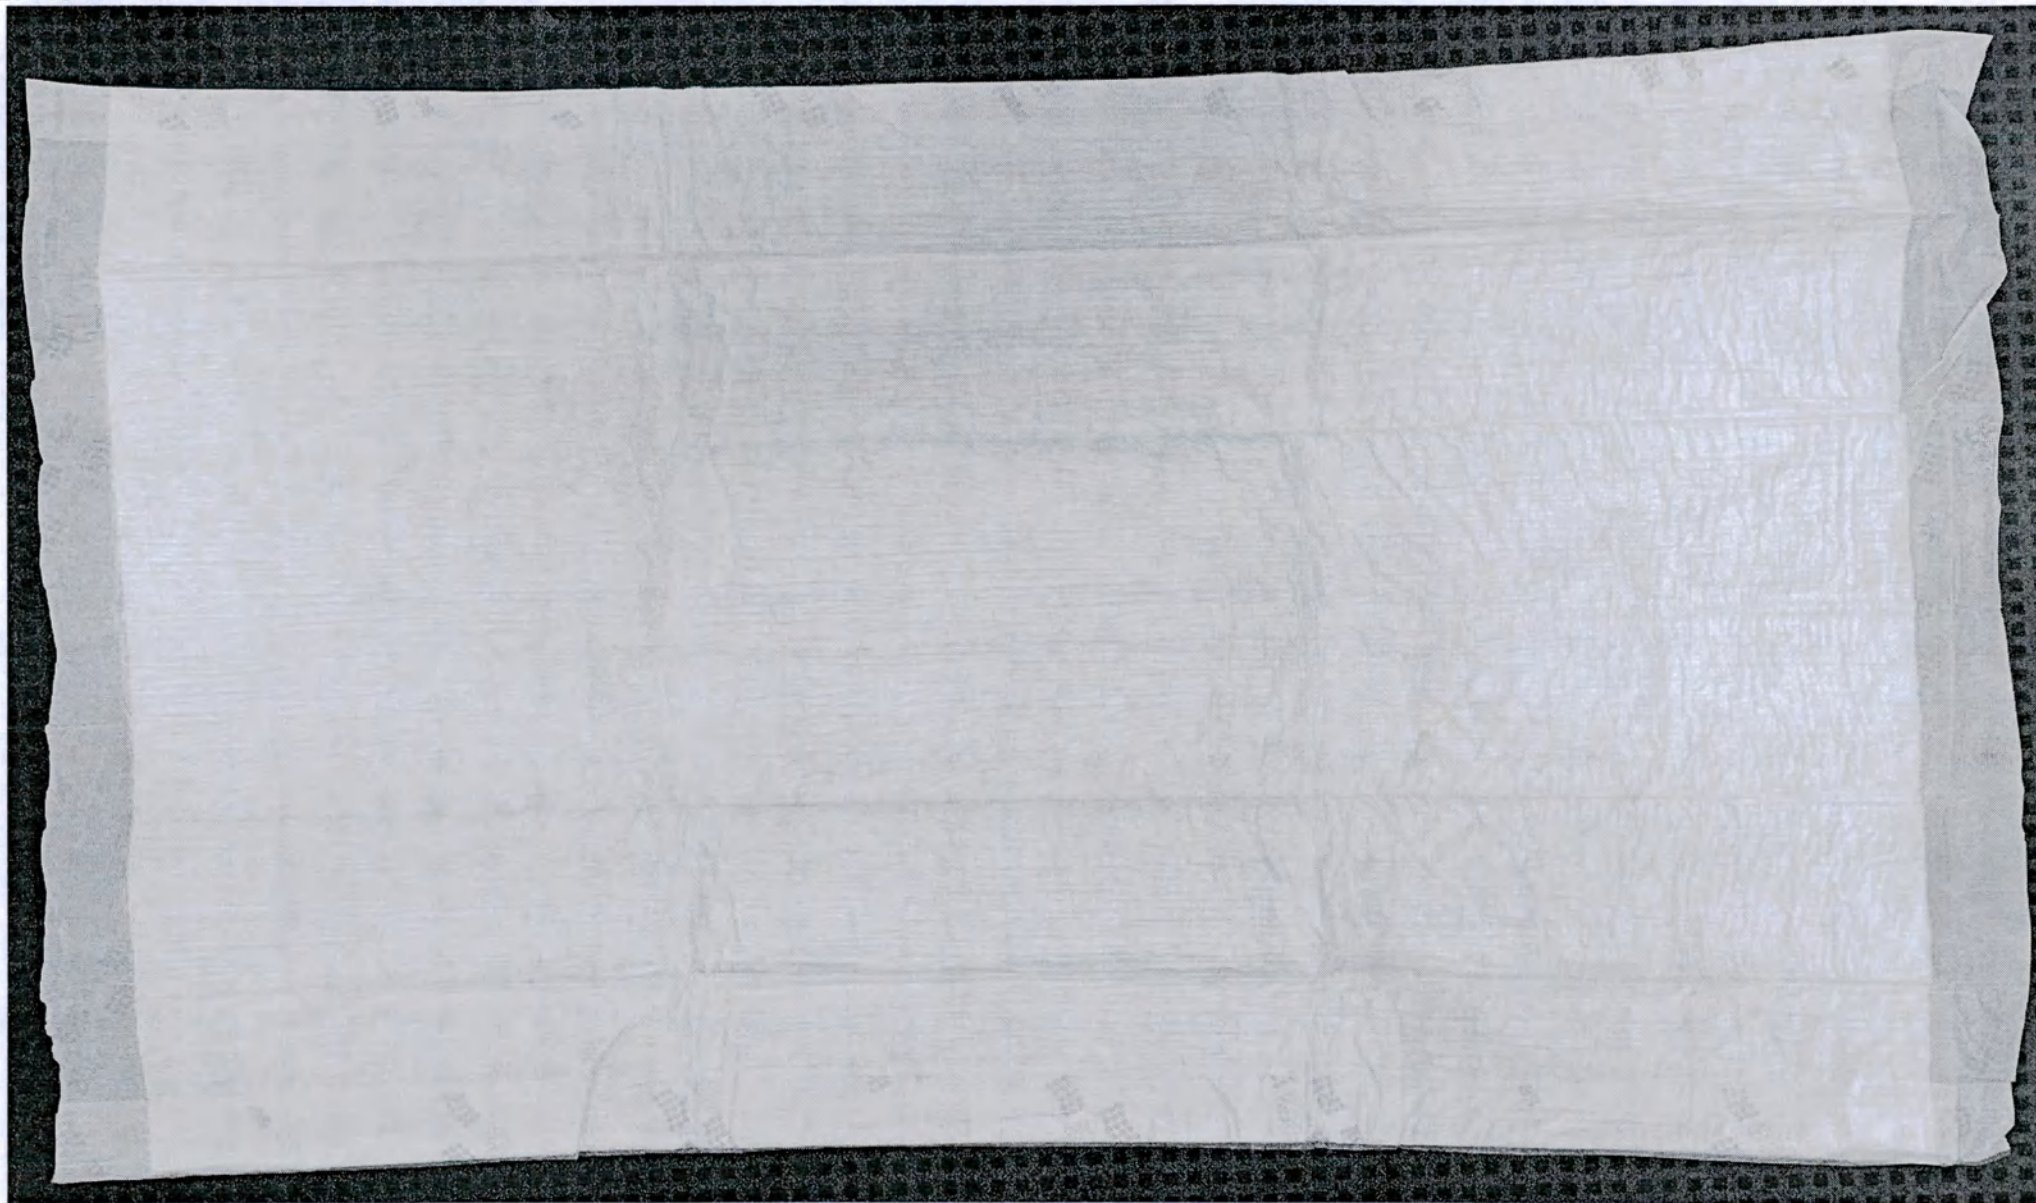


2.2. Маска.




2.3. Бахилы на резинке.




2.4. Бахилы нетканые высокие.

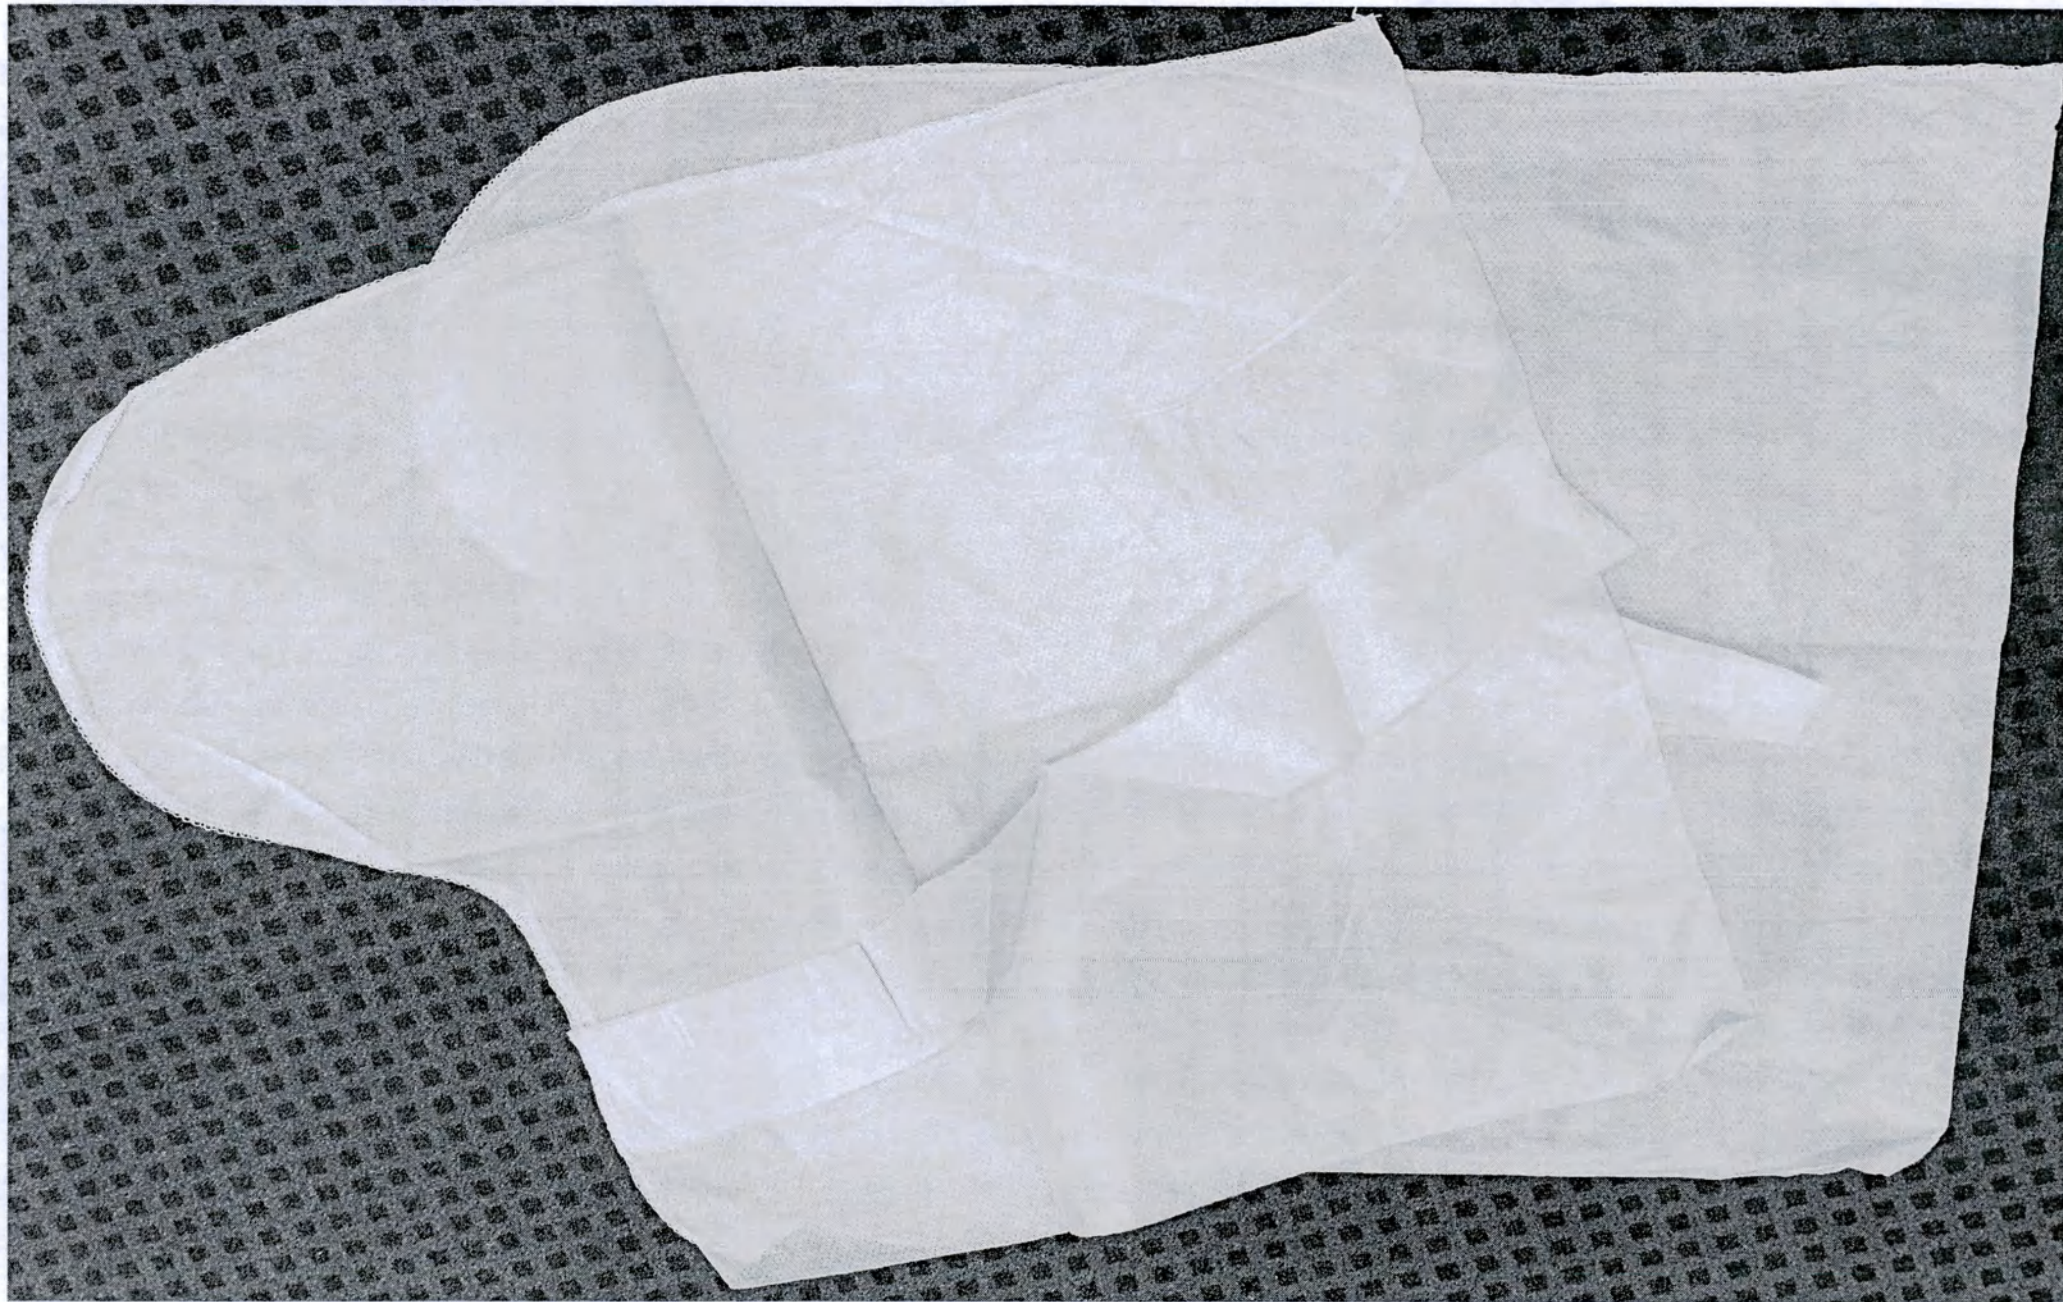


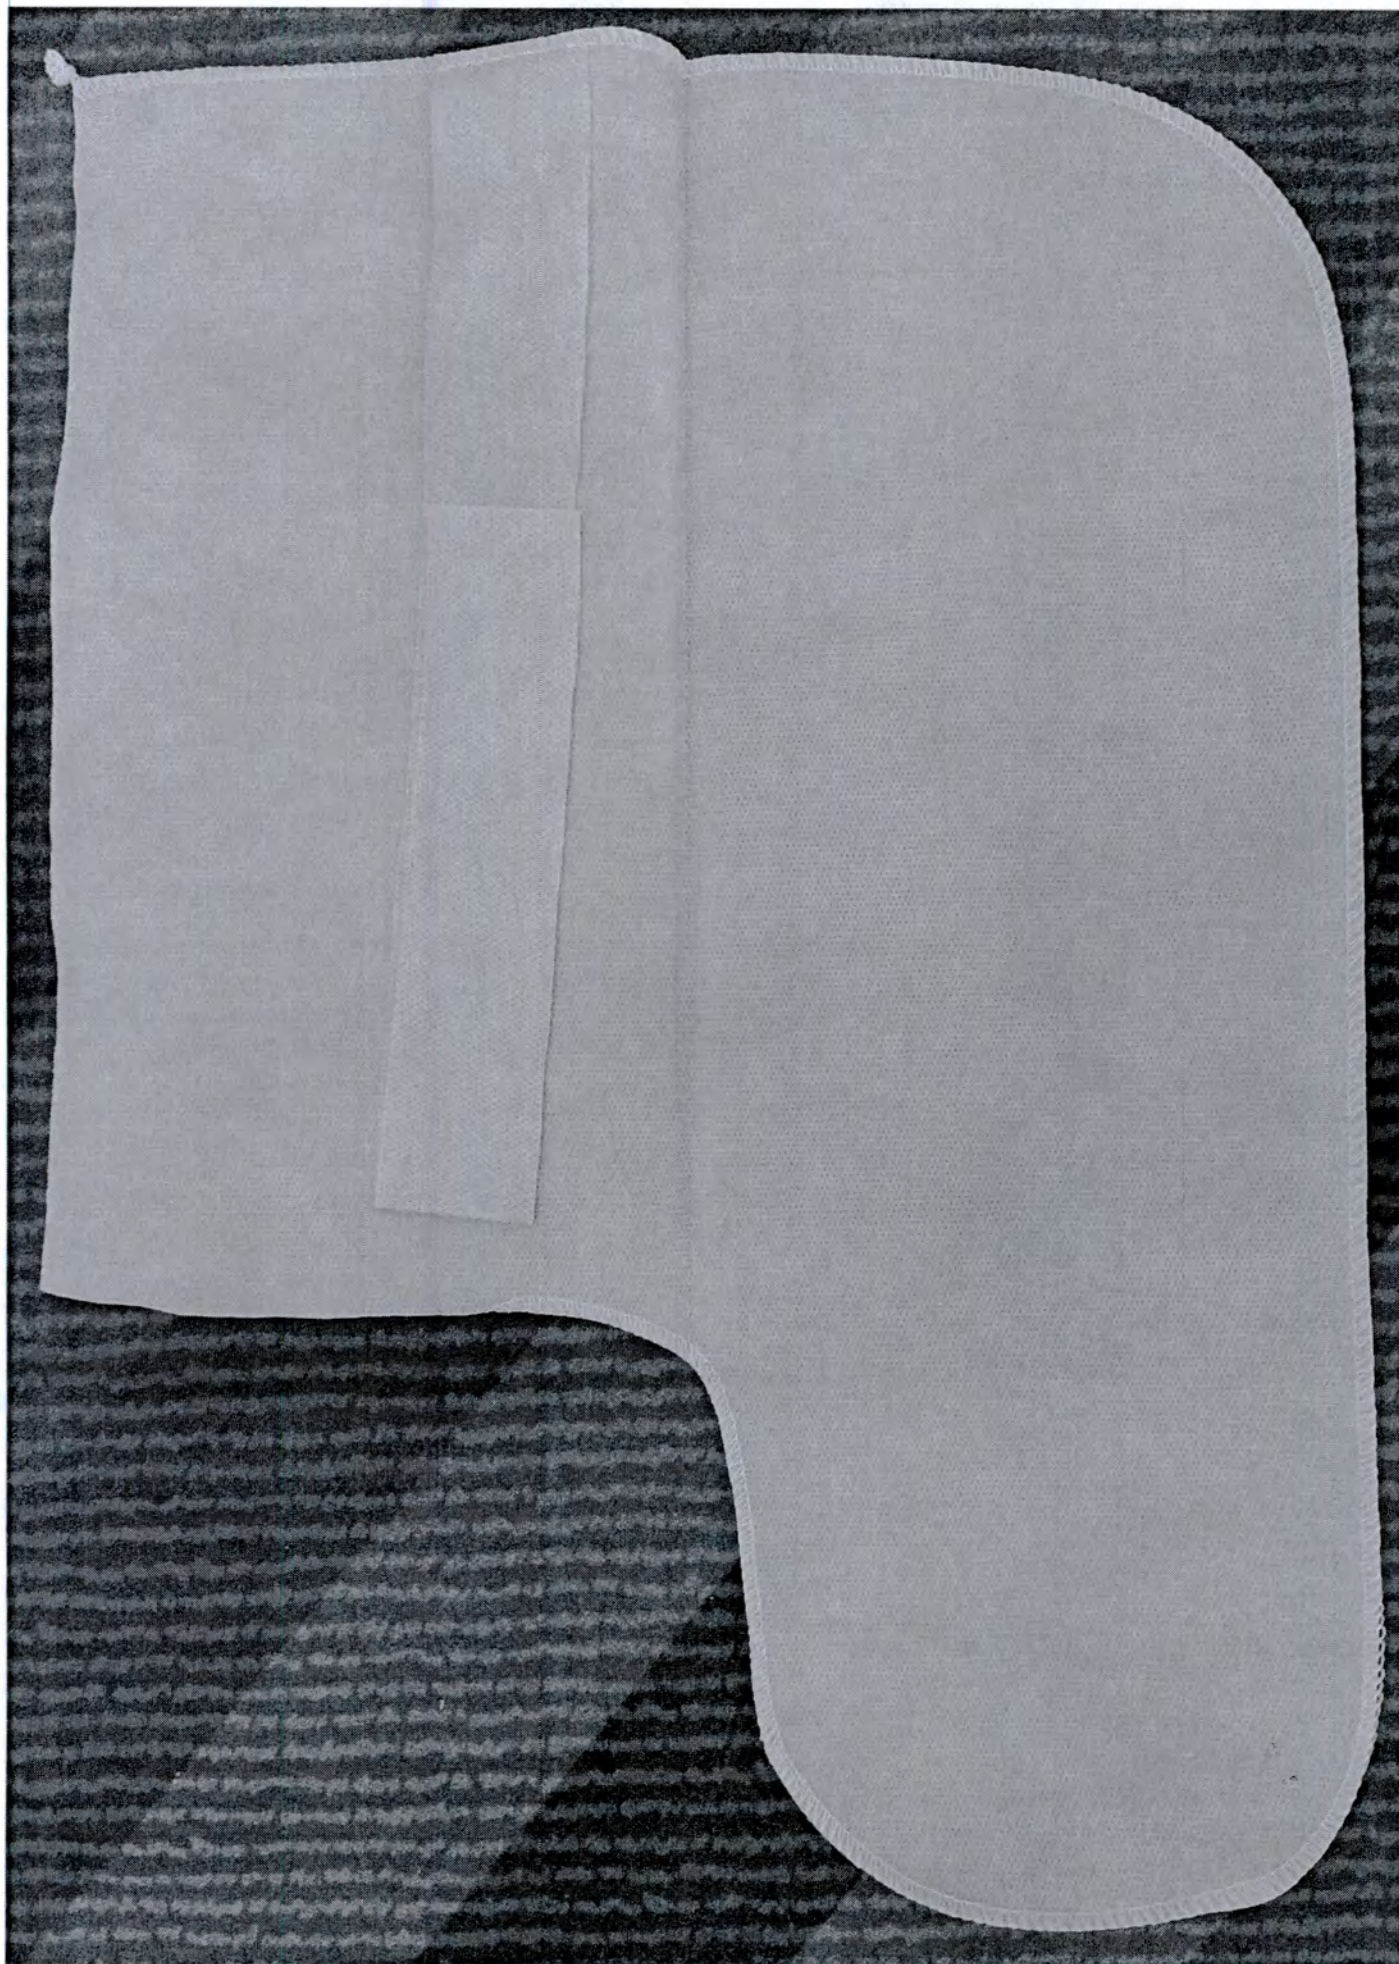


2.5. Лоток пластмассовый круглый.

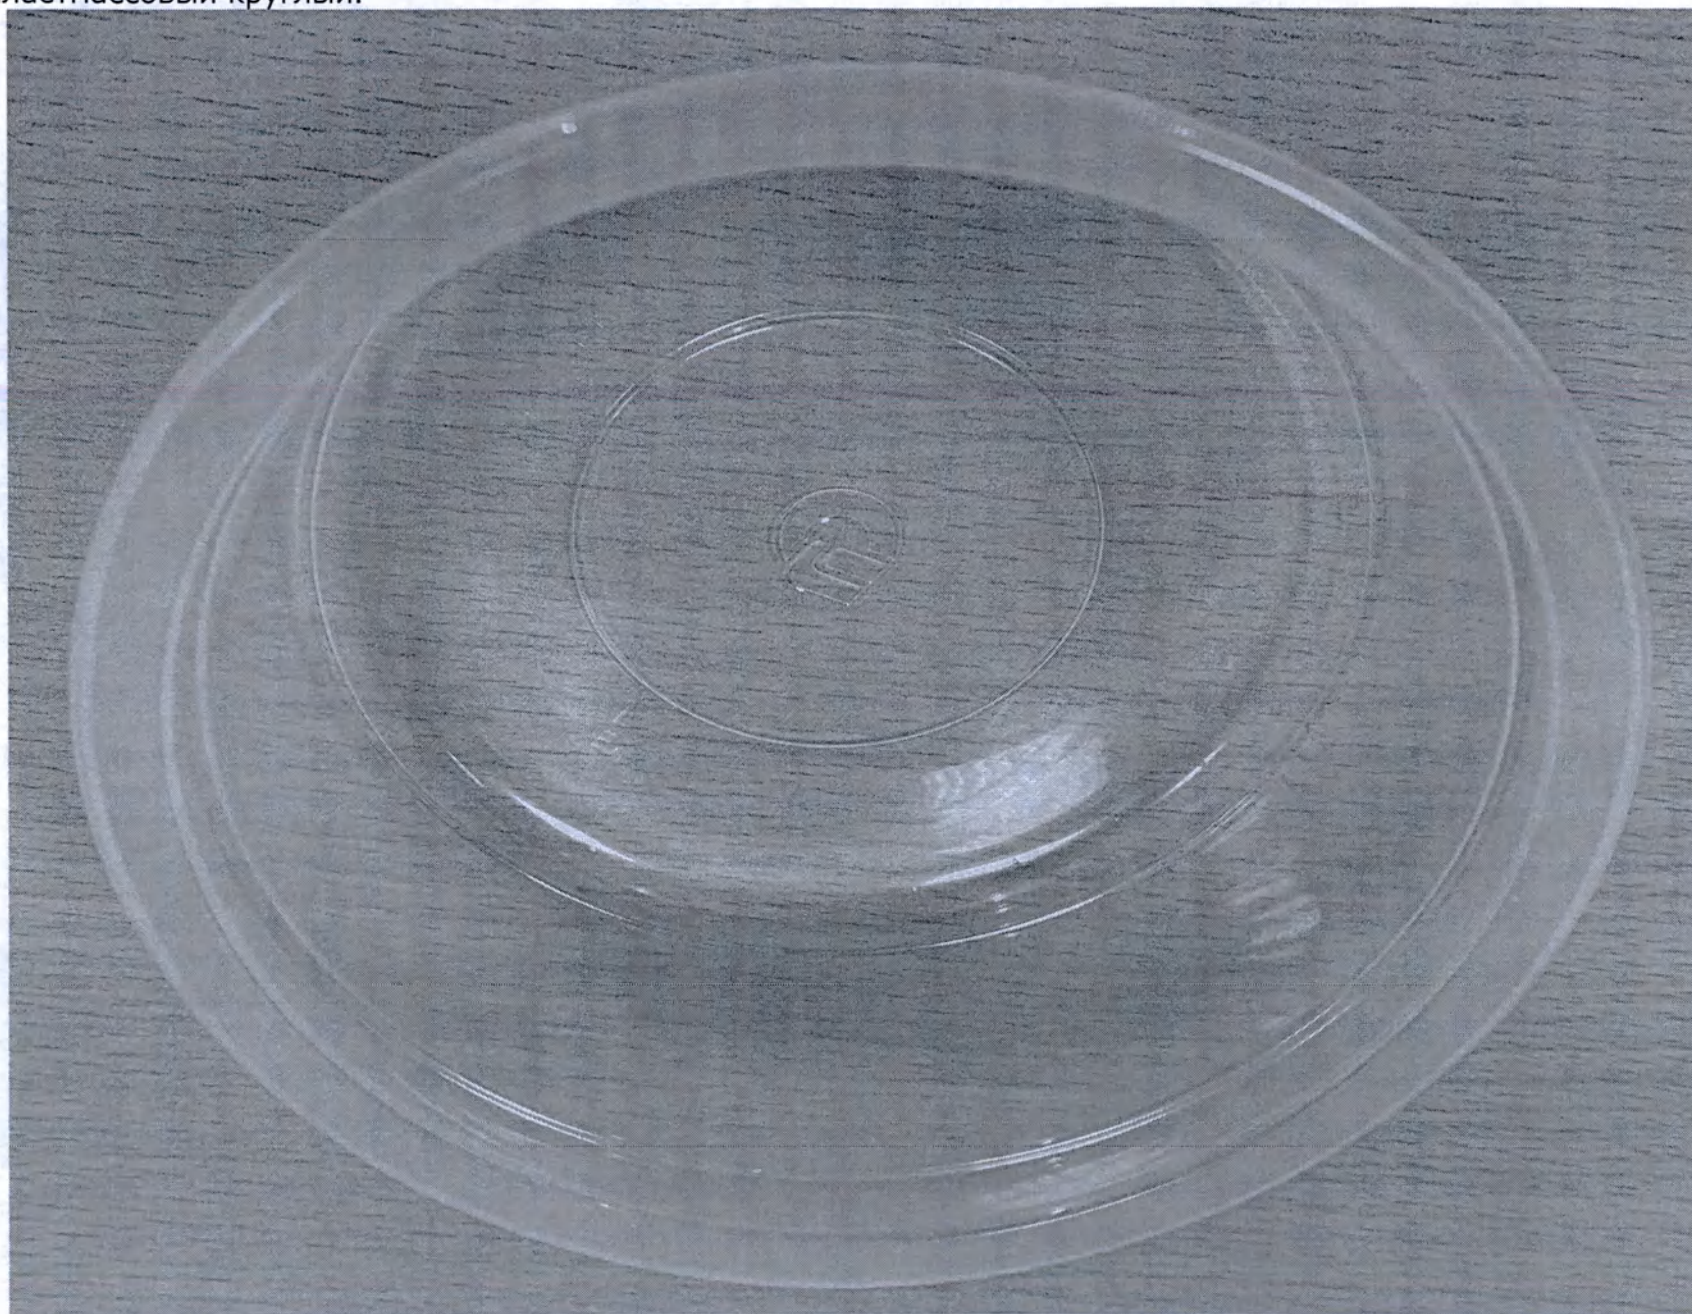


2.6. Лоток пластмассовый прямоугольный.

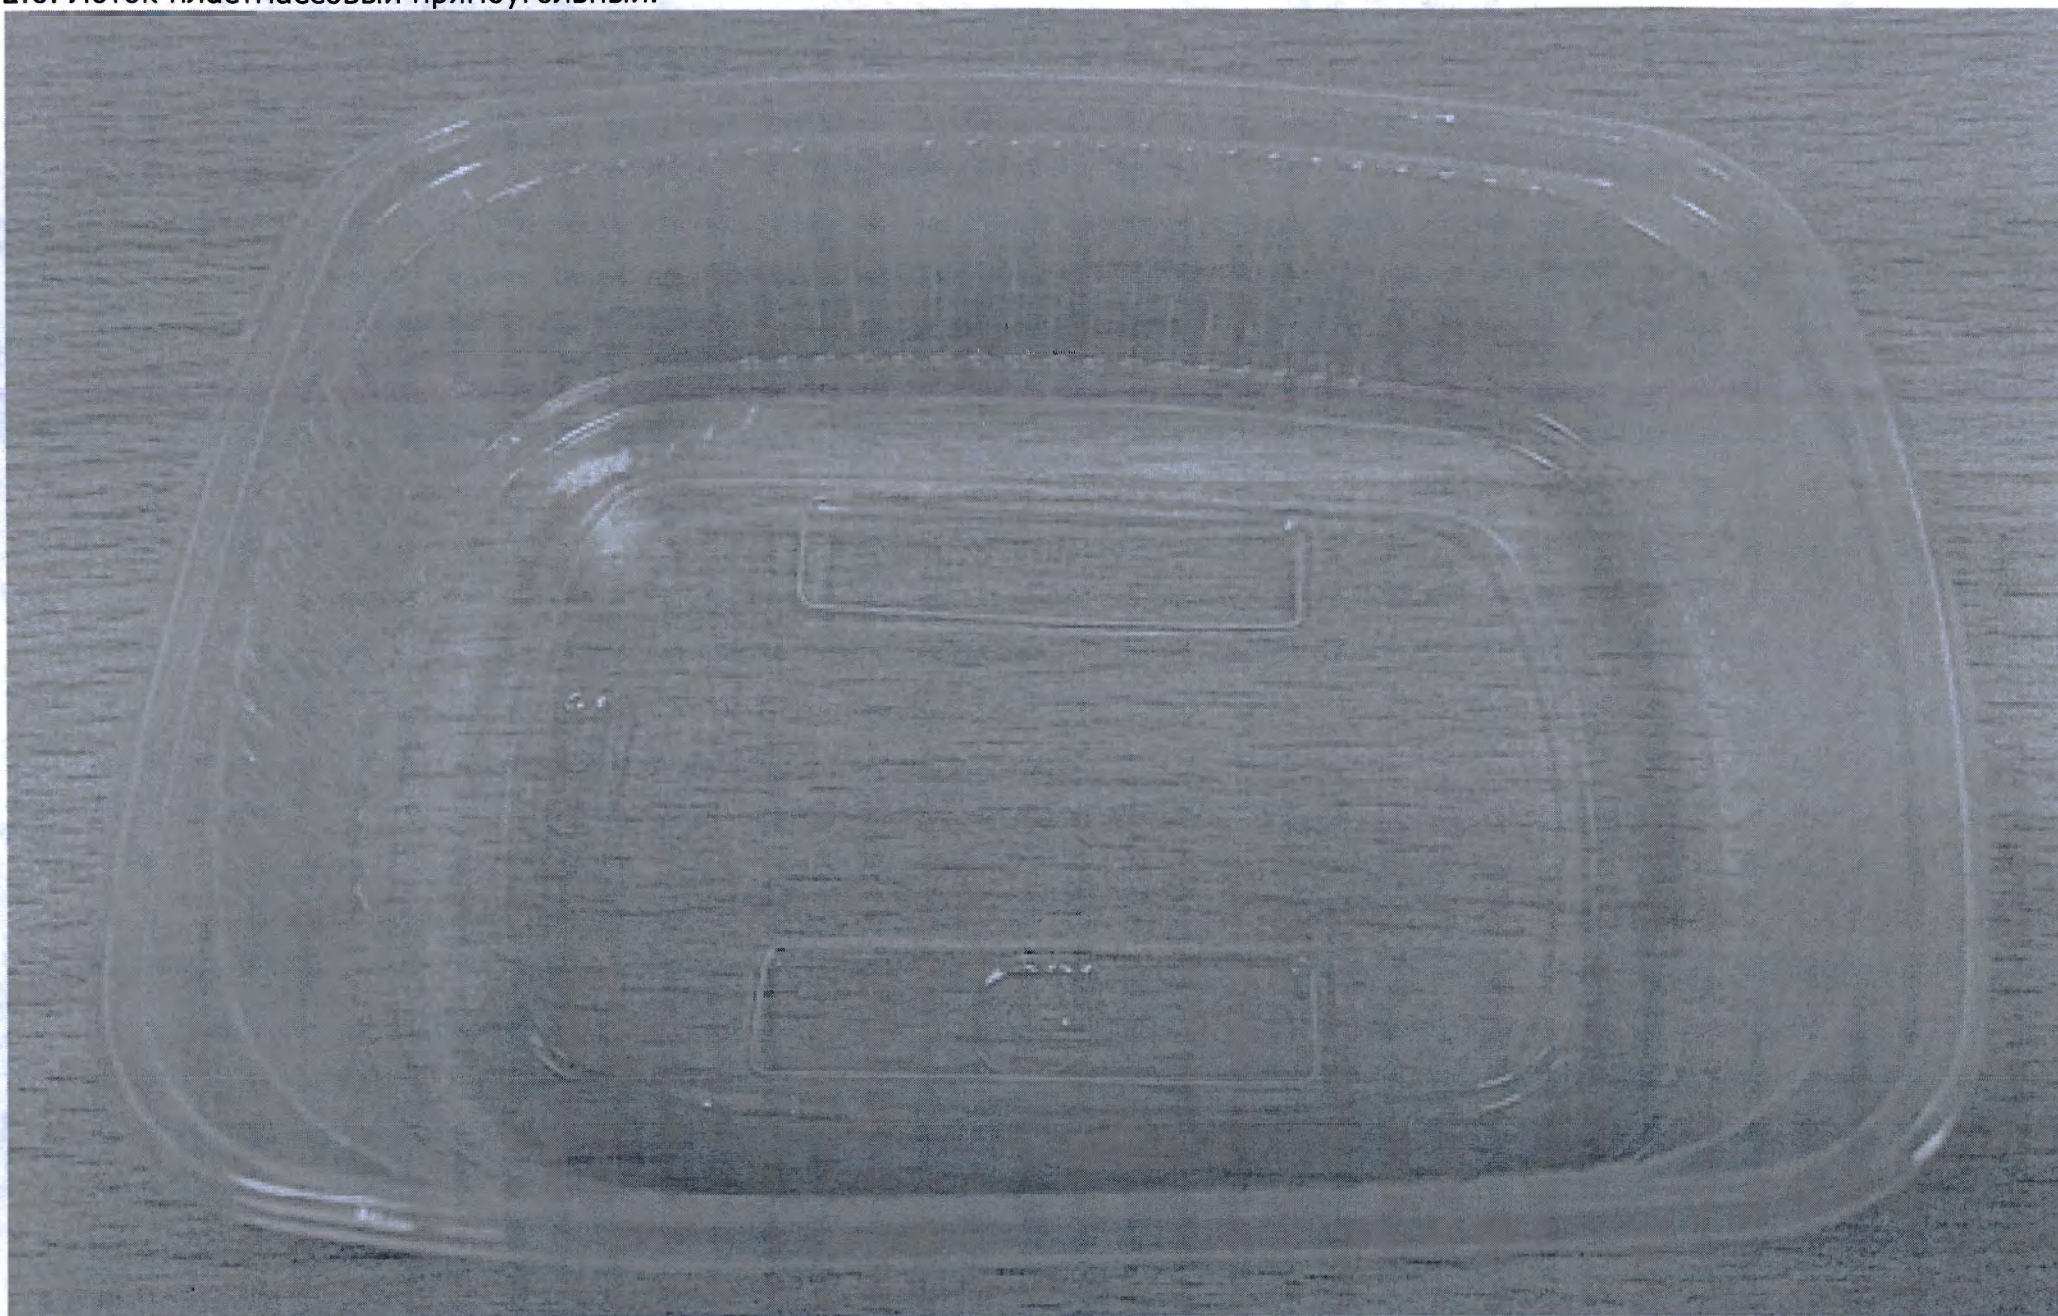


2.7. Стаканчик мерный.

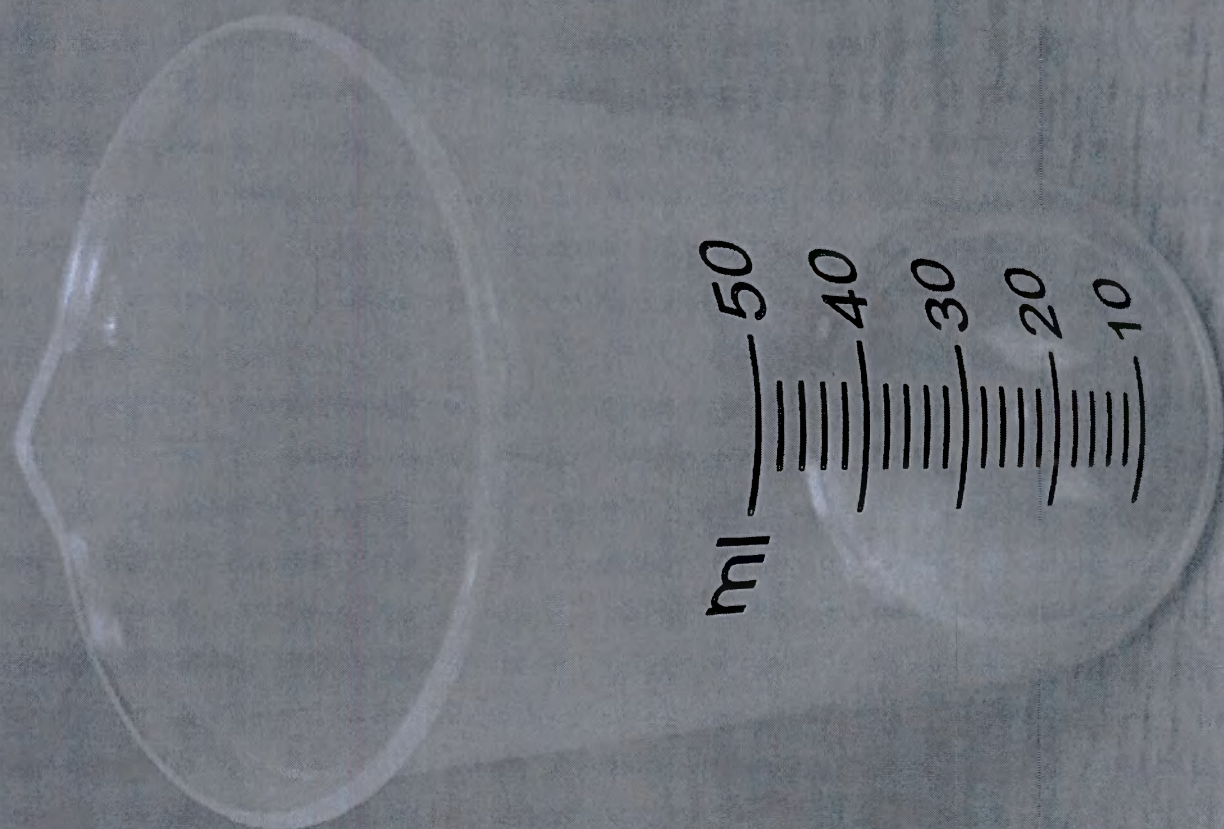


2.8. Перчатки смотровые латексные.

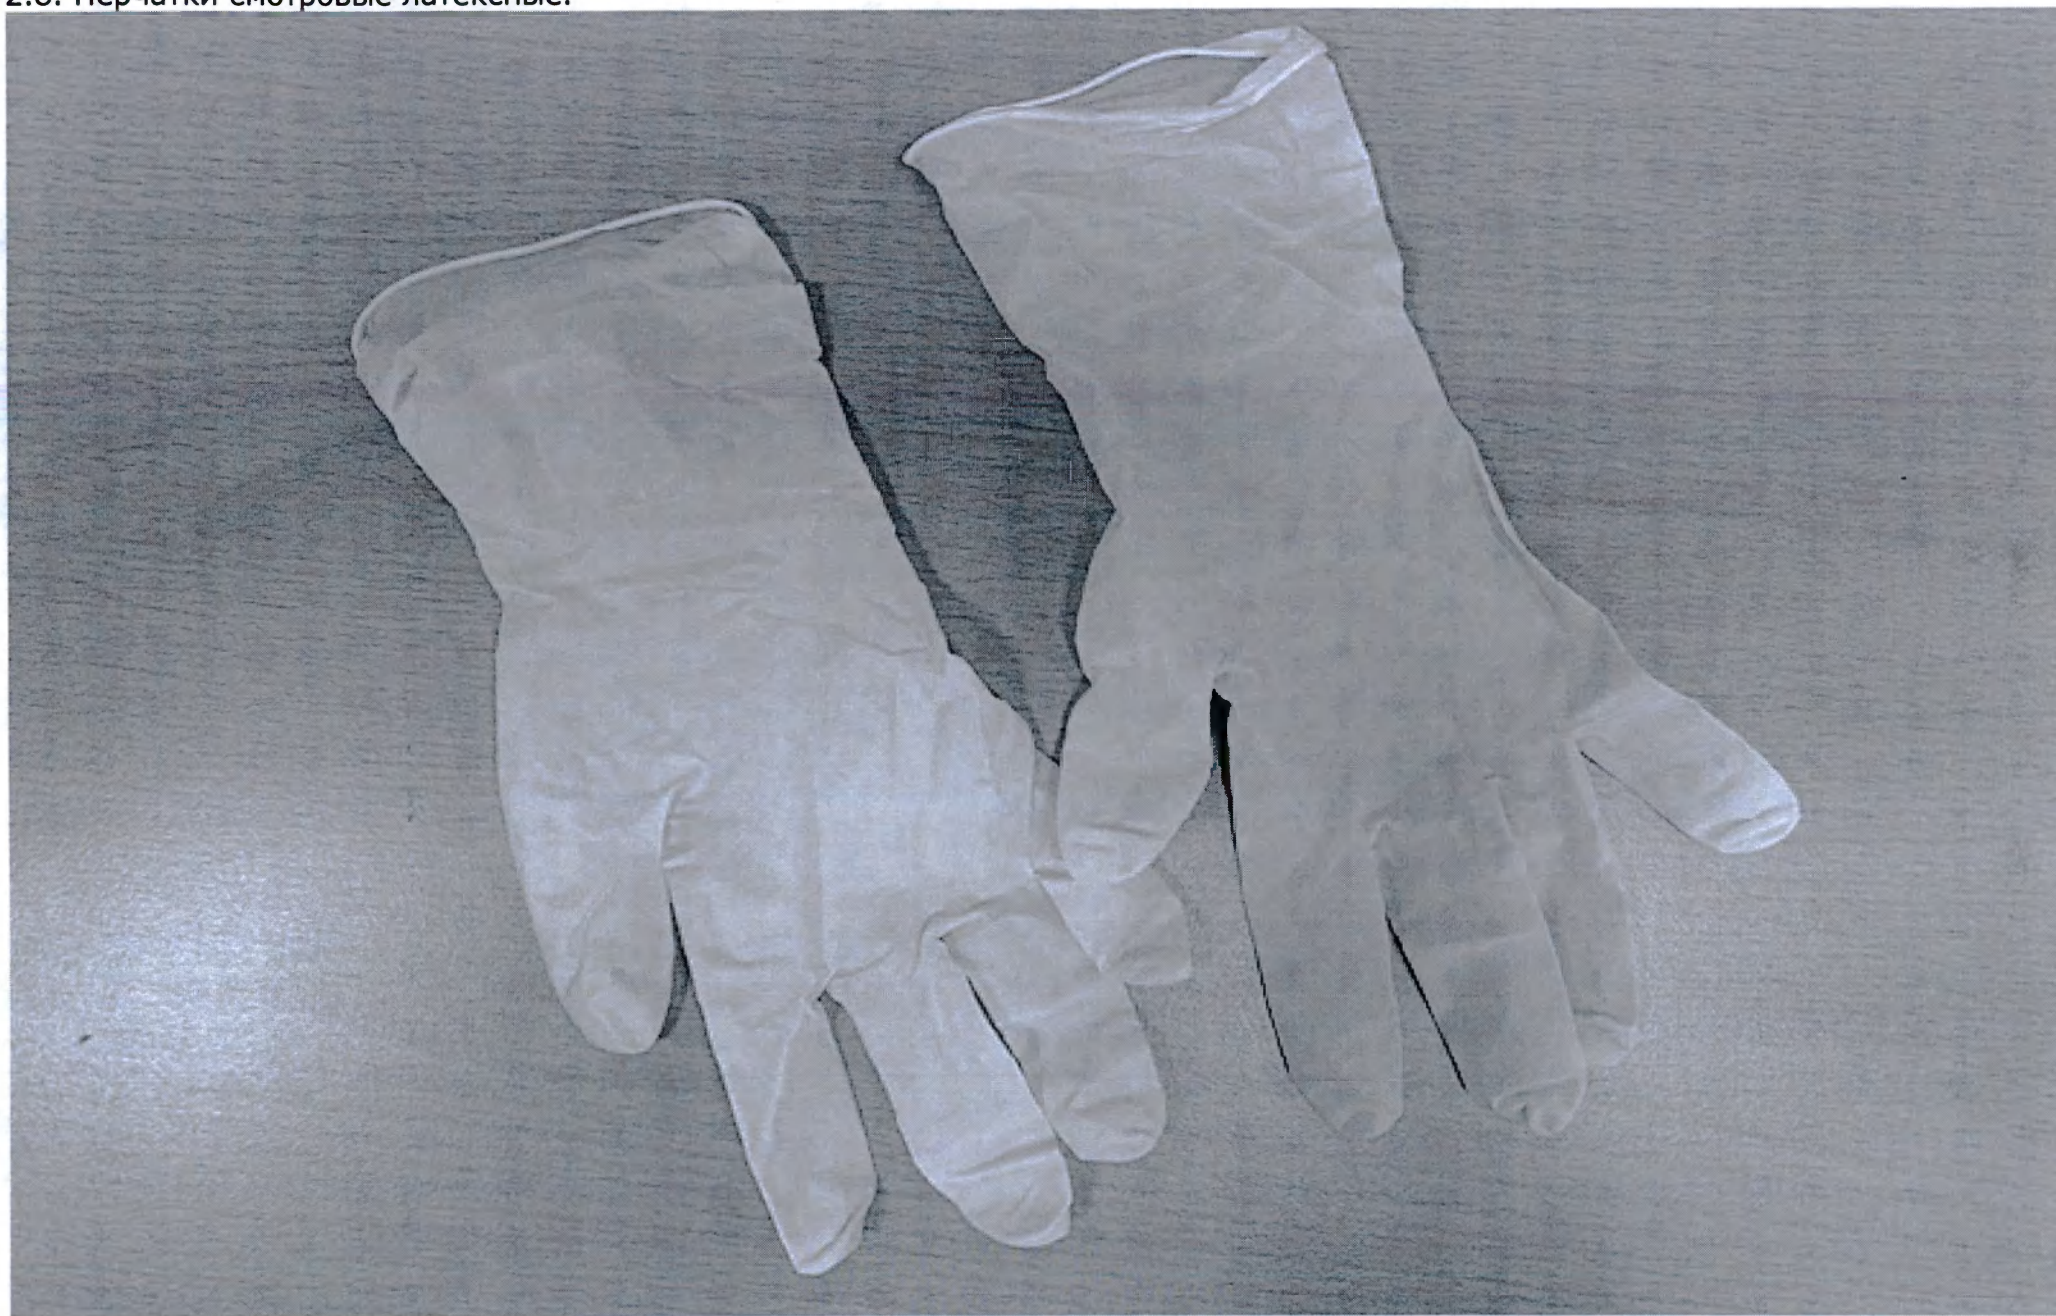


2.9. Перчатки смотровые нитриловые.

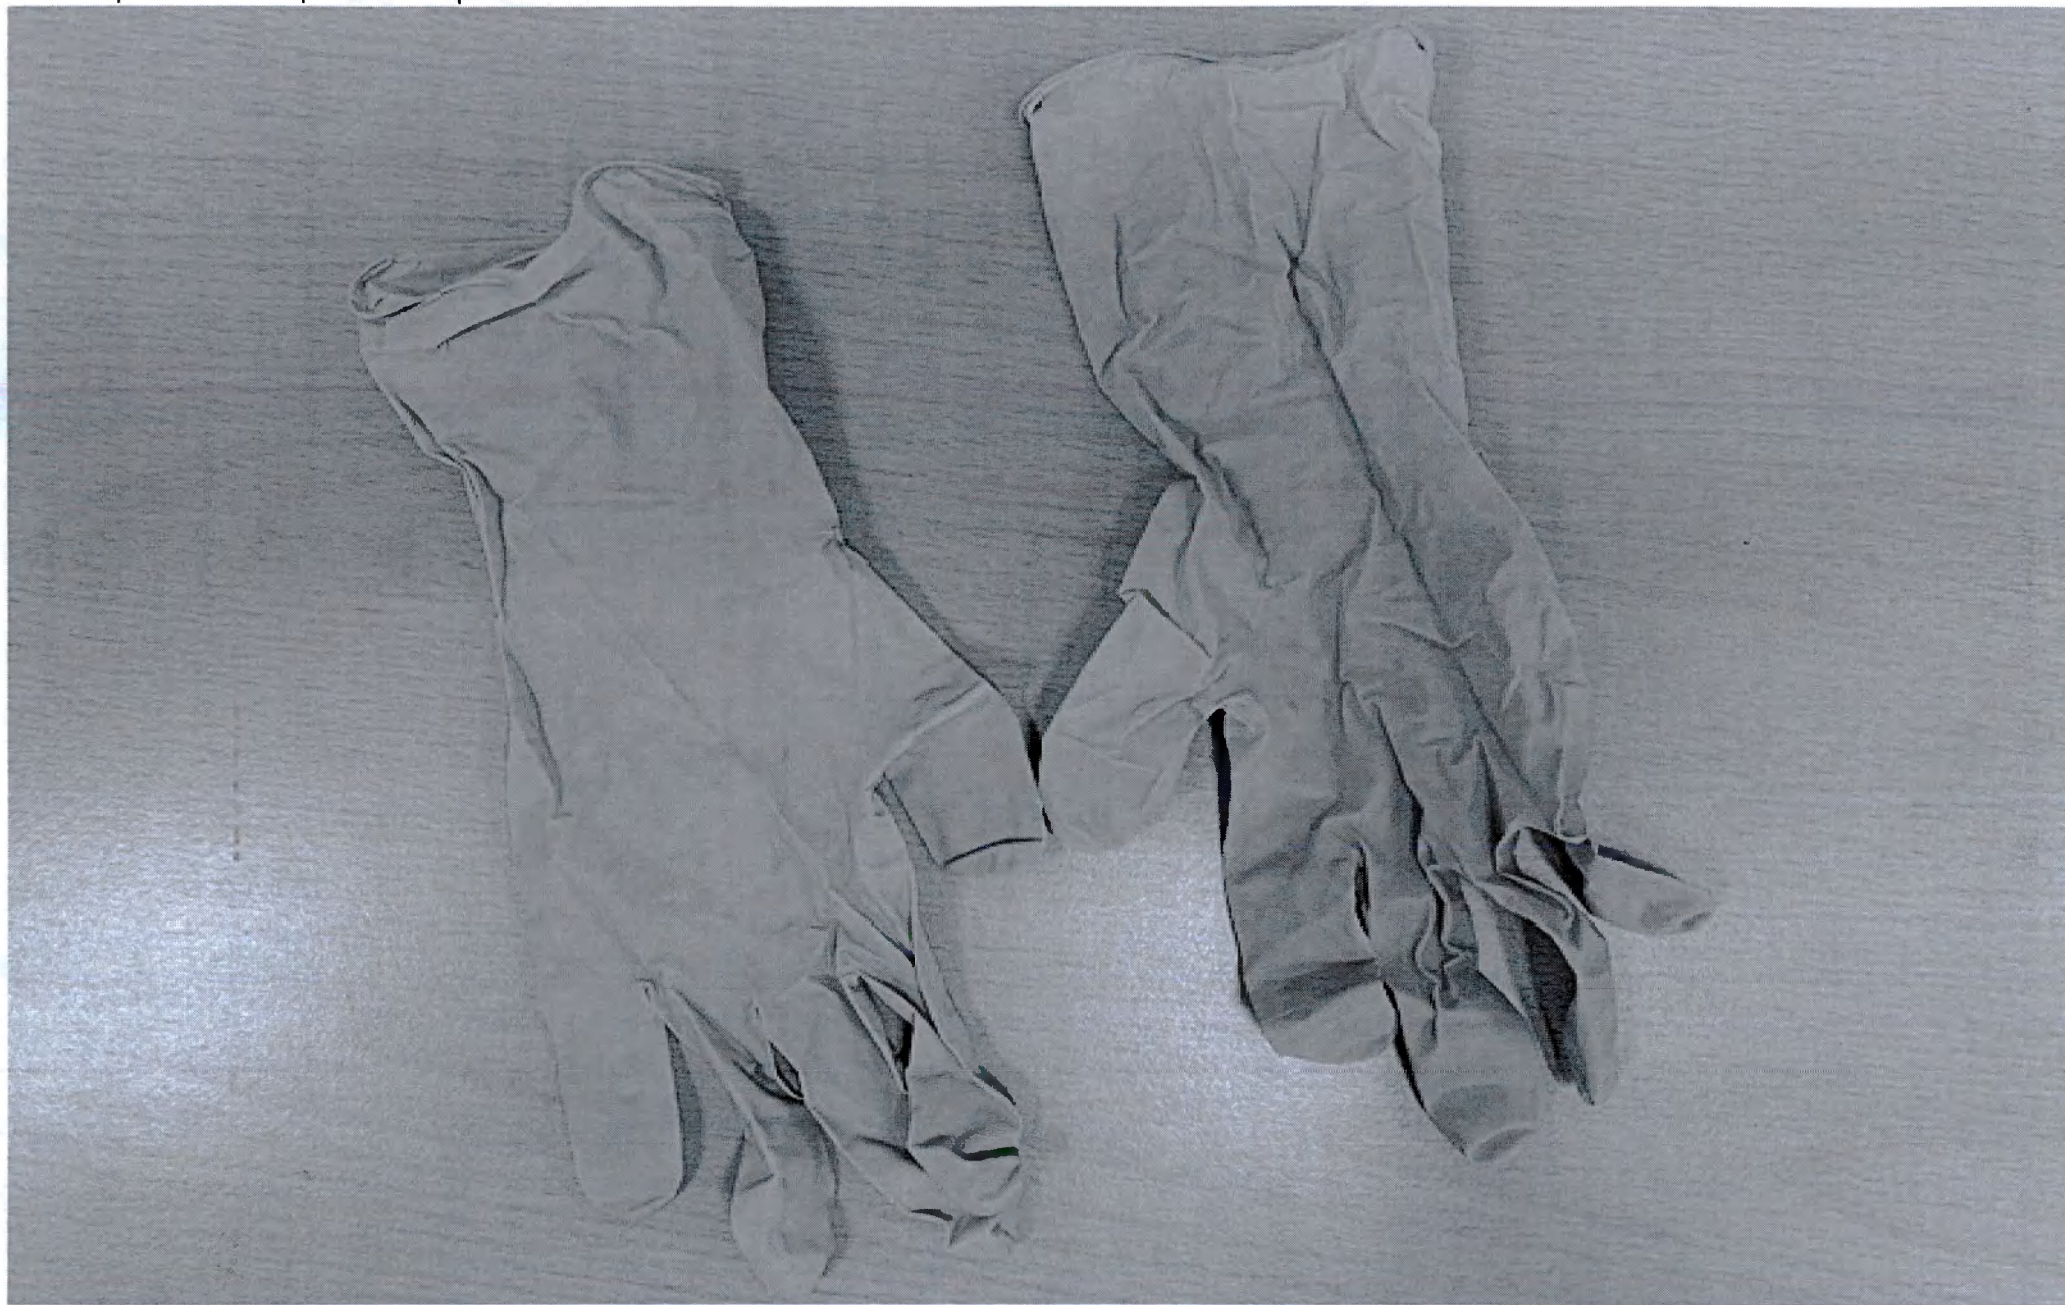


2.10. Зажим Корцанг.

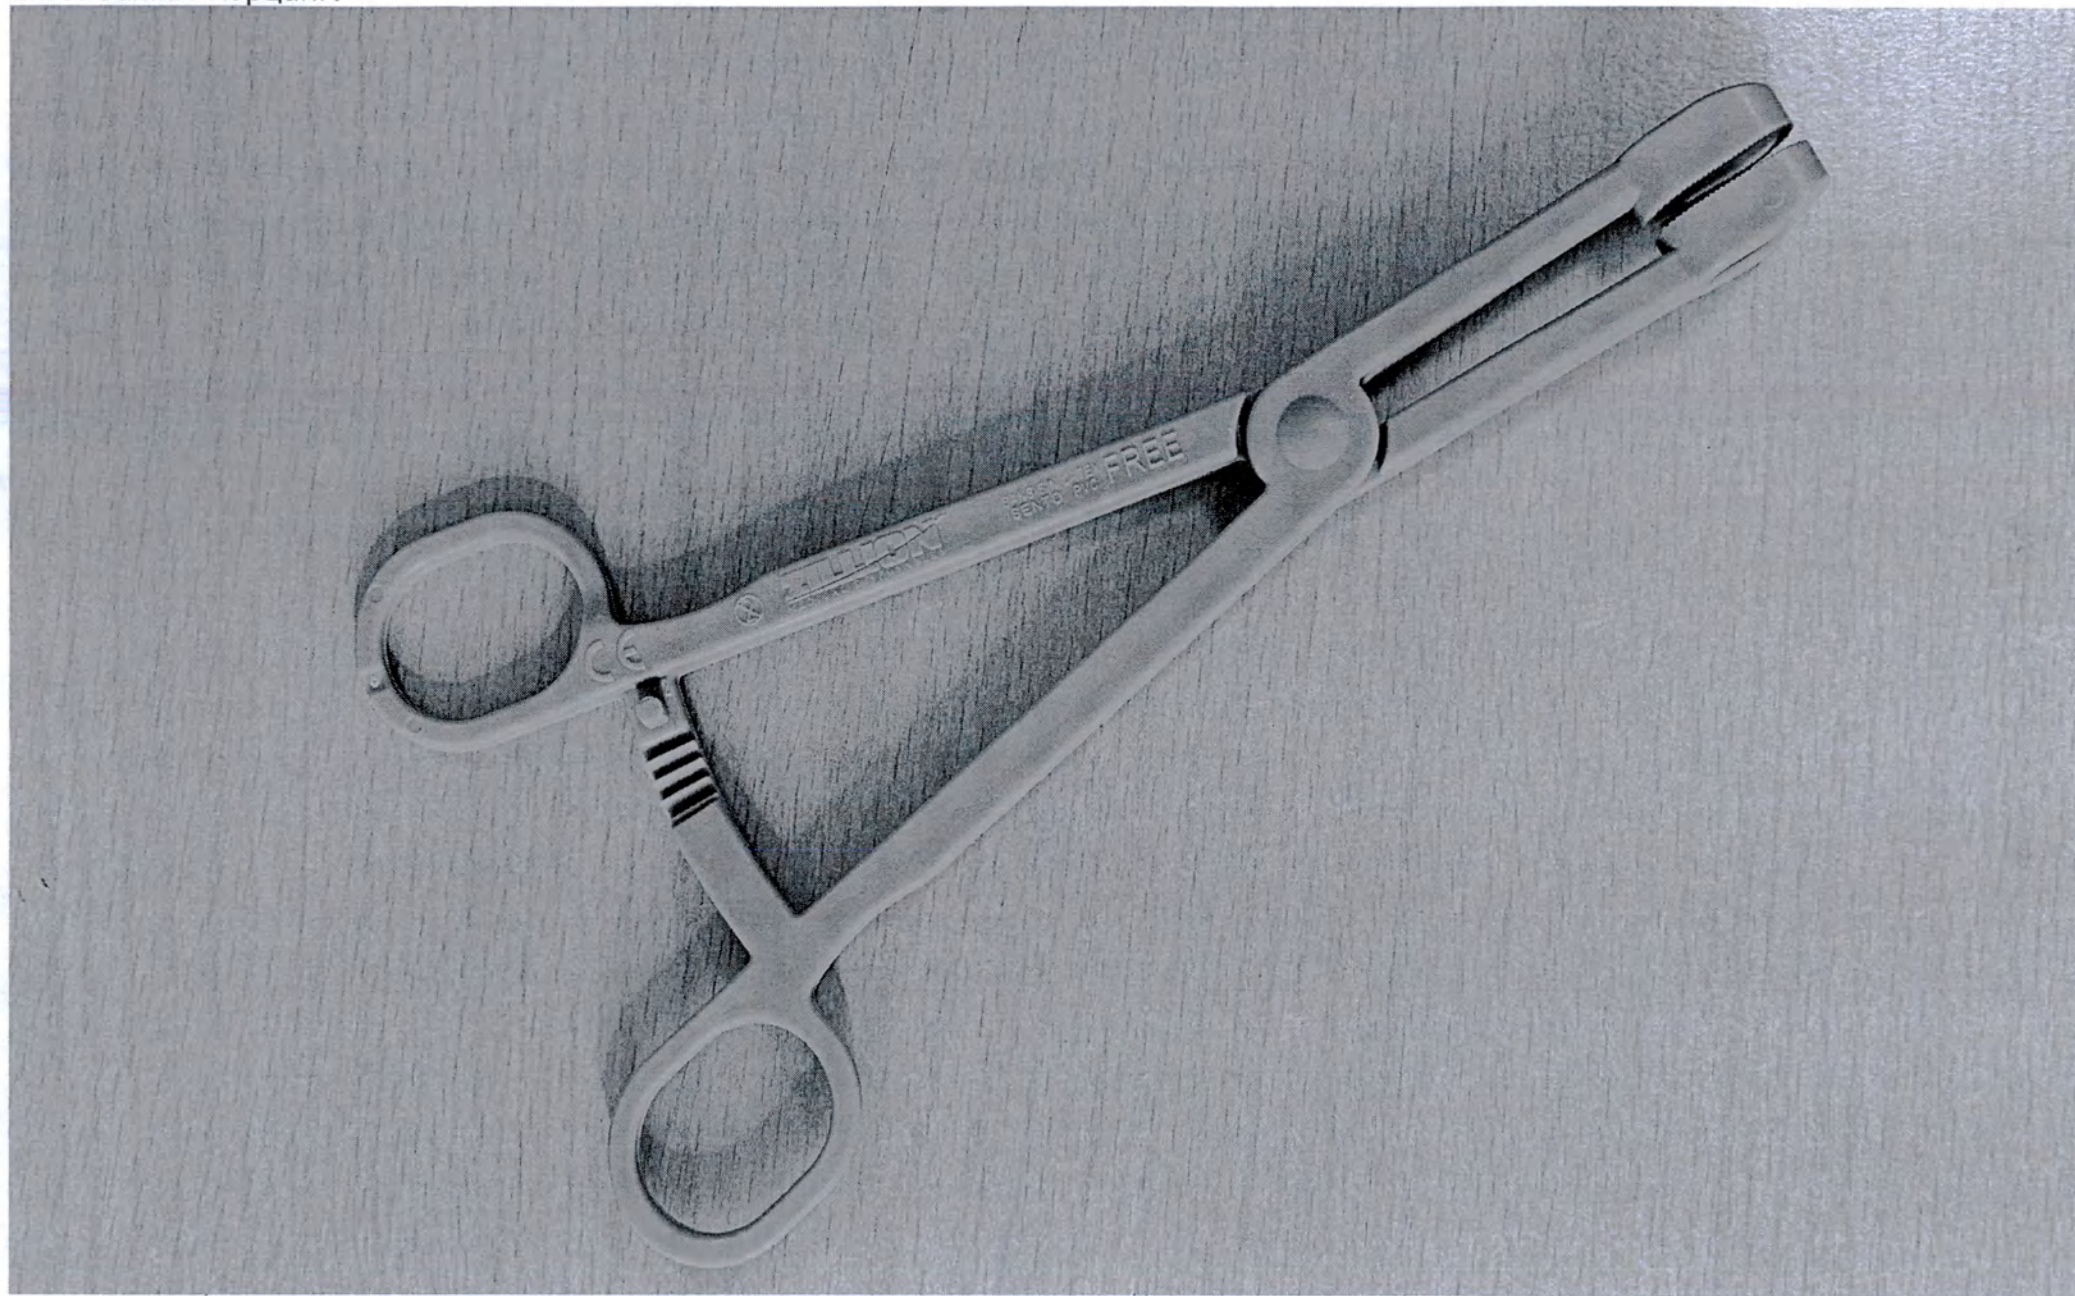

2.11. Салфетка медицинская.

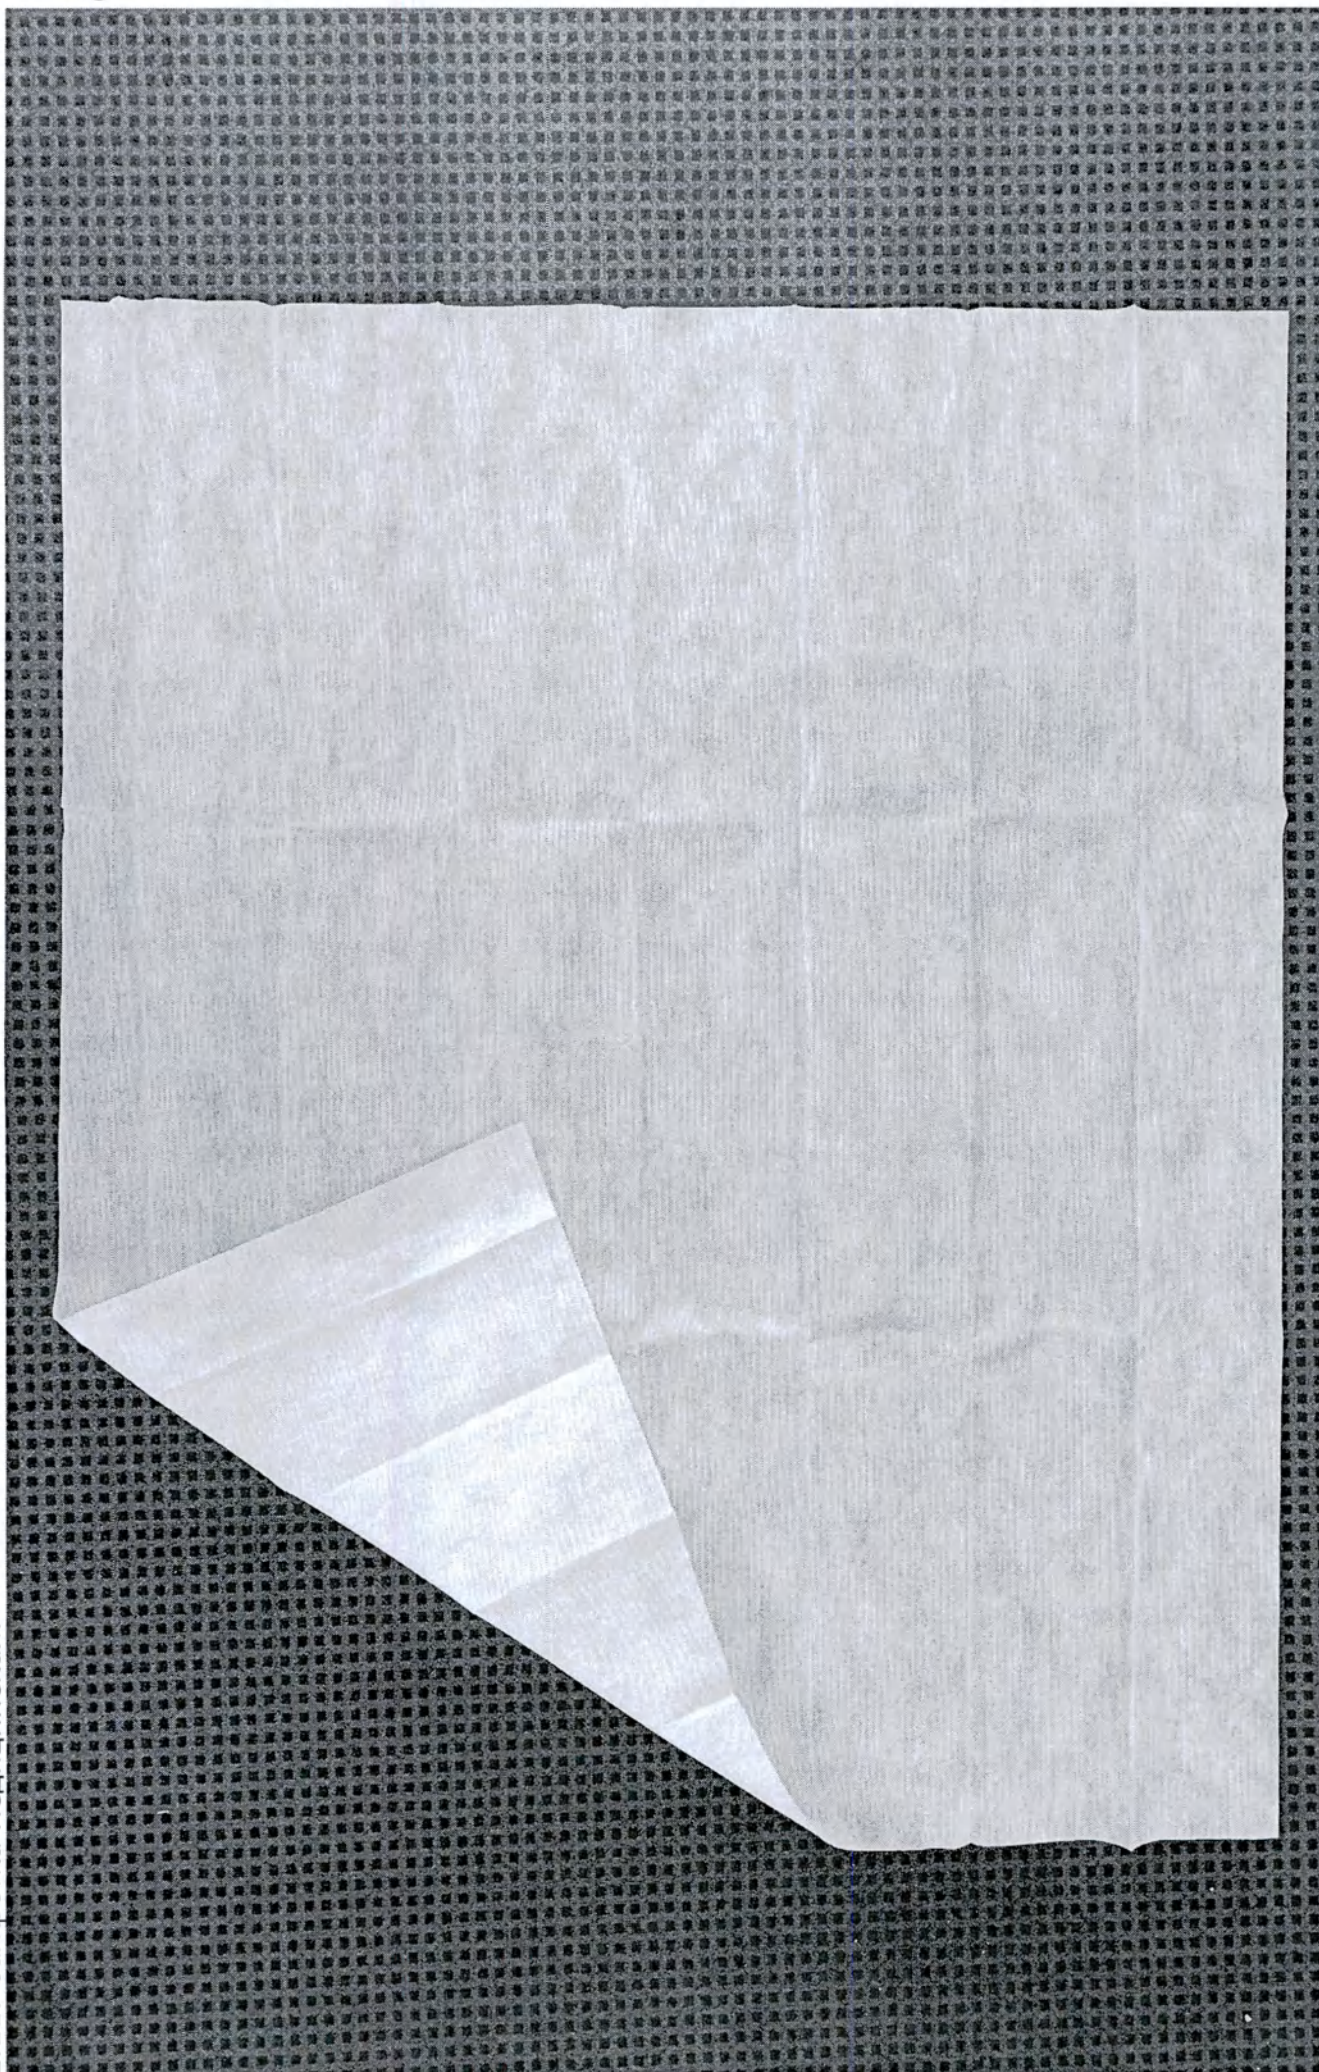


2.12. Ложка Фолькмана.

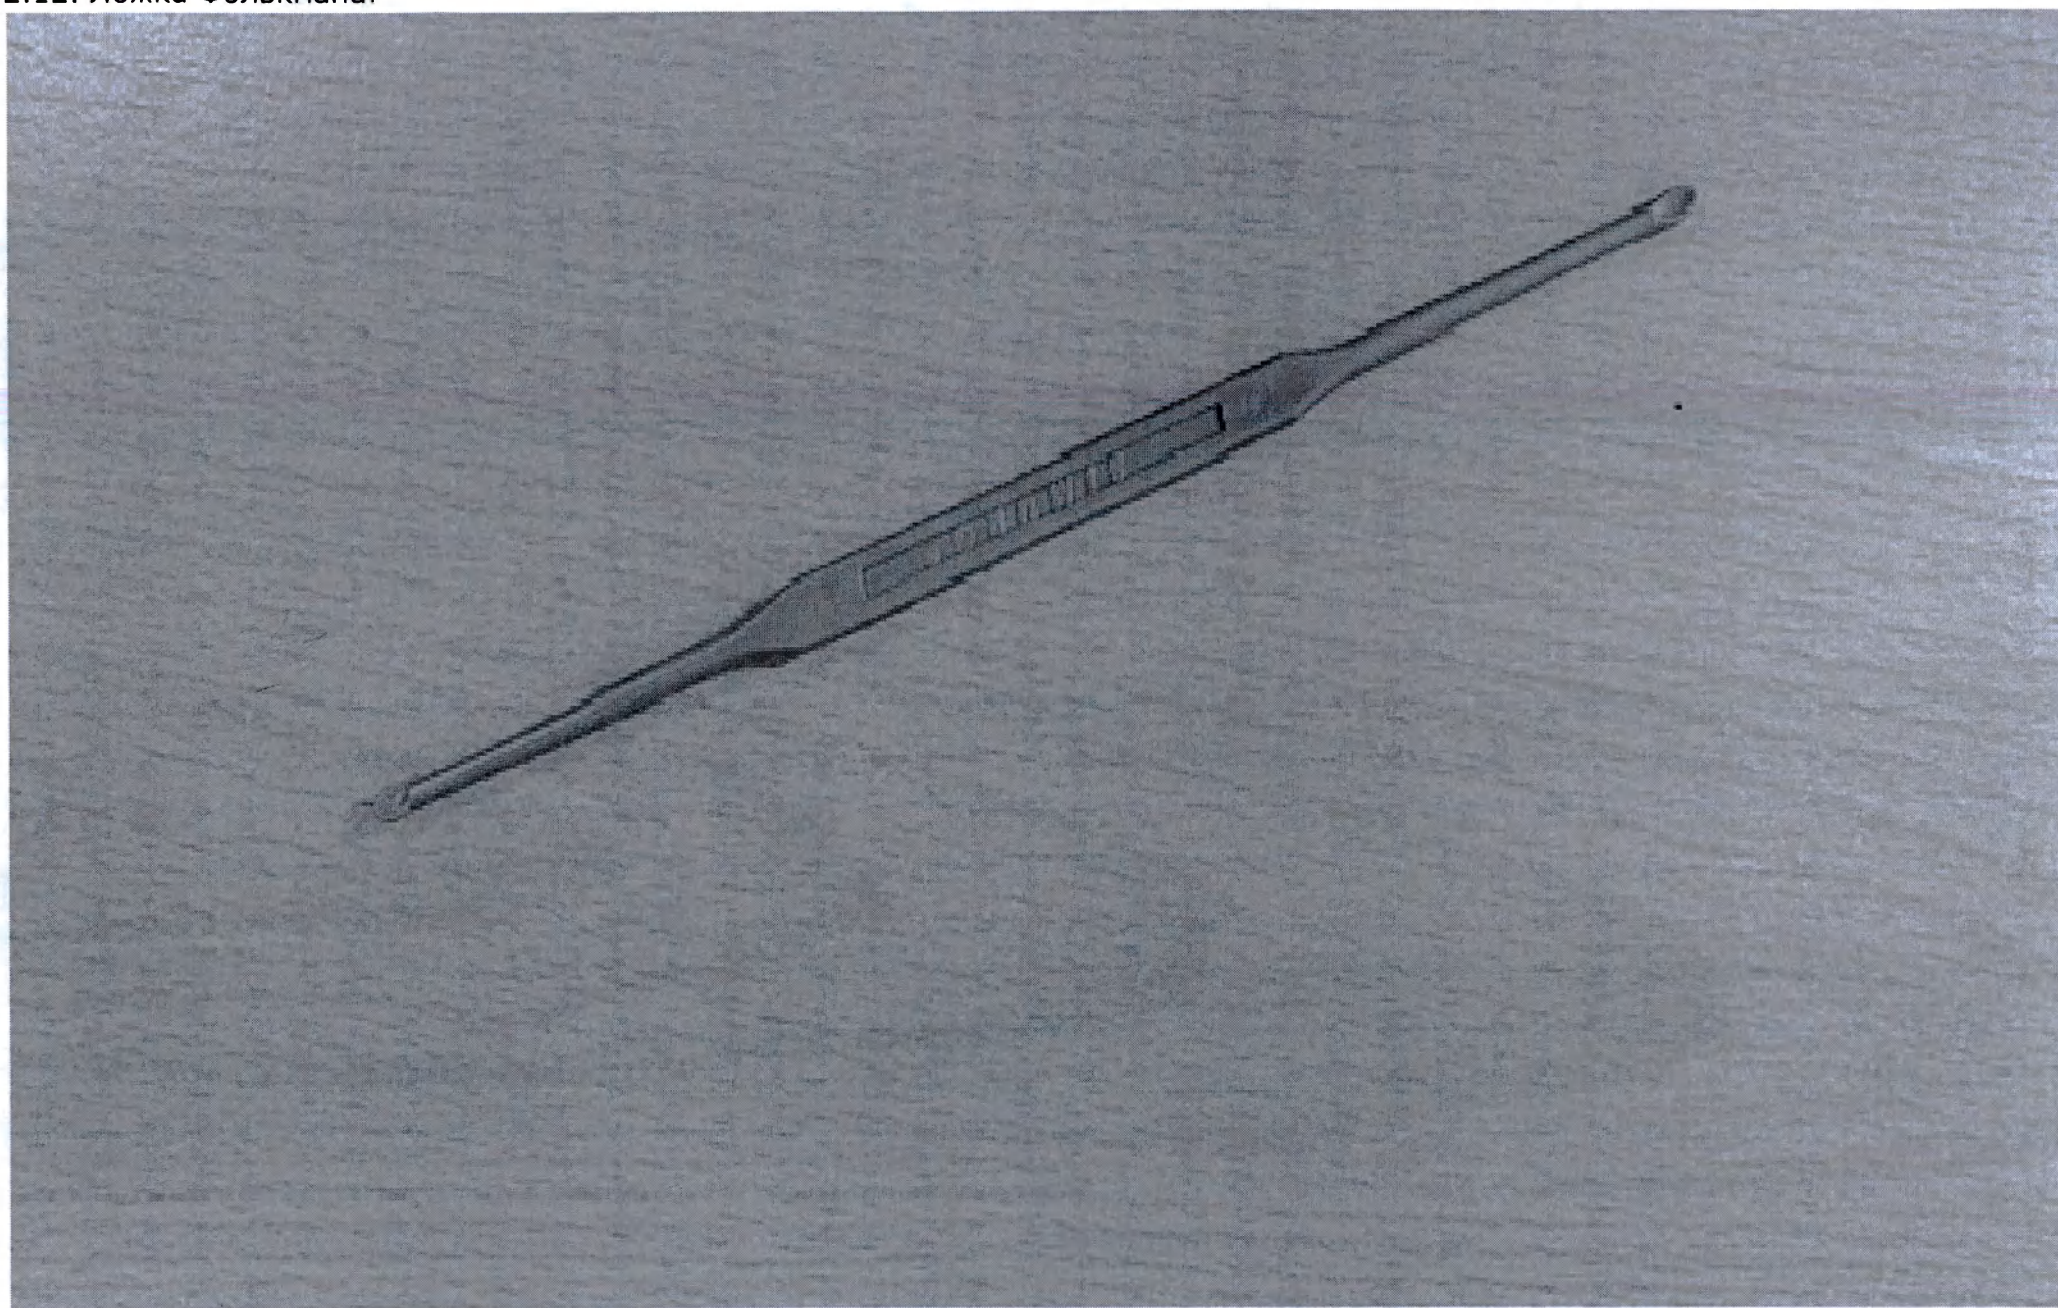


2.13. Шпатель Эйера.




2.14. Зонд аспирационный Classic Combi.

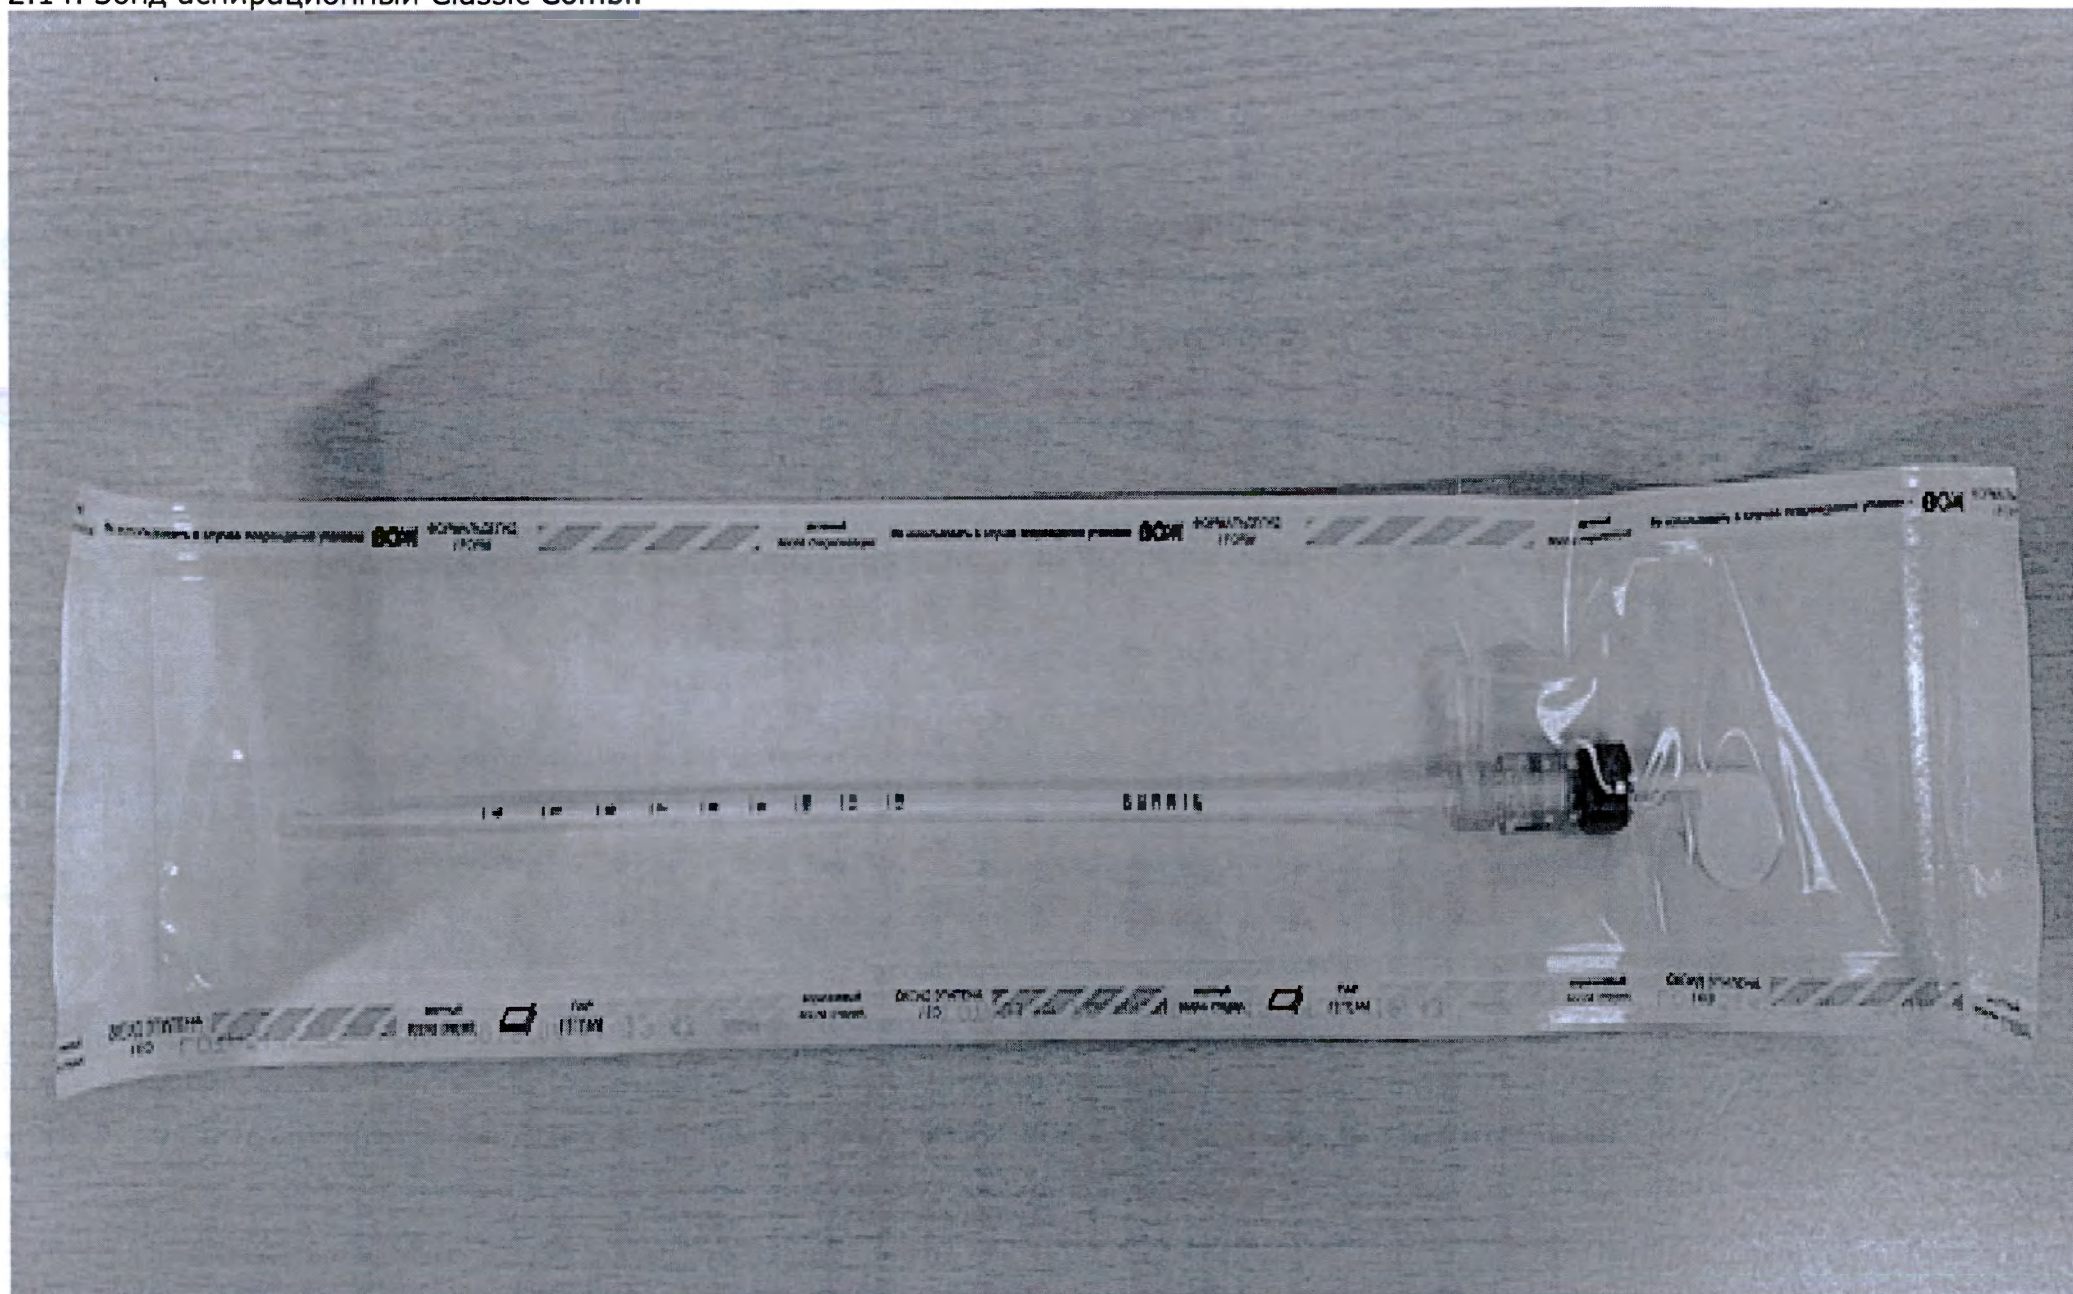


2.15. Цитоцетка.

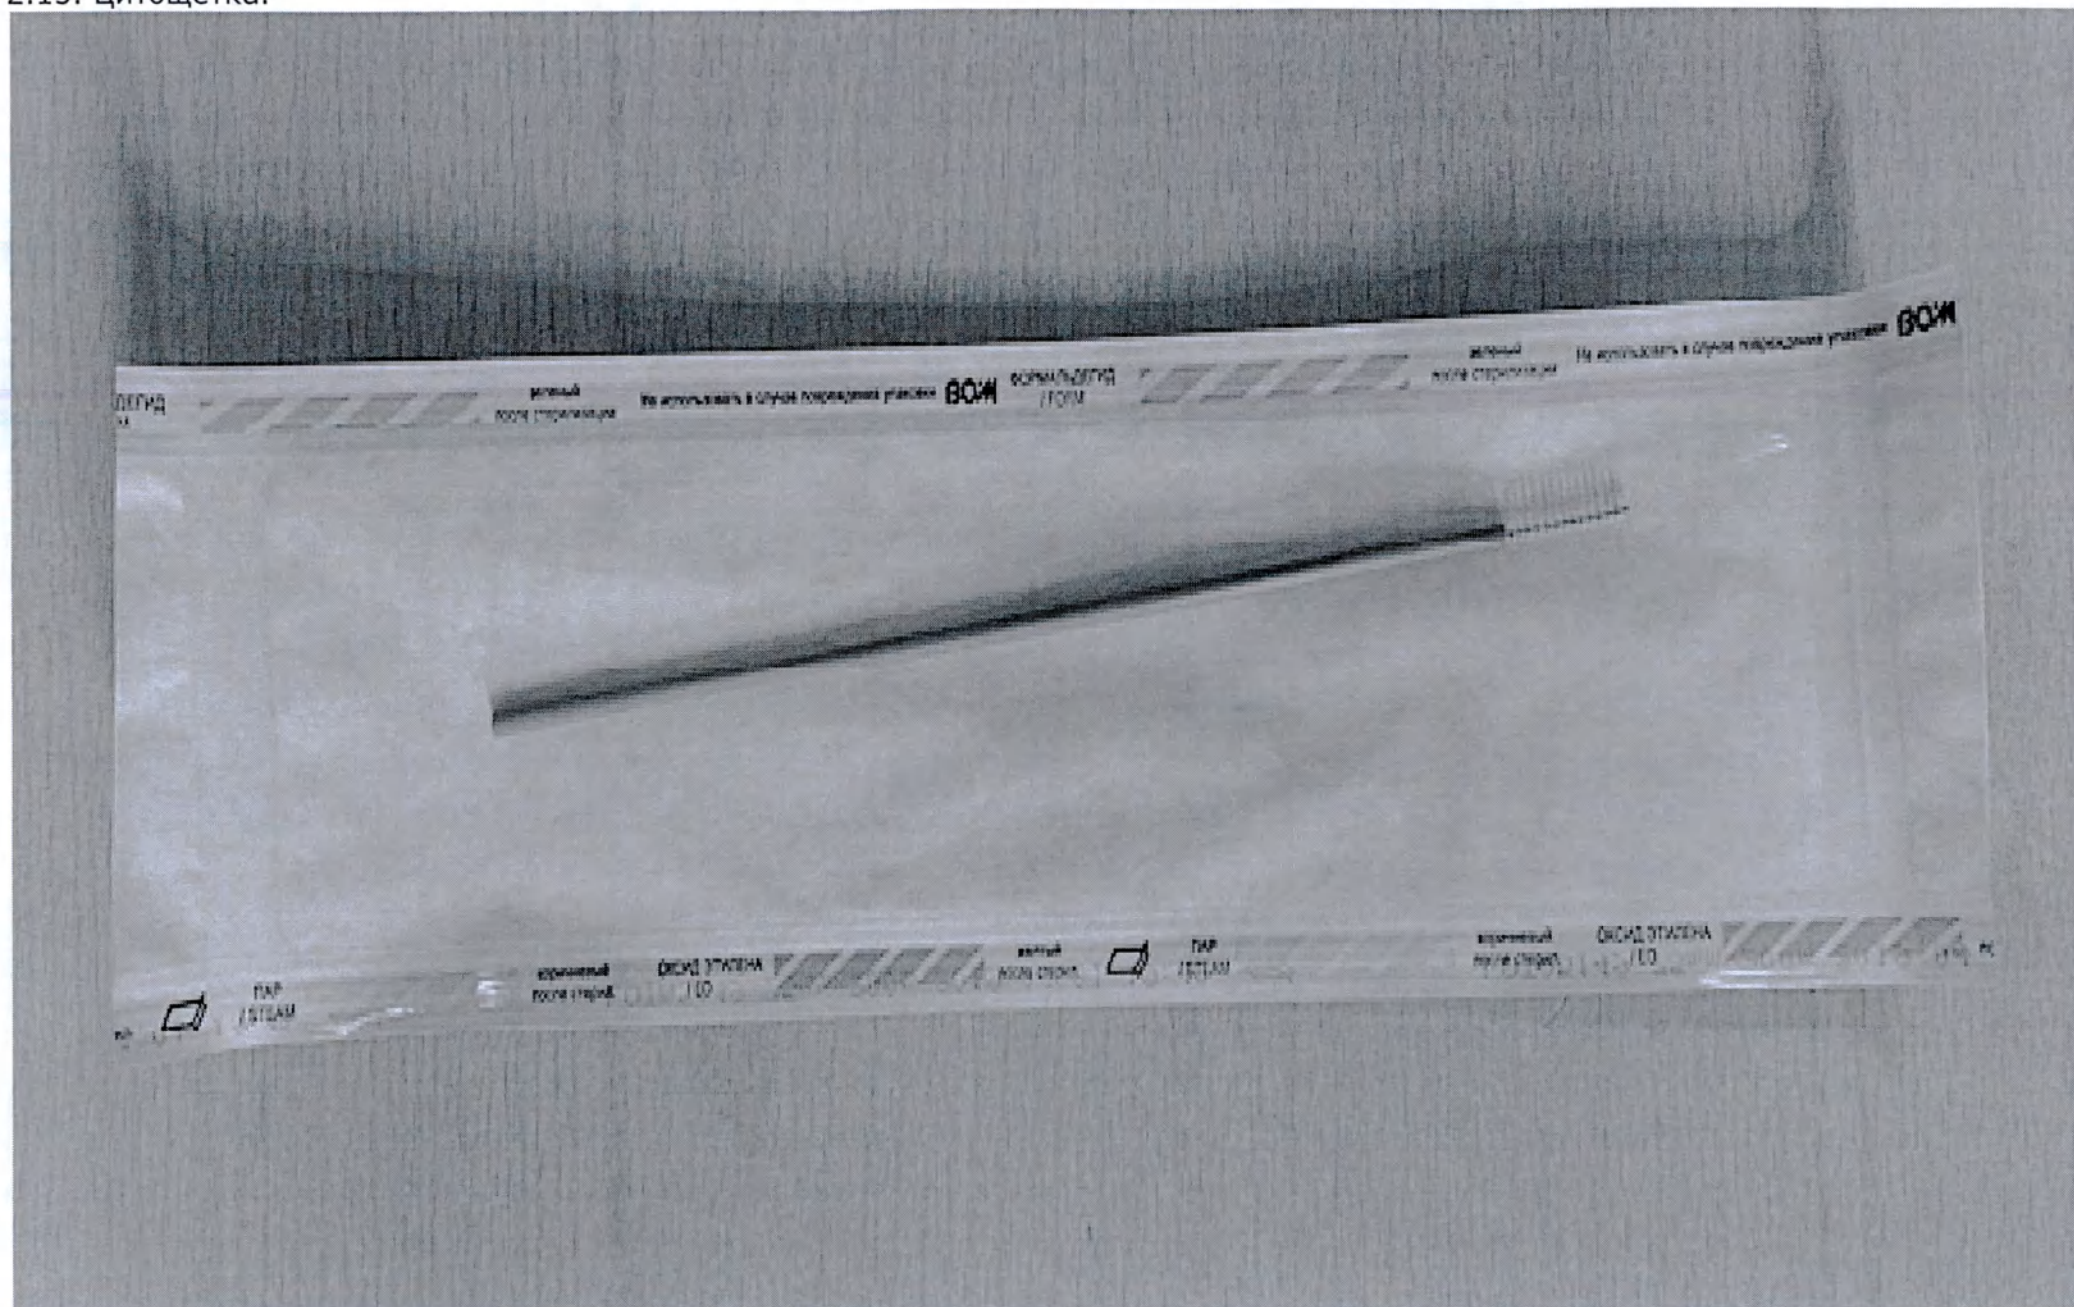


2.16. Цитощетка плюс.

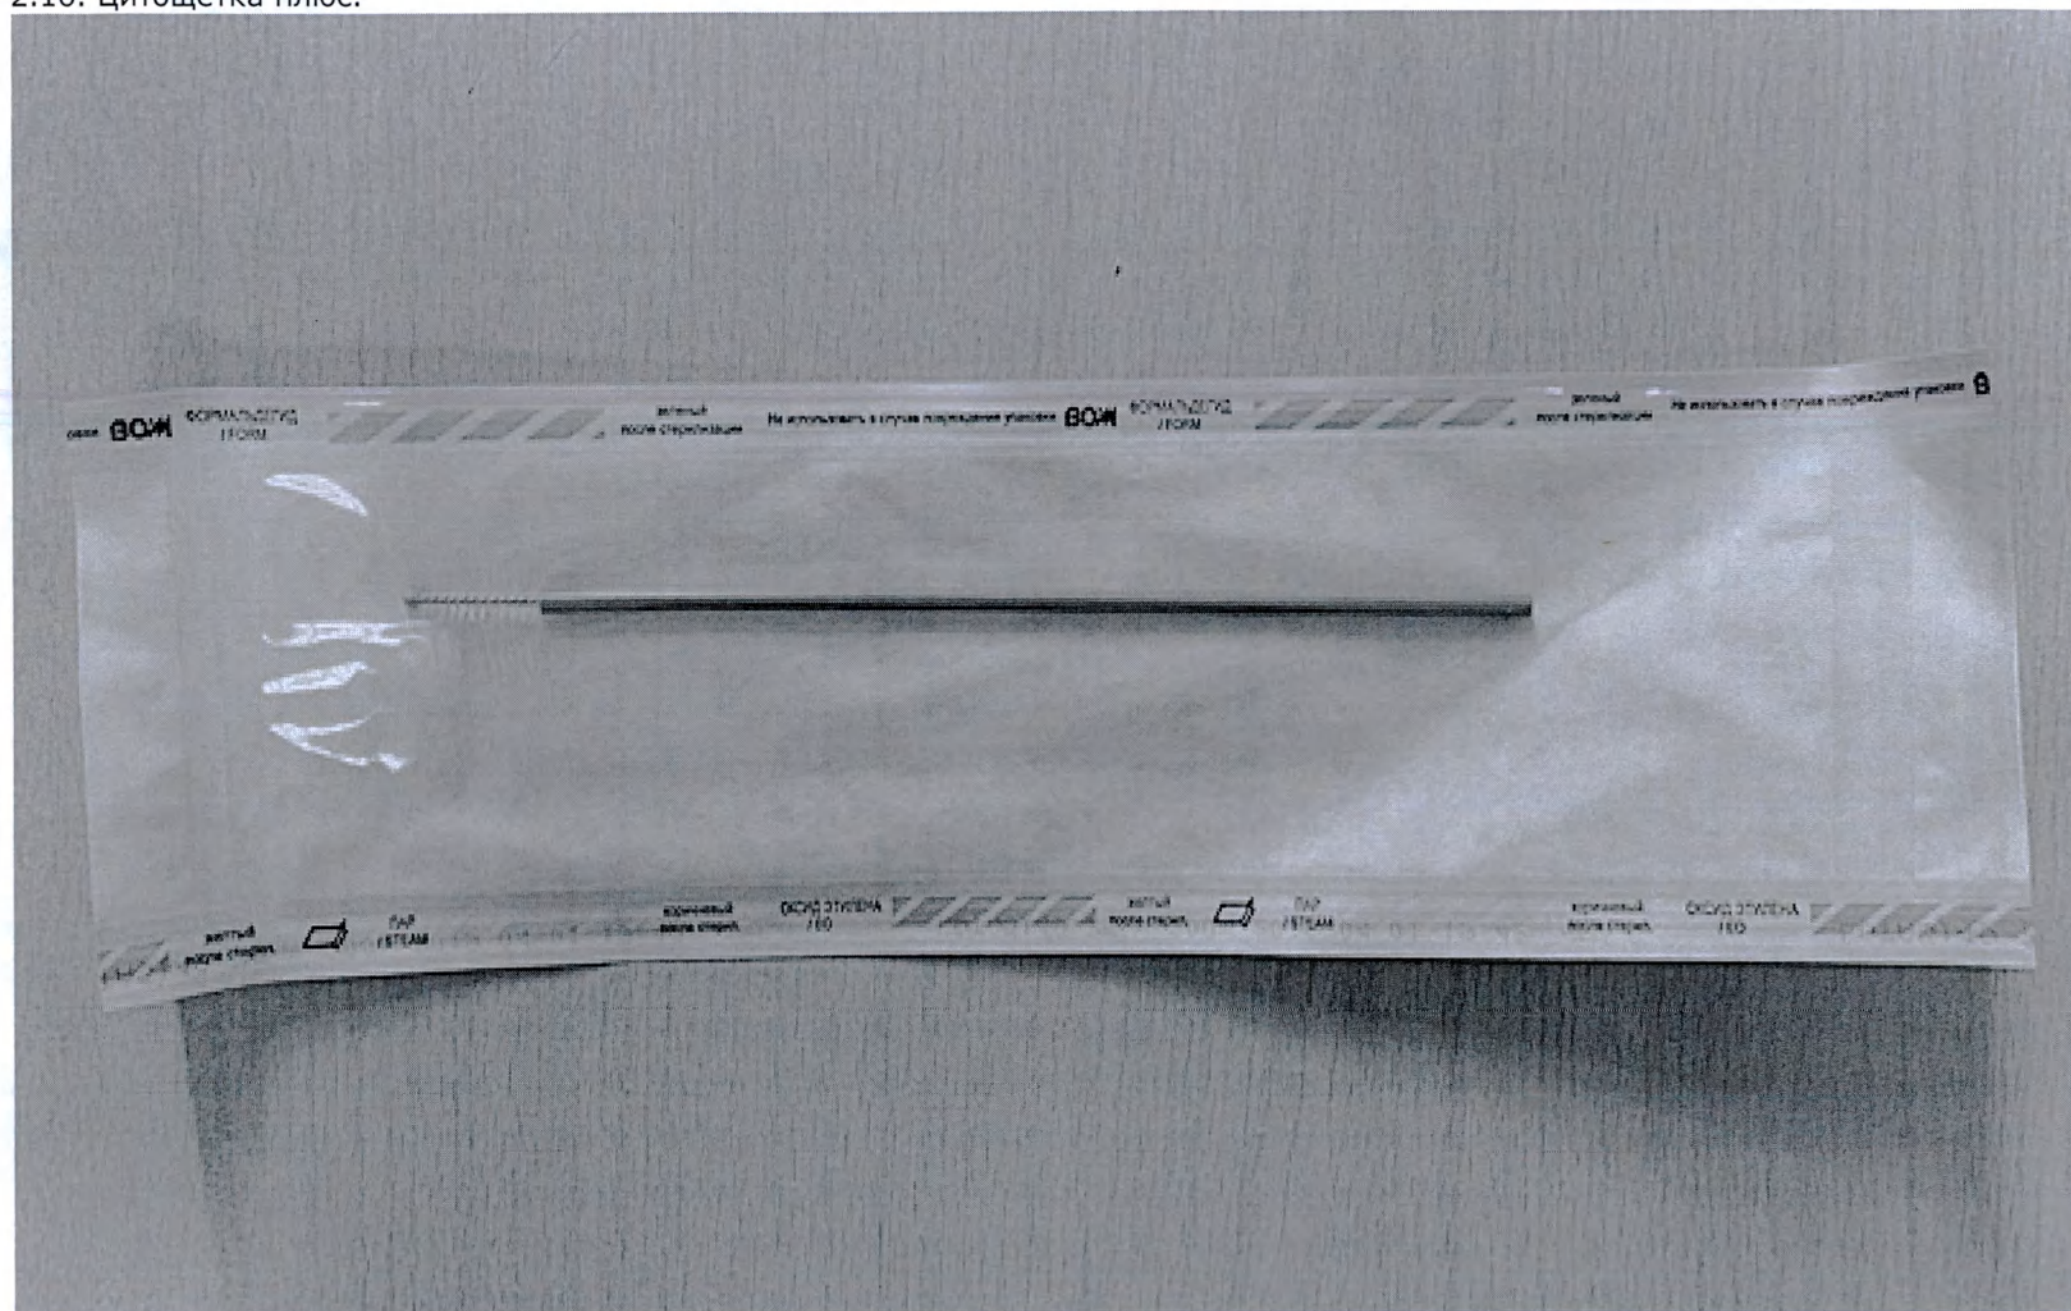


2.17. Цитощетка со шпателем.

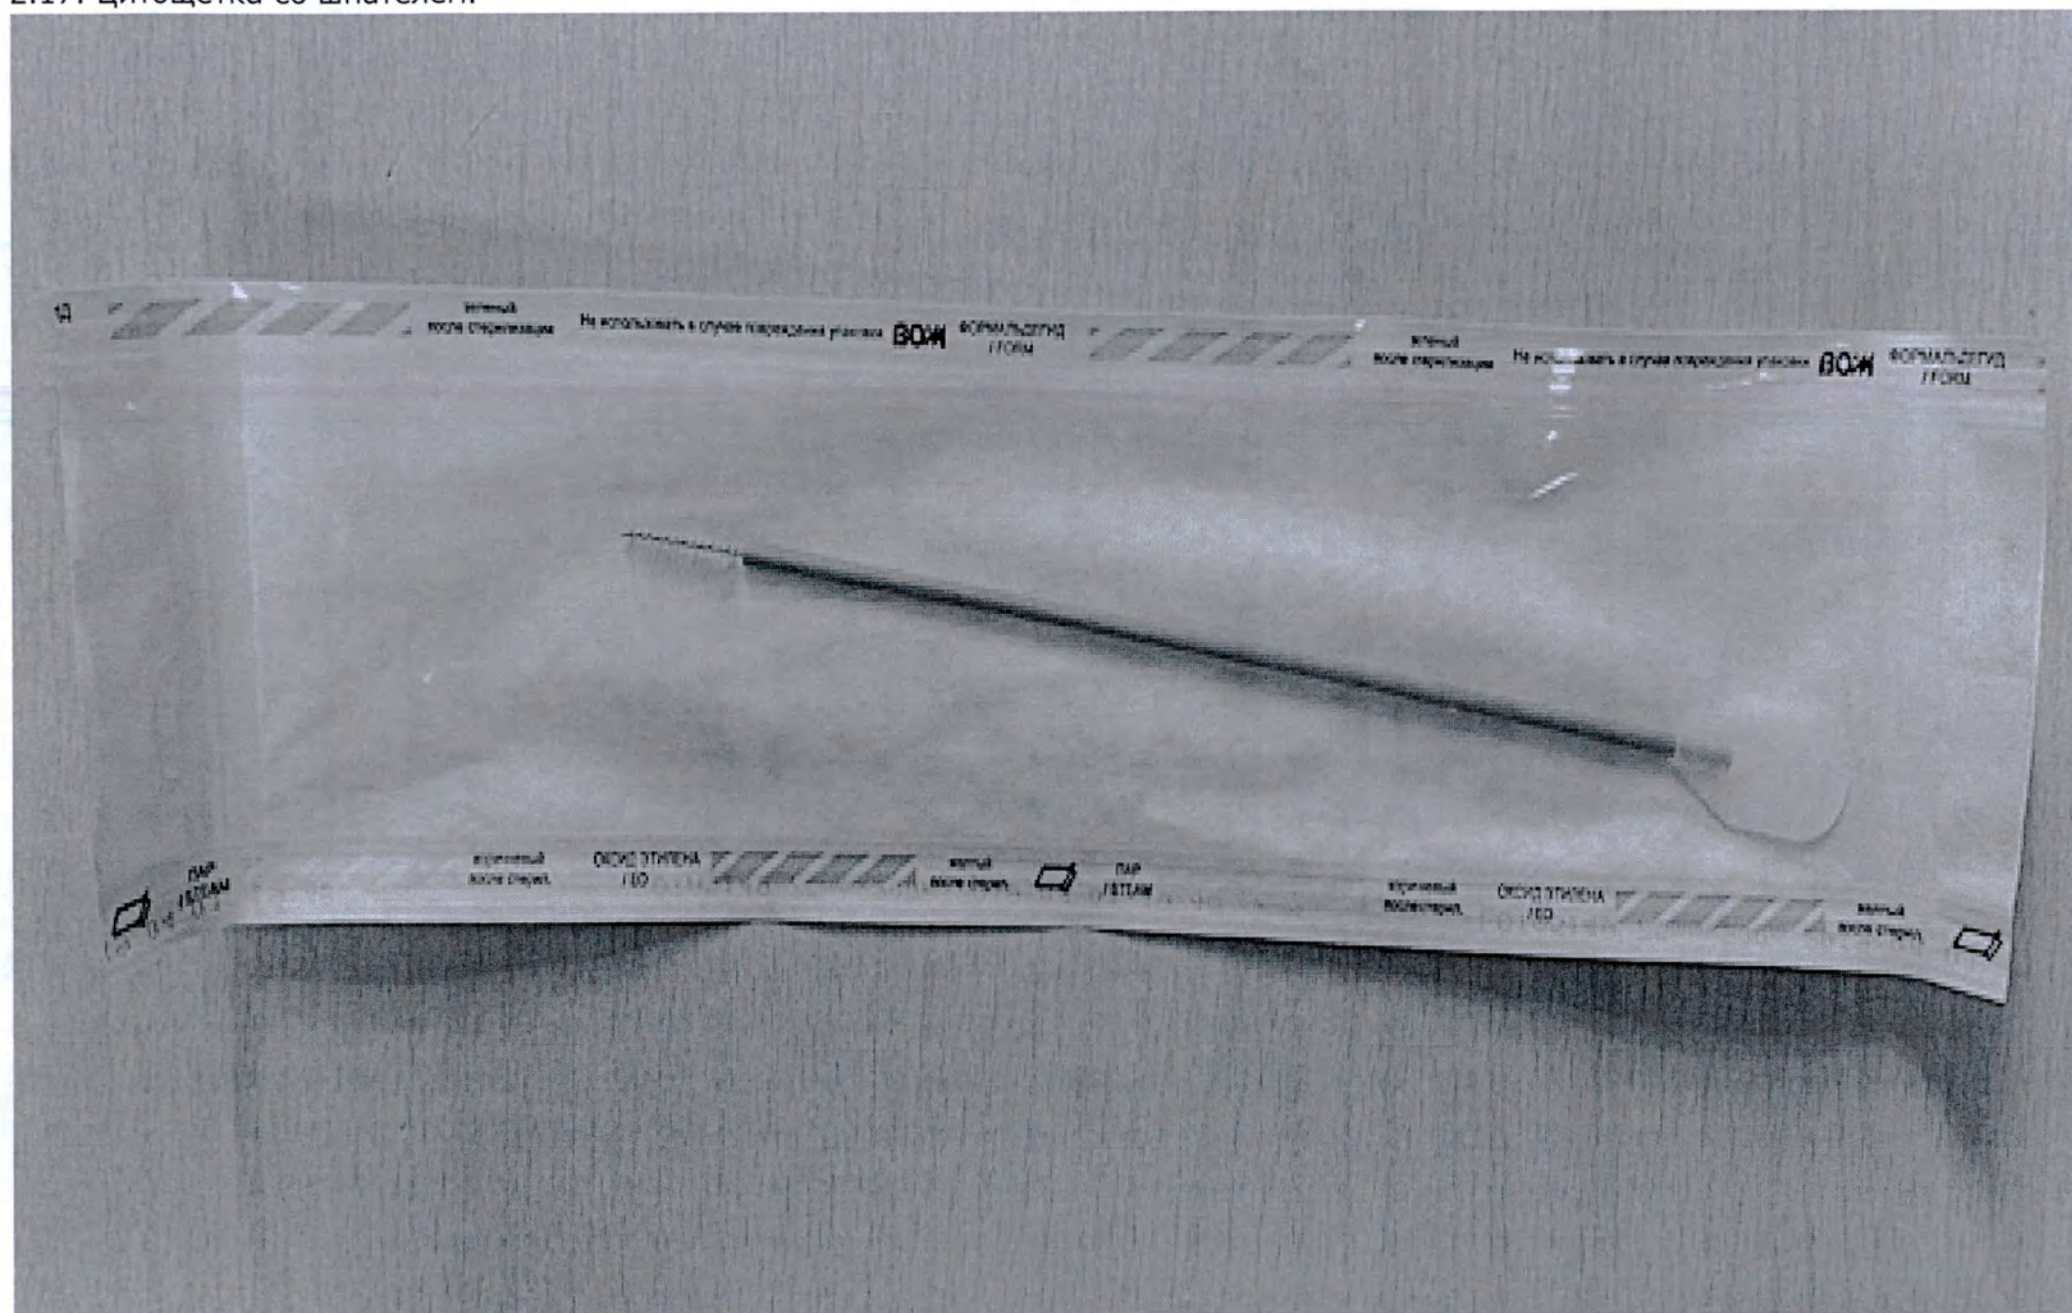


2.18. Цитошетка с тампоном.

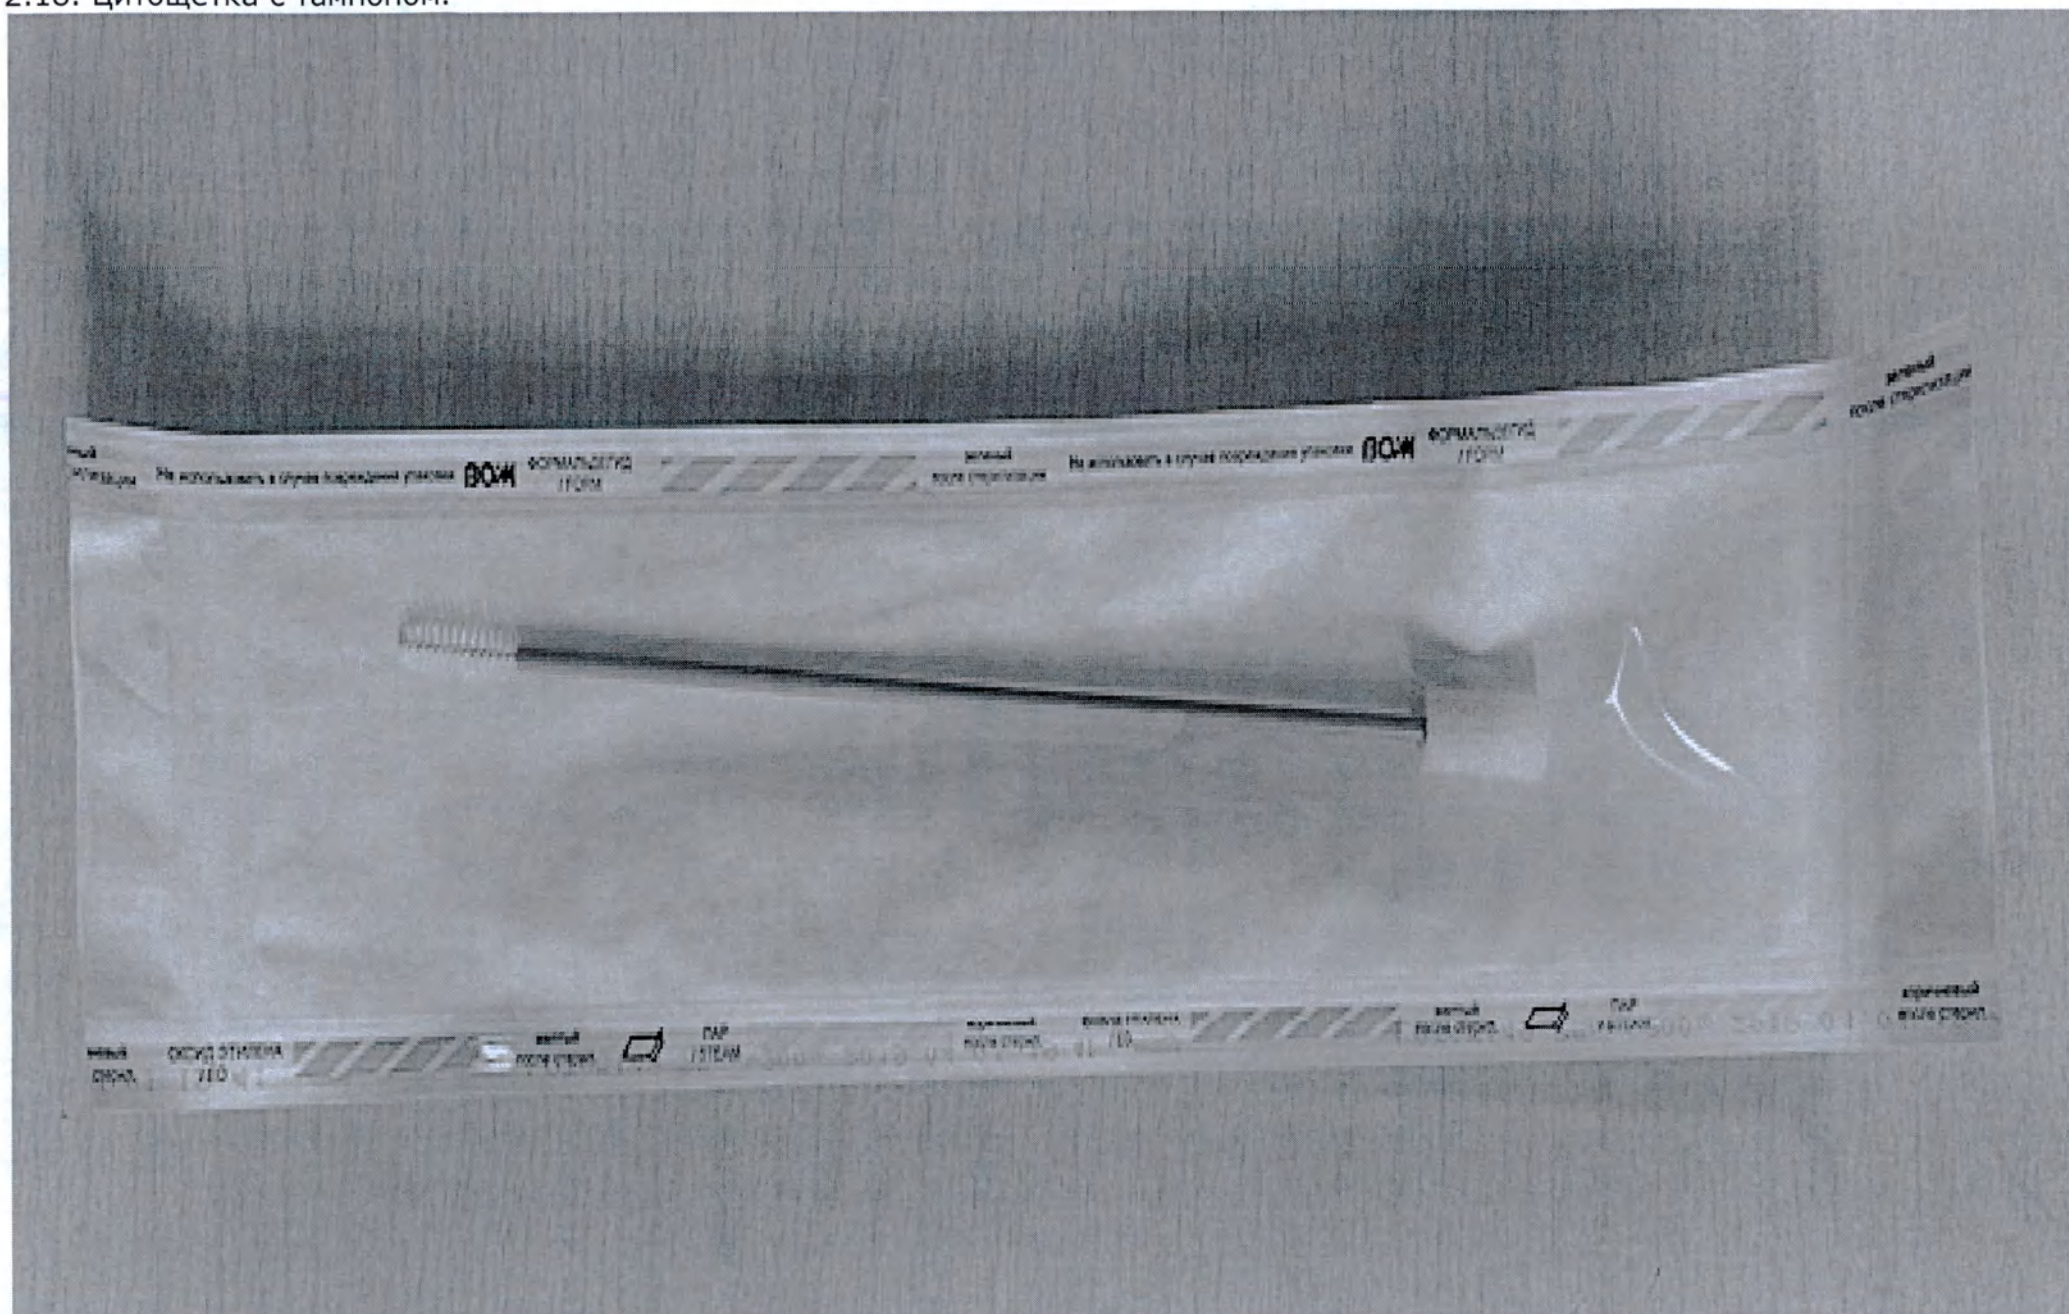


2.19. Цервикальная щетка.

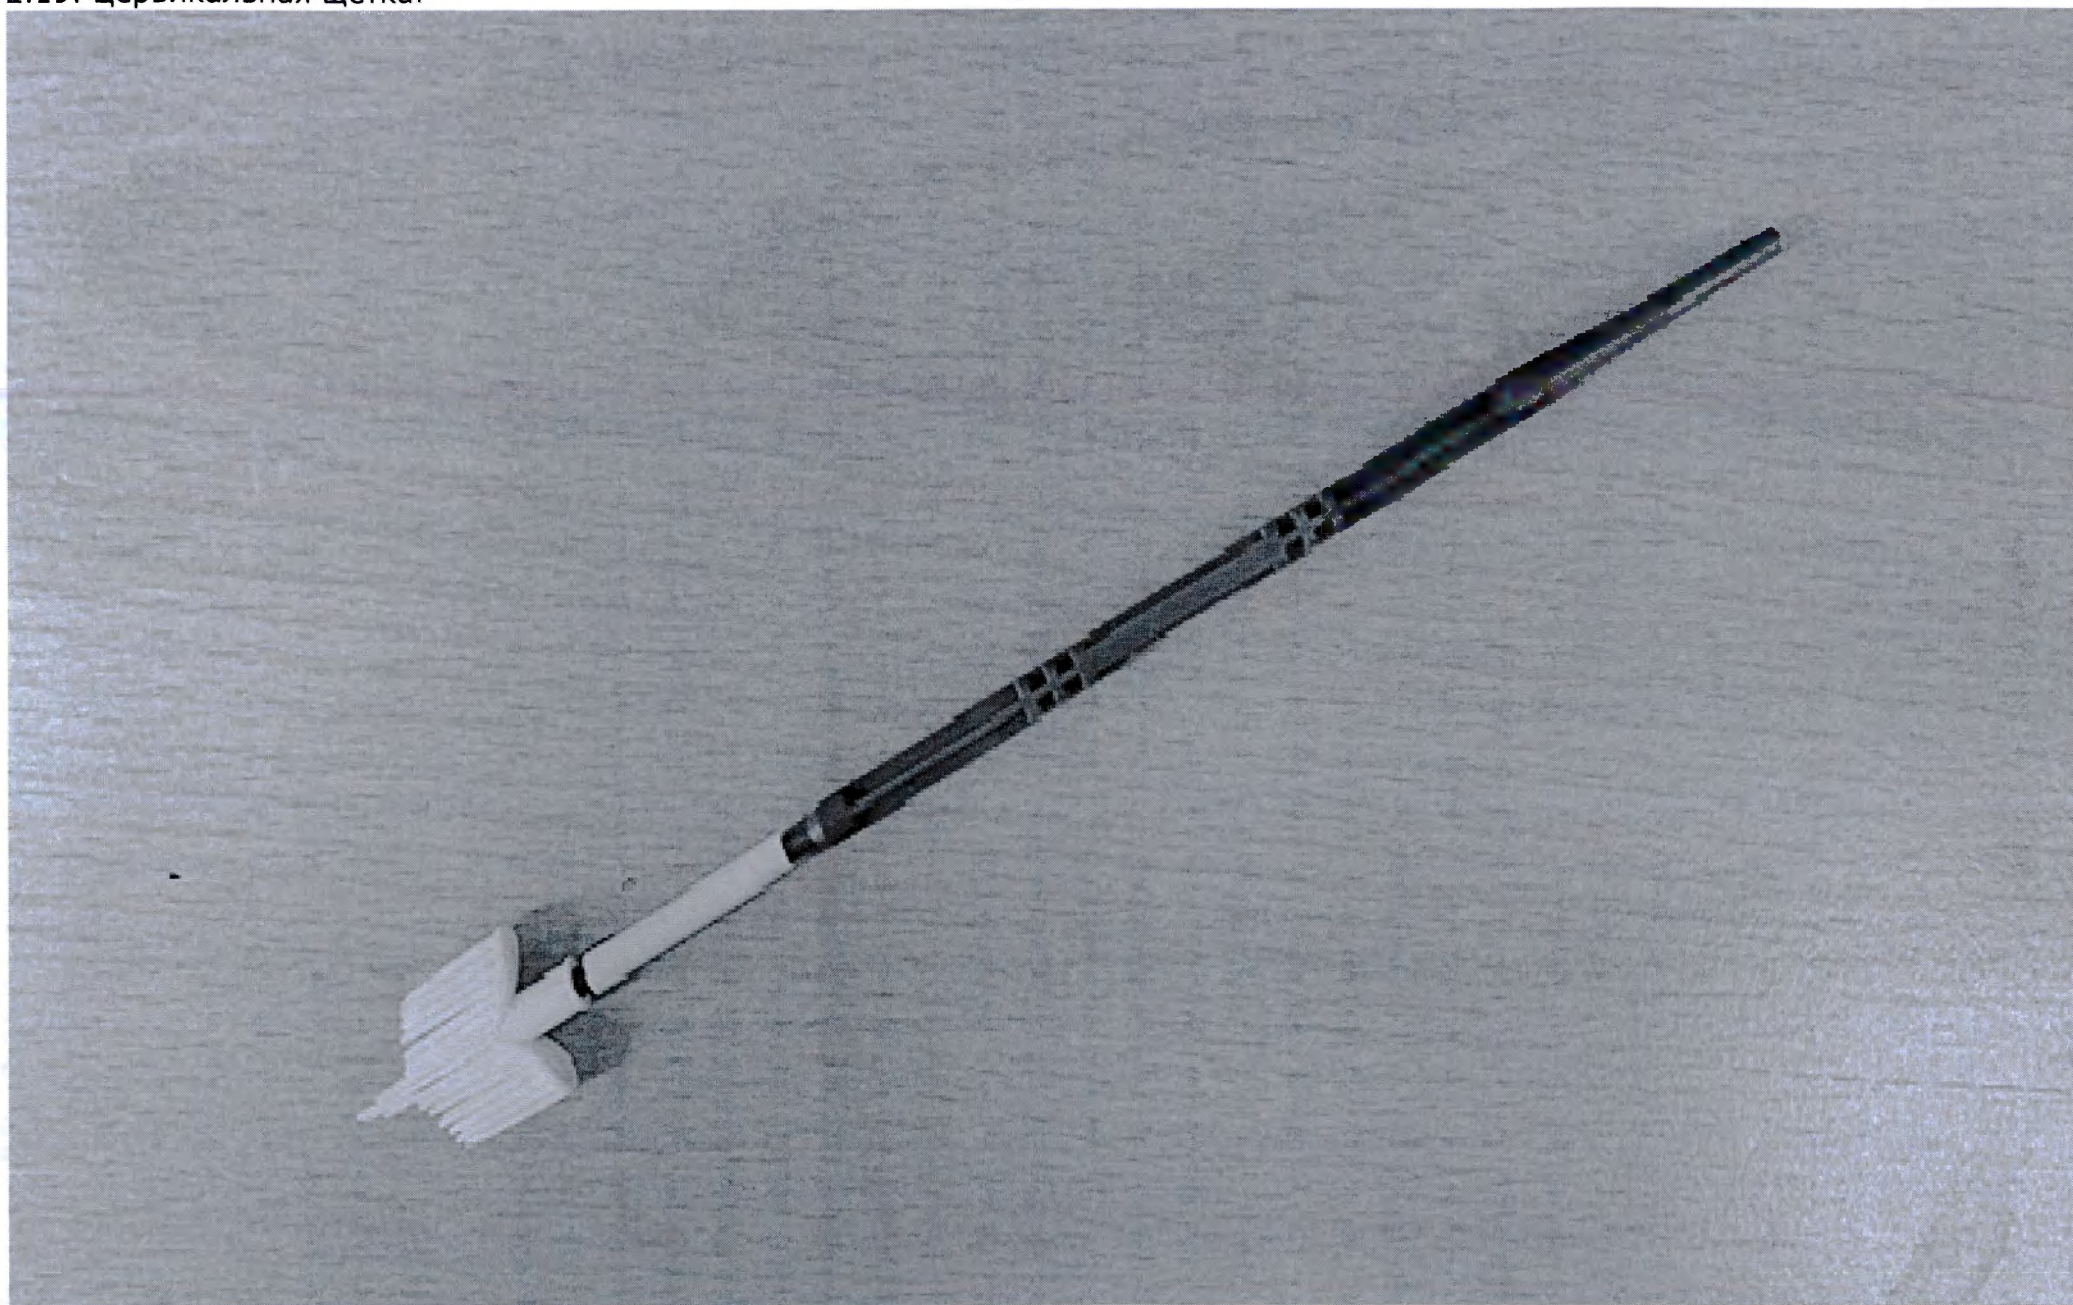


2.20. Зонд урогенитальный.

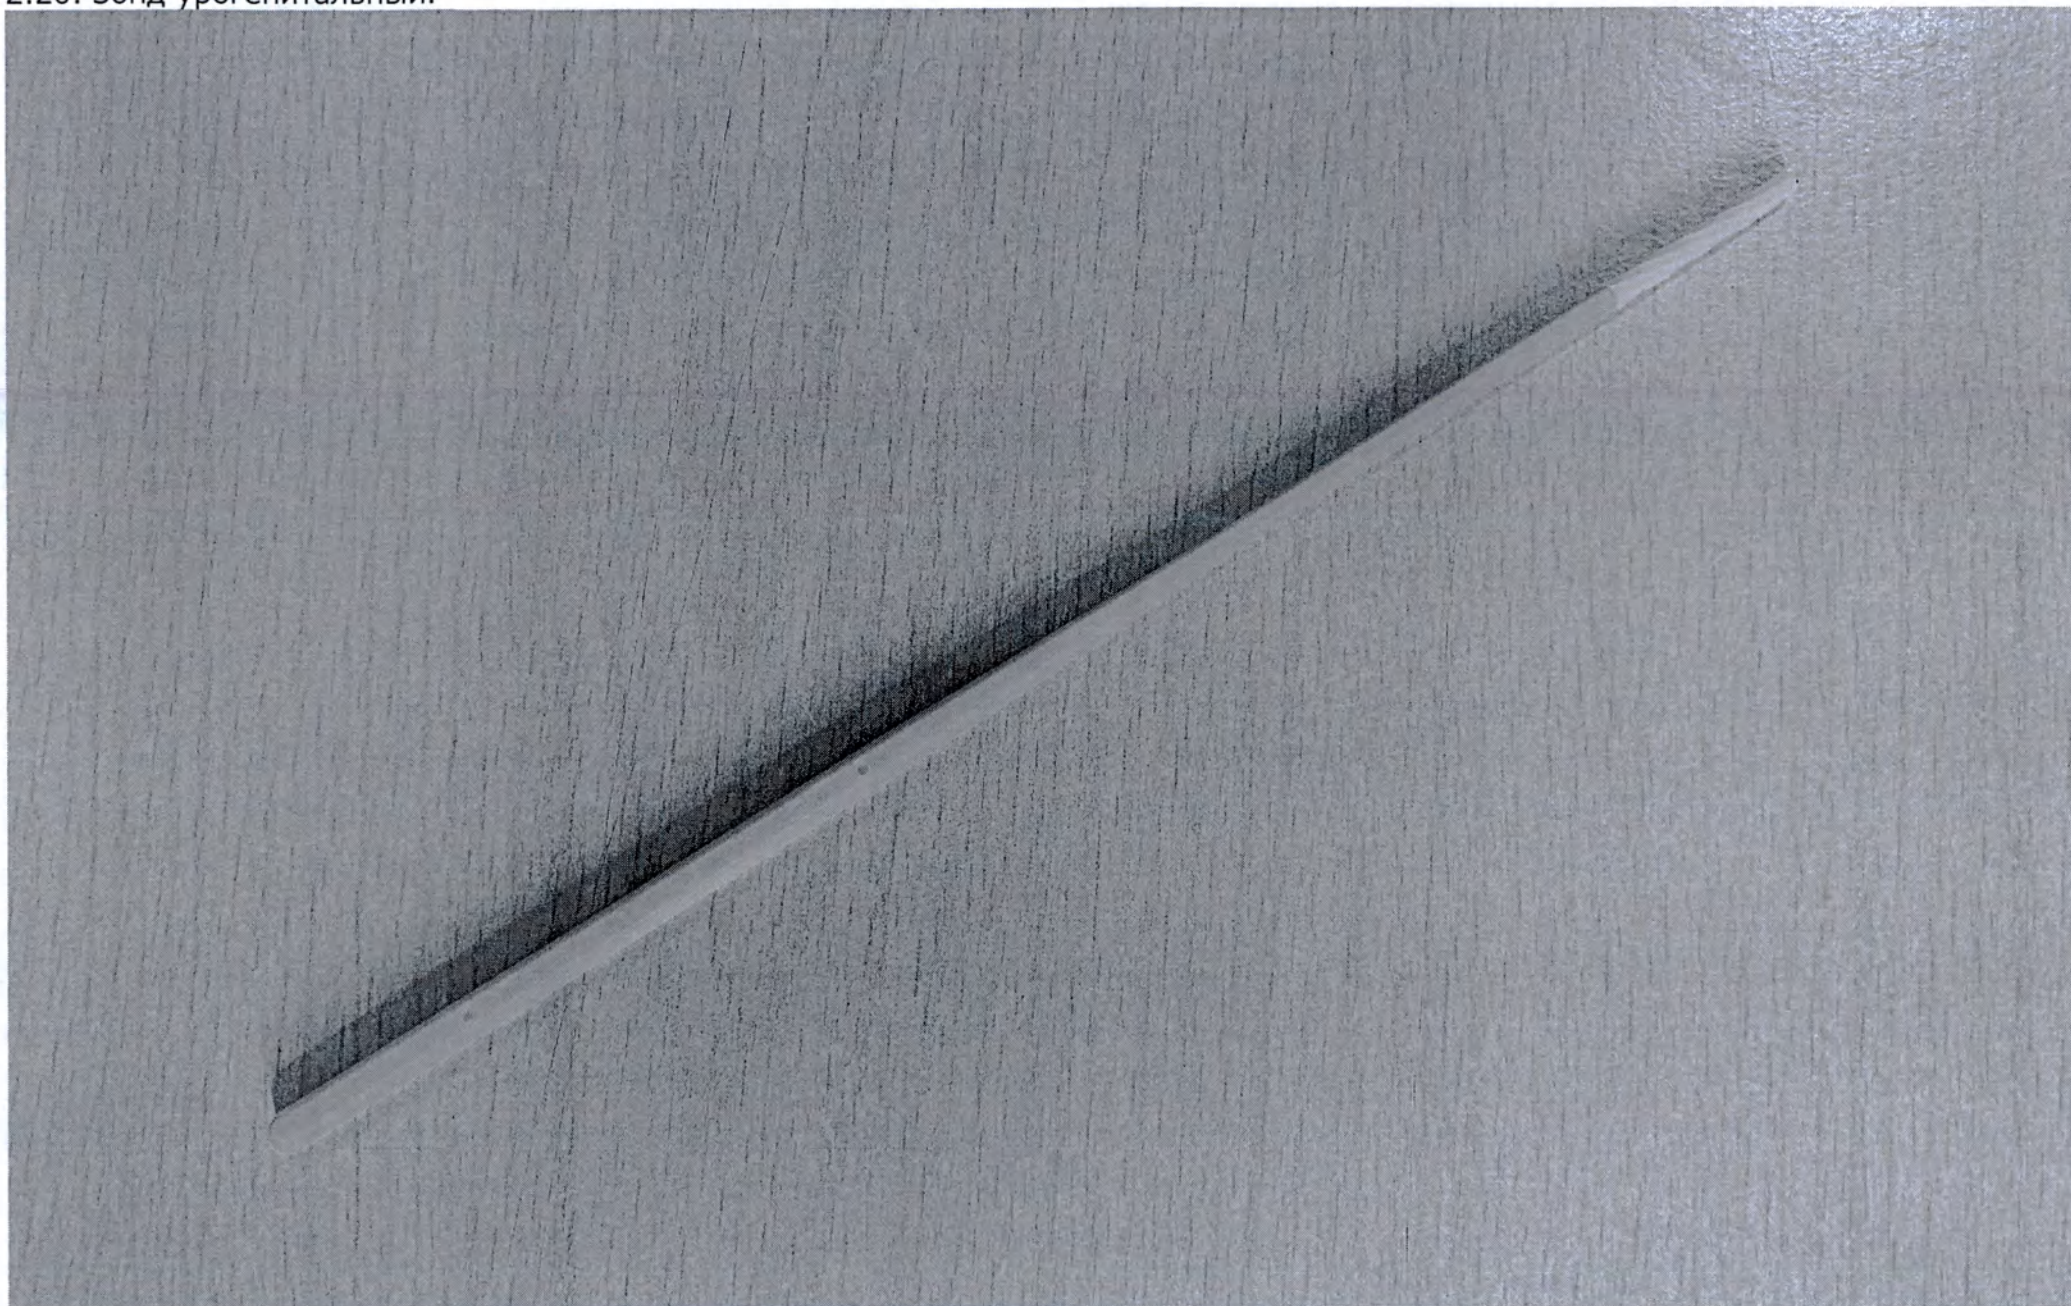


2.21. Зонд аспирационный Classic.

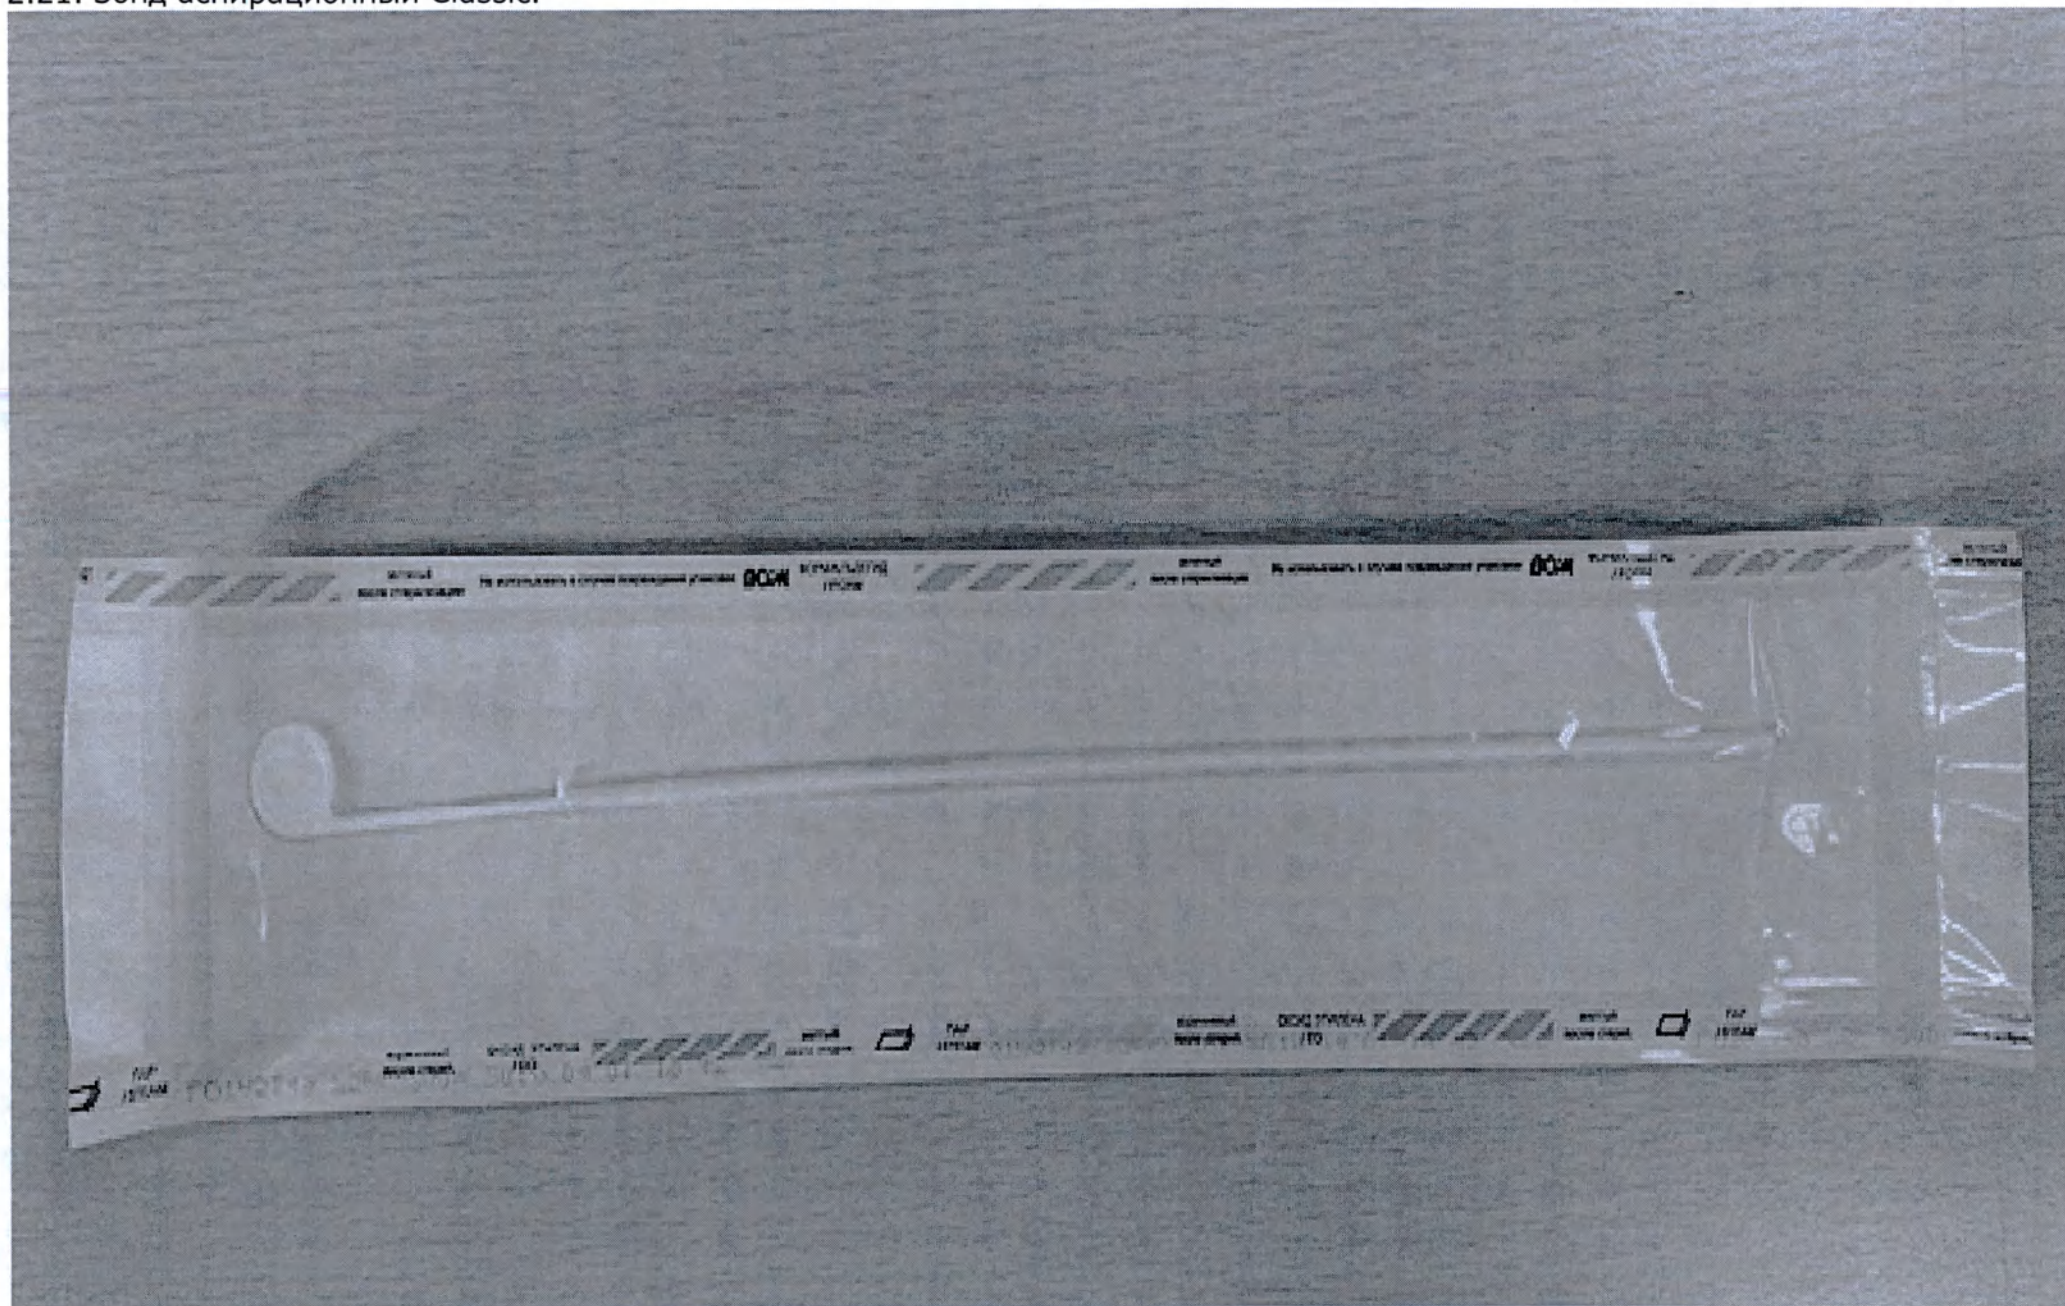


2.22. Зонд аспирационный Profi.

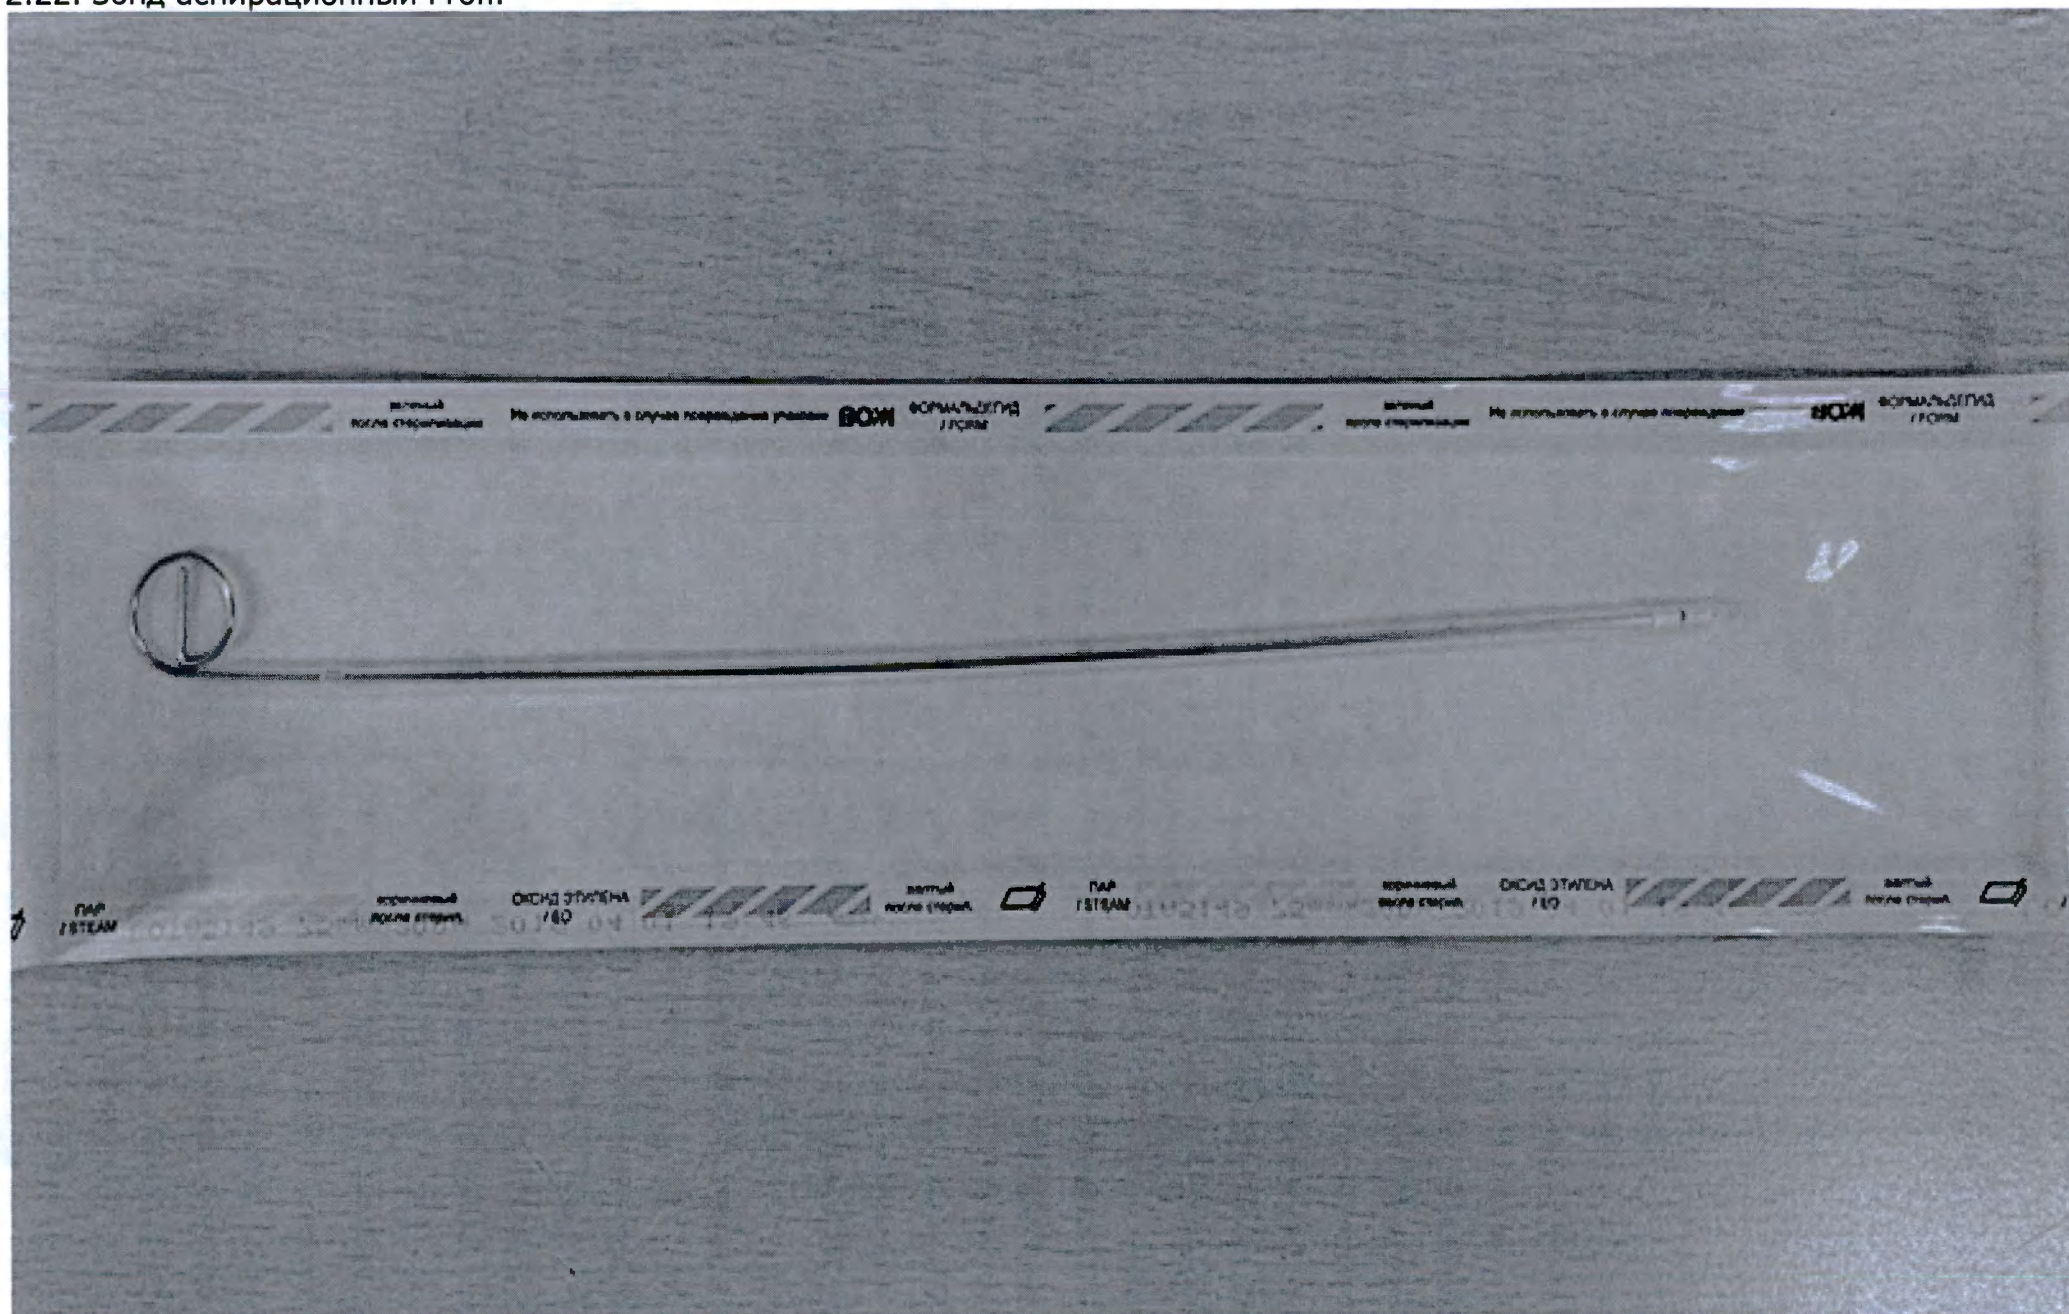

2.23. Пинцет пластмассовый одноразовый.

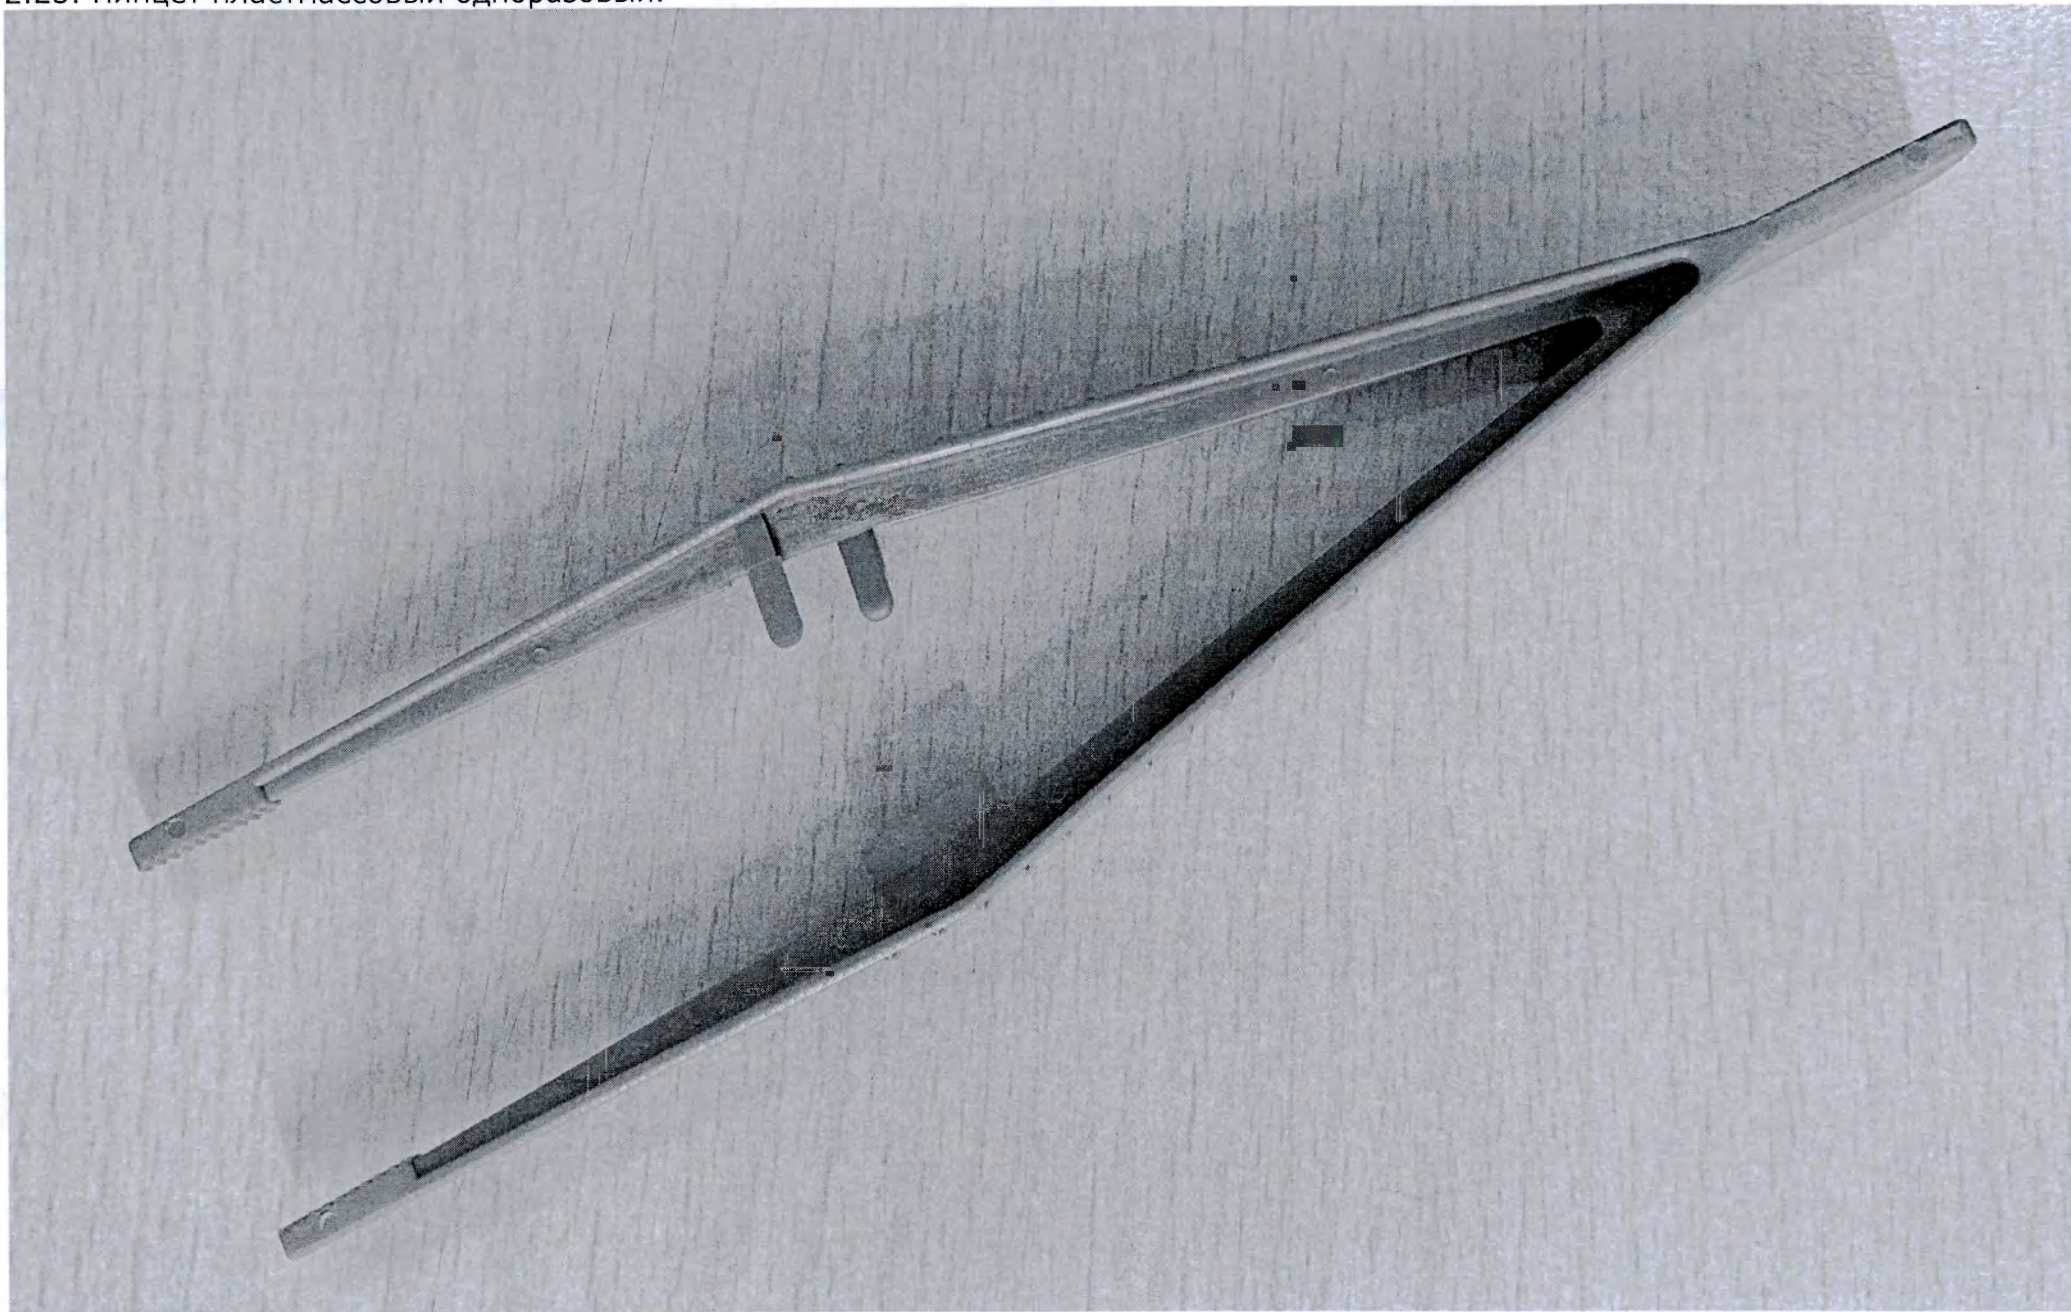


2.24. Шапочка типа «Берет».

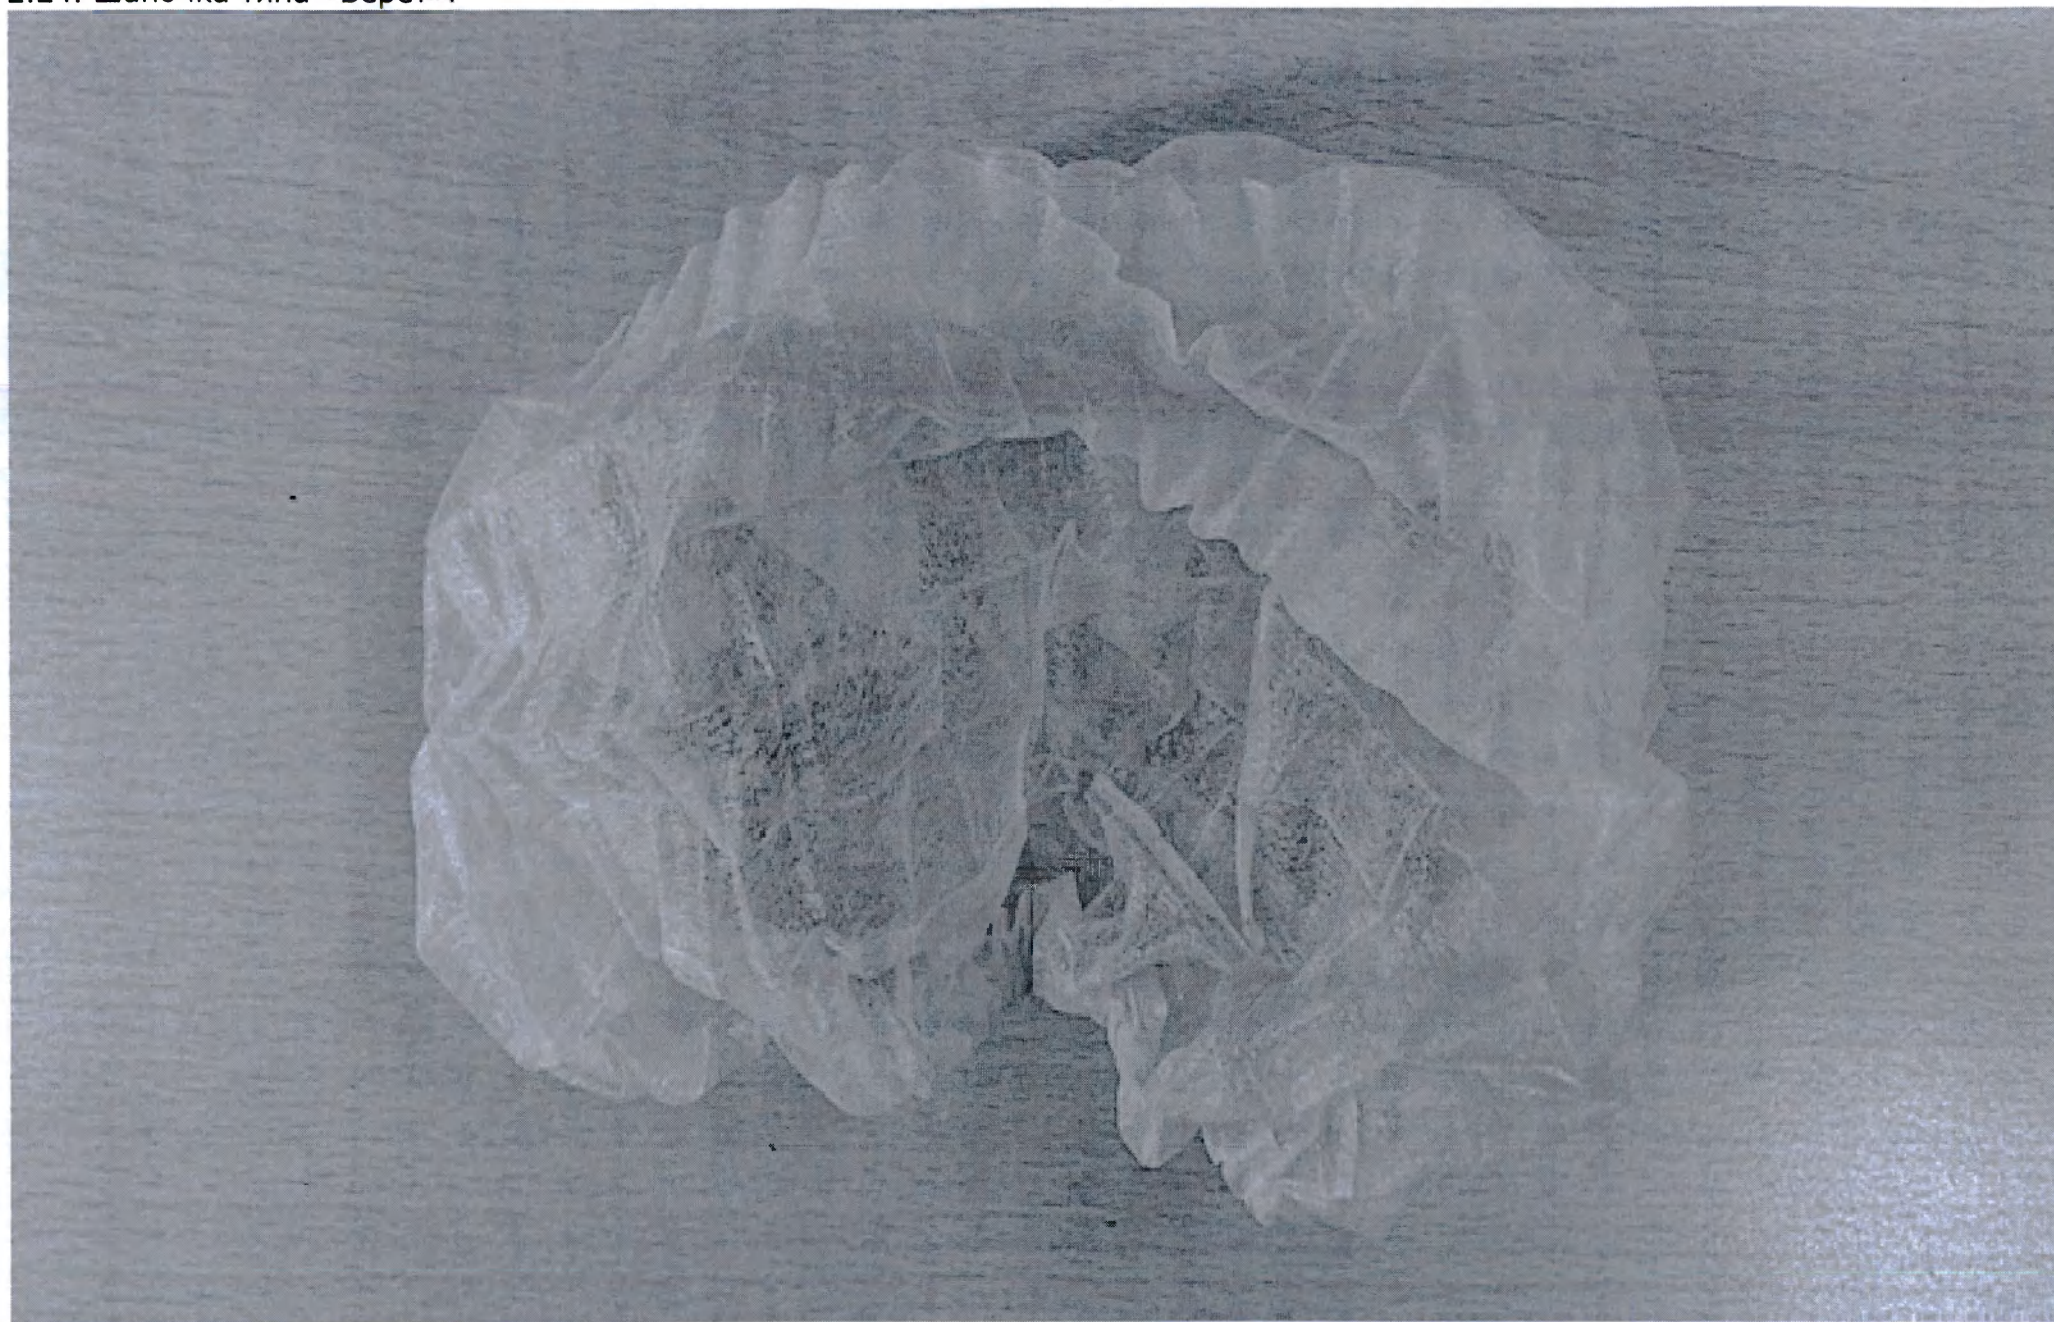


2.25. Палочка для взятия мазка с пробиркой.




2.26. Палочка для взятия мазка хлопковая.

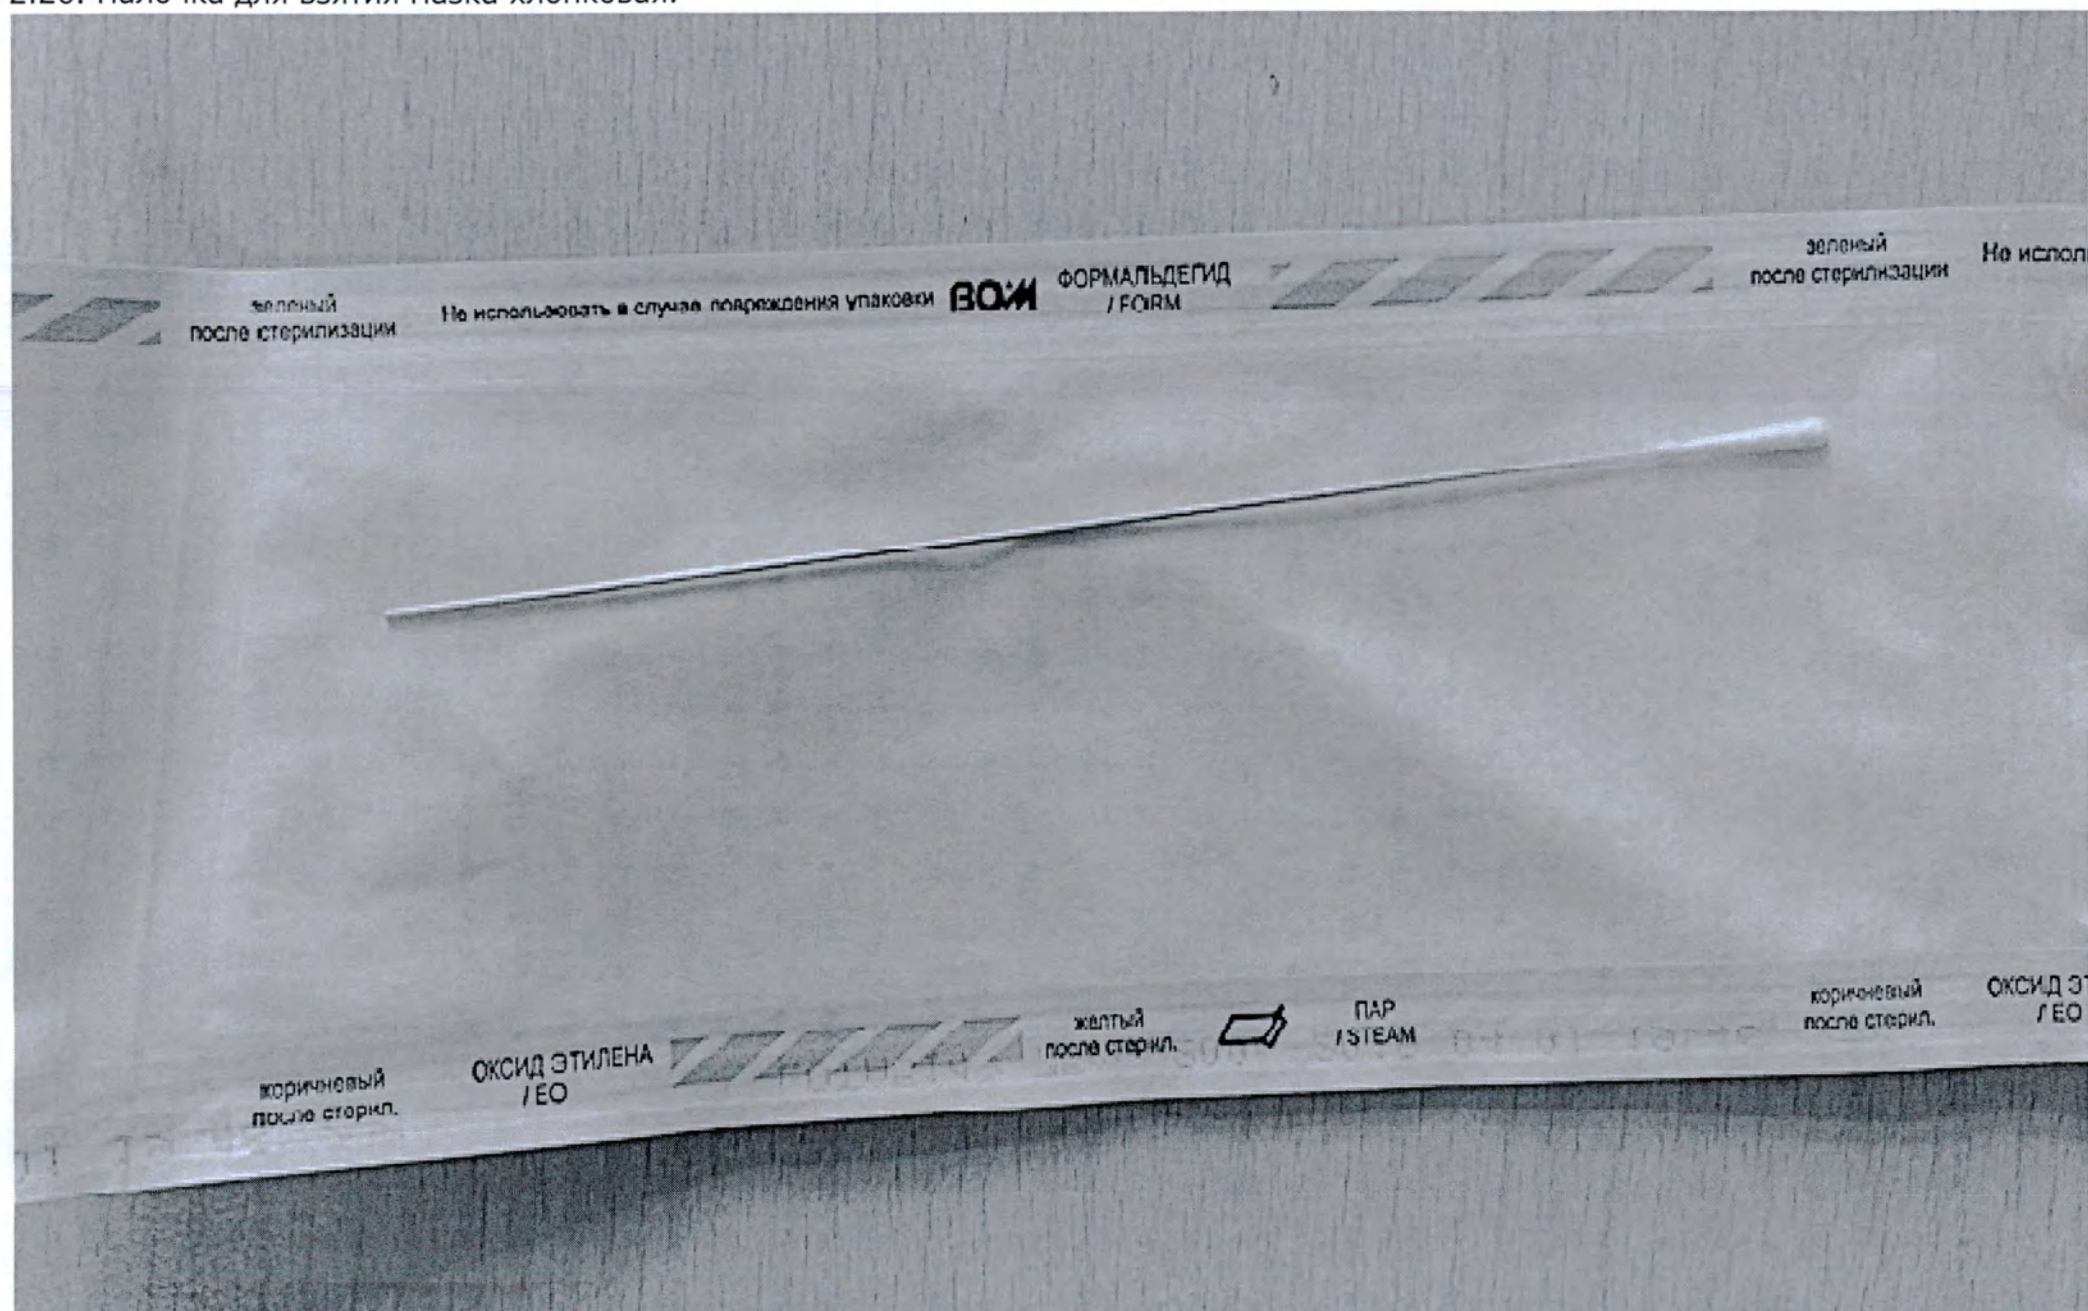

2.27. Палочка для взятия мазка вискозная.

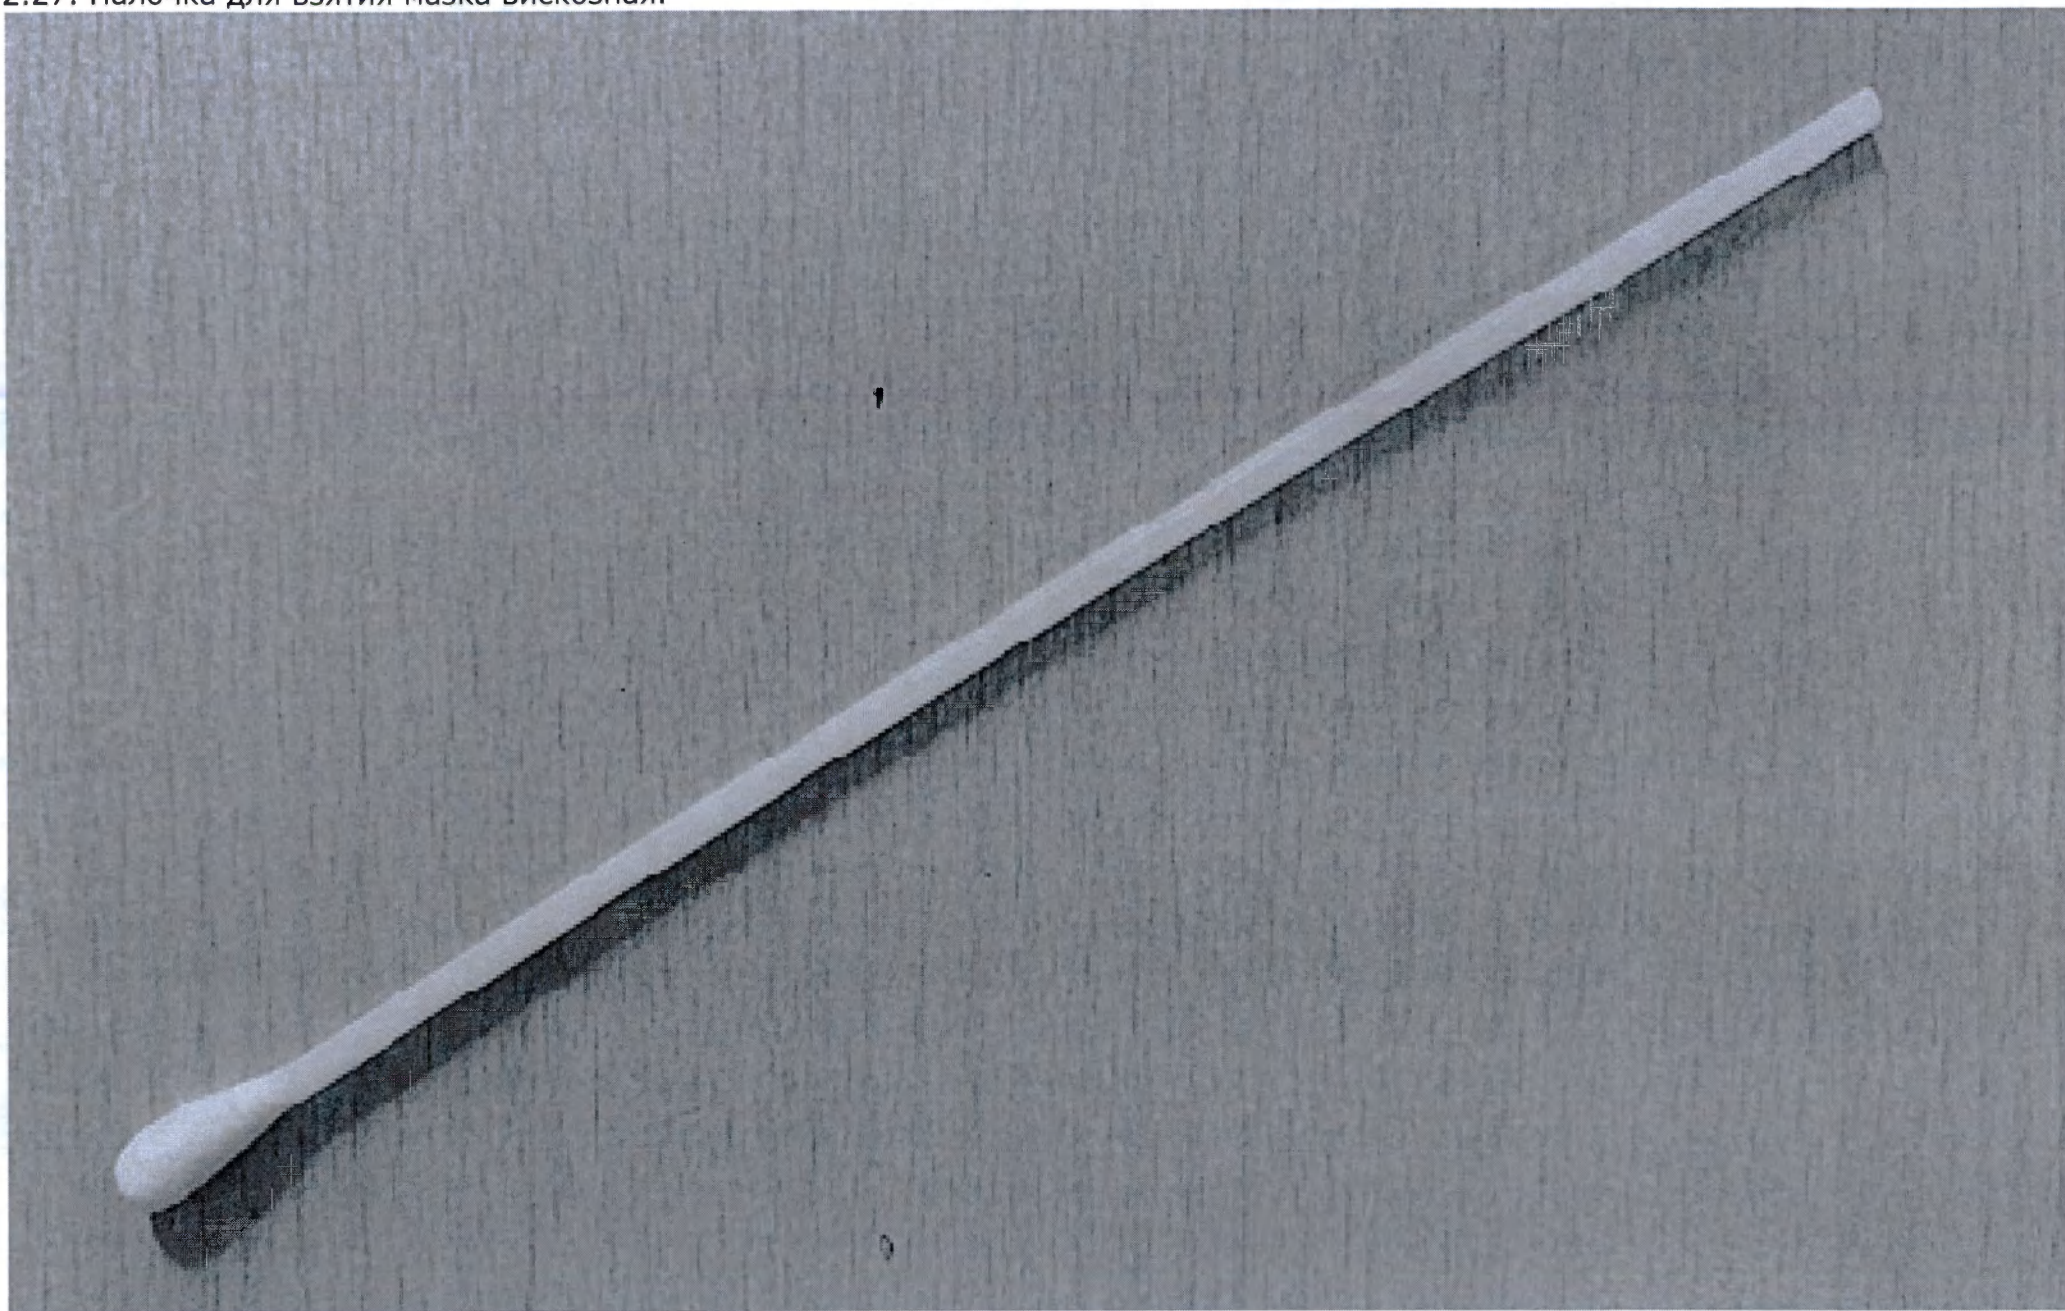


2.28. Зеркало гинекологическое.

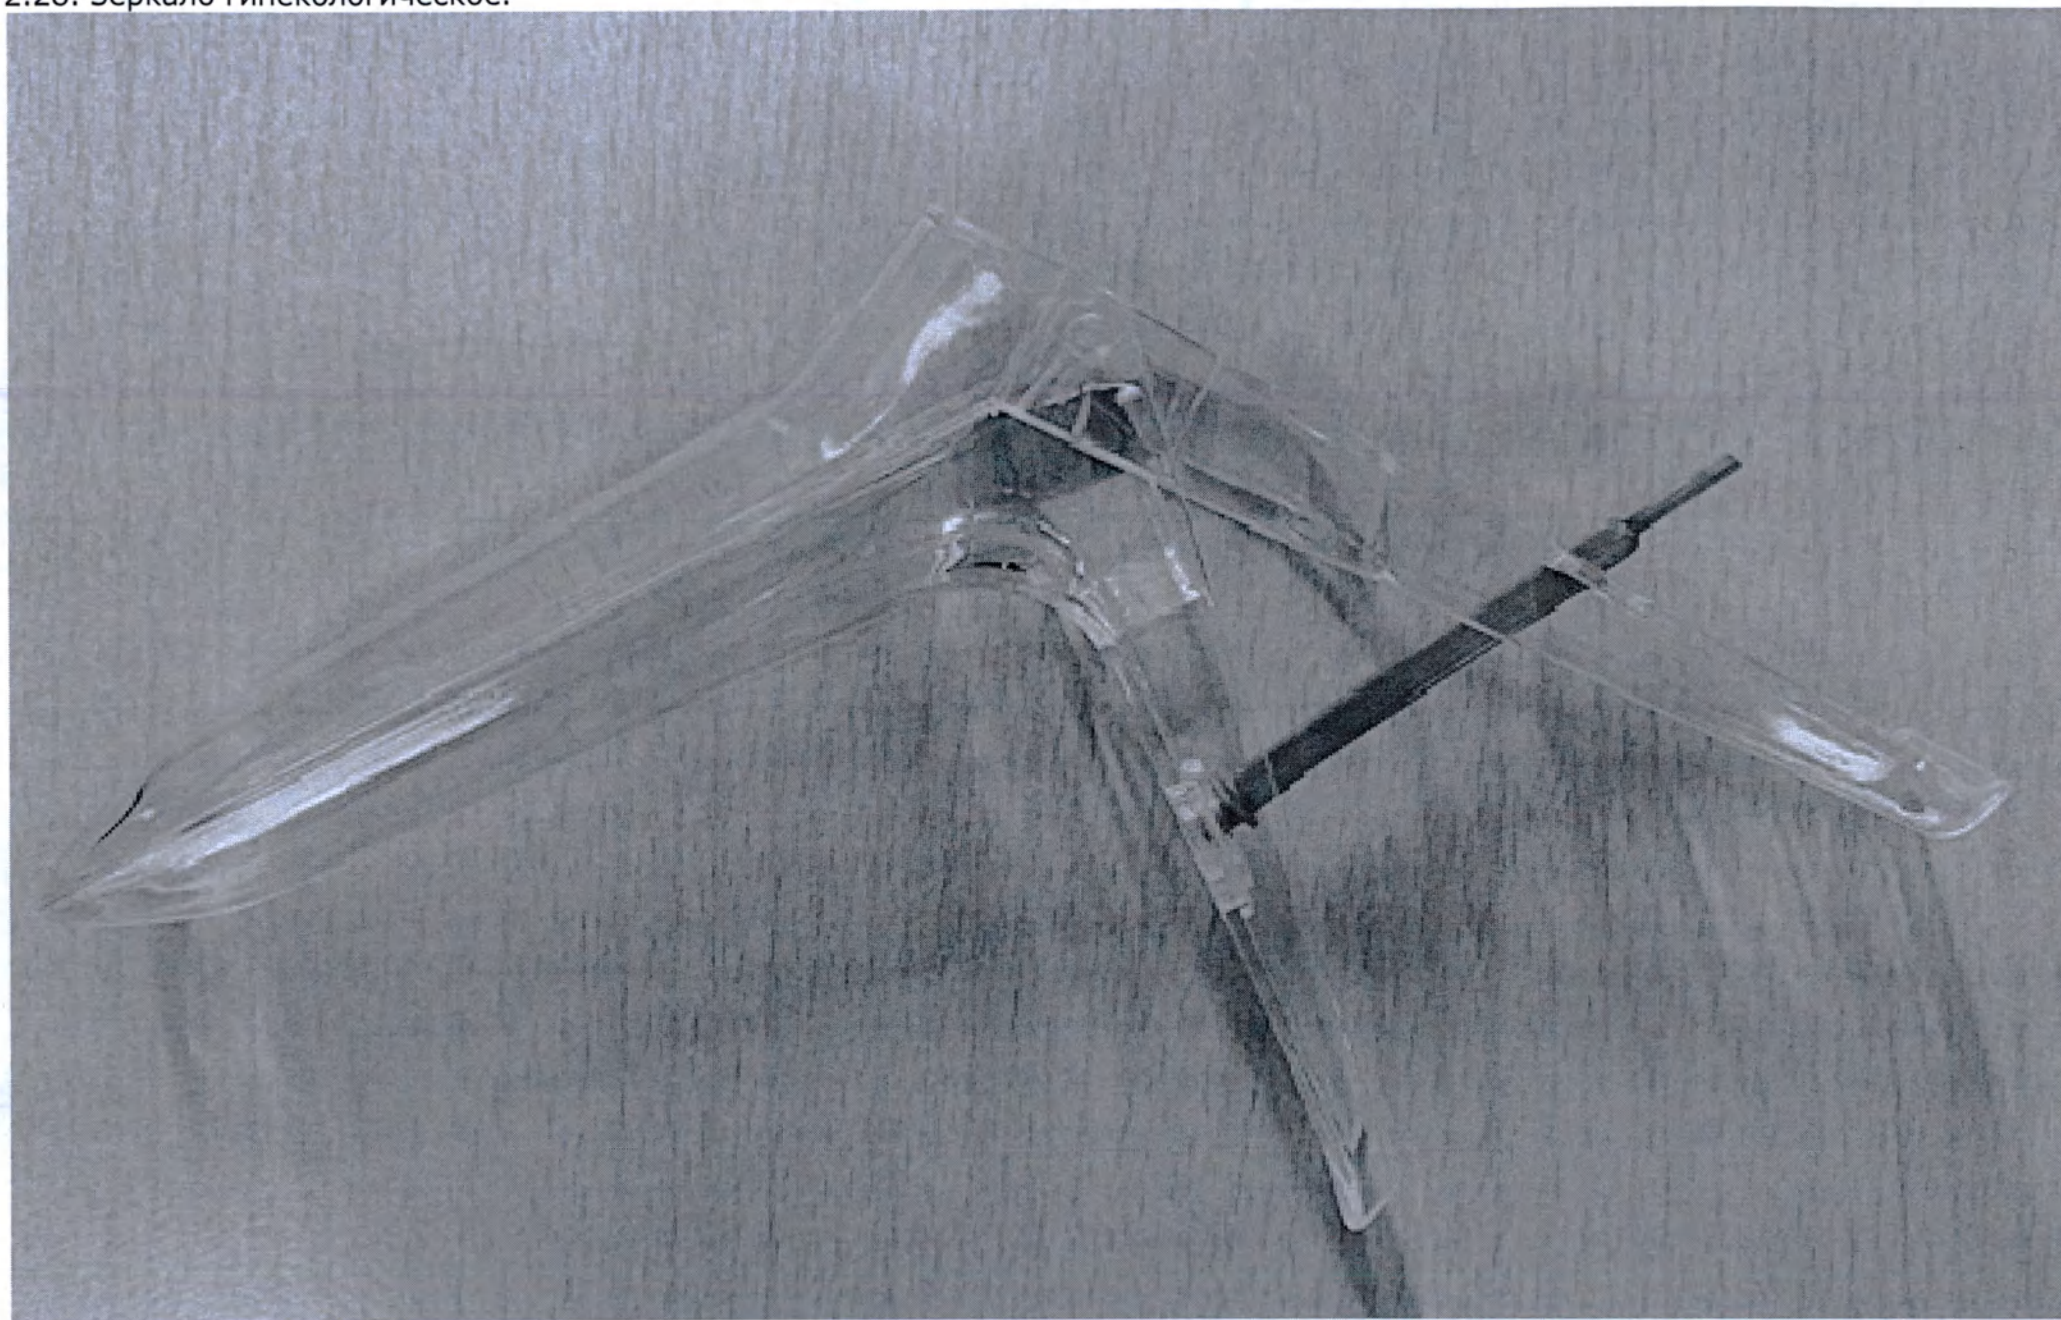

2.29. Стекло предметное.



2.30. Тупферы из марлевых отрезов (формы: шарик, треугольник, усик).

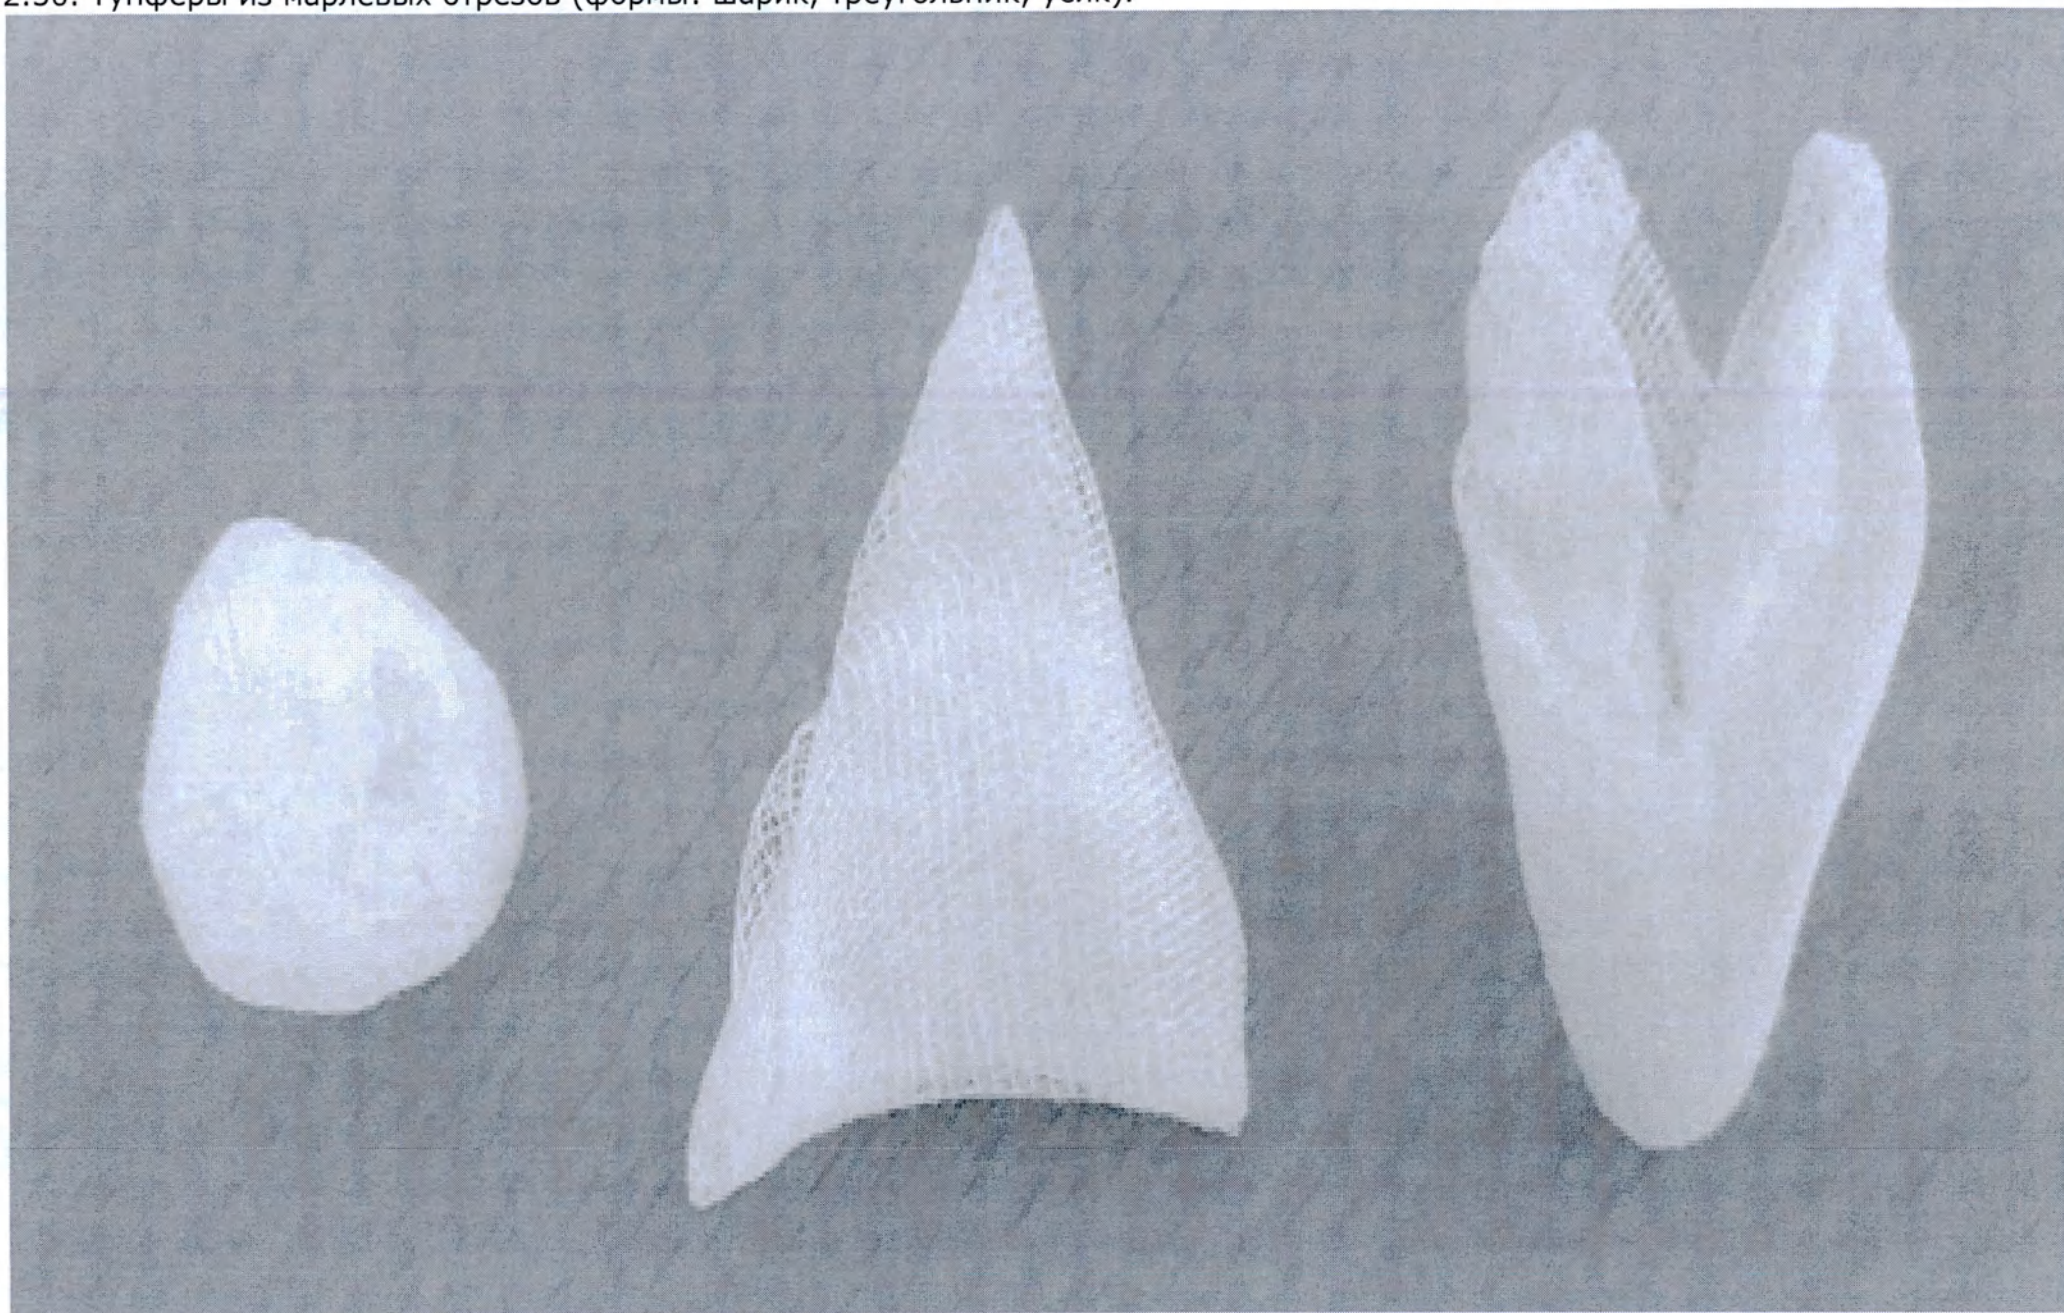

3. Общий вид Набора гинекологического процедурного, стерильного под товарным знаком matorpat по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019 в потребительской упаковке (упаковка «ВОМ»: бумажно-пленочный пакет) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.



LOT43049 280x450 2019 01 21 10:48

Набор гинекологических инструментов СТЕРИЛЬНЫЙ ПОЛ.
товарный знак и патент по ТУ 32.50.13-087-11730-425-2019,
Набор № 24.

Набор предназначен для использования во время проведения
гинекологических процедур.

Состав

- 5 шт. Туберкули из магнитных отрезков, форма шпателя Телес Телес
- 1 шт. Пинцет Stern Soft, длина 10 см
- 1 шт. Миска
- 1 шт. Лоток пластиковый крытый, 250 мл
- 1 шт. Лоток пластиковый открытый, 125 мл
- 1 шт. Стержень атриал, 50 см
- 2 шт. Перчатки слоистые нитриловые XS
- 2 шт. Перчатки слоистые латексные XS
- 2 шт. Бакли на резинке
- 1 шт. Зажим Кордана 190 мм
- 1 шт. Стержень Металлический 90x400мм 40хх2
- 1 шт. Цитощетка
- 1 шт. Лопка фольгированная
- 1 шт. Цитотель Эвора
- 1 шт. Цитотель инов
- 1 шт. Цитотель со шпатель
- 1 шт. Цитотель с тампоном
- 1 шт. Цитотельная чашка
- 1 шт. Зонд урогинецальный
- 1 шт. Зонд аспирационный Classic
- 1 шт. Зонд аспирационный Pili
- 1 шт. Шпатель типа "Берет"
- 1 шт. Пинцет для вагина вода с пробиркой
- 1 шт. Пинцет для вагина вода кюльон
- 1 шт. Пинцет для вагина вода кюльон
- 1 шт. Стержень пинцетный
- 1 шт. Пинцет пинцетный
- 1 шт. Пинцет пинцетный

Средой применения, включая все инструменты, является вагина, матка, шейка матки.

После применения по окончании процедуры инструменты должны быть стерилизованы в течение 10 минут в автоклаве при температуре 121°C.

Данный набор предназначен для использования в гинекологии.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.


Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.

Не использовать для других целей.



010000000000000000000000



STERILE EO

Lot RU 20200214
Дата стерилизации: 02/2020
2025/01



Производитель: ООО "Берет", 140001, Московская область,
Истринский район, с/пос. Беретское, д. 10
Министерство здравоохранения РФ, Беретское, д. 10

4. Общий вид Набора гинекологического процедурного, стерильного под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019, в потребительской упаковке (упаковка «ВОМ»: неткано-пленочный пакет) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.



Набор гинекологический процедурный, СТЕРИЛЬНЫЙ под
товарным знаком malopal® по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019,
Набор № 24.



Набор предназначен для использования во время проведения
гинекологических процедур.

Состав:


- 5 шт. Тупферы из марлевых отрезков: форма шарика 15смх15см
- 1 шт. Пеленка: Seni Soft: 40смх60см
- 1 шт. Маска
- 1 шт. Лоток пластиковый крутой: 250 мл
- 1 шт. Лоток пластиковый прямоугольный: 125 мл
- 1 шт. Стаканчик мерный: 50мл
- 2 шт. Перчатки смотровые нитриловые: XS
- 2 шт. Перчатки смотровые латексные: XS
- 2 шт. Бахилы на резинке
- 2 шт. Бахилы нетканые высокие
- 1 шт. Зажим Корданти: 190 мм
- 1 шт. Салфетка медицинская: 25смх22см, 35г/м2
- 1 шт. Цитощетка
- 1 шт. Лоска Фолькмана
- 1 шт. Шпатель Эйлера
- 1 шт. Цитощетка плюс
- 1 шт. Цитощетка со шпателем
- 1 шт. Цитощетка с тампоном
- 1 шт. Цервикальная щетка
- 1 шт. Зонд урогенитальный
- 1 шт. Зонд аспирационный Classic
- 1 шт. Зонд аспирационный Profi
- 1 шт. Зонд аспирационный Classic Combi
- 1 шт. Шалочка типа "Берет"
- 1 шт. Палочка для взятия мазка с пробиркой
- 1 шт. Палочка для взятия мазка хлопковая
- 1 шт. Палочка для взятия мазка вязкозная
- 1 шт. Стекла предметные
- 1 шт. Зеркало гинекологическое: S
- 1 шт. Пинцет пластиковый одноразовый: 125 мм

LOT/RU 20200213

Дата стерилизации:
02/2020

2025/01

STERILE EO




Способ применения: Плавным движением вскрыть упаковку, извлечь содержимое упаковки,
использовать содержимое по прямому назначению в том порядке, в котором это необходимо.
После использования по назначению – утилизировать.
Предупреждения: индивидуальная переносимость материалов,
на которых изготовлены составляющие Изделия.
Изделие нестерильно внутри.
Не использовать при поврежденной упаковке.
Не использовать после окончания срока годности.
Утилизировать использованное Изделие как медицинские отходы
класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.
Хранить в сухом помещении.
Дата изготовления – см. LOT(итинмад).

Рег. № РЗН 00000000 от 04.04.2017

Производитель: ООО "Белла", 140301, Российская Федерация,
Московская область, с. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9


Продавец: ООО "БЕЛЛА Восток", 140301, Российская Федерация,
Московская область, с. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9



5. Общий вид Набора гинекологического процедурного, стерильного под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019, в потребительской упаковке (блистерная упаковка) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.



6. Общий вид Набора гинекологического процедурного, стерильного под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.13-067-11736425-2019, в транспортной упаковке с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.

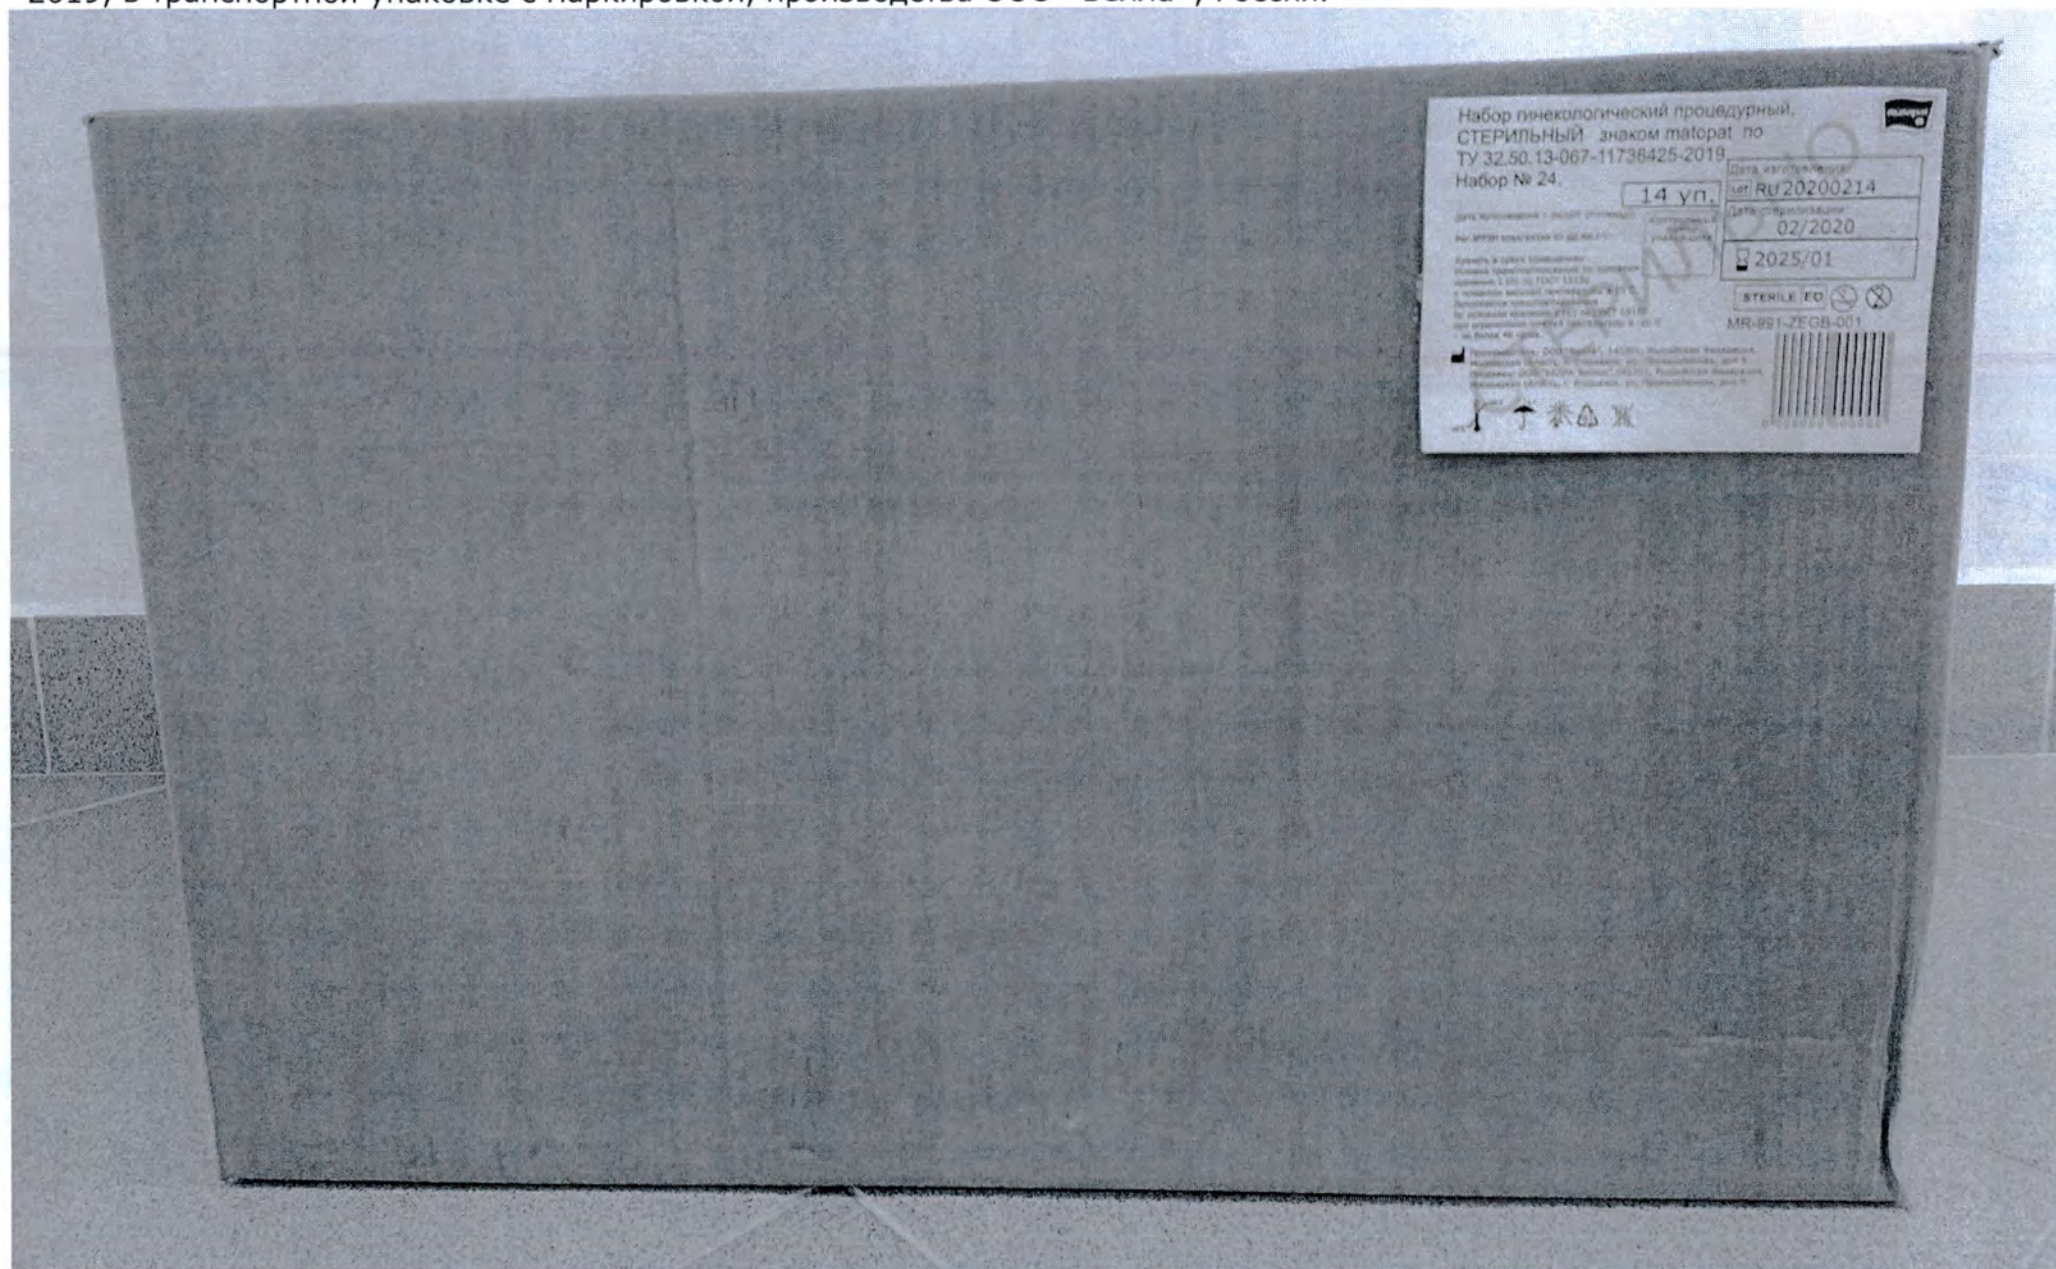



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
(*Тринадцать*) листа(ов)
Генеральный директор ООО «Белла»
М.К. Ковальчик