

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»

« 22 » июня 2020 г. Горшкова Н.А.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения липазы на анализаторах биохимических серии
Atellica (Atellica CH Lipase (Atellica CH Lip))

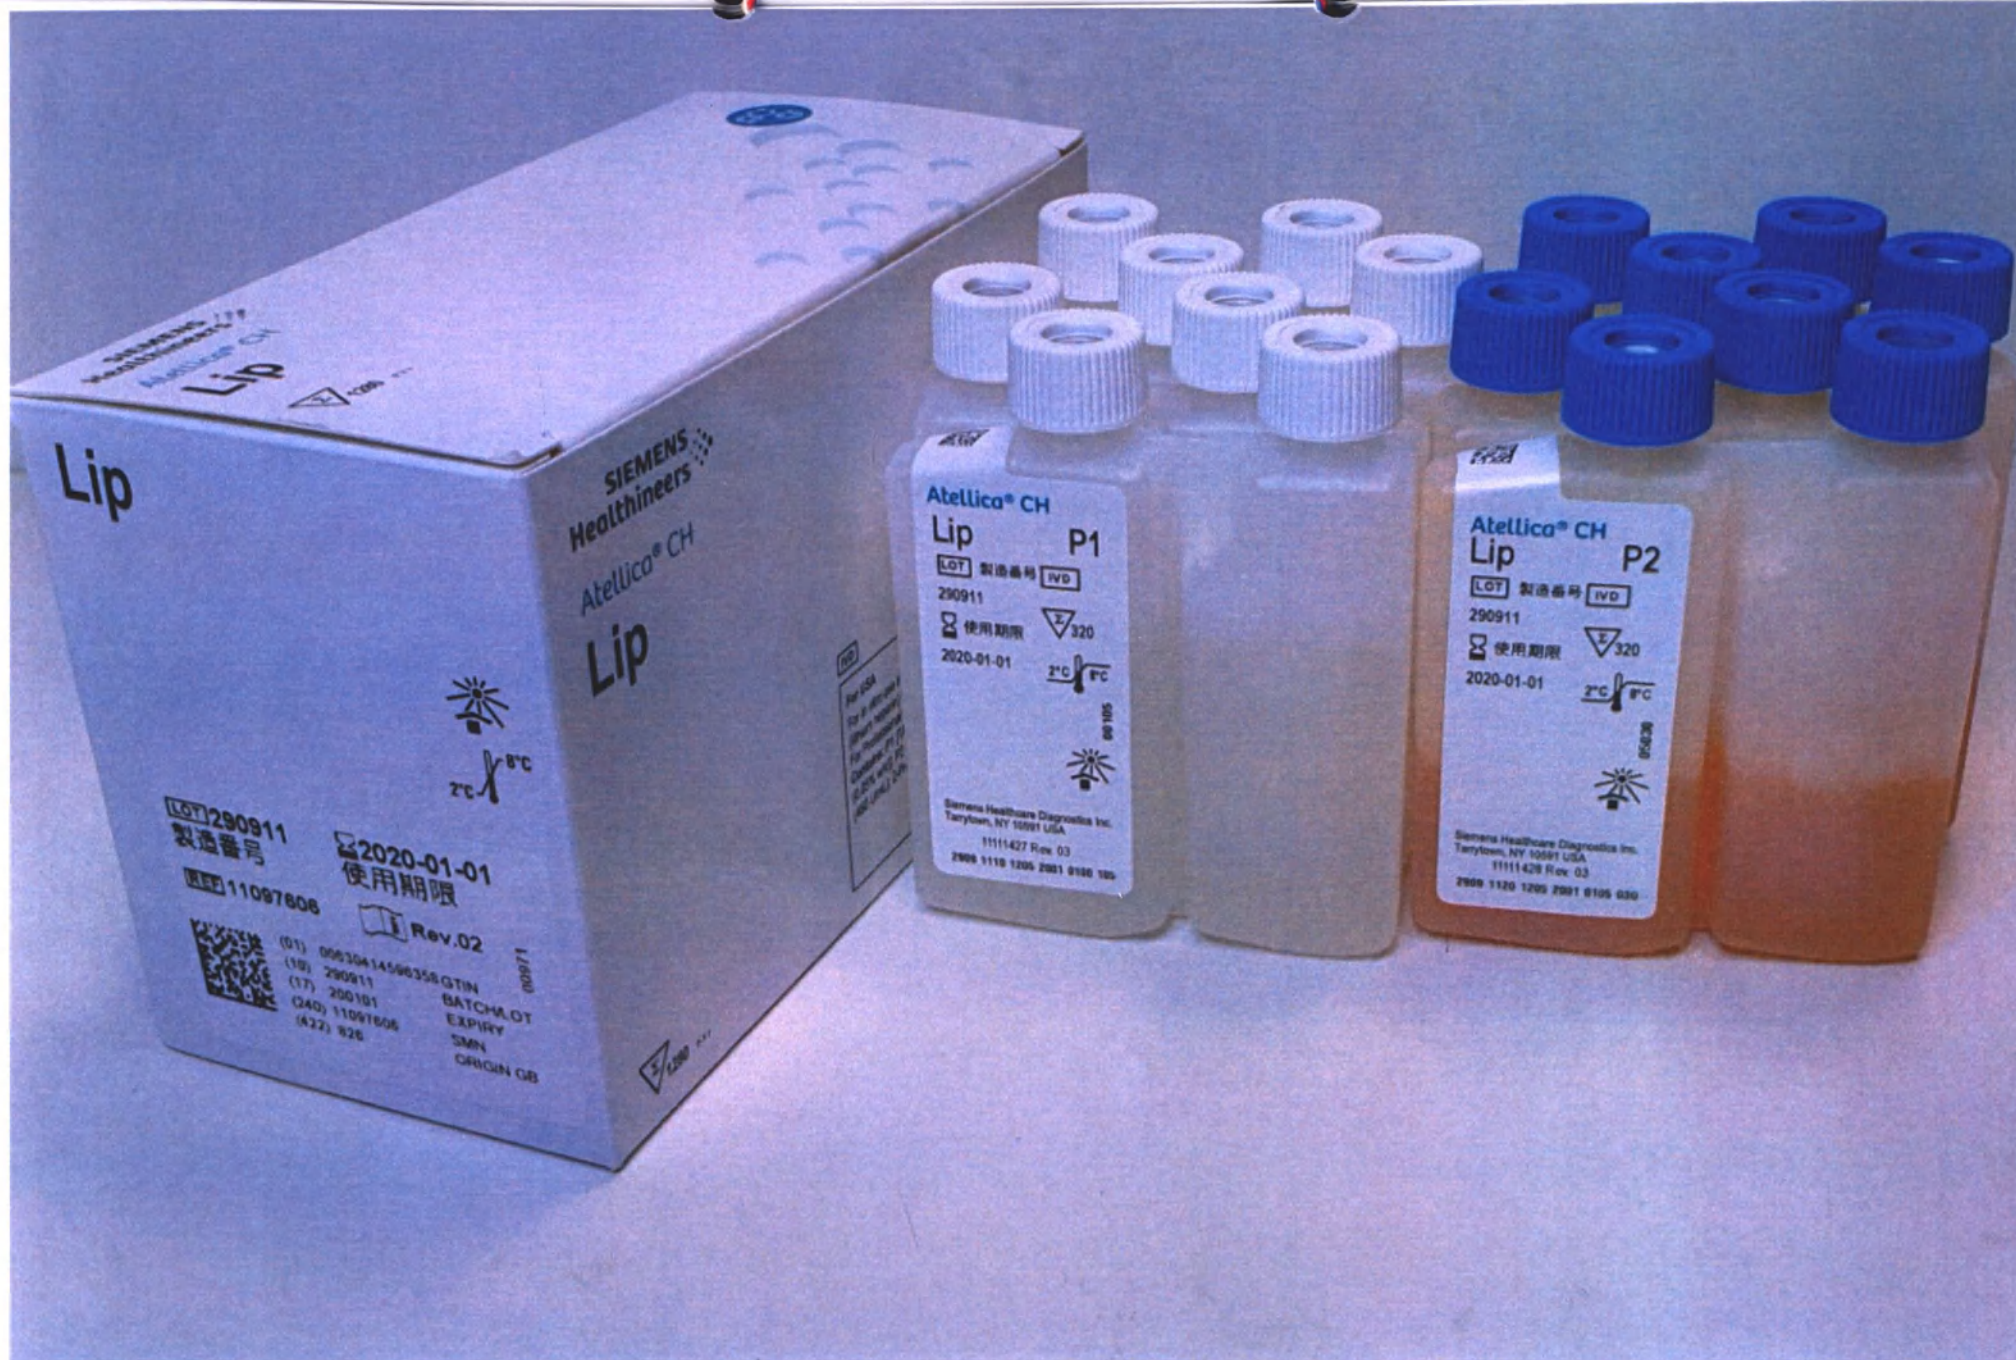


Рисунок 1 Набор реагентов для определения липазы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Lipase (Atellica CH Lip)): общий вид изделия

Atellica® CH

Lip

P1

LOT 製造番号 IVD

290911

使用期限

2020-01-01

Σ 320

2°C 8°C

01694




Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY 10591 USA

11111427 Rev 03

2909 1110 1205 2001 0101 694



Рисунок 3 Набор реагентов для определения липазы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Lipase (Atellica CH Lip)): общий вид, упаковка 2

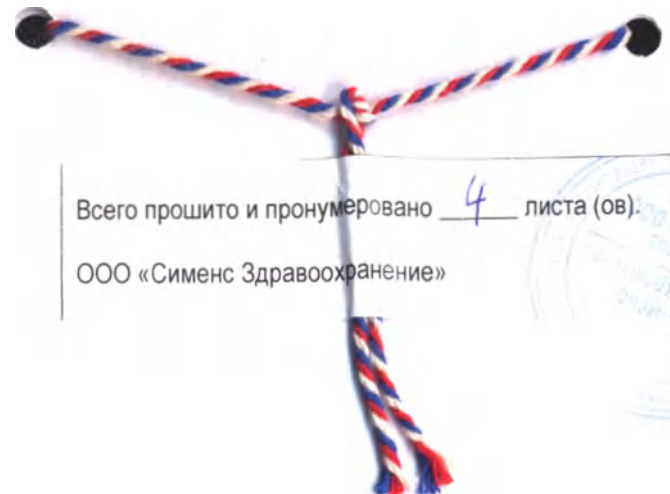

Всего прошито и пронумеровано 4 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»