

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Горшкова Н.А.

« 22 »

июль

2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Lactate Dehydrogenase L-P (Atellica CH LDLP))



Рисунок 1 Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Lactate Dehydrogenase L-P (Atellica CH LDLP)) : общий вид изделия


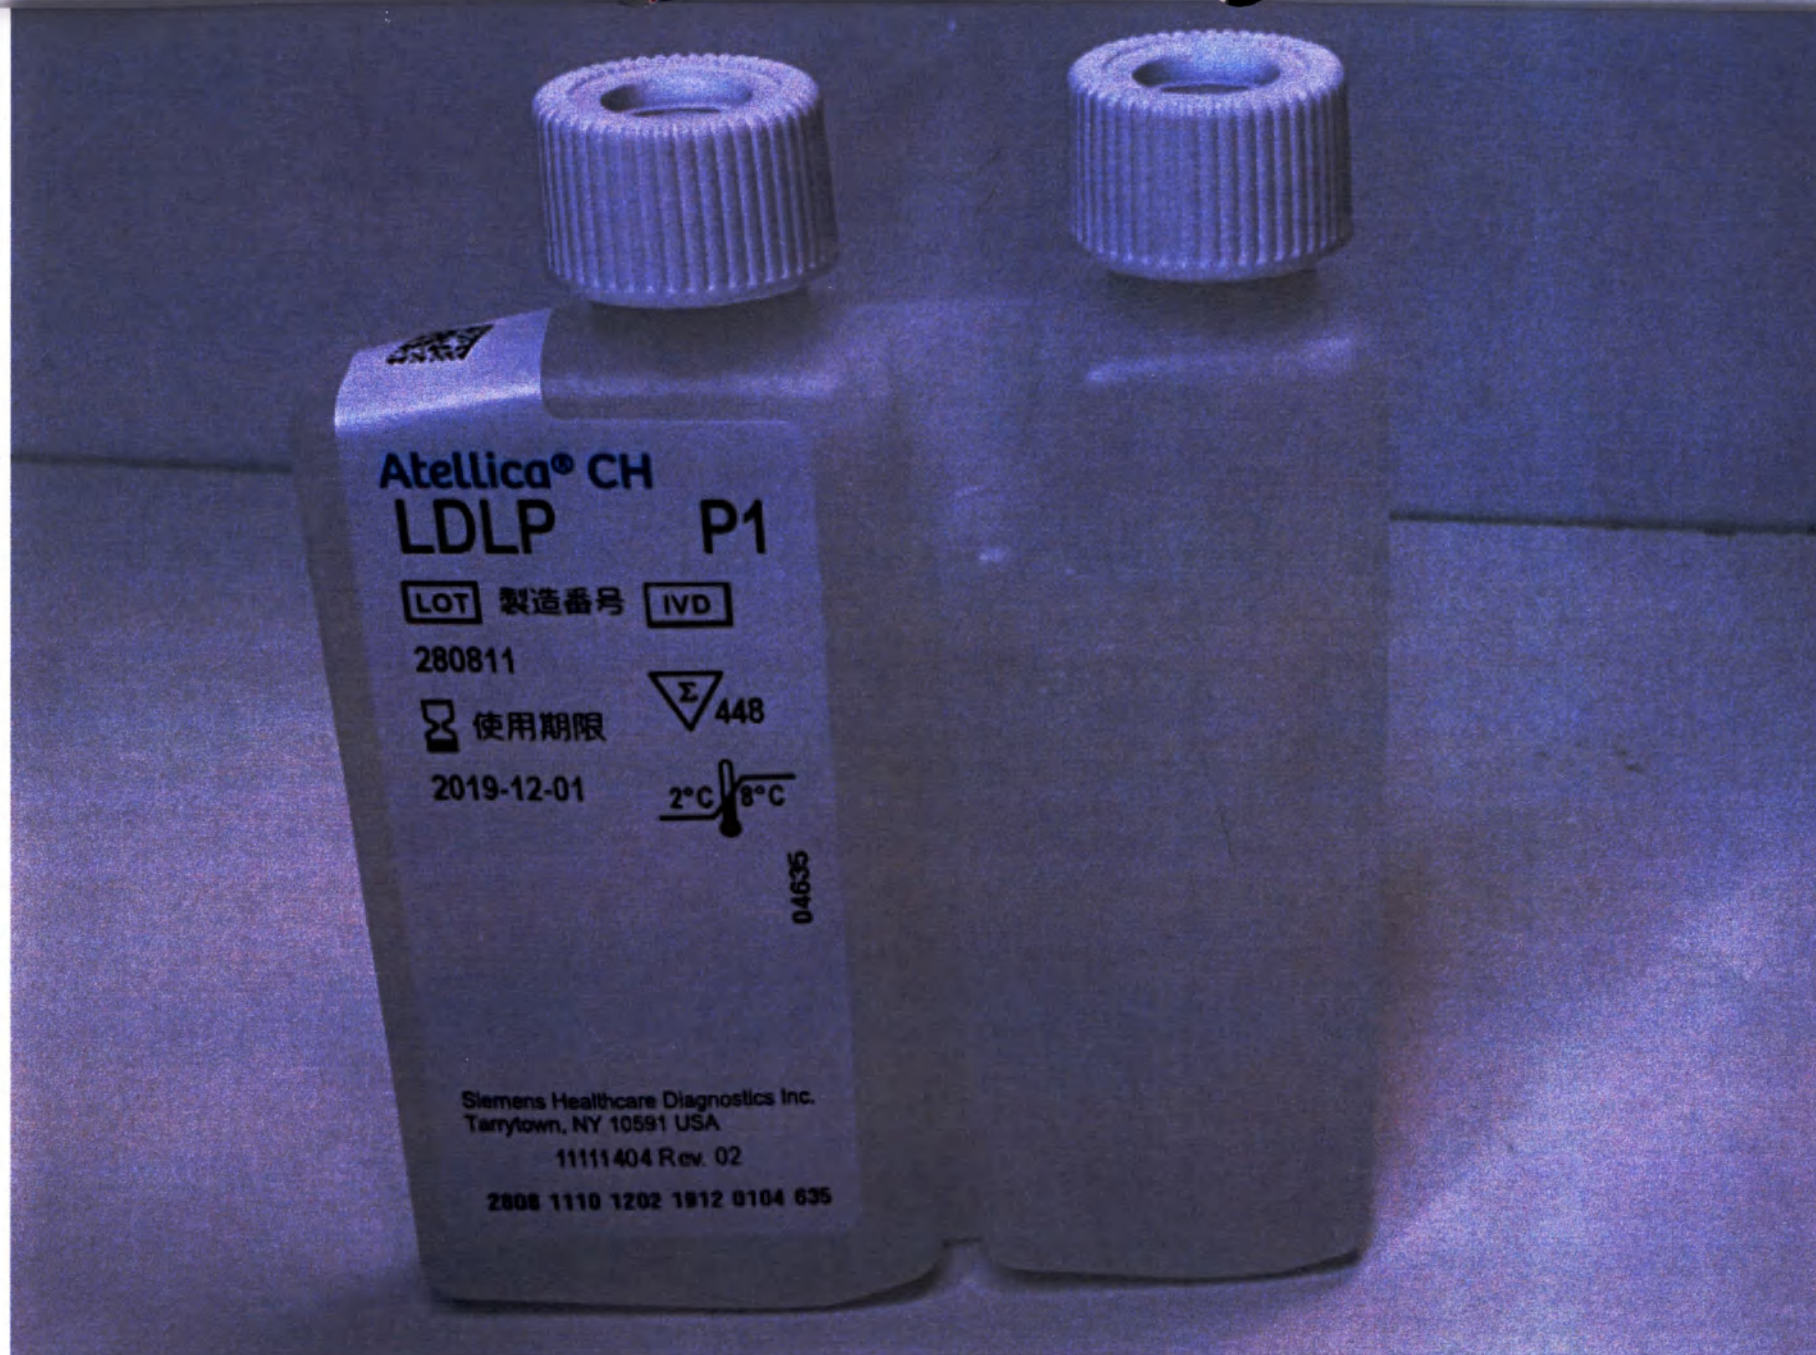


Рисунок 2 Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Lactate Dehydrogenase L-P (Atellica CH LDLP)): общий вид, упаковка 1



Всего прошито и пронумеровано 4 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

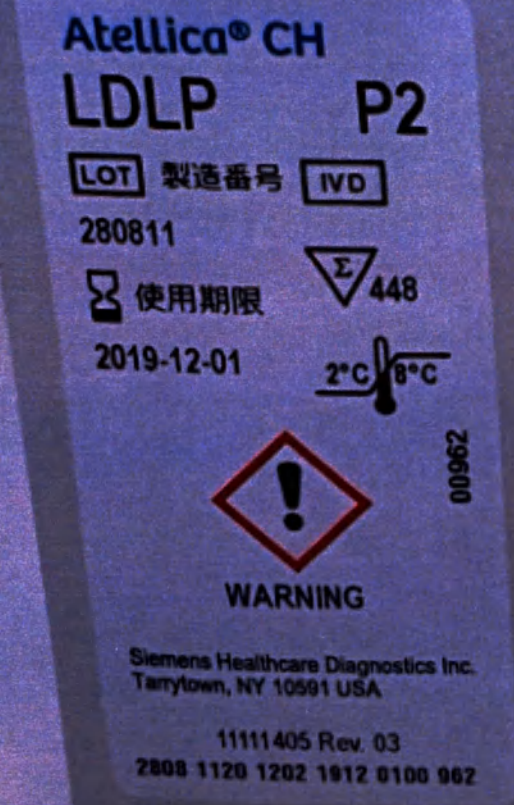