

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**“Набор реагентов для определения IgM+ IgA антител к SARS-CoV-2 в сыворотке/плазме крови человека методом иммуноферментного анализа «COVID-19 ELISA IgM+ IgA»”,
Партия (Лот) № 20ECOVMA901**

производства «ВИРСЕЛЛ С.Л.» (“Vircell, S.L.”), Испания,

Технологический парк здоровья, Авиценна, 8, 18016, Гранада, Испания.
(Parque Tecnológico de la Salud, Avicena 8, 18016, Granada, Spain).

(+34) 958 441 264

info@vircell.com

Кат. № MA1032-S001



QC
PASSED

COVID-19 ELISA IgM+IgA

Набор реагентов для определения IgM+IgA антител к SARS-CoV-2 в сыворотке/плазме крови человека методом иммуноферментного анализа.

vircell 

REF MA1032-S001

LOT 20ECOVMA901

 2022/02

- | | | |
|-----------|---|--------------|
| 1 | 1 VIRCELL МИКРОПЛАНШЕТ COVID-19 | 20ECOV115 |
| 2 | 25 мл VIRCELL БУФЕР ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ СЫВОРОТКИ | 20EDB007 |
| 3 | 1.5 мл VIRCELL IGM+IGA ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | 20ECOVMA010 |
| 4 | 1.5 мл VIRCELL IGM+IGA CUT-OFF КОНТРОЛЬ | 20ECOVMA210 |
| 5 | 1.5 мл VIRCELL IGM+IGA ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | 20ECOVMA0510 |
| 6 | 2 x 7.5 мл VIRCELL IGM+IGA КОНЬЮГАТ | 20ECOVMA310 |
| 7 | 15 мл VIRCELL РАСТВОР СУБСТРАТА TMB | 20ES004 |
| 8 | 15 мл VIRCELL СТОП-РАСТВОР | 20EP003 |
| 9 | 50 мл VIRCELL БУФЕР ДЛЯ ПРОМЫВКИ (20X) | 20ELO10 |
| 10 | 2 x 1.2 мл VIRCELL ELISA СОРБЕНТ | 20EO104 |

CE

IVD

 96



 2°C 8°C


ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



(01)08436040328316(10)20ECOVMA901(17)220228

 Vircell, S.L. Parque Tecnológico de la Salud, Avicena 8, 18016 Granada, Spain.


vircell
MICROBIOLOGISTS

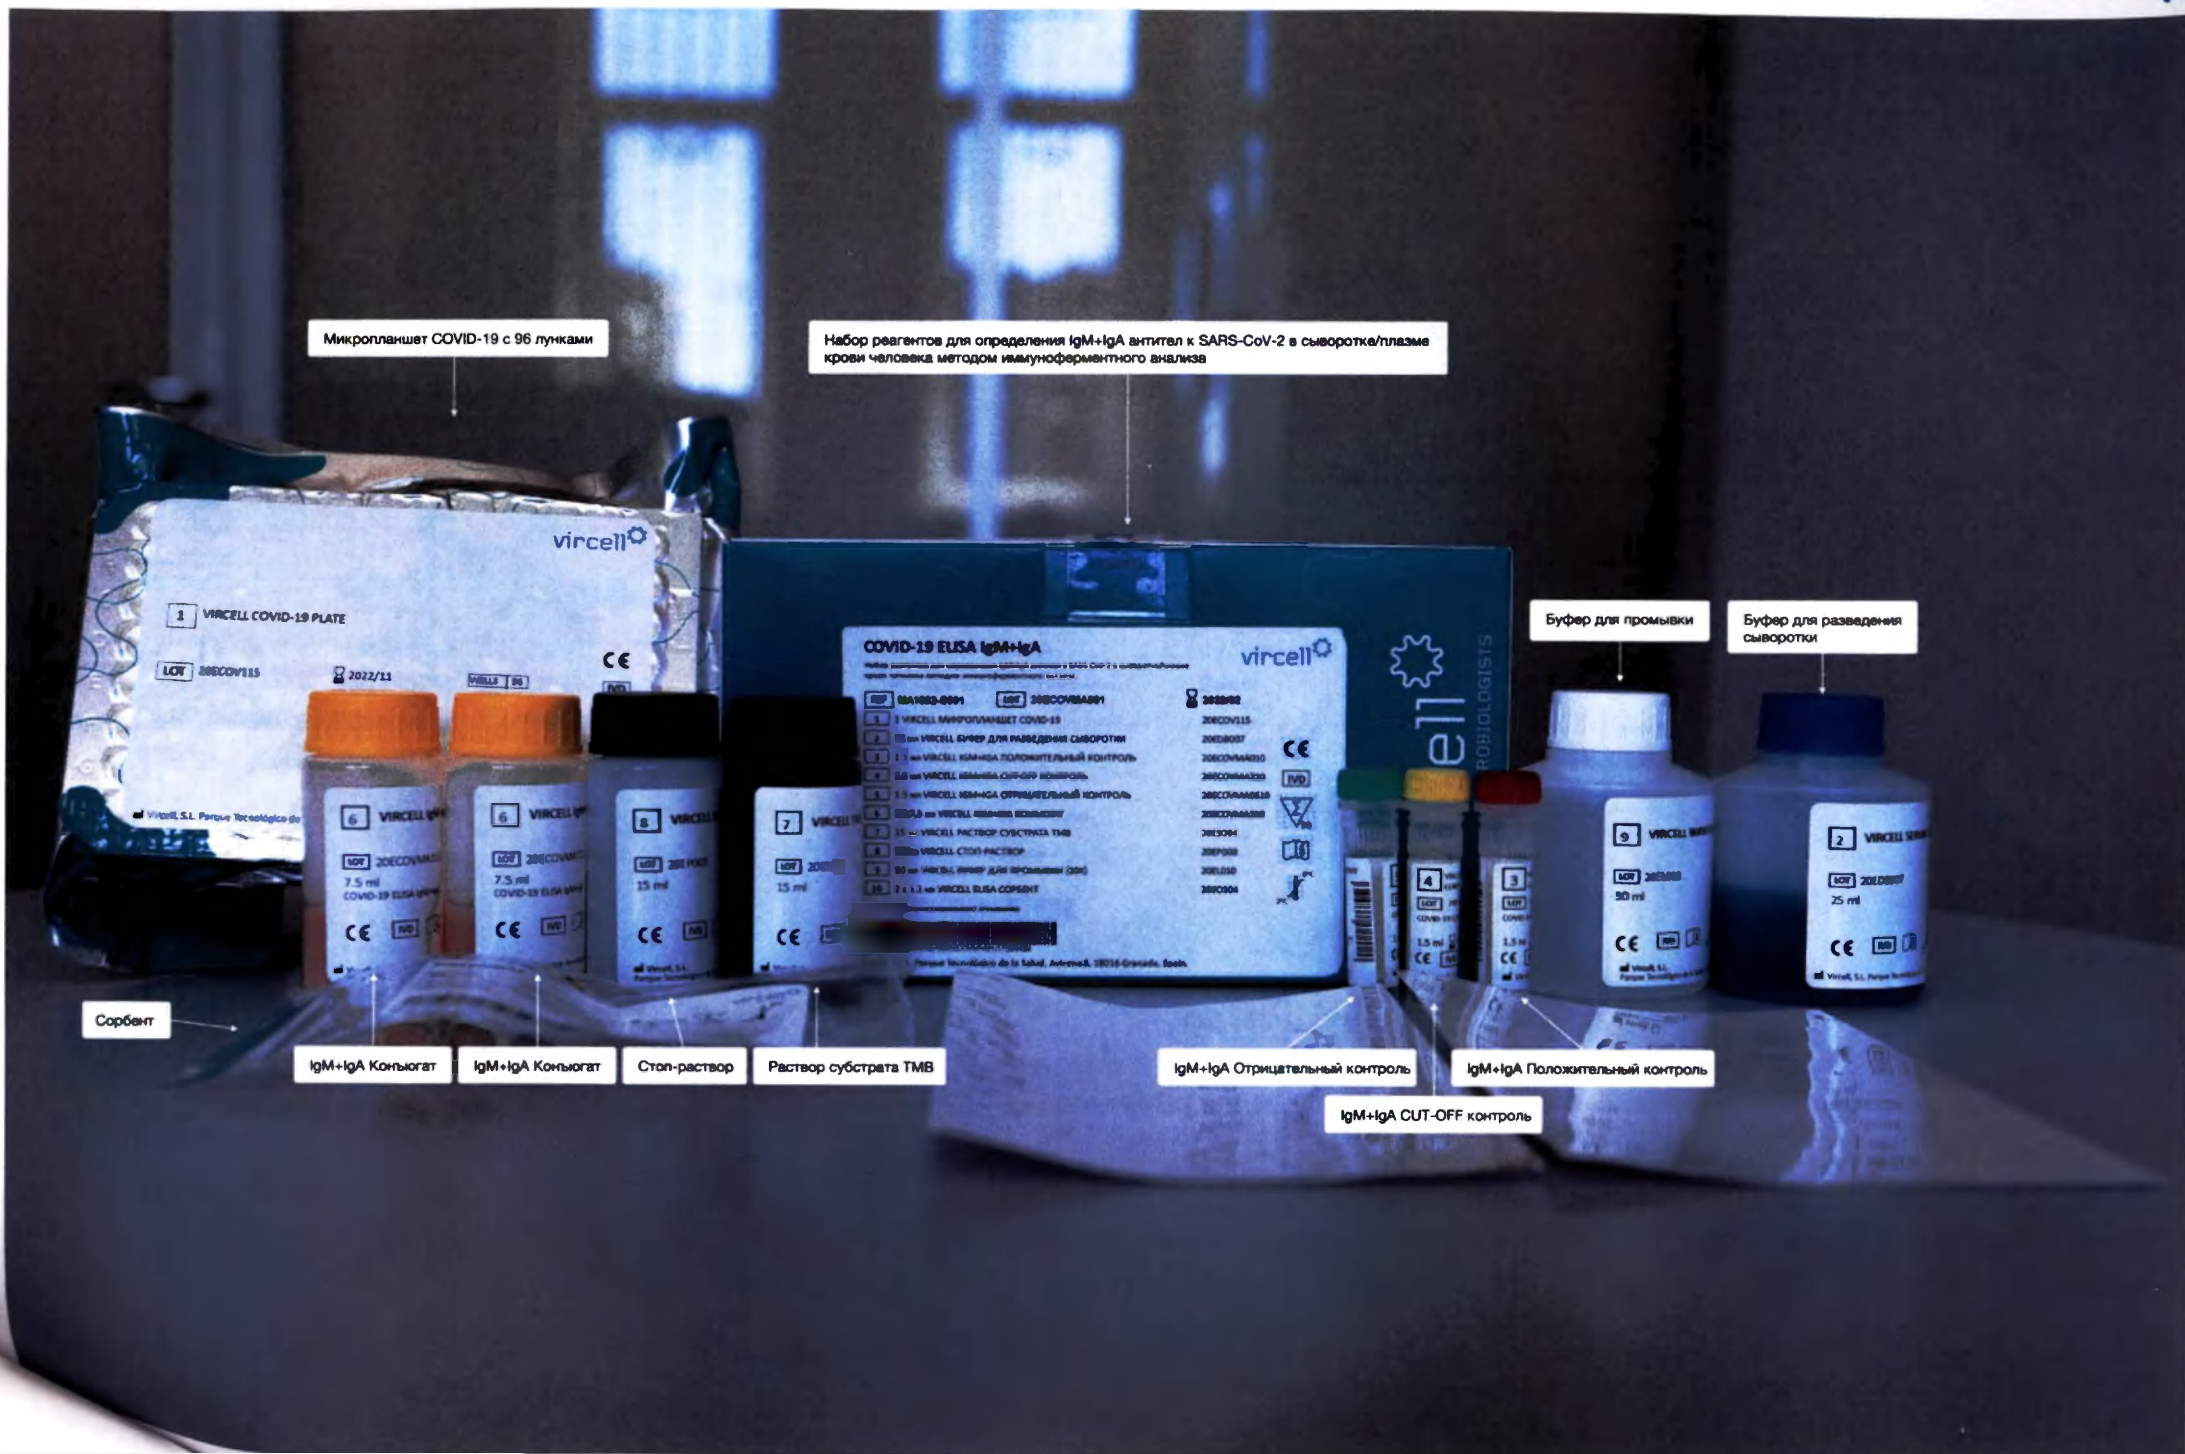

Микропланшет COVID-19 с 96 лунками

Набор реагентов для определения IgM+IgA антител к SARS-CoV-2 в сыворотке/плазме крови человека методом иммуноферментного анализа

Буфер для промывки

Буфер для разведения сыворотки

Сорбент

IgM+IgA Конъюгат

IgM+IgA Конъюгат

Стоп-раствор

Раствор субстрата TMB

IgM+IgA Отрицательный контроль

IgM+IgA Положительный контроль

IgM+IgA CUT-OFF контроль



QC
PASSED

COVID-19 ELISA IgM+IgA

реагентов для определения IgM+IgA антител к SARS-CoV-2 в сыворотке/плазме человека методом иммуноферментного анализа.

vircell



ROBIOLOGISTS

MA1032-S001 LOT 20ECOVMA901

2022/02

1 VIRCELL МИКРОПЛАШЕТ COVID-19

20ECOV115

25 мл VIRCELL БУФЕР ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ СЫВОРОТКИ

20EDB007

1.5 мл VIRCELL IGM+IGA ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

20ECOVMA010

1.5 мл VIRCELL IGM+IGA CUT-OFF КОНТРОЛЬ

20ECOVMA210

1.5 мл VIRCELL IGM+IGA ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

20ECOVMA0510

2 x 7.5 мл VIRCELL IGM+IGA КОНЬЮГАТ

20ECOVMA310

15 мл VIRCELL РАСТВОР СУБСТРАТА TMB

20ES004

15 мл VIRCELL СТОП-РАСТВОР

20EP003

50 мл VIRCELL БУФЕР ДЛЯ ПРОМЫВКИ (20X)

20EL010

2 x 1.2 мл VIRCELL ELISA CORPENT

20EO104

CE

IVD

Σ 96


1

20°C

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Vircell, S.L. Parque Tecnológico de la Salud, Avicena 8, 18016 Granada, Spain.

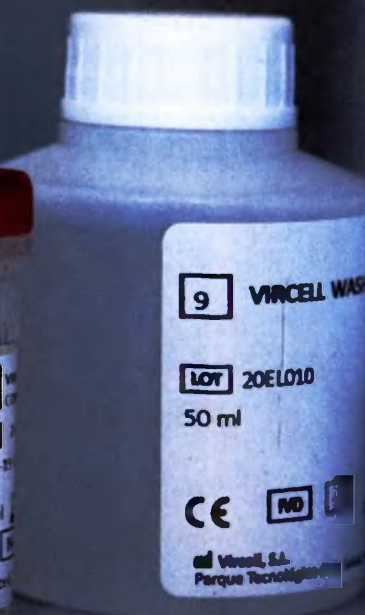

Всего прошито и пронумеровано
6 (шесть) листов
Генеральный Директор
ЗАО "БиоХимМак"

Тамм Н.Е.

