



ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИИ




О.В. Черничук

МИКРОХГЕН

ДИАГНОСТИКУМ ТУЛЯРЕЙНОЙ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ КРОВЯНОЙ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ

10 мл по 1

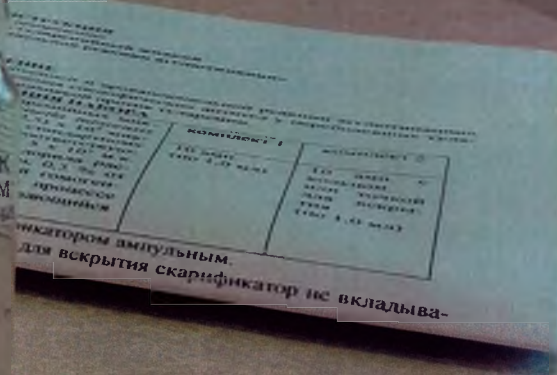

индикатор ампульным.
для вскрытия скарификатор не вкладыва-

МИКРОХГЕН

**ДИАГНОСТИКУМ ТУЛЯРЕМИЙНЫЙ ЖИДКИЙ
ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ И КРОВЯНОКАПЕЛЬНОЙ
РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ**

10 ампул по 1 мл


Только для диагностики ин витро
Для учреждений здравоохранения

Исполнительный директор
ФГУП «НПО «Микроген»



О.В. Черничук

«Диагностикум туляремиальный жидкий для объемной и кровянокапельной реакции агглютинации»
Фото пачки (Комплект 1)

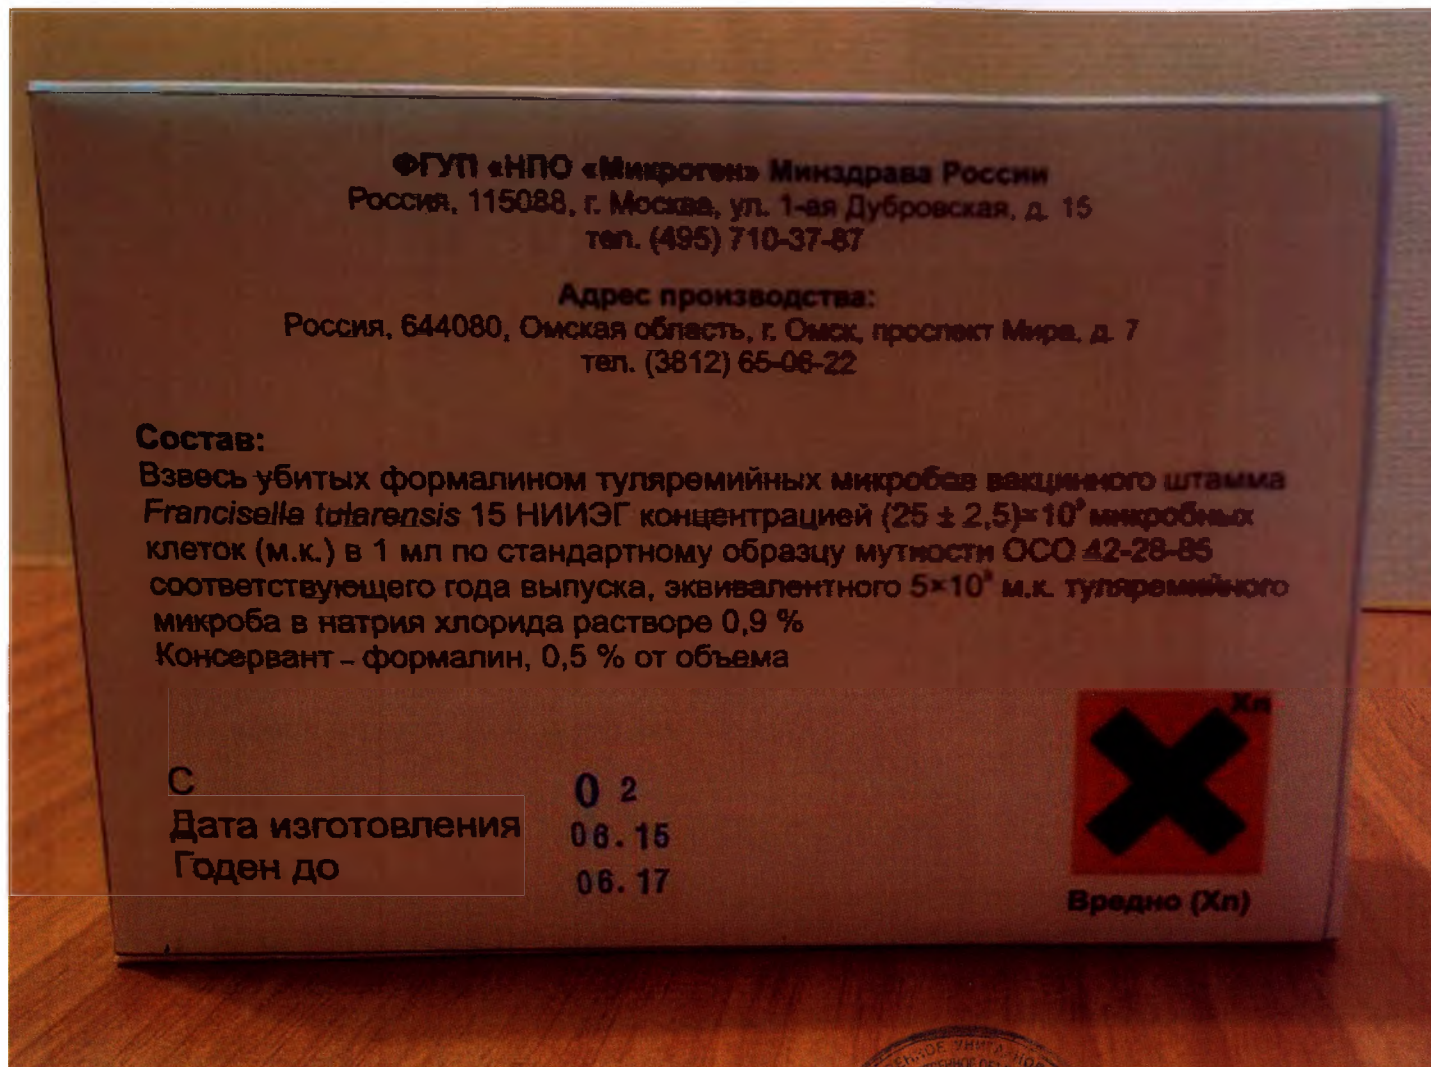

Исполнительный директор
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздрава России



О.В. Черничук

Пропитано, пронумеровано и
скреплено печатью
листа(ов)



Исполнительный директор
ФГУП «НПО «МИКРОГЕН»
МИНЗДРАВА РОССИИ
С.В. Черничук