

Приложение


К ПРОТОКОЛУ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ № 70/12 от 04.04.12 г.

Внешний вид изделия медицинского назначения:

«Наборы реагентов для диагностики in vitro», производства Mast Group Ltd.
(Великобритания)


1. Набор реагентов MAST OCCUTEST.

(Состав набора: Реагент А – 1 флакон, Реагент В – 1 флакон, Реагент С – 1 флакон, Пластина для постановки реакции – не более 1000 шт.).

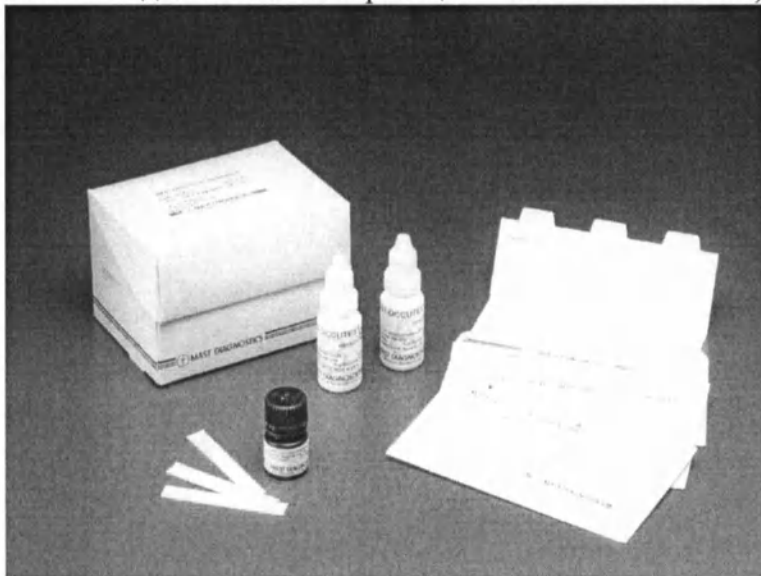

2. Набор реагентов MAST - ТРНА.


(Состав набора: Растворитель – от 2 до 4 флаконов, Клеточный тест – от 2 до 4 флаконов, Контроль эритроцитов - 2 флакона, Положительный контроль – 1 флакон, Отрицательный

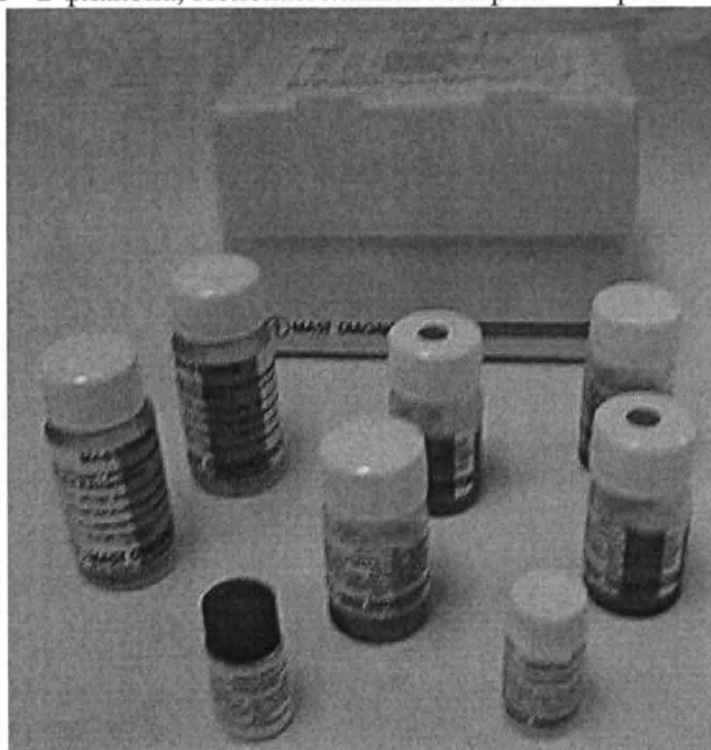

контроль – 1 флакон).


3. Набор реагентов MAST Toxoreagent.

(Состав набора: Латекс-реагент – 1 флакон, Позитивный контроль – 1 флакон, Буфер – 1 флакон).

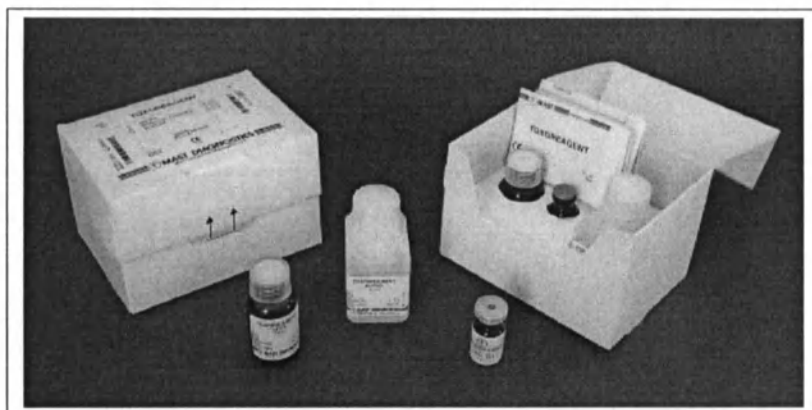

4. Набор реагентов MASTAZYME CMV.

(Состав набора: Планшеты – 5 шт., Буфер для промывки – 4 флакона, Позитивный контроль – 1 флакон, Отрицательный контроль – 1 флакон, Калибровочный контроль – 1 флакон, Конъюгат – 3 флакона, ТМВ субстрат – 1 флакон, Останавливающий (стабилизирующий) раствор – 3 флакона, Крышки для планшетов – 10 шт.).

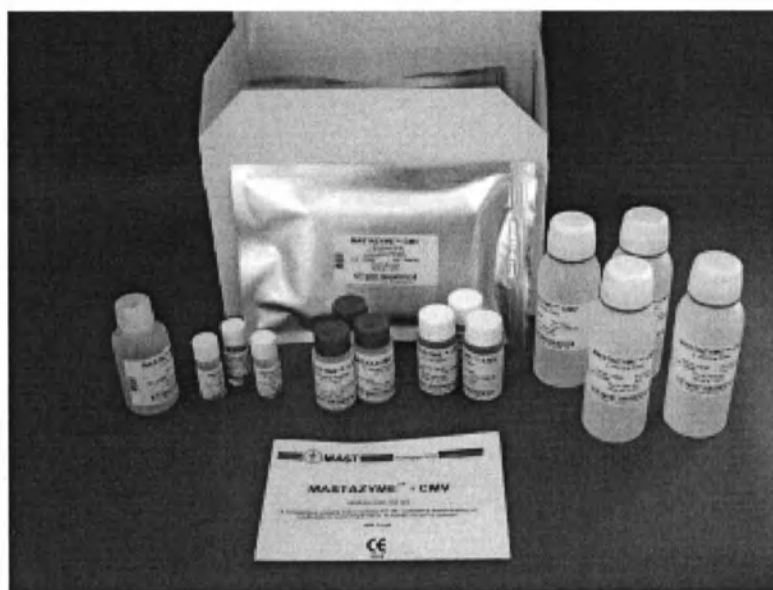

Приемочная комиссия в составе:

Доцент кафедры КЛД РМАПО,
к.м.н., Ройтман А.П.

Доцент кафедры КЛД РМАПО,
к.м.н., Ракова Н.Г.