

Исполнительный директор
АО «НПО «Микроген»



О.В. Черничук

« 01 » 12 2017 г.

Фосфатно-солевой буферный раствор pH (5,5±0,2)

1. Маркировка внутренней упаковки (флакона):

МИКРОГЕН
ФОСФАТНО-СОЛЕВОЙ
БУФЕРНЫЙ РАСТВОР
PH (5,5±0,2)
10 МЛ STERILE
С
ГОДЕН ДО

Исполнительный директор
АО «НПО «Микроген»


О.В. Черничук

« 21 » 12 20 / 7 г.

Фосфатно-солевой буферный раствор pH (5,5±0,2)

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 120x58x64 мм

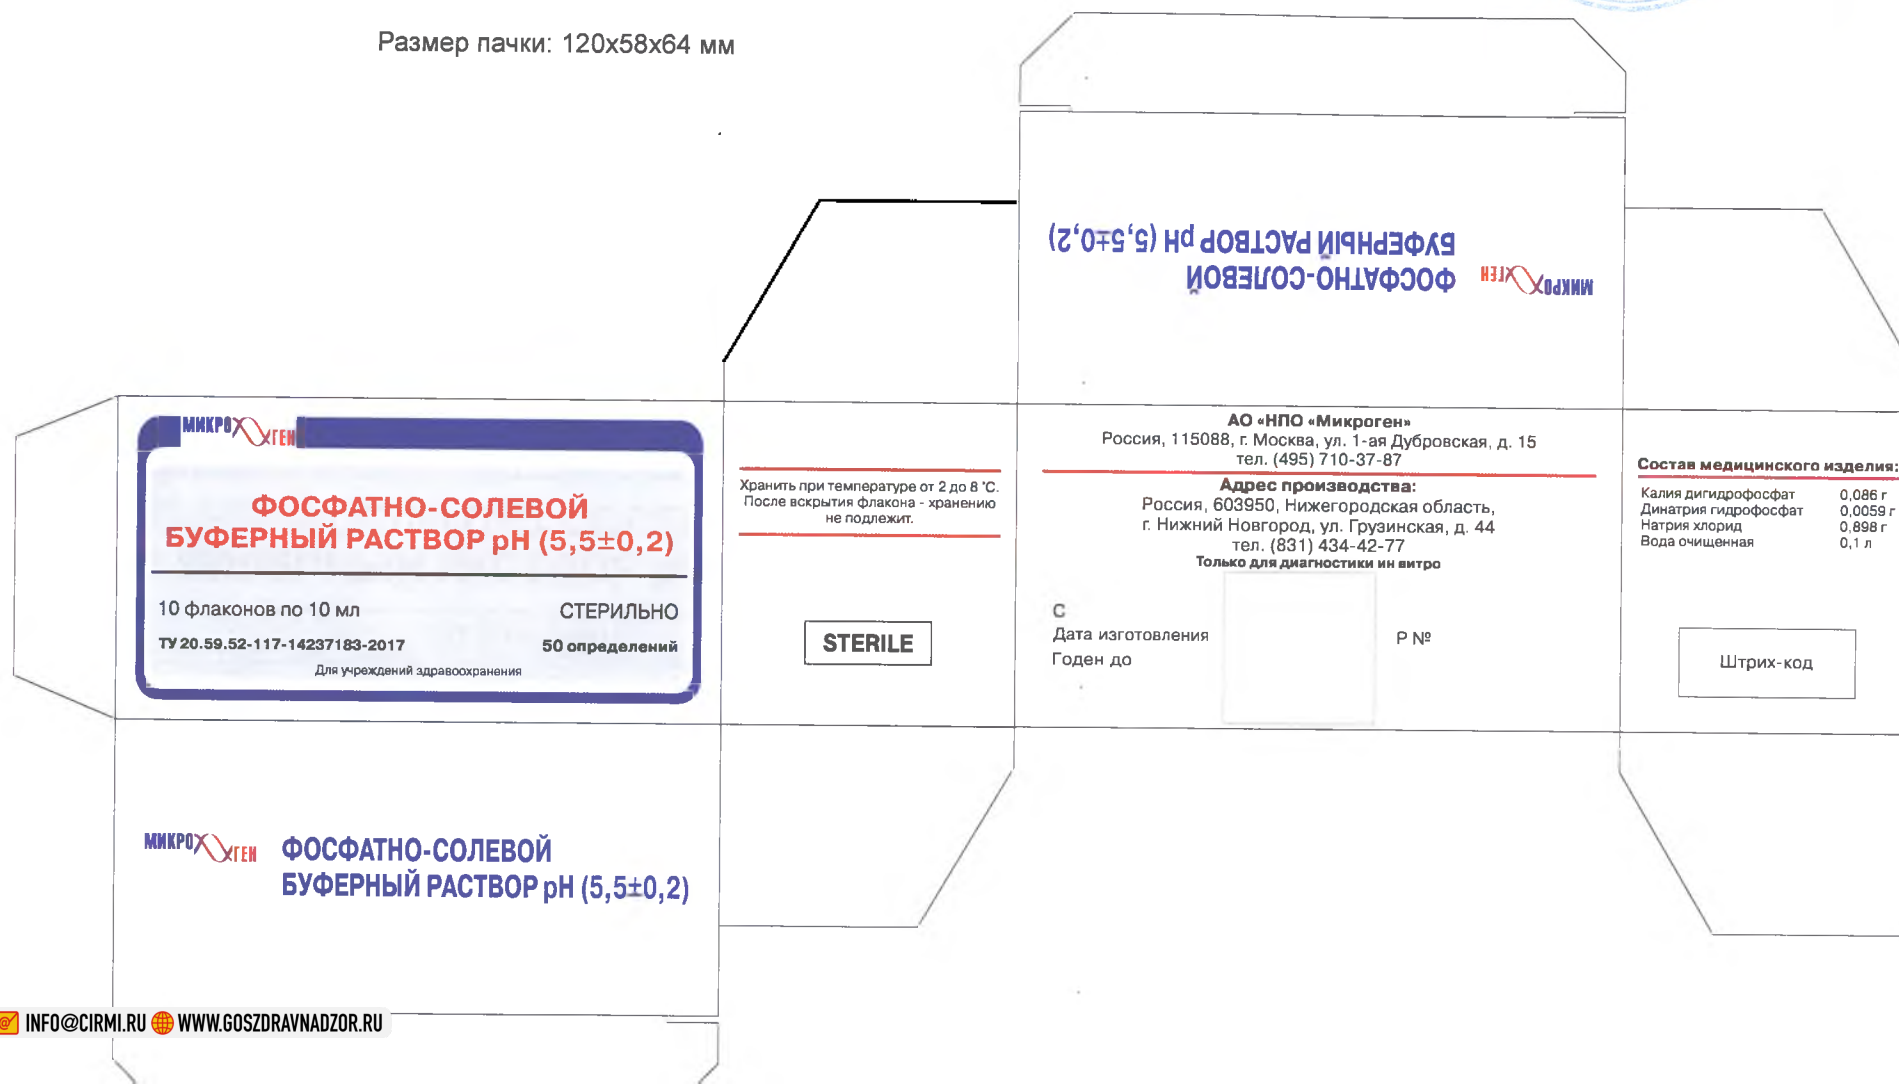

Исполнительный директор
АО «НПО «Микроген»


О.В. Черничук

«01» 12 2017 г.

Фосфатно-солевой буферный раствор pH (5,5±0,2)


3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

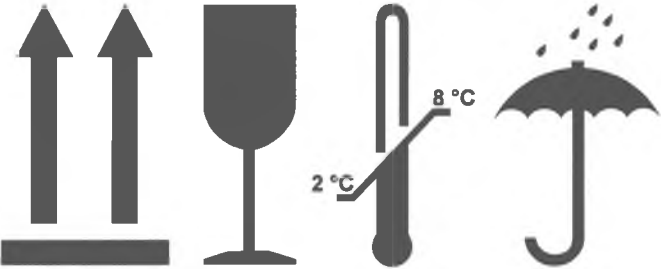 Не кантовать!	Серия: Дата изготовления: Годен до: Число единиц потребит. упак. изделия:
ФОСФАТНО-СОЛЕВОЙ БУФЕРНЫЙ РАСТВОР pH (5,5±0,2)	
СТЕРИЛЬНО	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортировать при температуре от минус 20 до 25 °С не более 14 суток. Хранить при температуре от 2 до 8 °С. После вскрытия флакона - хранению не подлежит.	 МИКРОГЕН АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 15 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 44 тел. (831) 434-42-77
Масса брутто	
Масса нетто	

Специальный знак обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза будет наноситься после прохождения установленных в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к внедрению и поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
3 листа(ов)

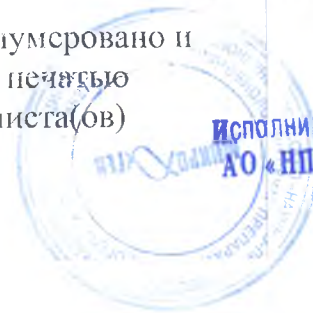

Исполнительный директор
АО «НПО «МИКРОГЕН»
О. В. Черничук

Исполнительный директор АО «НПО «Микроген»

О.В. Черничук

