



ЦЕНТР
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ

Общество с ограниченной
ответственностью
«Центр Подтверждения Соответствия»
123308, г. Москва, ул. Мневники, дом
3, корпус 1
ИНН/КПП 7725790126/773401001
ОГРН 1137746368869
Тел/факс +7 495 532 92 10,
эл. почта: info@ctrps.ru

Фотографические изображения медицинского изделия
Гемостатический клапан WATCHDOG, в составе:

- 1. гемостатический клапан;**
- 2. установочное устройство (при необходимости);**
- 3. устройство для вращения (при необходимости)**

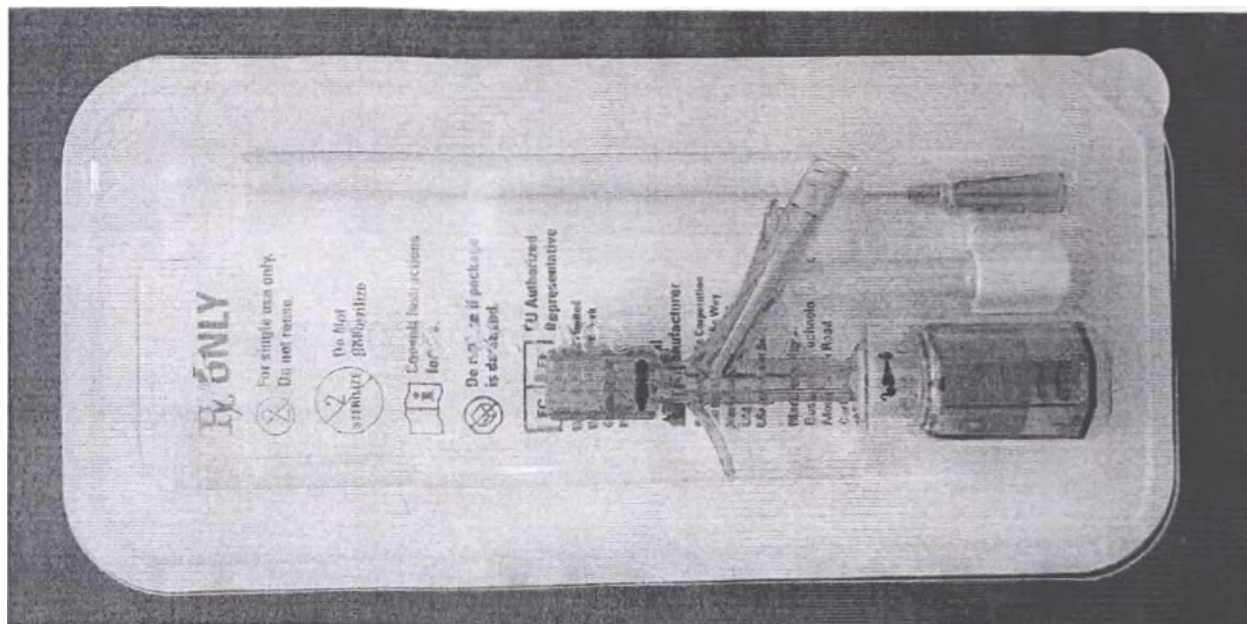


Рис.1. Общий вид медицинского изделия с комплектующими в первичной упаковке (гемостатический клапан с установочным устройством и устройством для вращения)

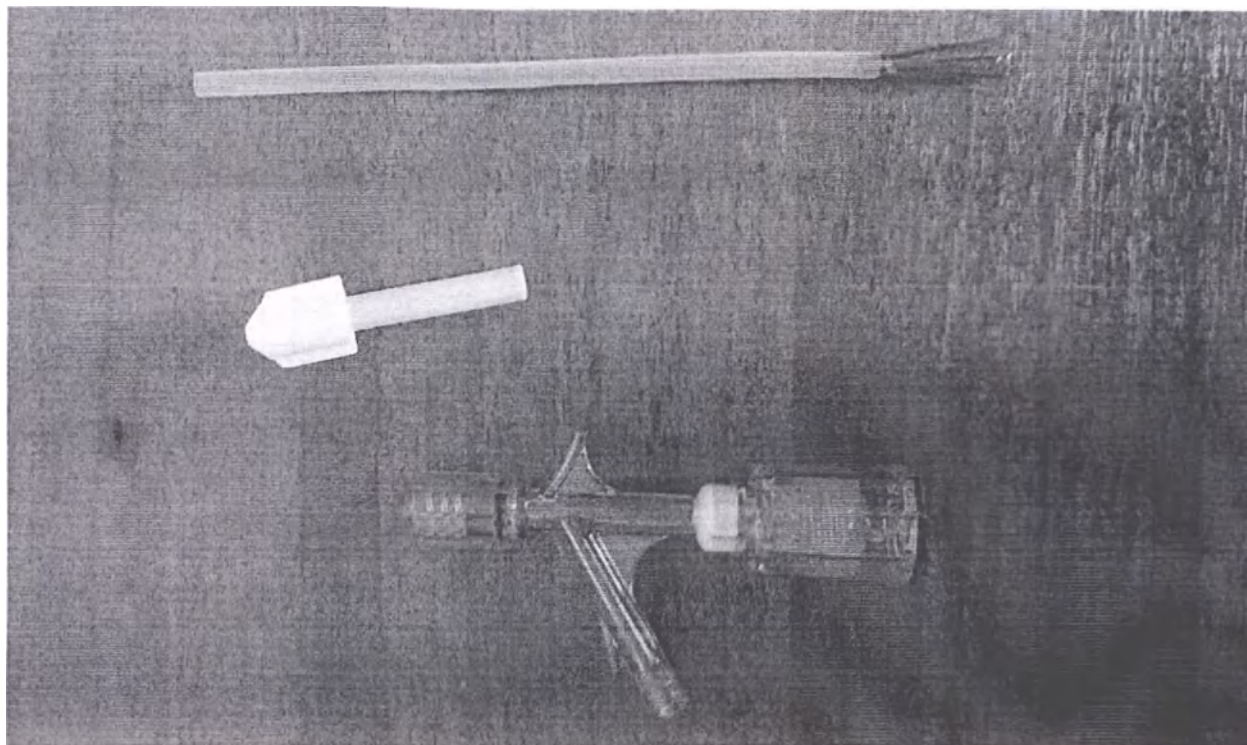


Рис.2. Гемостатический клапан WATCHDOG с установочным устройством и устройством для вращения

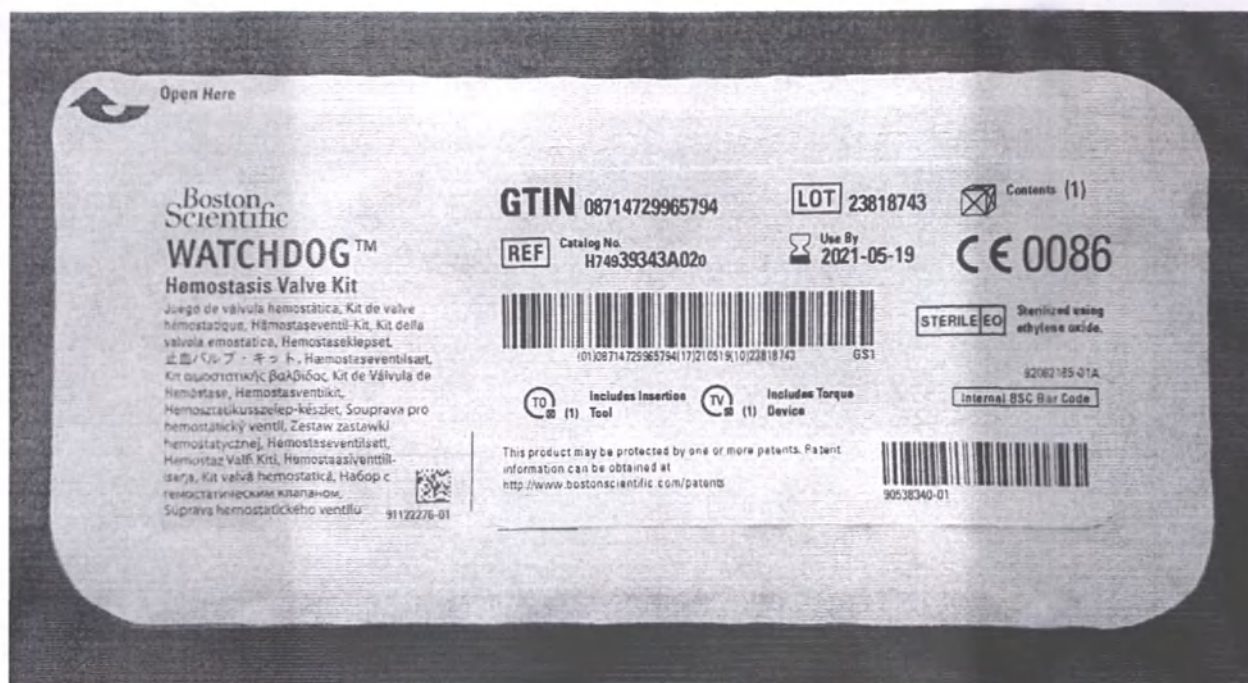


Рис. 3. Маркировка производителя на первичной упаковке гемостатического клапана WATCHDOG

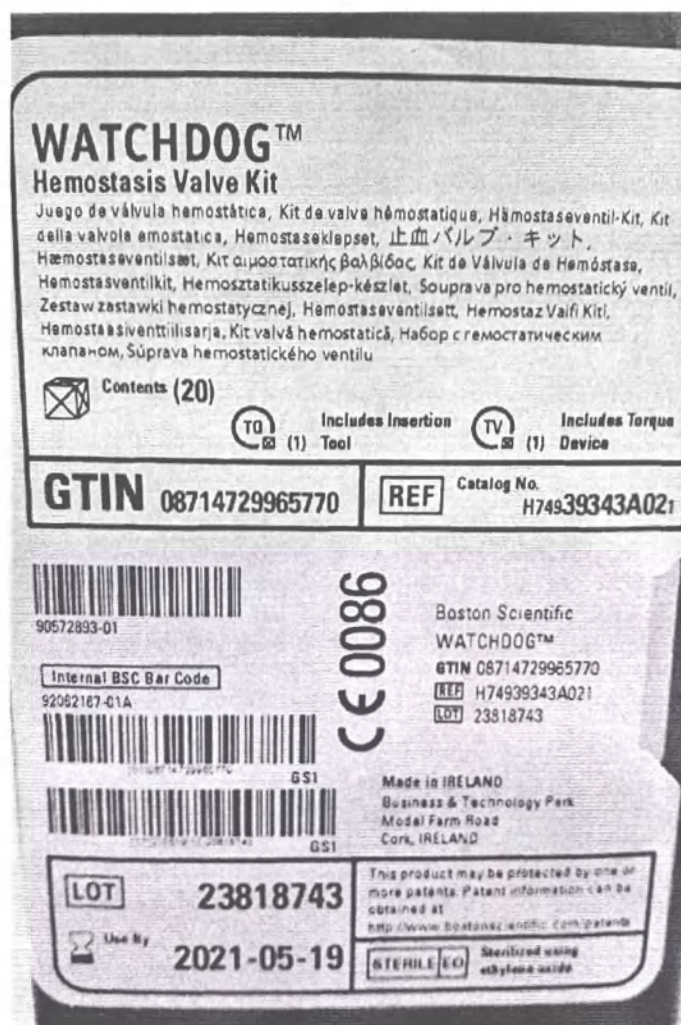


Рис. 4. Маркировка производителя на вторичной упаковке гемостатического клапана WATCHDOG



Рис. 5. Потребительская упаковка (картонная коробка) гемостатического клапана WATCHDOG

Certificate Registration Description 1		
Registered Product Name 2		
Регистрационное удостоверение: 3	От: 4	
Reg. Cert. #1	dd/MM/yyyy	
Reg. Cert. #2	dd/MM/yyyy	
Reg. Cert. #3	dd/MM/yyyy	
Reg. Cert. #4	dd/MM/yyyy	
Reg. Cert. #5	dd/MM/yyyy	
только для одноразового использования 5		
стерильно / не стерильно 6		
Апирогенно 7		
нетоксично 8		
Дата изготовления/срок хранения, указанный на оригинальной упаковке 9		
		11 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 10		FIM 10: WO 92505282-01A

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-labeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте.

Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Рис. 6. Проект маркировки упаковки медицинского изделия «гемостатический клапан WATCHDOG» на русском языке

(1) Описание регистрационного удостоверения, 2) Наименование зарегистрированного продукта, 3) Номер регистрационного удостоверения (возможно добавление до 5 номеров), 4) Дата выдачи регистрационного удостоверения (возможно добавление до 5 номеров в зависимости от количества регистрационных удостоверений), 5) Положение об одноразовом использовании, 6) Положение о стерильности/не стерильности, 7) Положение об апирогенности, 8) Положение о нетоксичности, 9) Дата изготовления / дата окончания срока годности, указанного на оригинальной упаковке, 10) Положение о наличии инструкции по применению в электронном формате)