

ПОДТВЕРЖДАЮ
Руководитель направления по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»


Чигринец Е.А.
2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор калибраторов для определения CA 125II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 125II Calibrator (Atellica IM CA 125II CAL))»

производства «Сименс Хелскеа Диагностика Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

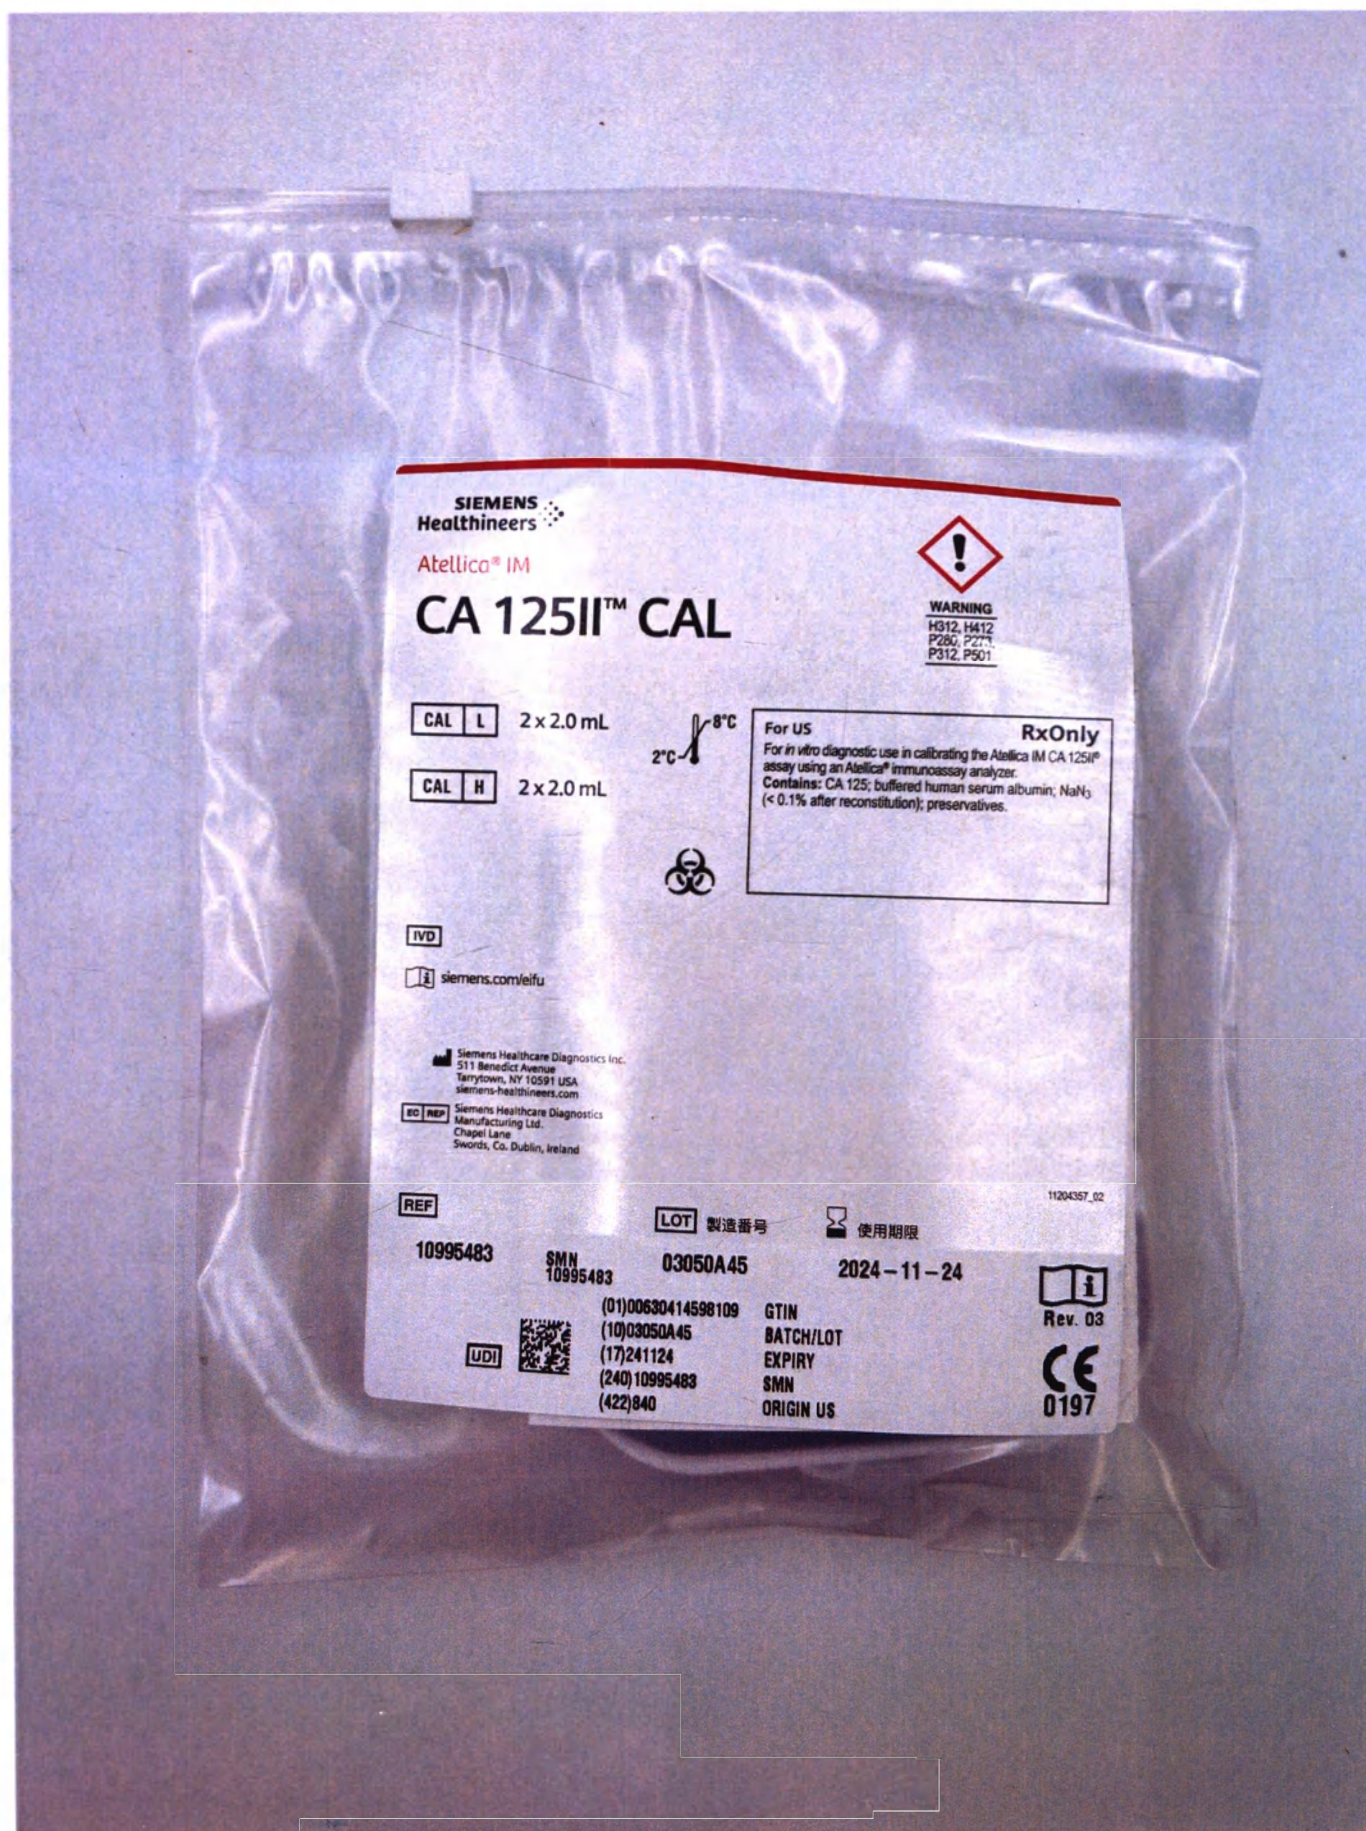


Рисунок 1. Набор калибраторов для определения CA 125II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 125II Calibrator (Atellica IM CA 125II CAL)). Общий вид



Рисунок 2. Набор калибраторов для определения CA 125II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 125II Calibrator (Atellica IM CA 125II CAL)). Общий вид



Рисунок 3. Набор калибраторов для определения CA 125II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 125II Calibrator (Atellica IM CA 125II CAL)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CA 125II CAL L, 2,0 мл



Рисунок 4. Набор калибраторов для определения СА 125II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 125II Calibrator (Atellica IM CA 125II CAL)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CA 125II CAL L, 2,0 мл



Рисунок 5. Набор калибраторов для определения CA 125II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 125II Calibrator (Atellica IM CA 125II CAL)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CA 125II CAL L, 2,0 мл

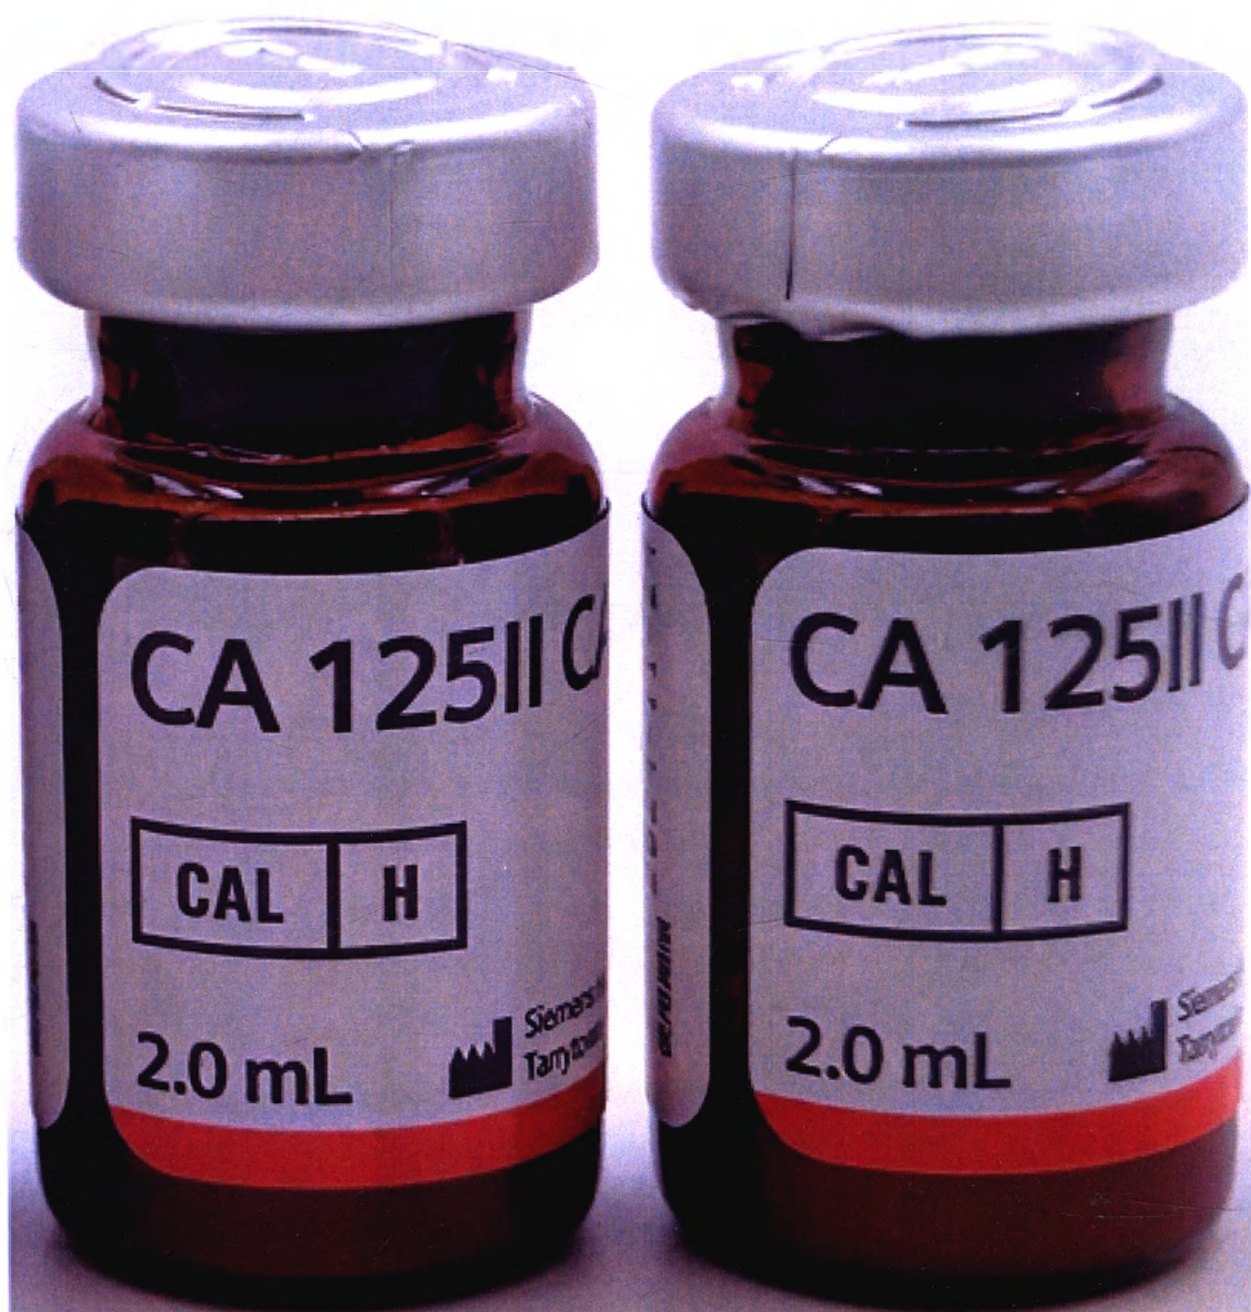


Рисунок 6. Набор калибраторов для определения CA 125II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 125II Calibrator (Atellica IM CA 125II CAL)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CA 125II CAL H, 2,0 мл



Рисунок 7. Набор калибраторов для определения CA 125II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 125II Calibrator (Atellica IM CA 125II CAL)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CA 125II CAL H, 2,0 мл

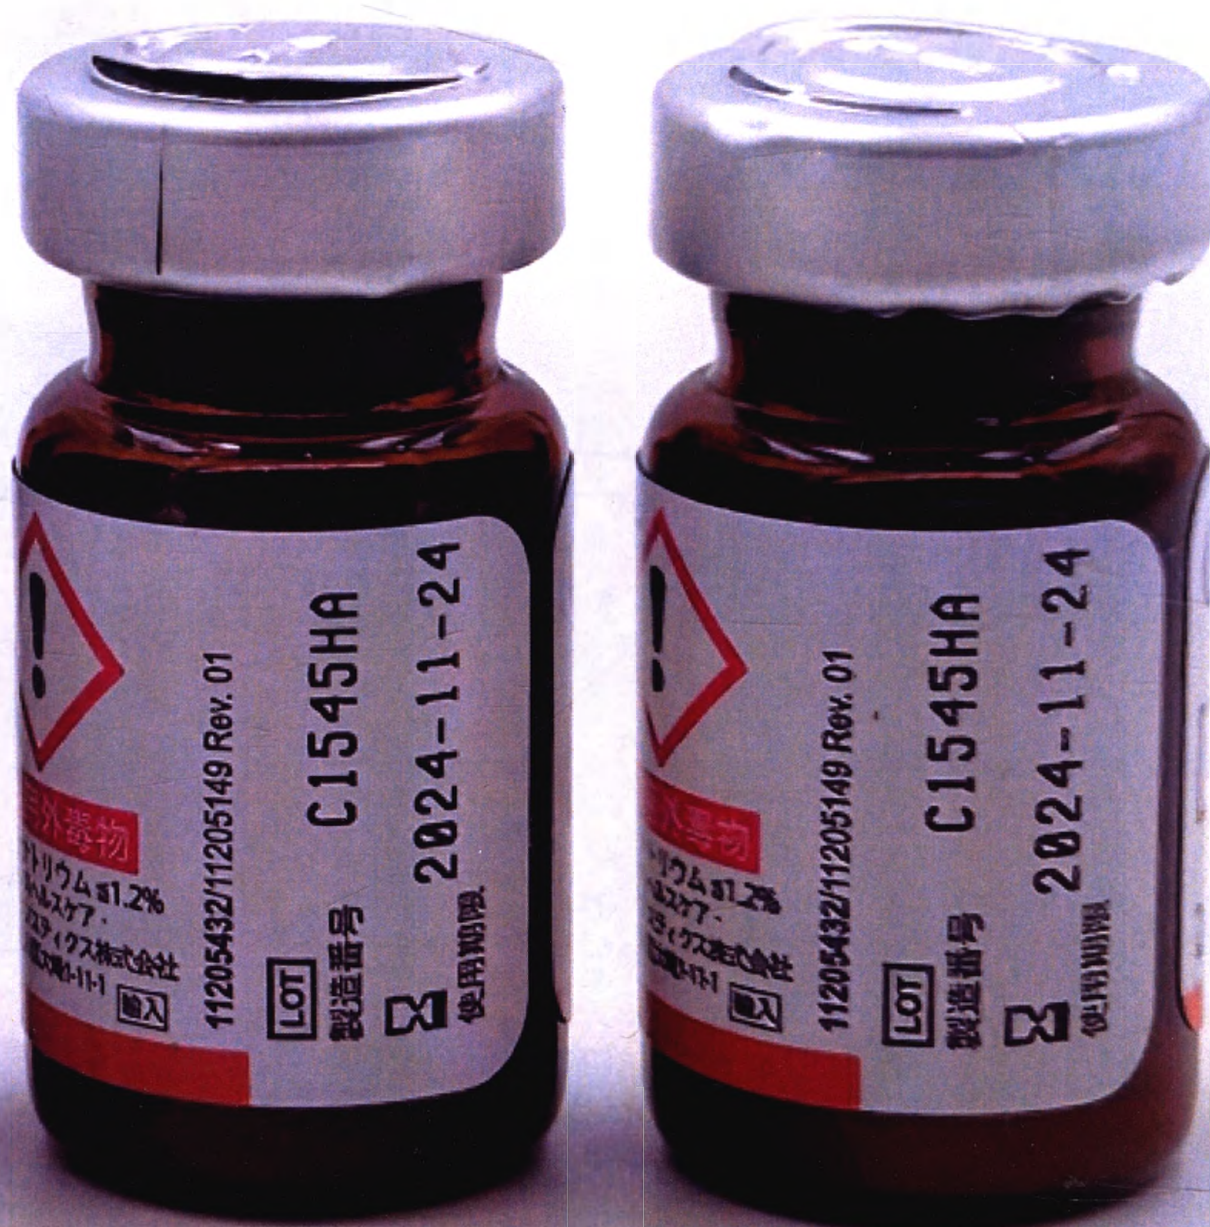


Рисунок 8. Набор калибраторов для определения CA 125II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 125II Calibrator (Atellica IM CA 125II CAL)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CA 125II CAL H, 2,0 мл

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CAL
CA125

CAL LOT VAL

LOT

C1539

製造番号



2021-10-02

使用期限



[siemens.com/document-library](https://www.siemens.com/document-library)



45281111

CHECKSUM

CAL L

CAL H

UNITS C

UNITS SI

UNITS C

UNITS SI

CA125



16.3 U/ML

564 U/ML

10907540 Rev. 02

Рисунок 9. Набор калибраторов для определения CA 125II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 125II Calibrator (Atellica IM CA 125II CAL)): Лист значений параметров серии калибратора

10995483 Набор калибраторов для определения СА 125II для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM CA 125II Calibrator (Atellica IM CA 125II CAL))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2020/12468 от 09.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Всего прошито и пронумеровано
11 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

