



Р-ФАРМ

Инновационные
технологии
здоровья

Акционерное общество «Р-Фарм»

ул.Берзарина, д.19, корп.1, Москва, 123154
Телефон: (+7 495) 956-79-37 (многоканальный)

Факс: (+7 495) 956-79-38

www.r-pharm.com; e-mail: info@rpharm.ru

ОГРН 1027739700020

ИНН/КПП 7726311464/997550001

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы регистрации
медицинских изделий отдела регистрации
Медицинского департамента АО «Р-Фарм»

Гелах Е.И.

2020 г.

(на основании Доверенности №557 от 21.11.2018)

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Камера медицинская лазерная мультимедийная DRYPIX» в вариантах исполнения
(DRYPIX Smart - модель DRYPIX 6000; DRYPIX EDGE - модель DRYPIX 8000),
с принадлежностями**

2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Камера медицинская лазерная мультимедийная DRYPIX» в вариантах исполнения (DRYPIX Smart - модель DRYPIX 6000; DRYPIX EDGE - модель DRYPIX 8000), с принадлежностями

I. «Камера медицинская лазерная мультимедийная DRYPIX EDGE - модель DRYPIX 8000», в составе:

1. Камера медицинская лазерная мультимедийная DRYPIX EDGE - модель DRYPIX 8000 – 1 шт.
2. Кабель питания (при необходимости) – 1 шт.
3. Компакт-диск с индивидуальными данными – 1 шт.
4. Компакт-диск с программным обеспечением основного блока – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
6. Компакт-диск со справочным руководством, справочным руководством по контролю качества – 1 шт.
7. Очистной валик – (при необходимости) 10 шт.

II. Принадлежности:

1. Сортировщик для пленки – 1 шт.
2. Набор креплений для фиксации камеры к полу – 1 набор.

I. «Камера медицинская лазерная мультимедийная DRYPIX Smart - модель DRYPIX 6000», в составе:

1. Камера медицинская лазерная мультимедийная DRYPIX Smart - модель DRYPIX 6000 – 1 шт.
2. Кабель питания (при необходимости) – 1 шт.
3. Компакт-диск с индивидуальными данными – 1 шт.
4. Компакт-диск с программным обеспечением основного блока – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
6. Компакт-диск со справочным руководством, справочным руководством по контролю качества – 1 шт.
7. Краткое руководство – 1 шт.
8. Очистной валик – (при необходимости) 10 шт.

II. Принадлежности:

1. Дополнительный лоток для пленки – не более 10 шт.
2. Дополнительный набор креплений для фиксации камеры к полу – 1 набор.
3. Дополнительный набор присосок – 1 набор.



Рис. 1 «Камера медицинская лазерная мультиформатная DRYPIX EDGE - модель DRYPIX 8000»,

– вид спереди



Рис. 2 «Камера медицинская лазерная мультиформатная DRYPIX EDGE - модель DRYPIX 8000»,

— вид сзади



**Рис. 3 «Камера медицинская лазерная мультиформатная DRYPIX EDGE - модель DRYPIX 8000»,
– вид слева**



**Рис. 4 «Камера медицинская лазерная мультиформатная DRYPIX EDGE - модель DRYPIX 8000»,
– вид справа**

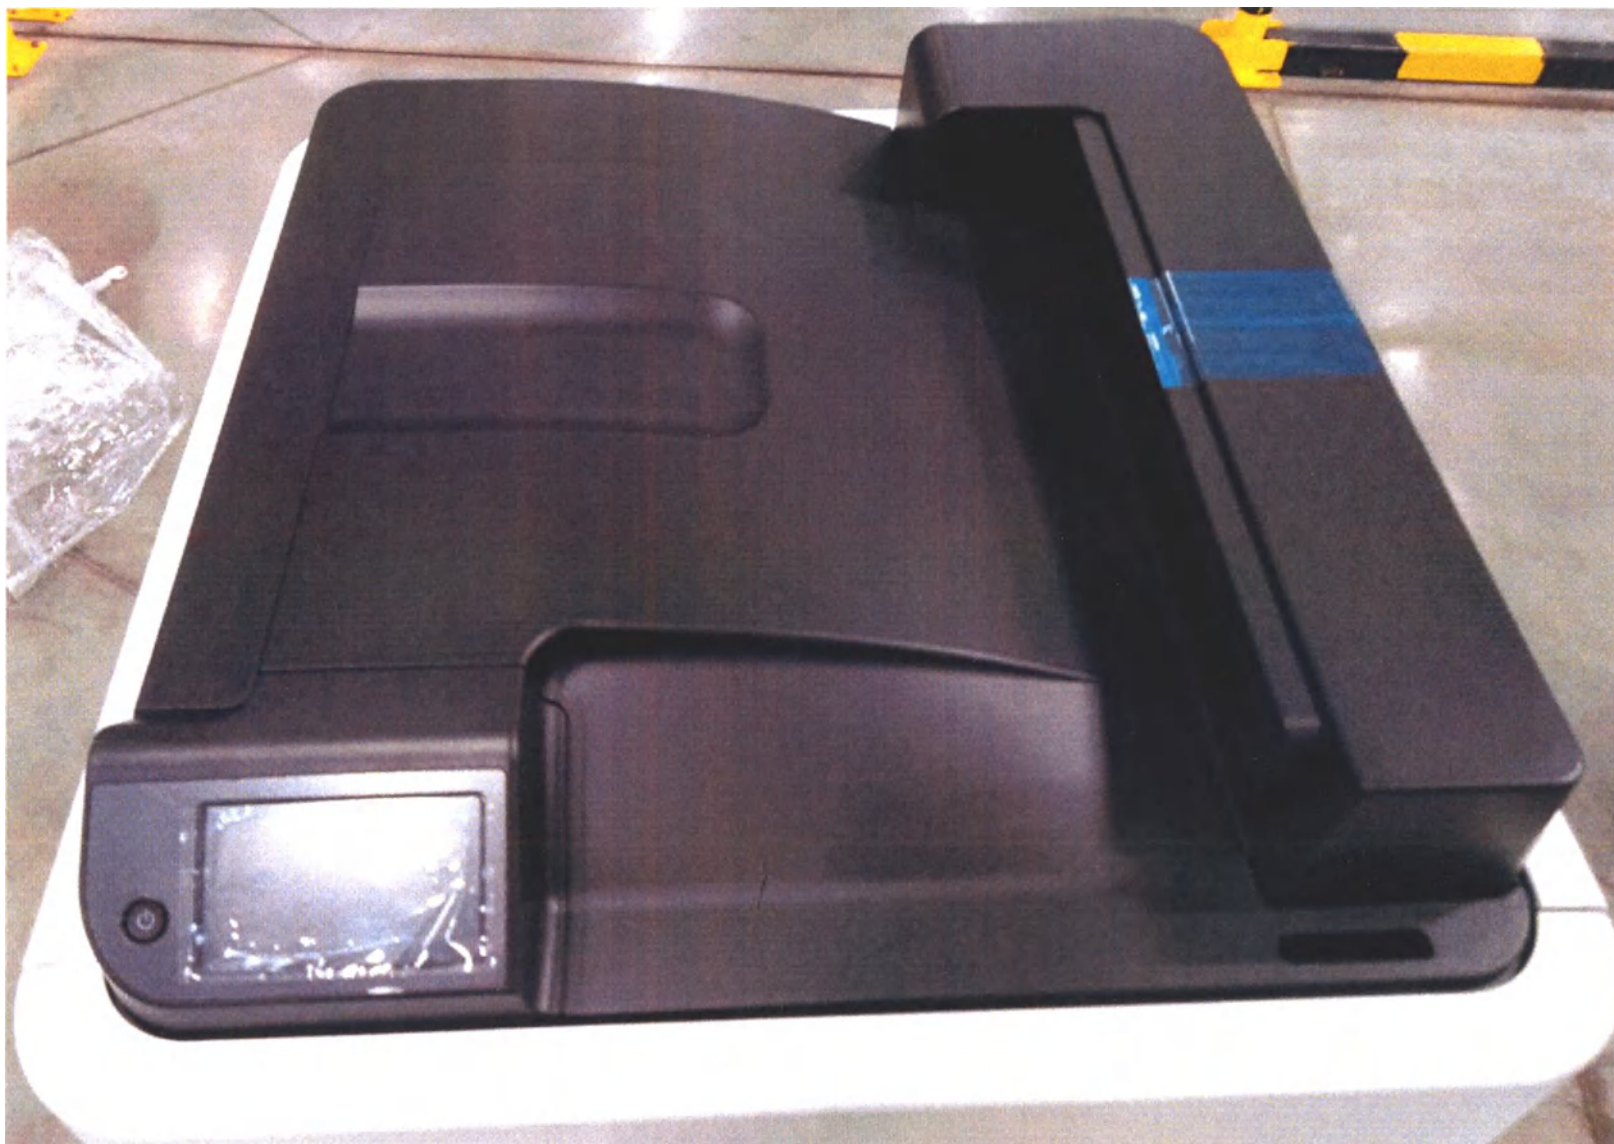


Рис. 5 «Камера медицинская лазерная мультиформатная DRYPIX EDGE - модель DRYPIX 8000», вид сверху

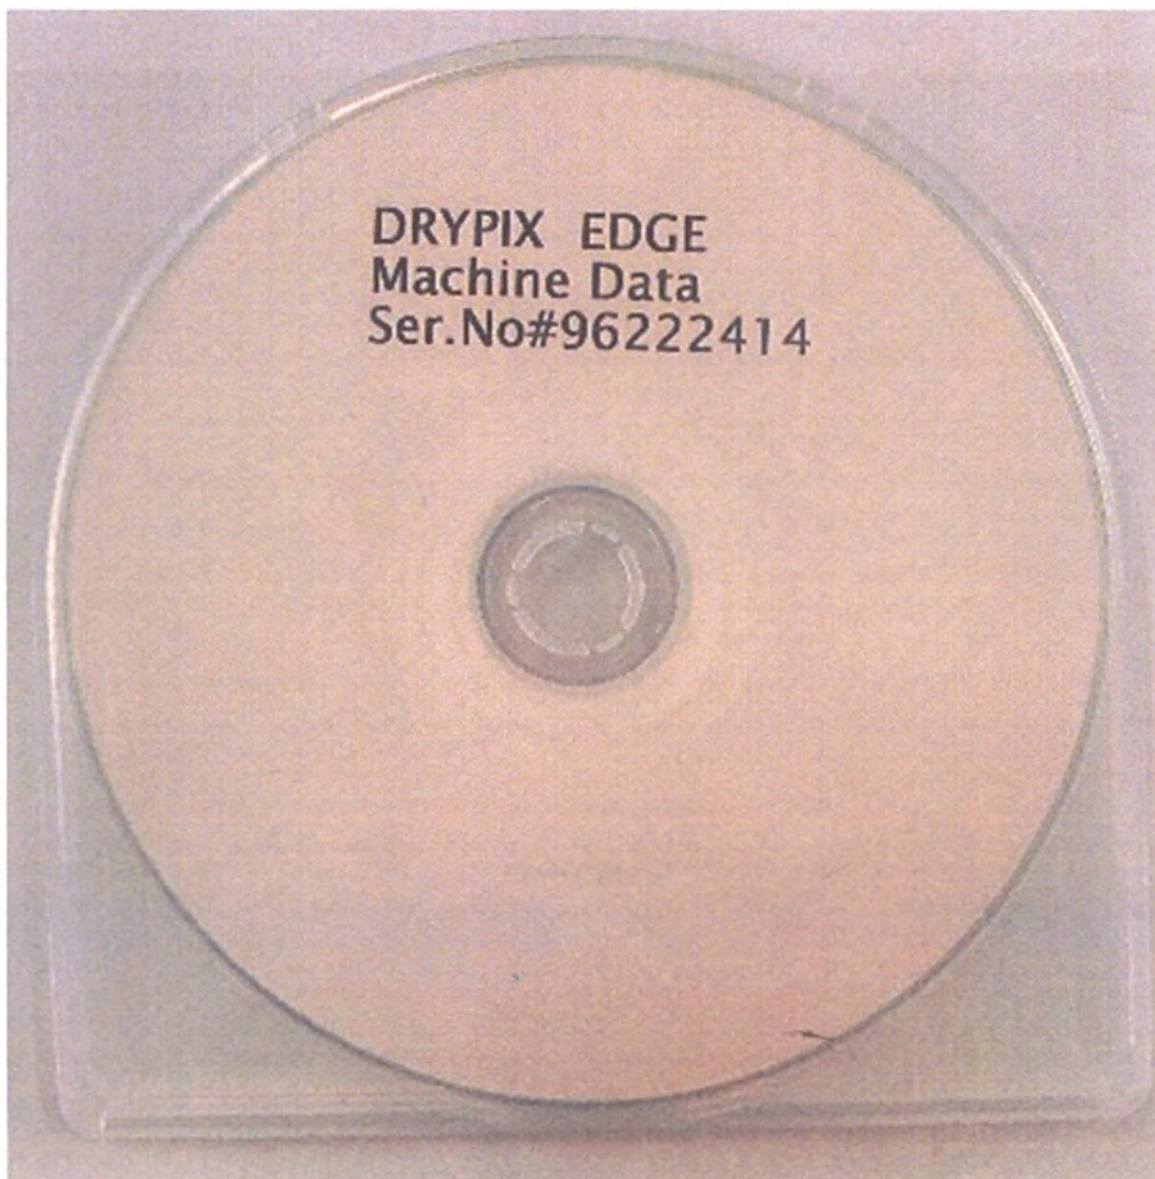


Рис. 6 Компакт-диск с программным обеспечением основного блока



Рис. 7 Диск со справочным руководством и руководством по контролю качества

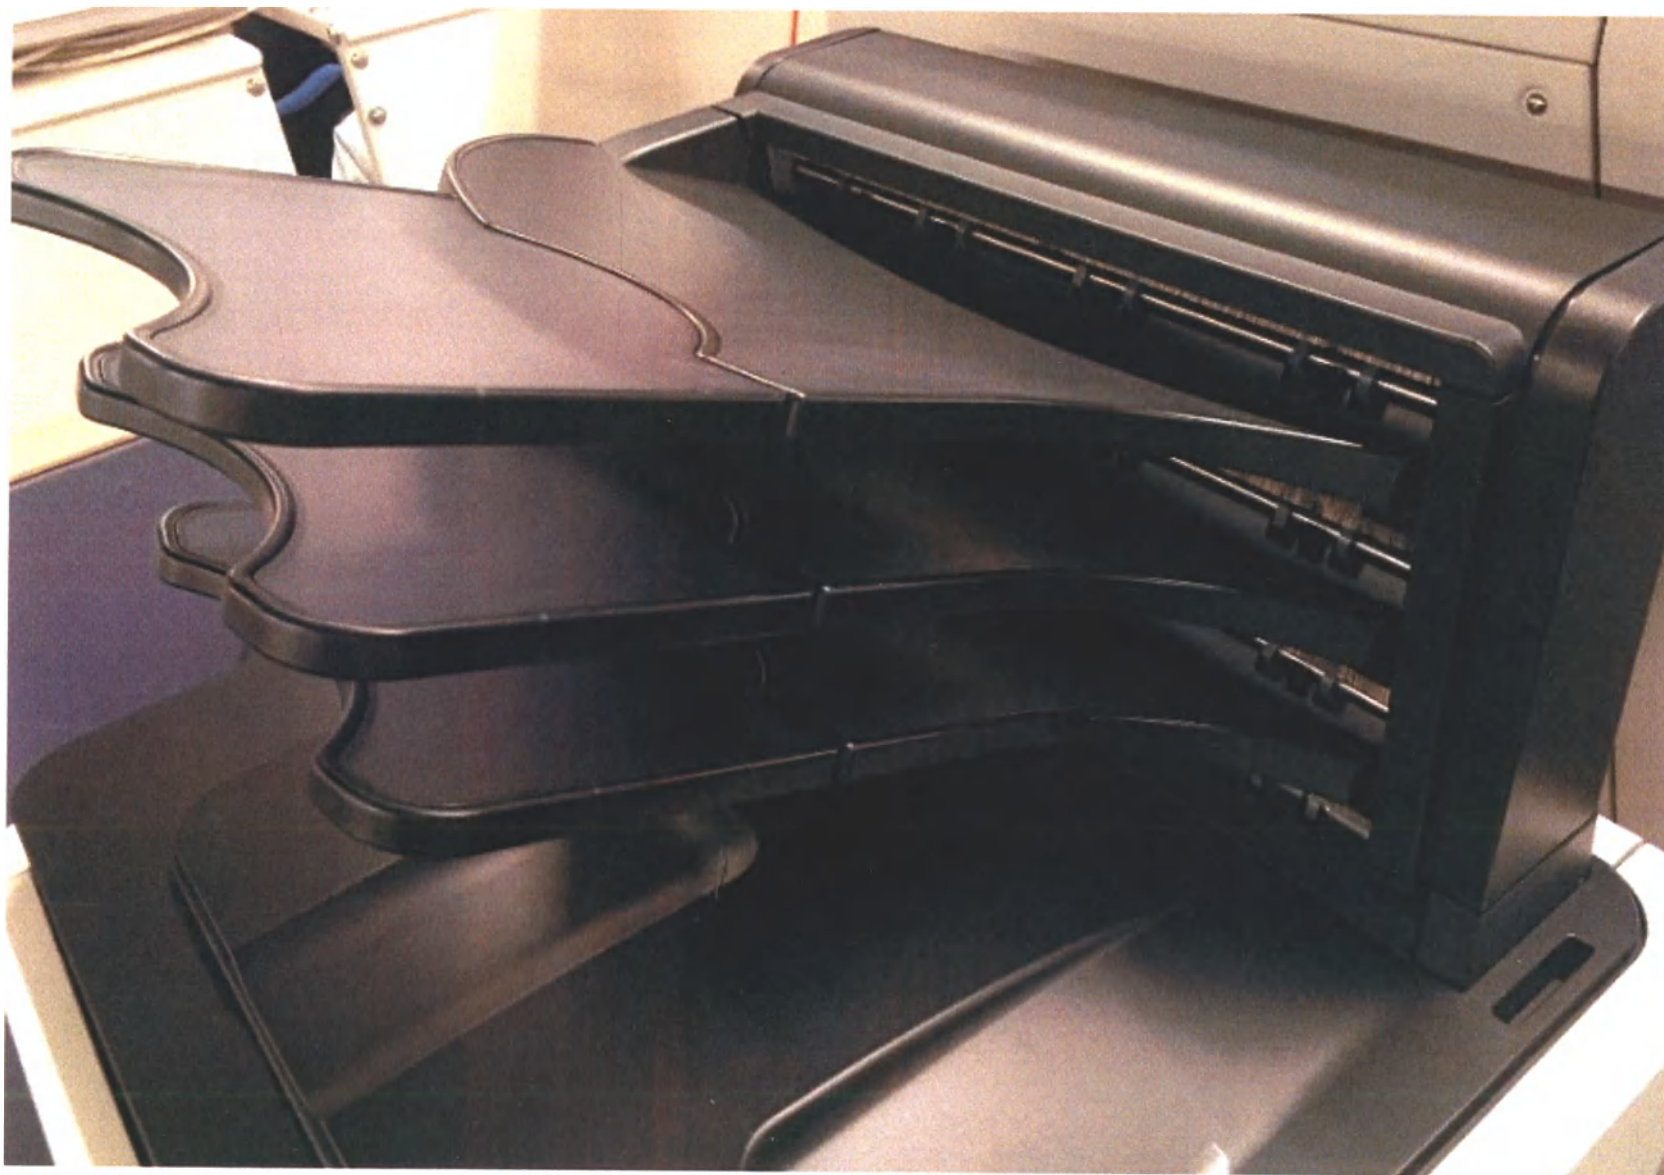


Рис. 8 Сортировщик для пленки

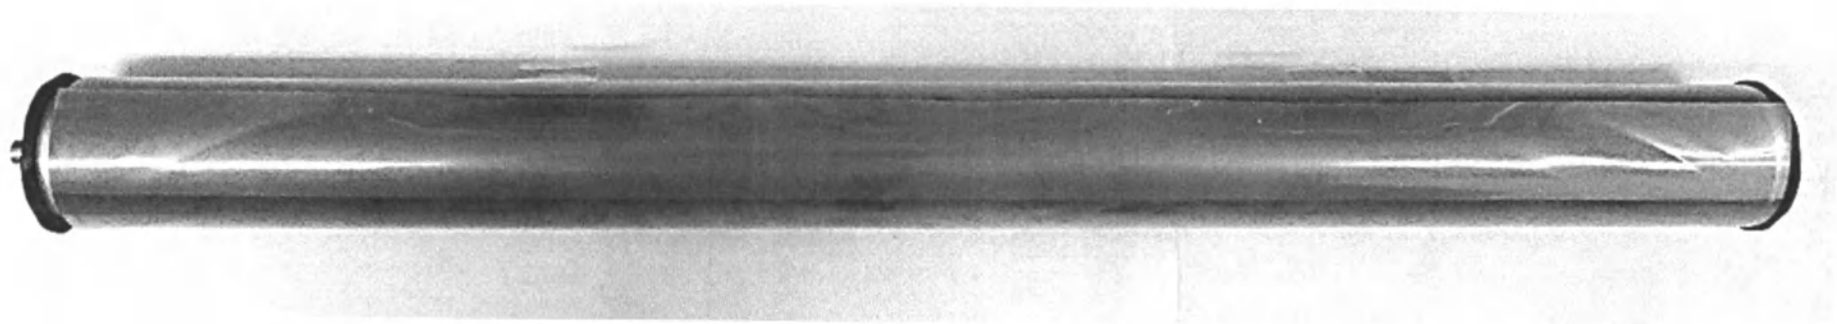


Рис. 9 Очистной валик



Рис. 10 Набор креплений для фиксации камеры к полу



Рис. 11 «Камера медицинская лазерная мультiformатная DRYPIX Smart - модель DRYPIX 6000» - вид спереди.



Рис. 12 «Камера медицинская лазерная мультимедийная DRYPIX Smart - модель DRYPIX 6000» - вид сбоку



Рис. 13 «Камера медицинская лазерная мультиформатная DRYPIX Smart - модель DRYPIX 6000» - вид сзади

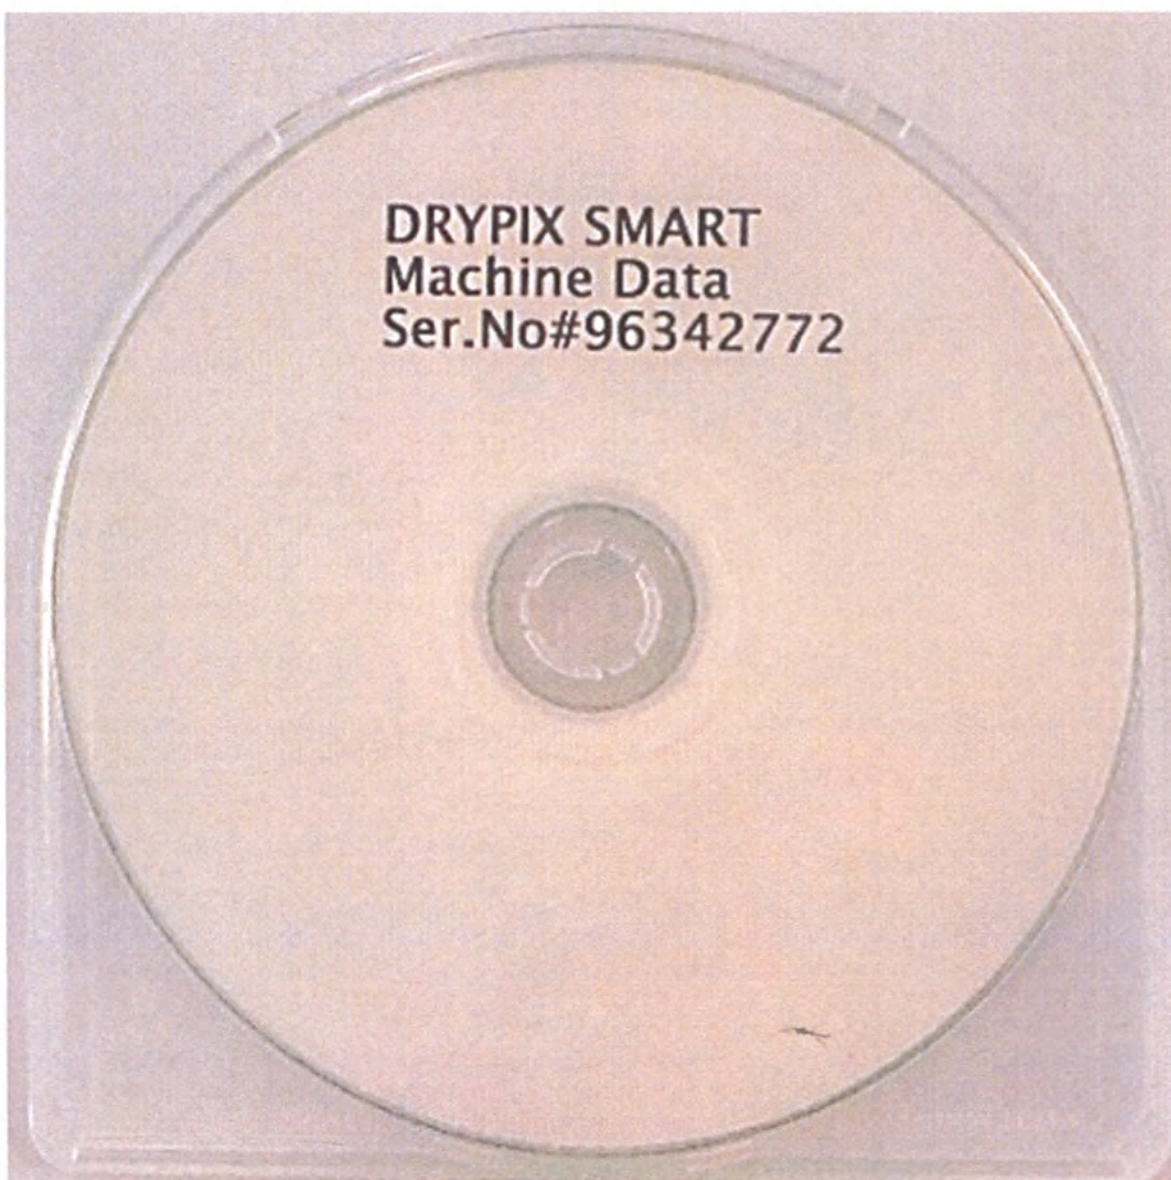


Рис. 14 Компакт-диск с программным обеспечением основного блока

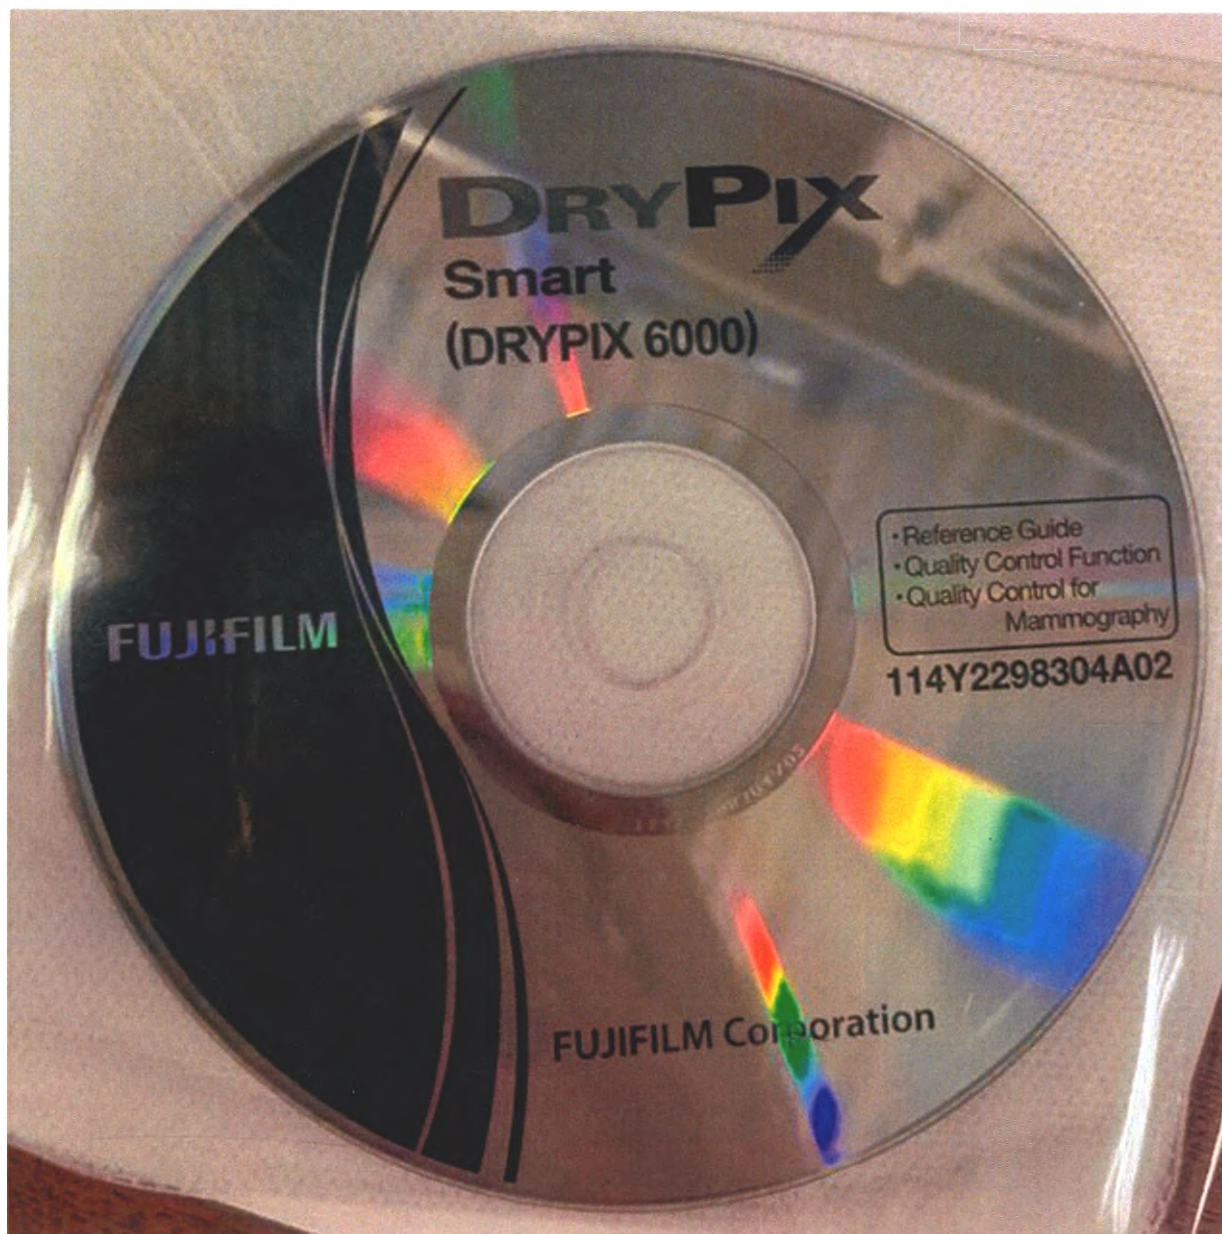


Рис. 15 Диск со справочным руководством и руководством по контролю качества



Рис. 16 Очистной валик



Рис. 17 Дополнительный лоток для пленки

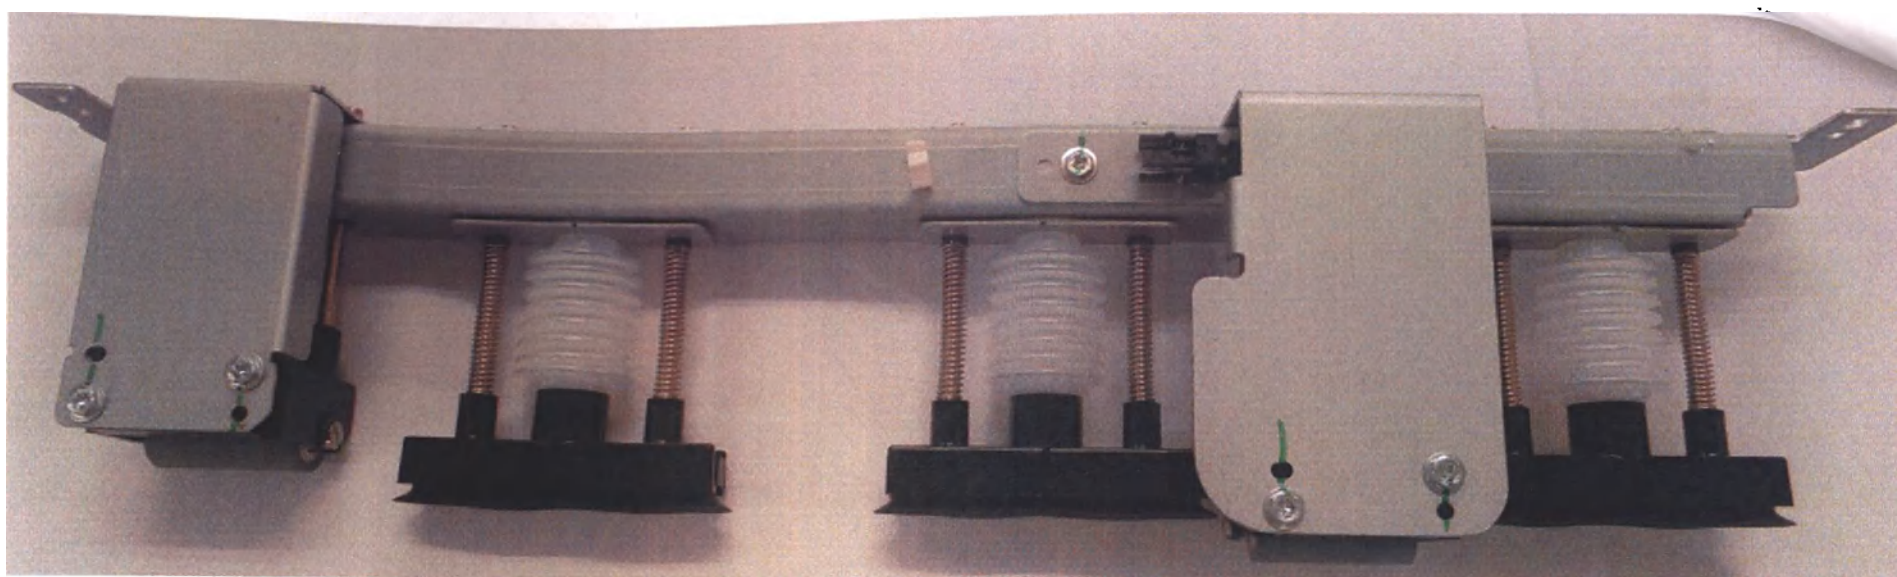


Рис. 18 Дополнительный набор присосок



Рис. 19 Дополнительный набор креплений для фиксации камеры к полу

прошито, сиринено
посыто, и заверено
един лист

