

Директор зонального бизнес – подразделения
«Системы диагностической визуализации»

ООО «Сименс Здравоохранение»

Аспидов А.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

«Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Freestyle с принадлежностями»,
производства «Siemens Medical Solutions USA, Inc.»
(Сименс Медикал Солюшенс США, Инк.), США

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Freestyle с принадлежностями»



Рисунок 1. Общий вид медицинского изделия

Фотографические изображения базового блока медицинского изделия:
«Система ультразвуковая диагностическая **ACUSON Freestyle** с принадлежностями»



Рисунок 2. Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Freestyle со встроенным экраном визуализации



Рисунок 3. Системное программное обеспечение



Рисунок 4. Операционная система



Рисунок 5. Кабель питания




Рисунок 6. Датчик линейный L13-5 беспроводной и/или проводной



Рисунок 7. Датчик конвексный C5-2 беспроводной и/или проводной



Рисунок 8. Датчик линейный L8-3 беспроводной и/или проводной

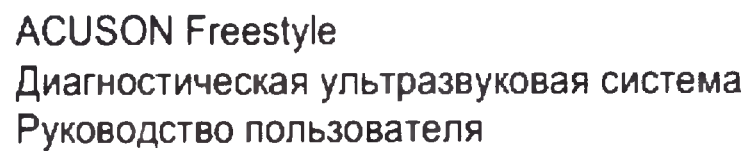

US



11002790_01 Russian

Рисунок 9. Документация пользователя на русском языке

Фотографические изображения принадлежностей для медицинского изделия:
«Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Freestyle с принадлежностями»

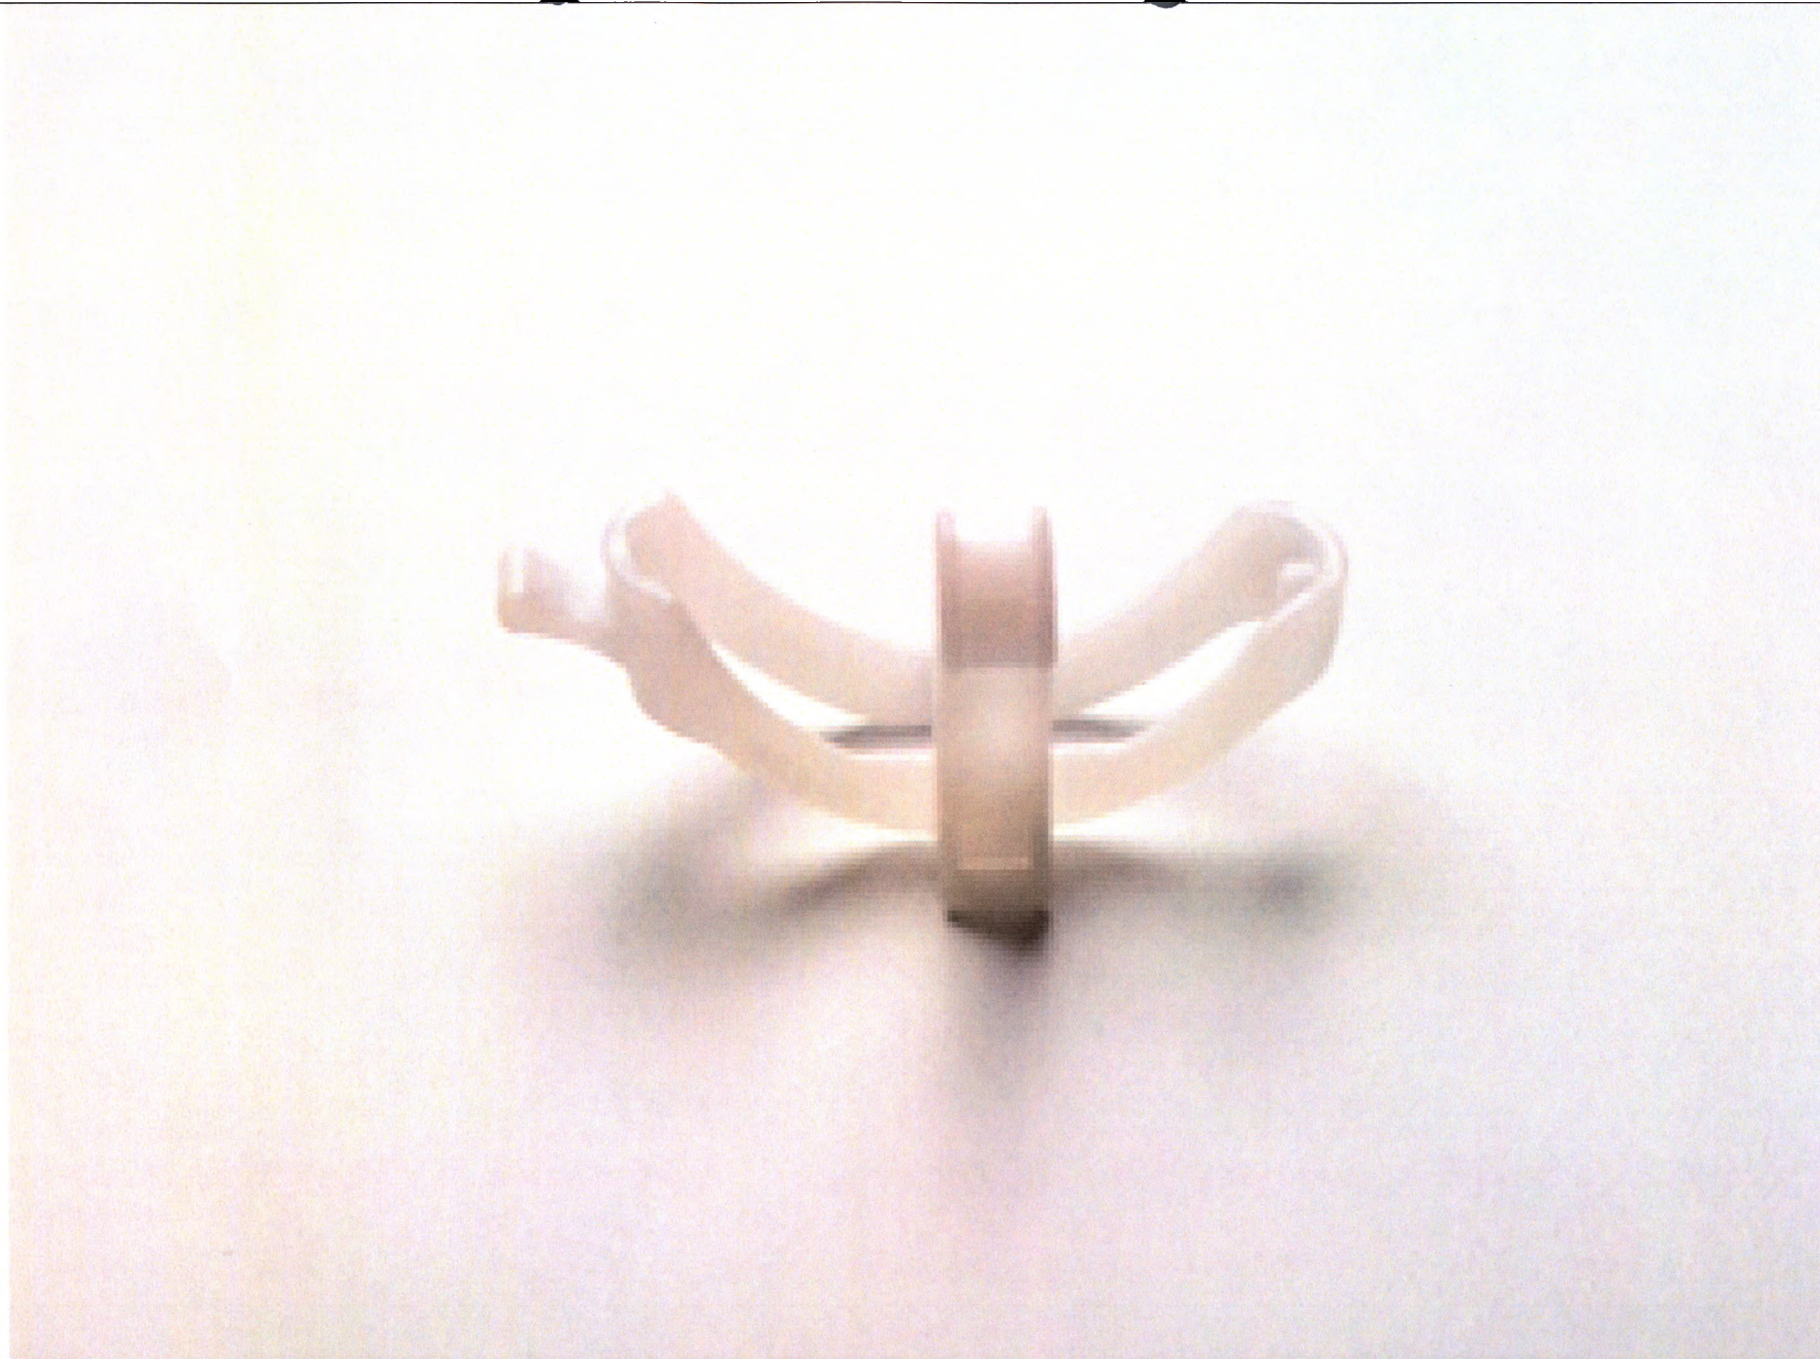


Рисунок 10. Адаптеры иглопроводника для датчика L13-5 с центральным положением направляющей биопсийной иглы

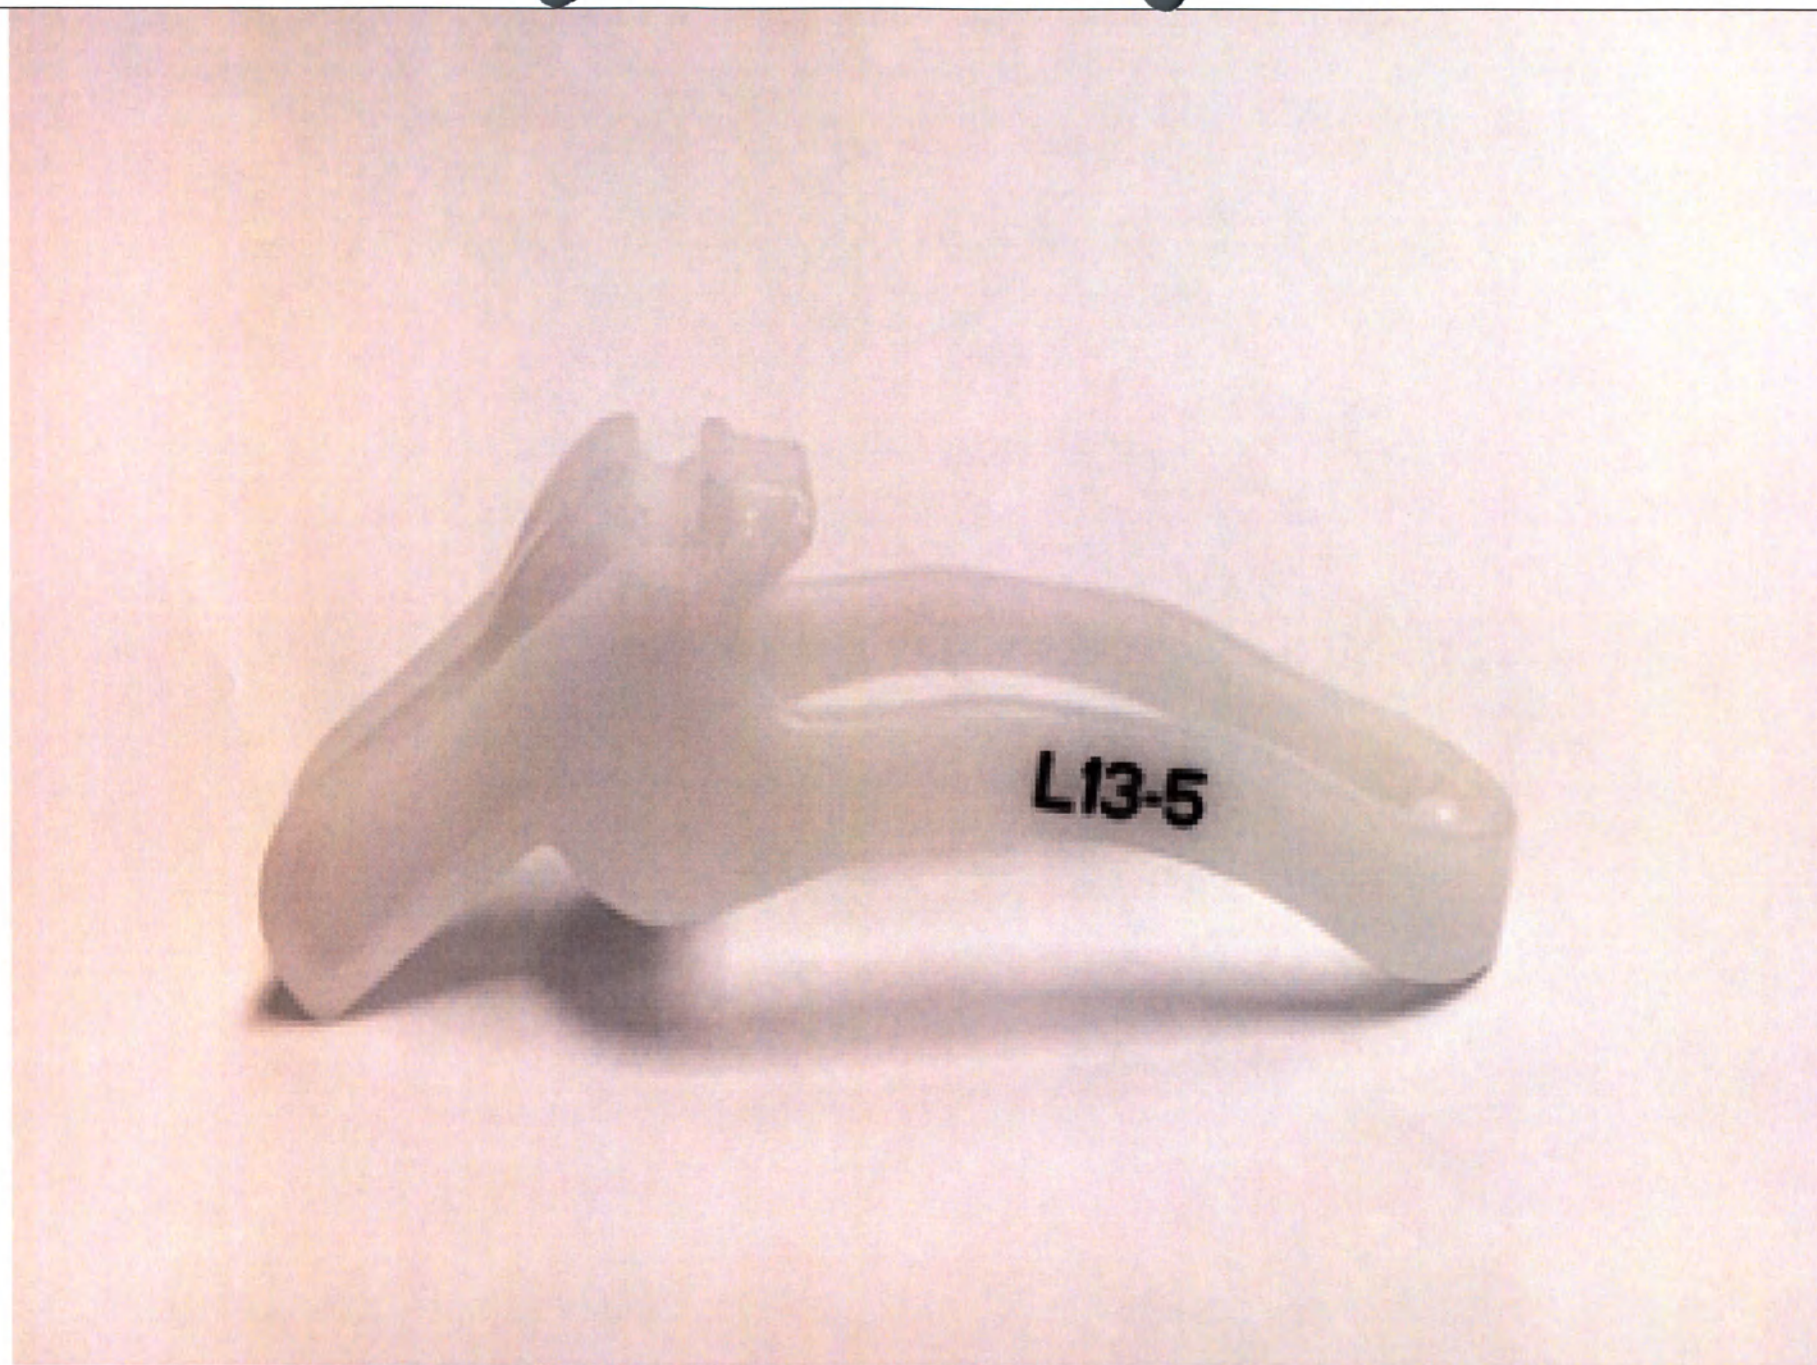


Рисунок 11. Адаптеры иглопроводника для датчика L13-5 с латеральным положением направляющей биопсийной иглы



Рисунок 12. Адаптеры иглопроводника для датчика C5-2

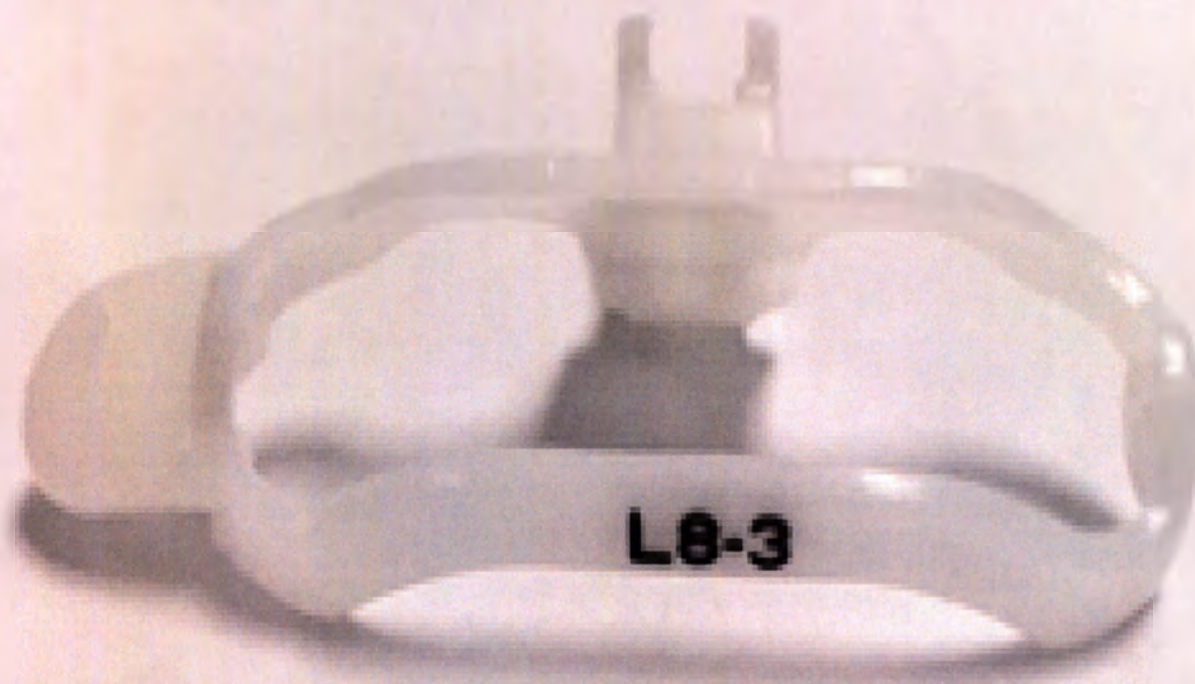


Рисунок 13. Адаптеры иглопроводника для датчика L8-3 с центральным положением направляющей биопсийной иглы



Рисунок 14. Адаптеры иглопроводника для датчика L8-3 с латеральным положением направляющей биопсийной иглы



Рисунок 15. Стерильные оболочки для датчиков

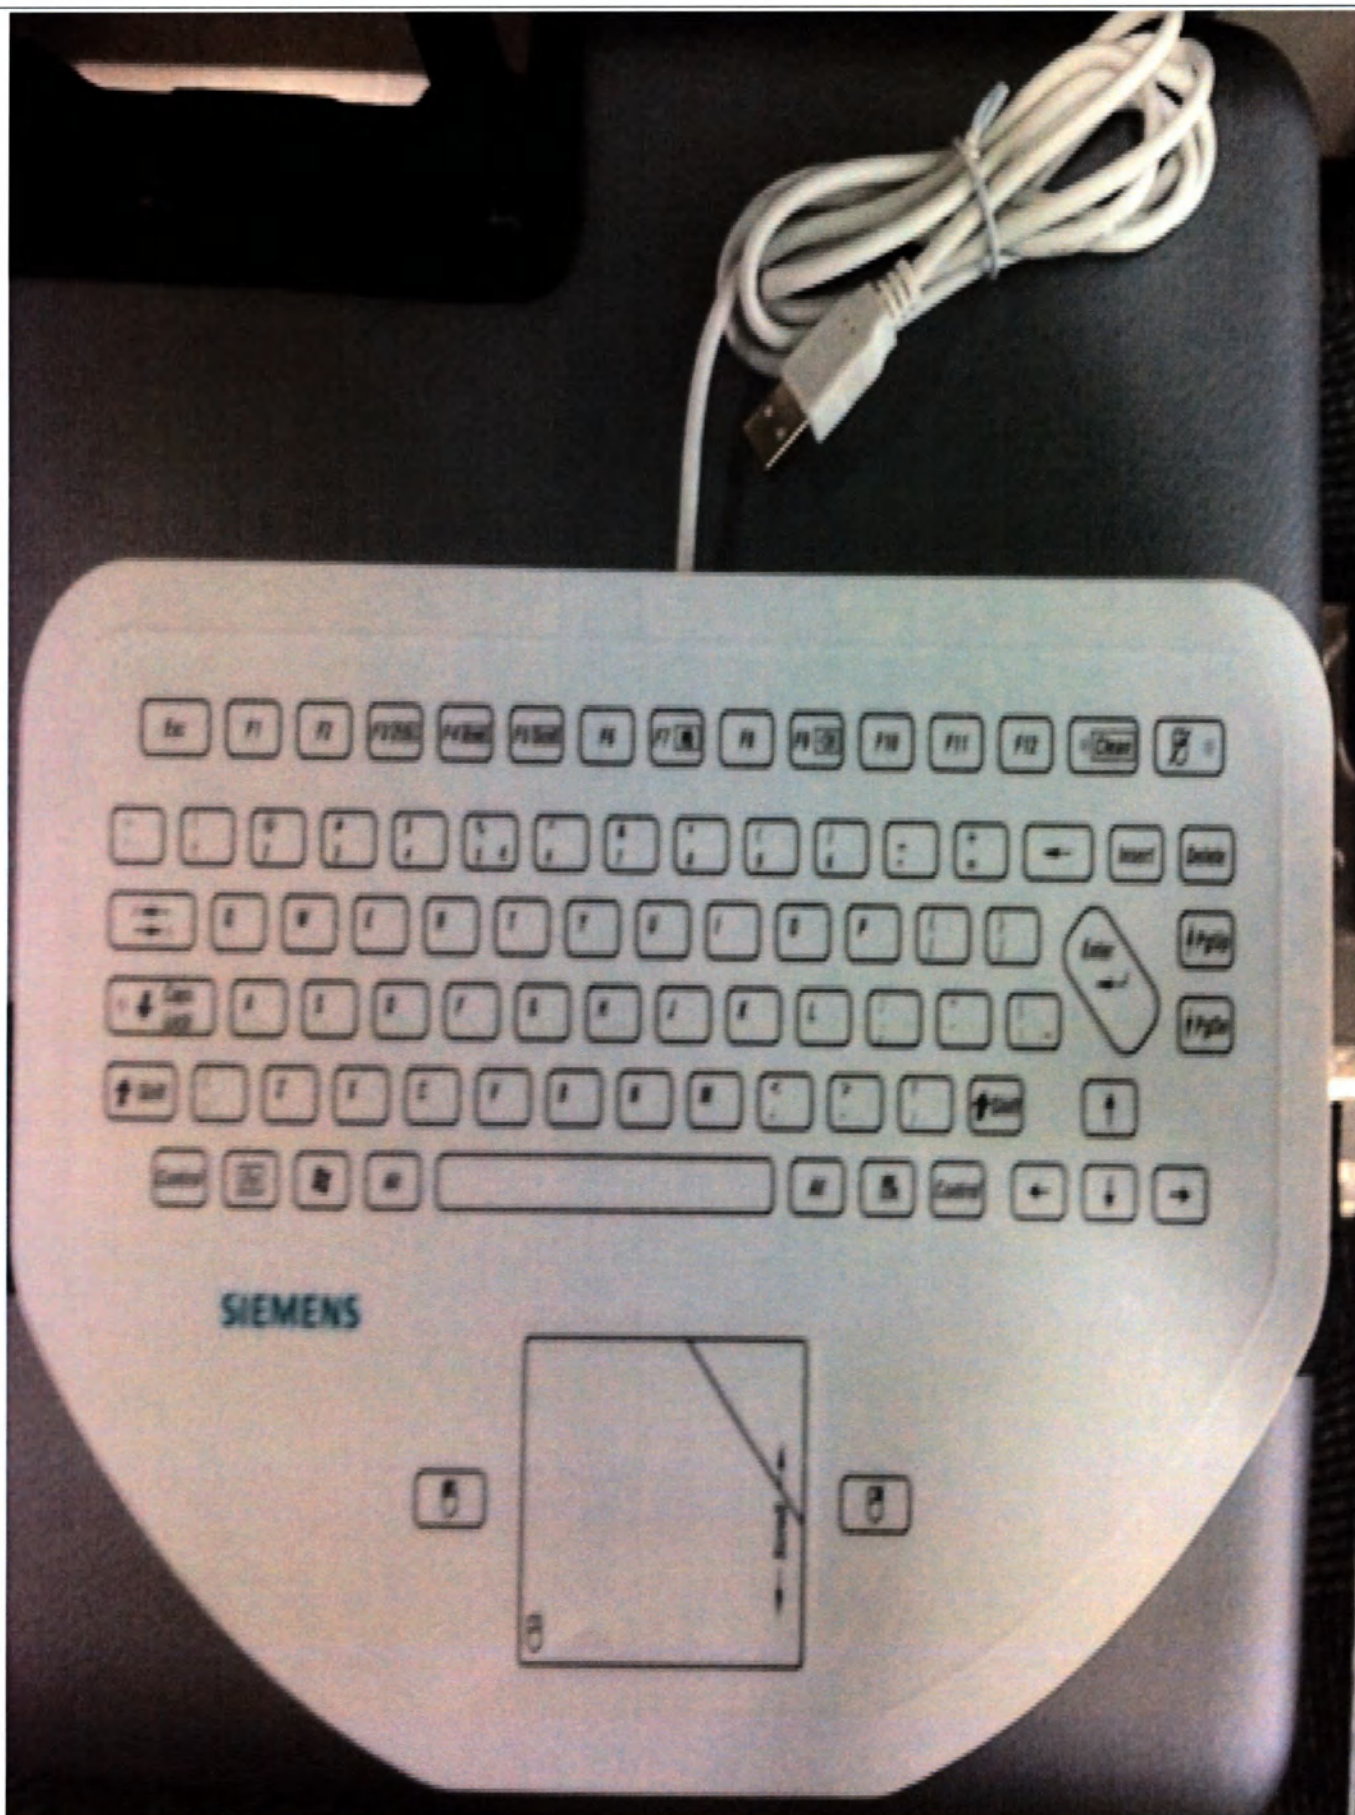


Рисунок 16. Клавиатура внешняя

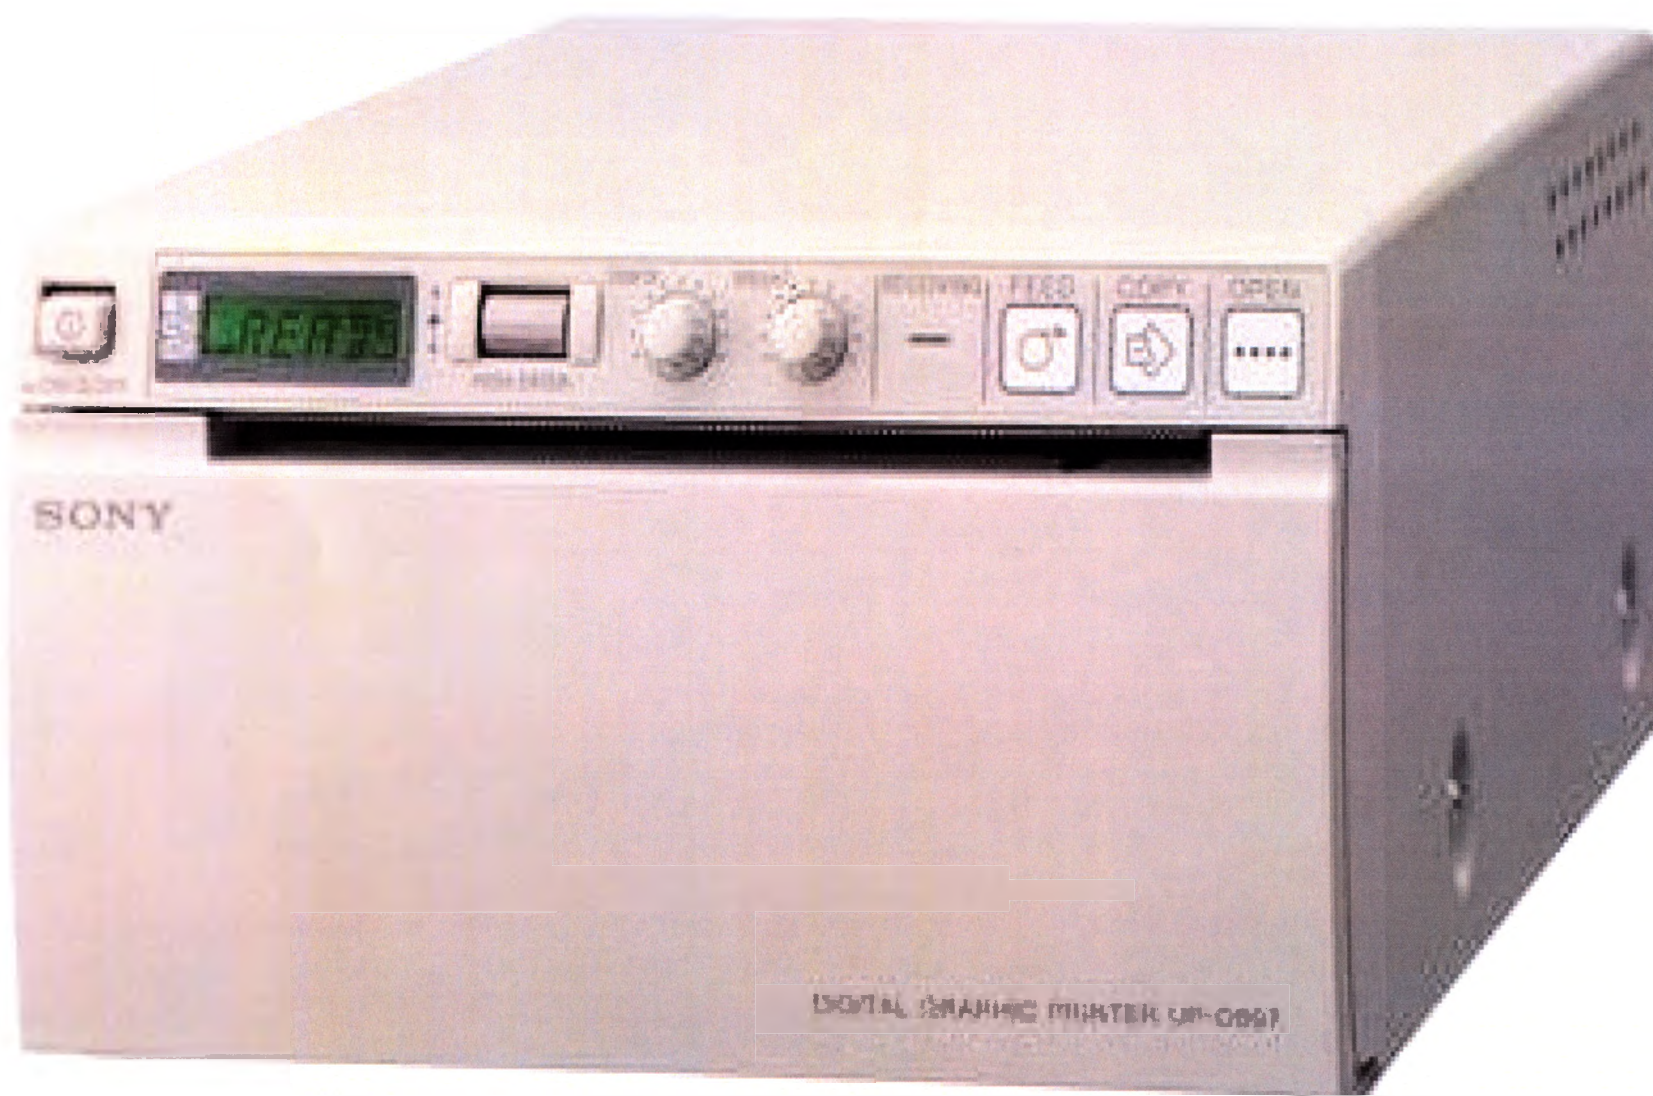


Рисунок 17. Принтер черно-белый для печати медицинских изображений



Рисунок 18. Кабель – адаптер для проводного подключения датчиков



Рисунок 19. Интерфейс Ethernet



Рисунок 20.1 Транспортировочный чемодан твердый



Рисунок 20.2 Транспортировочный чемодан мягкий

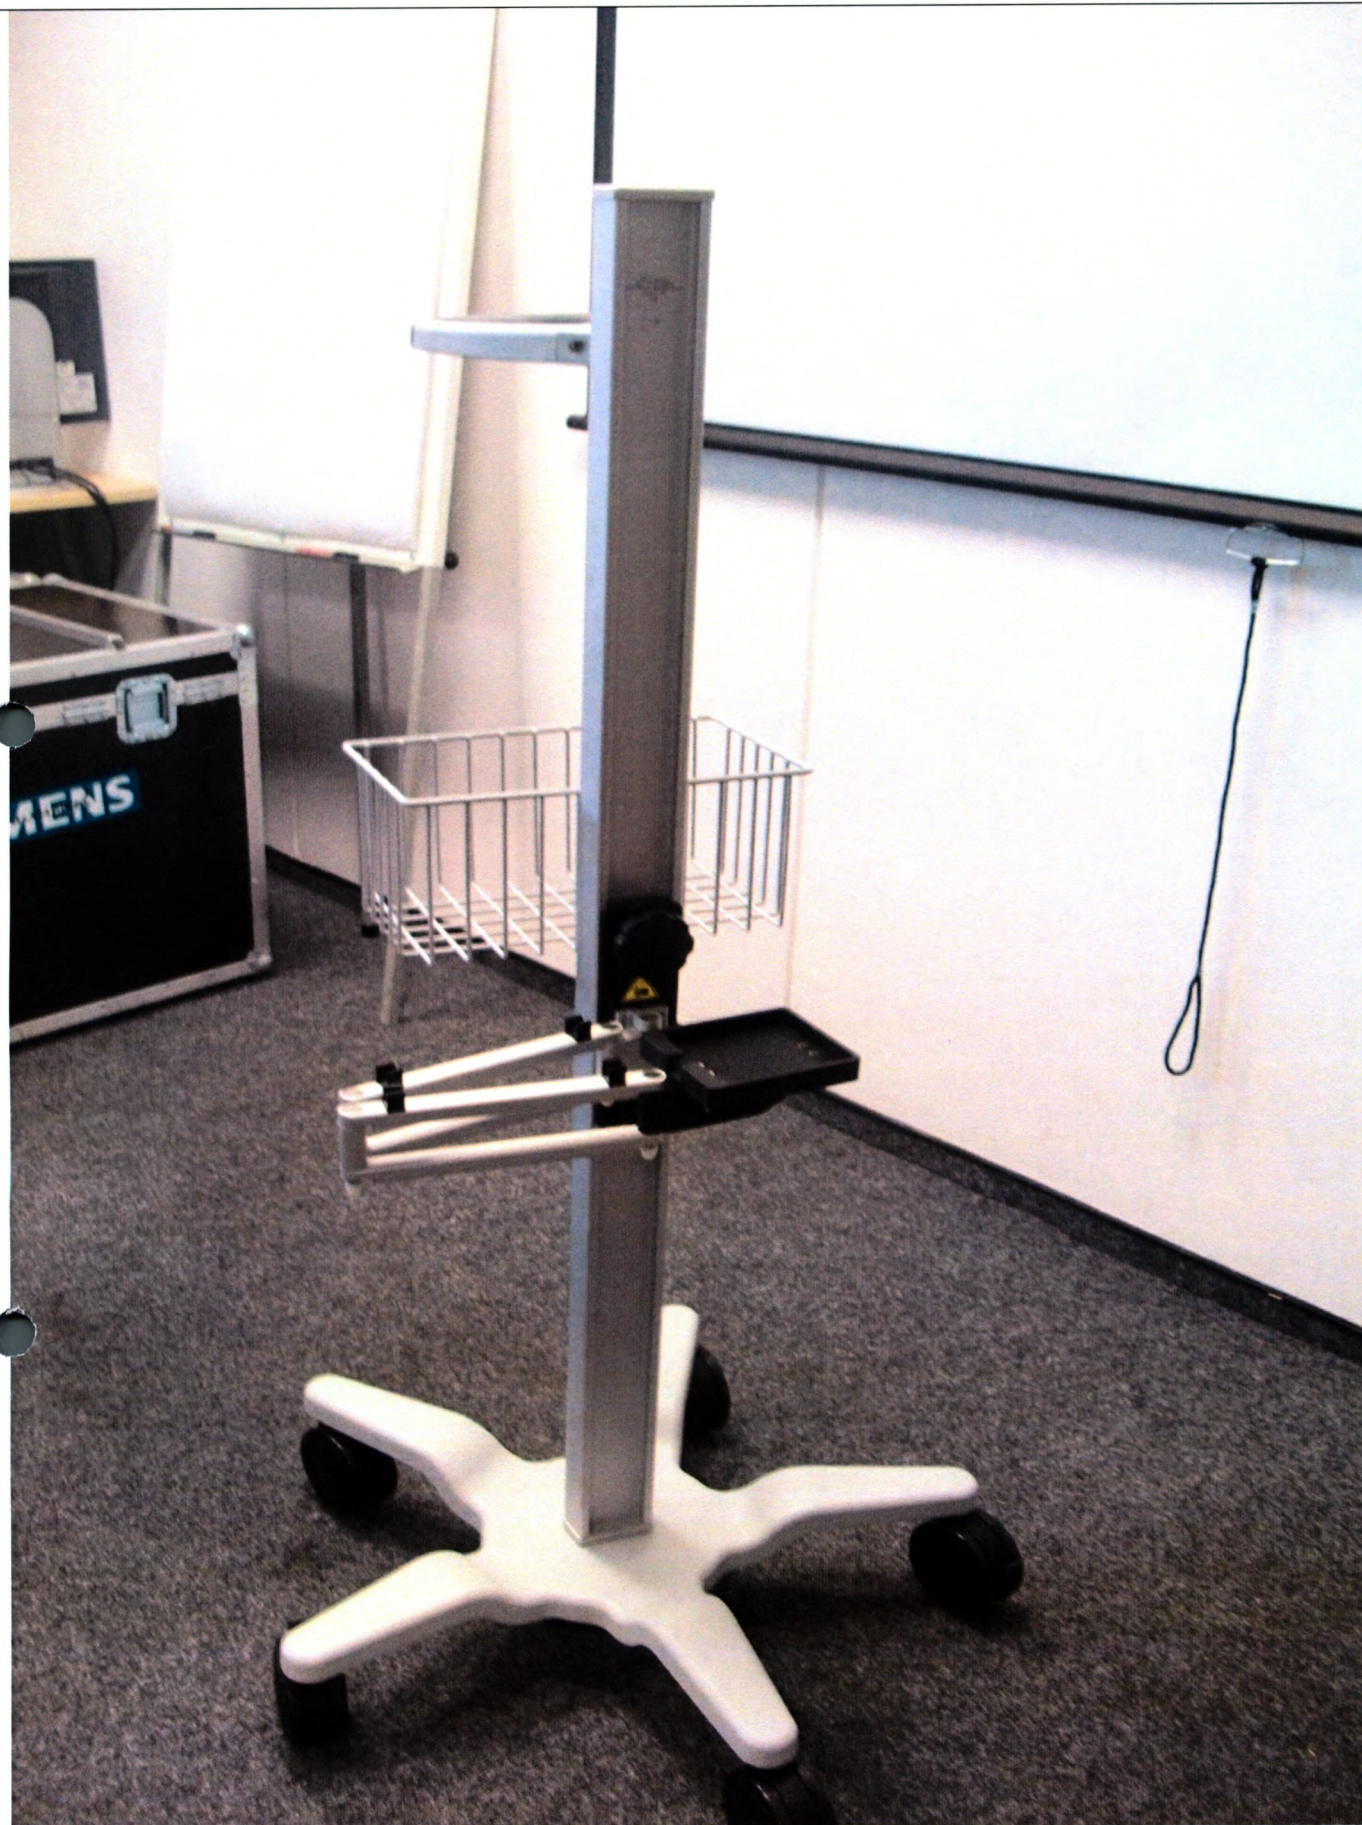


Рисунок 21. Стойка универсальная



Рисунок 22. Кабель



Рисунок 23.1 Дополнительные батареи для датчиков

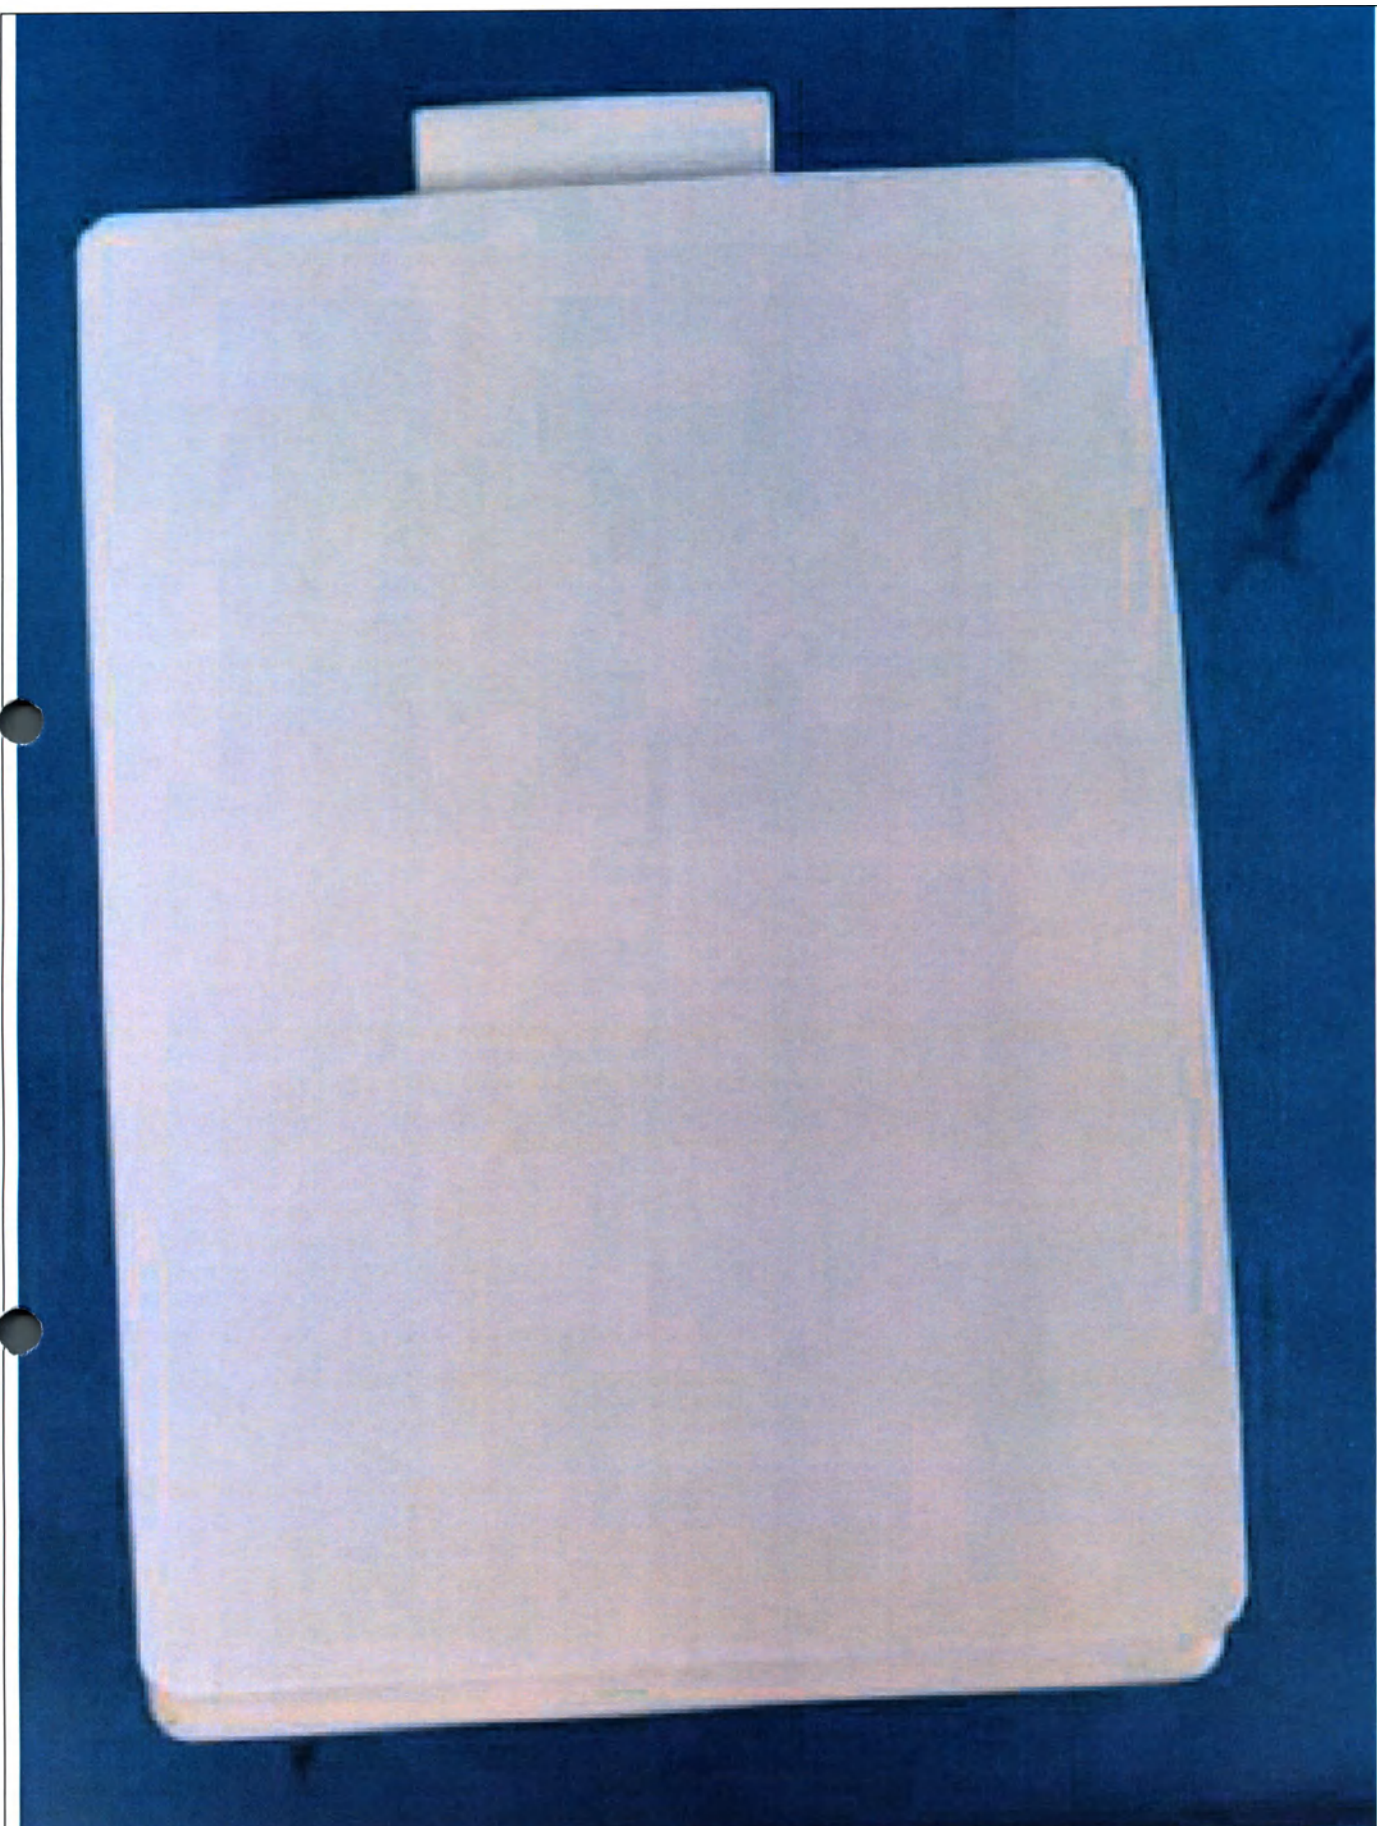


Рисунок 23.2 Дополнительные батареи для датчиков

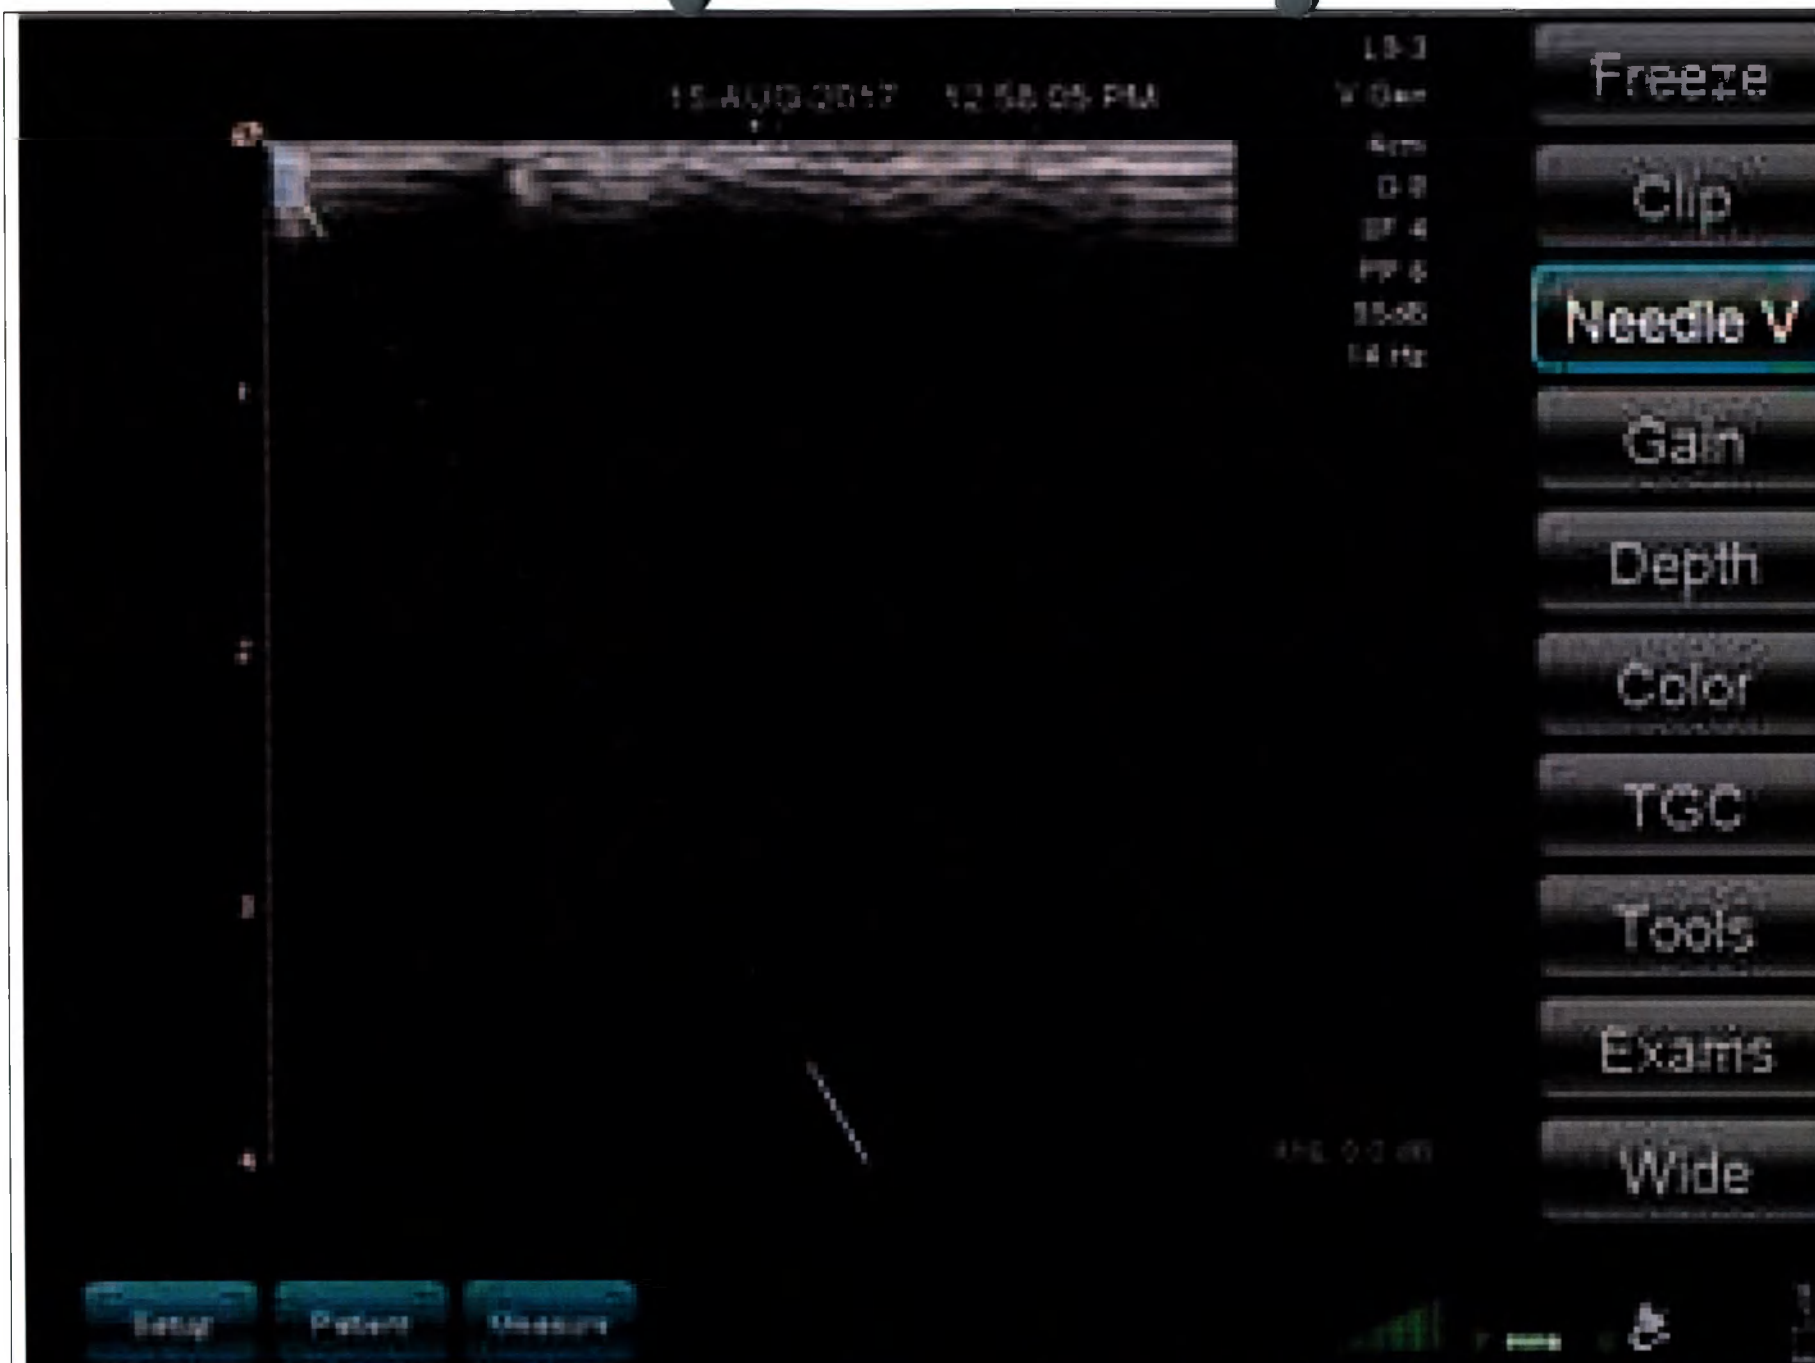


Рисунок 24. Лицензионный ключ для улучшенной визуализации биопсийной иглы



Рисунок 25. Лицензионный ключ для поддержки формата DICOM (стандарт создания, хранения, передачи, обработки и печати медицинских данных и изображений)

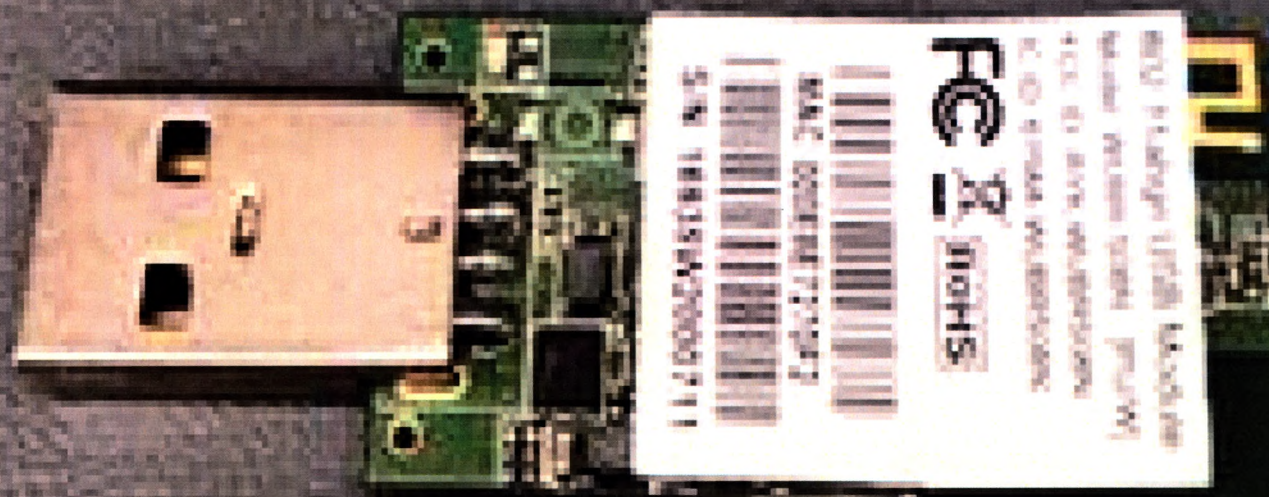


Рисунок 26. Лицензионный ключ для беспроводной передачи данных



Рисунок 27. Внешняя антенна для синхронизации изображения с ангиографическим оборудованием для семейства Artis



Рисунок 28. Крепления для коммутации с ангиографическим оборудованием



Рисунок 29. Лицензионный ключ для синхронизации изображения с ангиографическим оборудованием



Рисунок 30. Лицензионный ключ для получения изображения в формате трапеции



Рисунок 31. Лицензионный ключ для автоматической передачи полученных изображений/данных в госпитальную информационную сеть



Рисунок 32. Лицензионный ключ автоматического удаления изображений/данных для оптимизации свободного пространства

