

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Фирма К и К»



Ю.М. Стародумов


2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса
цифровой, исполнения: DS-10, DS-10a, DS-11, DS-11a.**

СОДЕРЖАНИЕ

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой DS-10	3
Маркировка прибора для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой DS-10.....	4
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой DS-10a	5
Маркировка прибора для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой DS-10a	6
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой DS-11	7
Маркировка прибора для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой DS-11.....	8
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой DS-11a	9
Маркировка прибора для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой DS-11a.....	10
Манжета: Cuff DS-10.....	11
Манжета: Cuff DS-11.....	12
Элементы питания AA x 1,5B	13
Источник электропитания ADP-W5	14
Сумка (для DS-10, DS-10a, DS-11a, DS-11a)	15
Гарантийный талон (DS-10, DS-10a, DS-11, DS-11a)	16
Упаковка (коробка) DS-10	17
Упаковка (коробка) DS-10a	18
Упаковка (коробка) DS-11	19
Упаковка (коробка) DS-11a	20
Маркировка потребительской упаковки медицинского изделия для Российской Федерации:	21

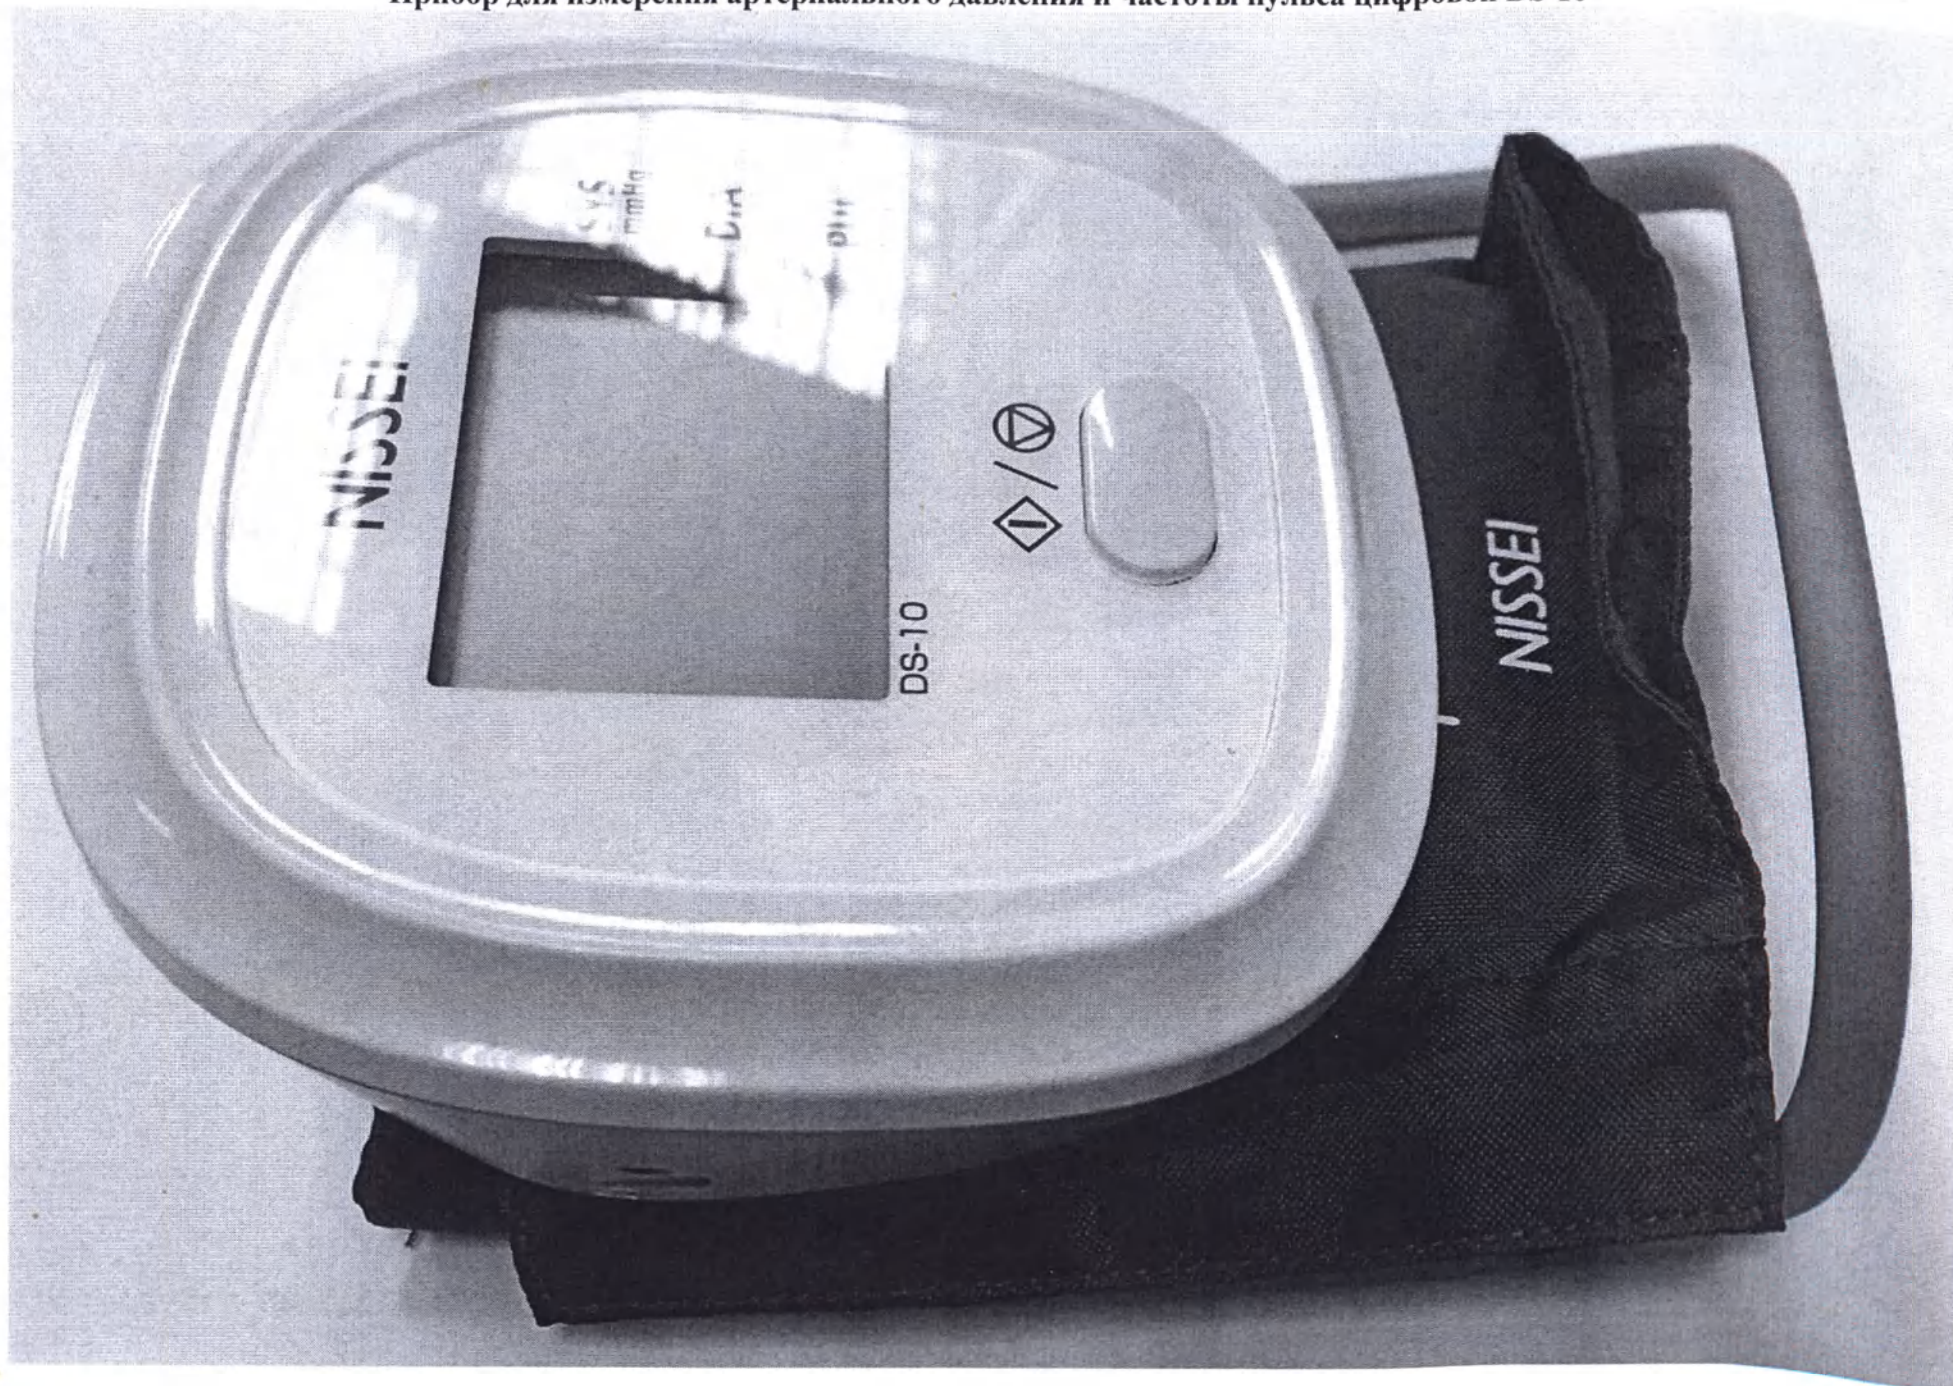



Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой DS-10a










Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой DS-11a

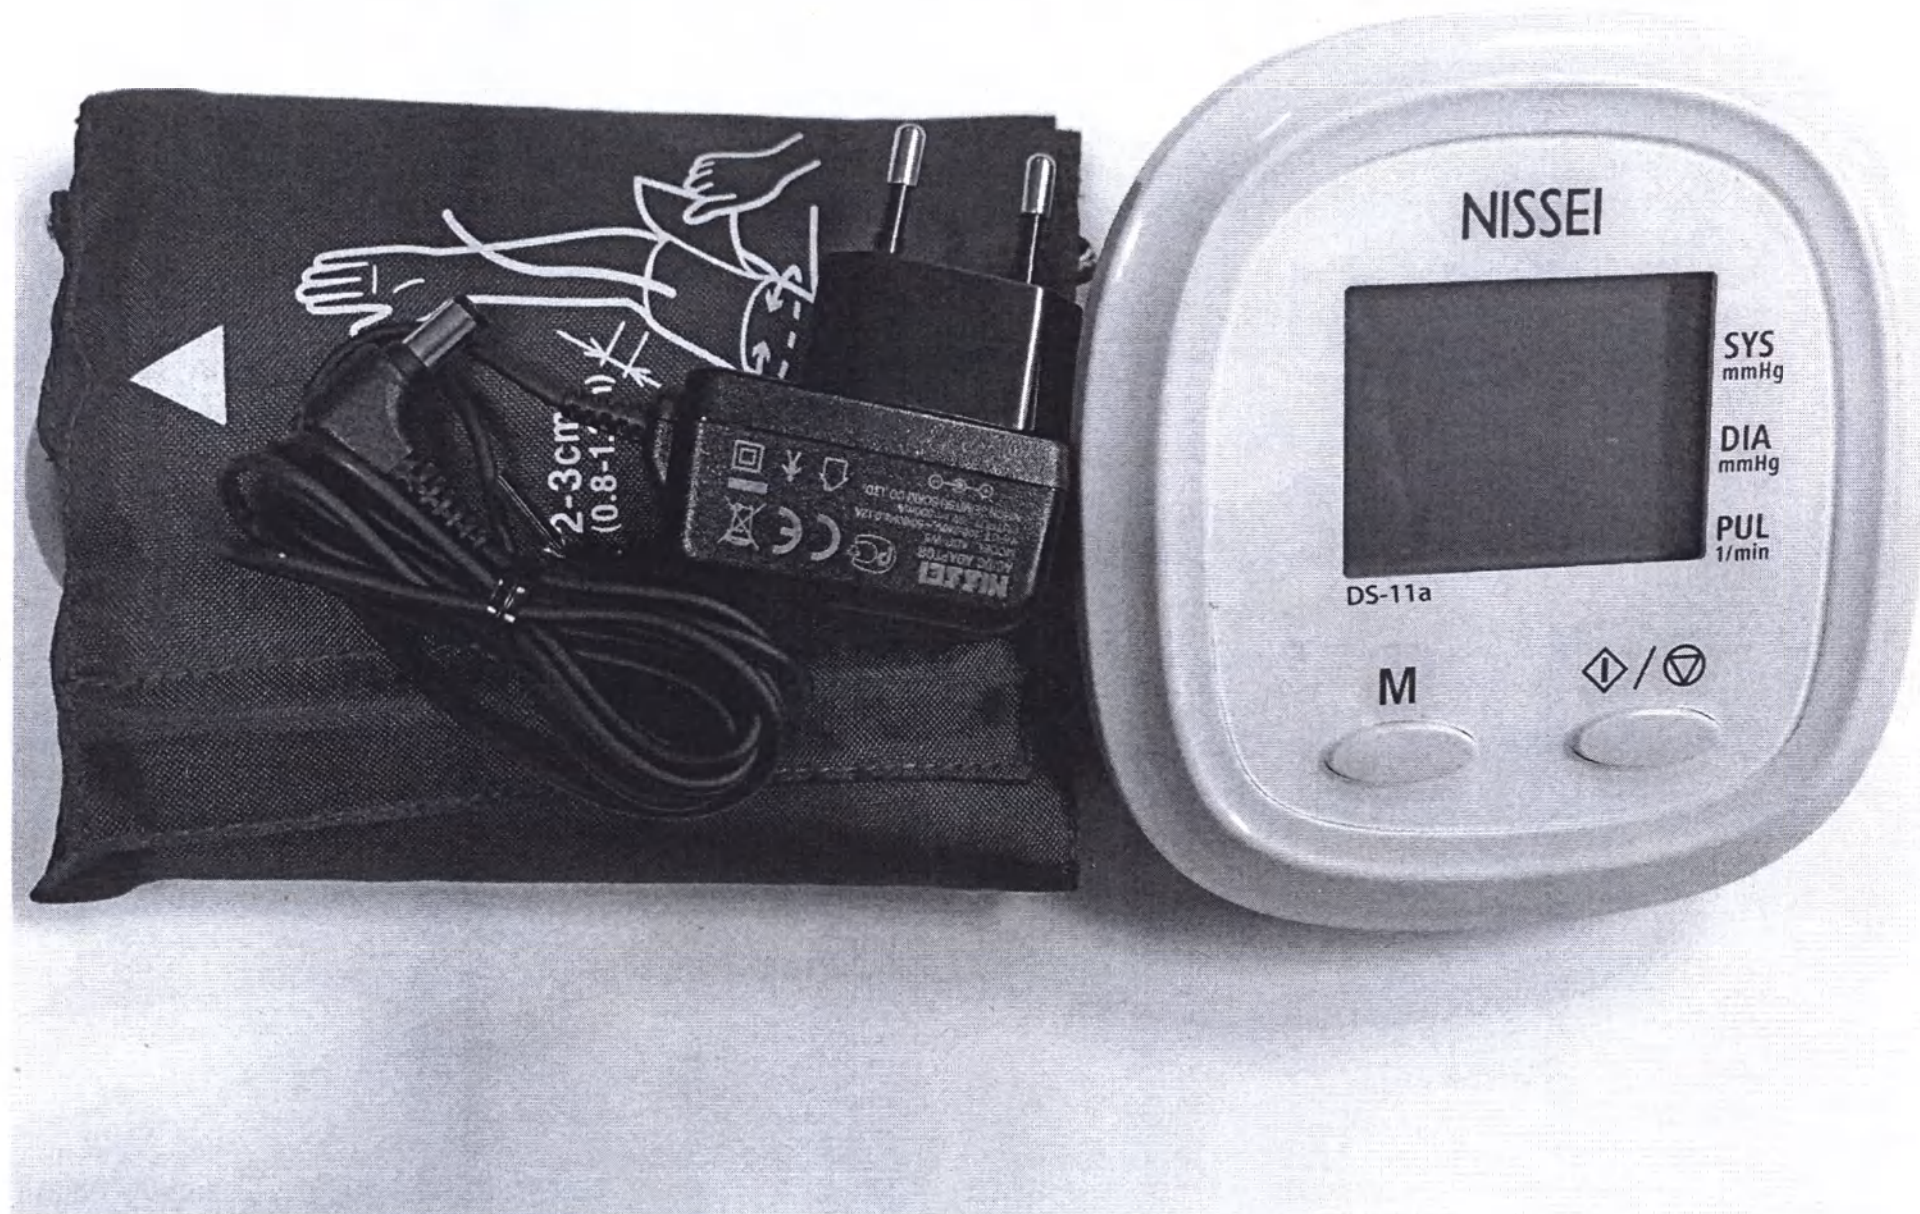










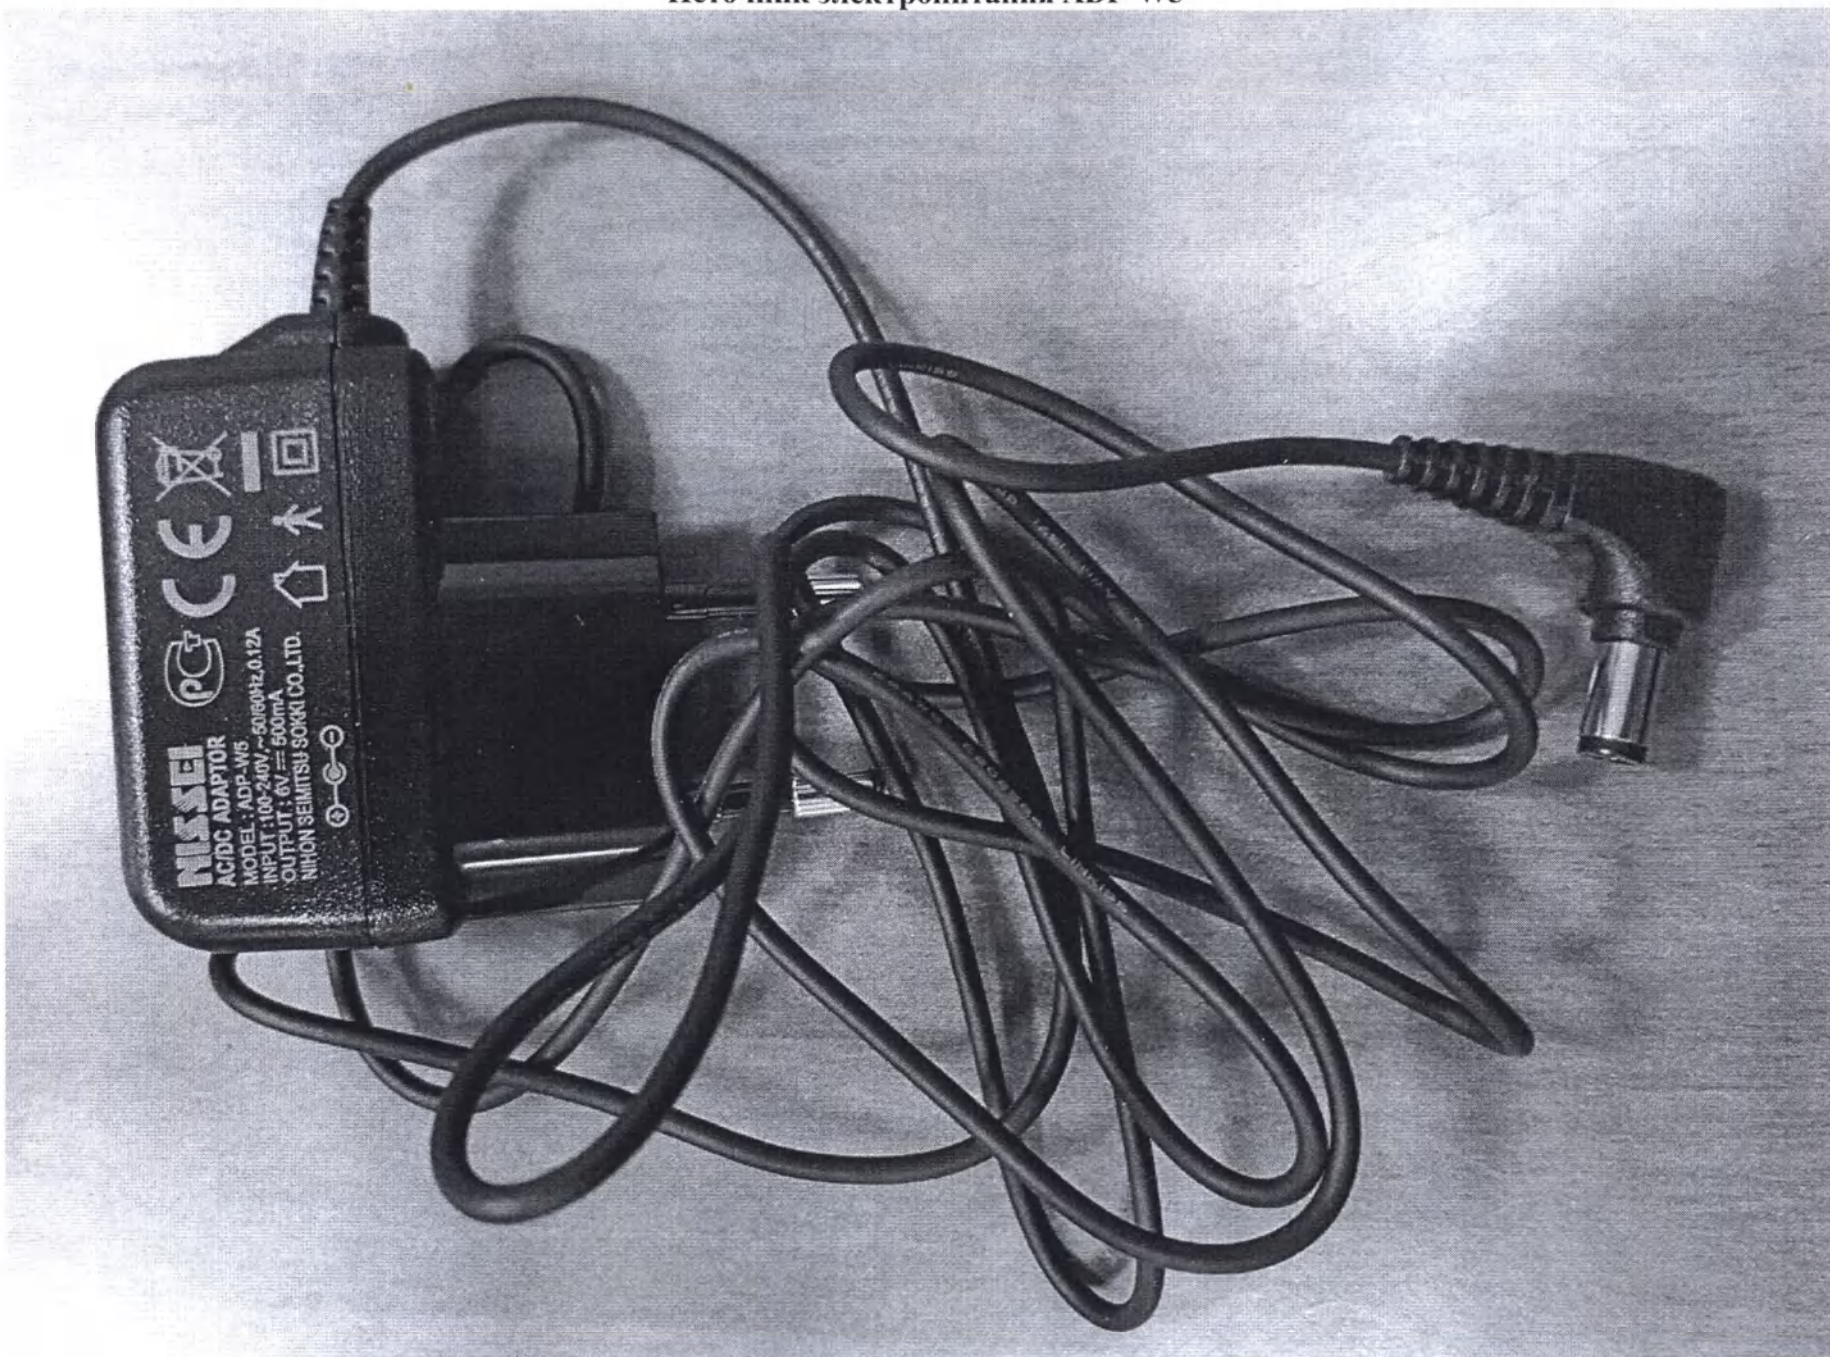

Сумка (для DS-10, DS-10a, DS-11a, DS-11a)



Заполняется представителем уполномоченной сервисной организации.
Заповнюється представником уповноваженої сервісної організації.
Уквітетті сервістік ұйымның өкілі толтырады.
Do wypełnienia przez upoważnionego przedstawiciela organizacji usług.

Дата Күнi Data	Отметки о проведении гарантийного обслуживания Відмітка про проведення гарантійного обслуговування Кепілдемелік қызметтің көрсетілгендігі туралы белгі Adnotacje dotyczące przebiegu napraw


® Зарегистрированные товарные знаки Little Doctor International (S) Pte. Ltd.
© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2003-2014

P105/1401/15
A117515-1-F

NISSEI
JAPAN

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
КЕПІЛДЕМЕЛІК
KARTA GWARANCYJNA




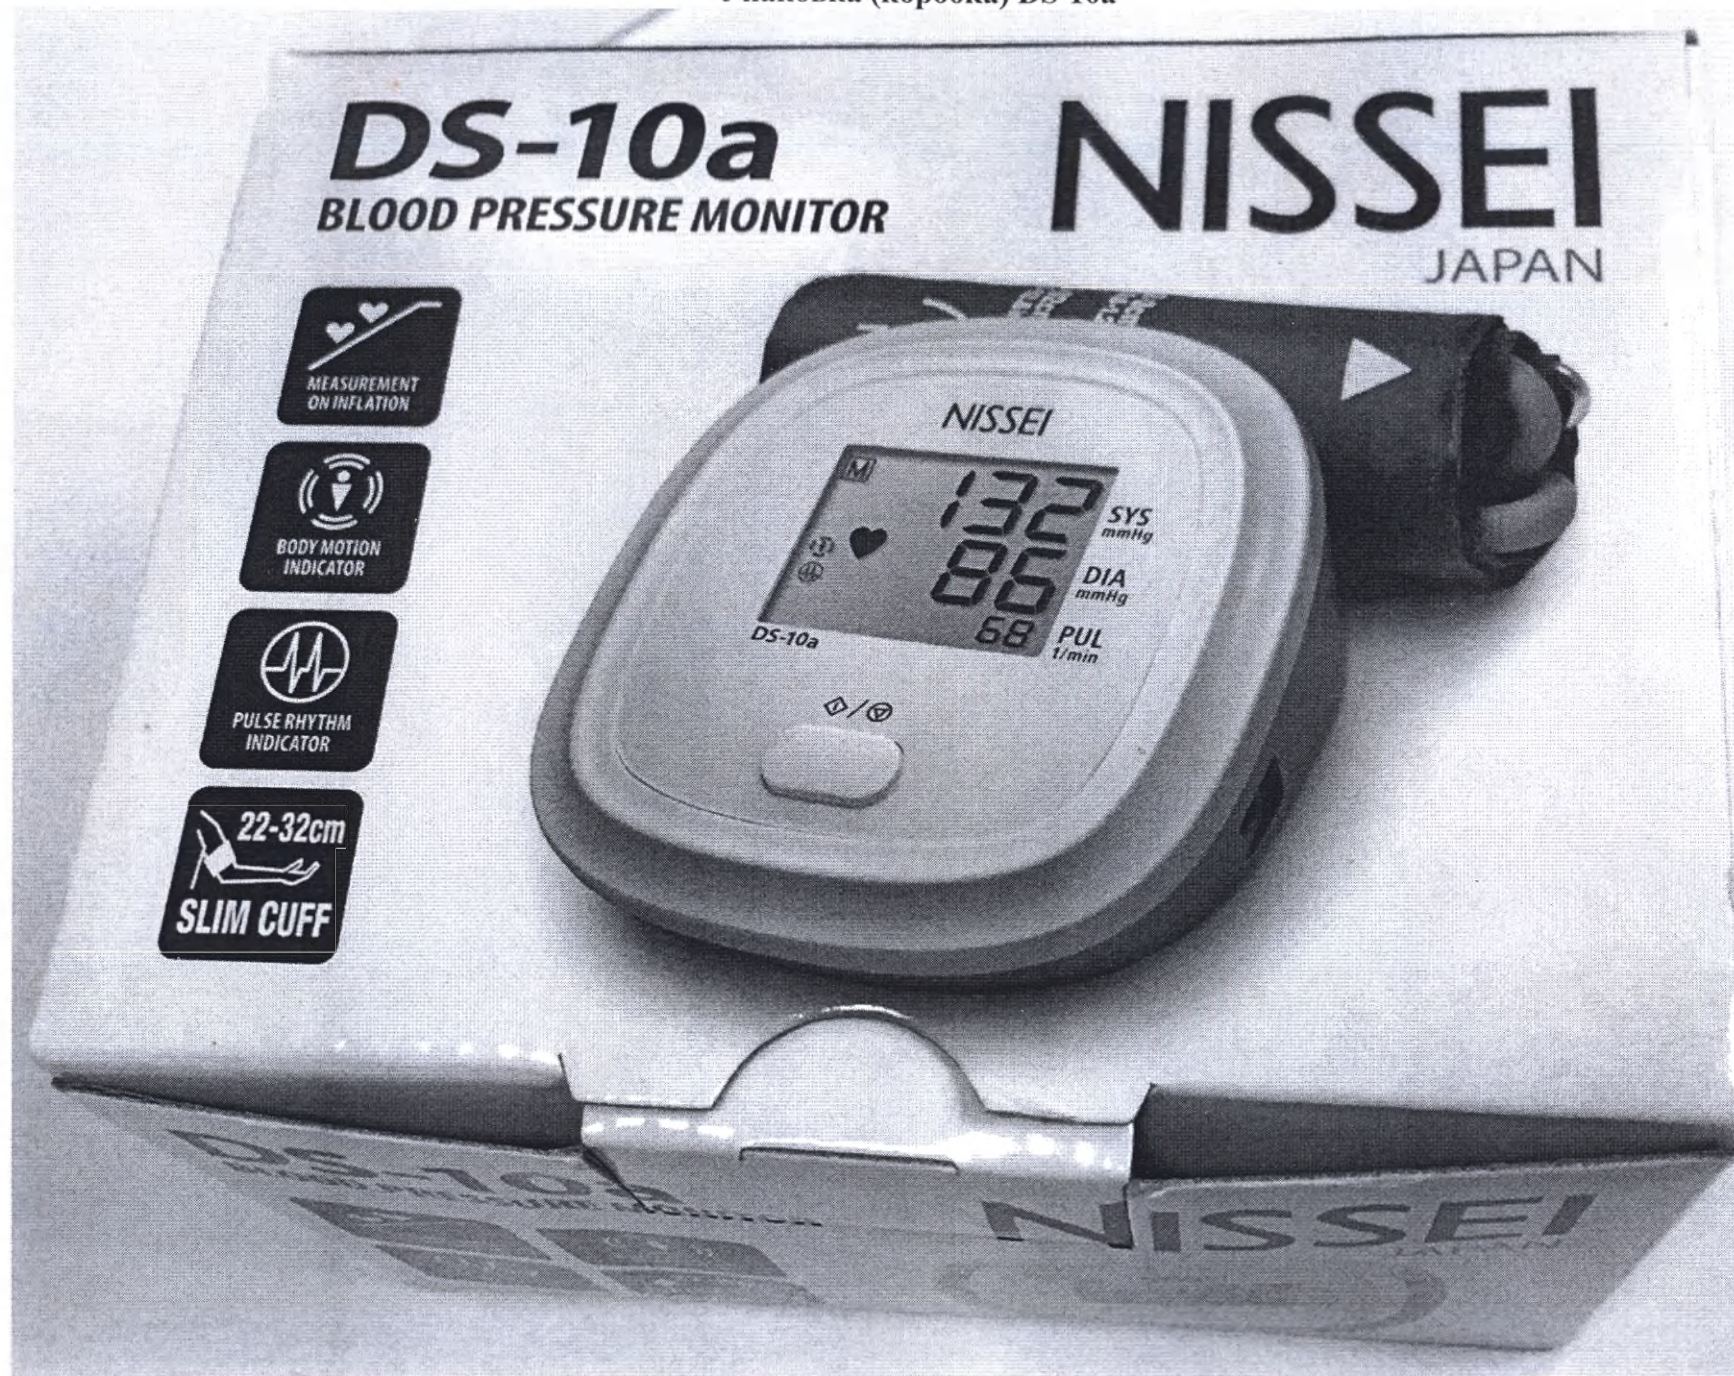


DS-11

BLOOD PRESSURE MONITOR

NISSEI

JAPAN

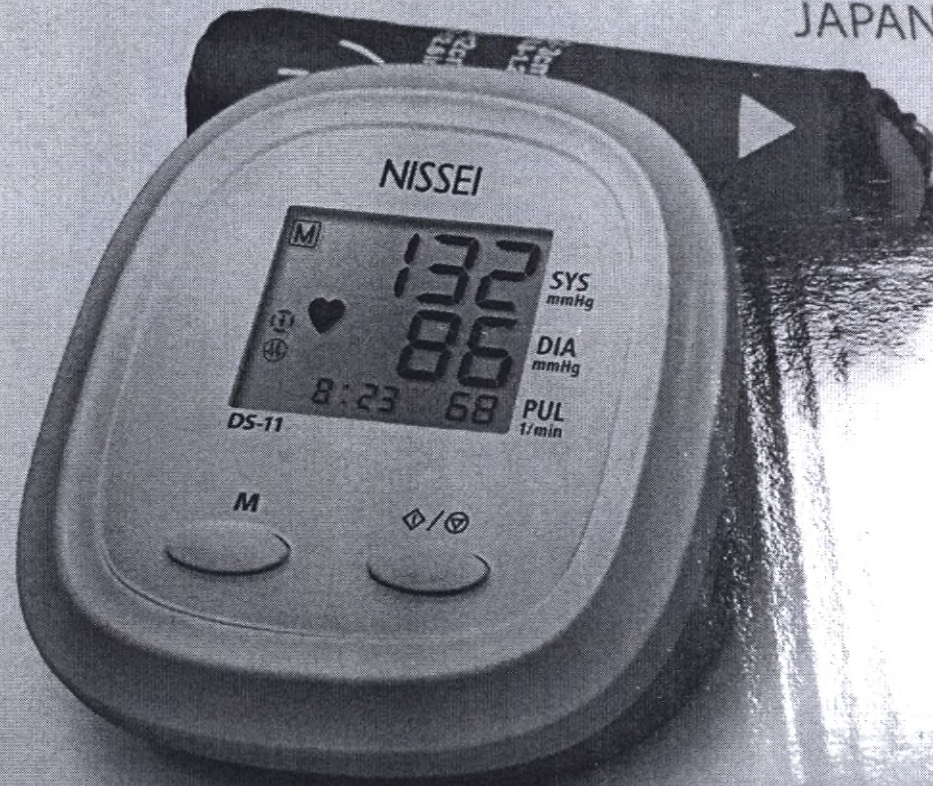



Маркировка потребительской упаковки медицинского изделия для Российской Федерации:

Наименование изделия Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые
 Вариант исполнения DS-10, DS-10a, DS-11, DS-11a



Производитель:
 NIHON SEIMITSU SOKKI CO., LTD. (Нихон Сеймицу Соки Ко., Лтд.). Komochi Factory
 2508-13 Nakago Shibukawa Gunma 377-0293
 Japan.




Дата изготовления



Обратиться к инструкции по эксплуатации



Знак соответствия европейским стандартам



Название и адрес компании
 представительства производителя в Европе:
 Nissei Healthcare (UK) Ltd. New Barn Lane
 Henfield West Sussex BN5 9SJ UK



Предупреждение о хранении: «Беречь от влаги»



Знак обязательного подтверждения соответствия




Класс защиты от поражения электрическим током




Оборудование с рабочей частью типа BF



Декларирование соответствия программе переработки отходов



Хранение и транспортировка: Температура окружающего воздуха от минус 20 до 60°C. Влажность окружающего воздуха от 10 до 95%



Условия использования: Температура окружающего воздуха от 10 до 40°C. Влажность окружающего воздуха от 15 до 85%

Уполномоченный представитель на территории РФ

ООО «Фирма Консалтинг и Коммерция»
117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская,
д.34, кор.1



Условия утилизации: при утилизации руководствуйтесь действующими в данное время правилами в Вашем регионе. Специальных условий утилизации на настоящий прибор производителем не установлено

№ _____ дата выдачи _____

Номер и дата регистрационного удостоверения

Штрих-код

Штрих - код EAN-13 европейский стандарт, предназначенный для кодирования идентификатора товара и производителя

Пронумеровано, прошито

и скреплено печатью

лист _____

Ю.М. Стародумов

