

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
_____ А.Г.Плехов



_____ 2023 г.


МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c)
в цельной крови имунотурбидиметрическим методом
«ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-090-94568735-2020**

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF B 15.11

Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 2 x 15 мл
Реагент №2: 1 x 10 мл
Реагент №3: 1 x 250 мл

ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
РЗН 2020/12521 от 11.11.2020

LOT

Серия:
0075



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 2 x 15 мл
R2: 1 x 10 мл
R3: 1 x 250 мл

LOT

0075



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2025.04

IVD



15112304000075

РЕАГЕНТ 1

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

15 мл
латекс

REF B 15.11
REF B 15.21
REF B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Vital Development

РЕАГЕНТ 1

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

15 мл
латекс

REF B 15.11
REF B 15.21
REF B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Vital Development

РЕАГЕНТ 2

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

10 мл
антитела

REF B 15.11
REF B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Vital Development

РЕАГЕНТ 3

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.04


только для in vitro диагностики

Vital Development

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF B 15.21

Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 3 x 15 мл
Реагент №2: 1 x 15 мл
Реагент №3: 1 x 250 мл

ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
РЗН 2020/12521 от 11.11.2020

LOT

Серия:
0075



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 3 x 15 мл
R2: 1 x 15 мл
R3: 1 x 250 мл

LOT

0075



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A - 194356
St Petersburg, Russia



2025.04

IVD



15912304000075

РЕАГЕНТ 1 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

15 мл [REF] B 15.11
латекс [REF] B 15.21
[REF] B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

15 мл [REF] B 15.11
латекс [REF] B 15.21
[REF] B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

15 мл [REF] B 15.11
латекс [REF] B 15.21
[REF] B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

15 мл [REF] B 15.21

антитела

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 3 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF B 15.31

Лабор. реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 4 x 15 мл
Реагент №2: 2 x 10 мл
Реагент №3: 2 x 250 мл

ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
РЗН 2020/12521 от 11.11.2020

LOT

Серия:
0075



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 4 x 15 мл
R2: 2 x 10 мл
R3: 2 x 250 мл

LOT

0075



2025.04



Vital Development Corporation
Doroga v Kamensk 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



15312304000075

РЕАГЕНТ 1 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

15 мл латекс

REF B 15.11
REF B 15.21
REF B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Vital Development

РЕАГЕНТ 1 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

15 мл латекс

REF B 15.11
REF B 15.21
REF B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Vital Development

РЕАГЕНТ 1 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

15 мл латекс

REF B 15.11
REF B 15.21
REF B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Vital Development

РЕАГЕНТ 1 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

15 мл латекс

REF B 15.11
REF B 15.21
REF B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Vital Development

РЕАГЕНТ 2 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

10 мл антитела

REF B 15.11
REF B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Vital Development

РЕАГЕНТ 2 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

10 мл антитела

REF B 15.11
REF B 15.31

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Vital Development

РЕАГЕНТ 3 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

гемолизирующий реагент

250 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Vital Development

РЕАГЕНТ 3 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

гемолизирующий реагент

250 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Vital Development



REF В 15.71-1.150

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 22 мл ТУ 21.20.23-090-94568735-2020

Реагент №2: 1 x 8,5 мл РЭН 2020/12521 от 11.11.2020

Реагент №3: 1 x 250 мл

LOT

Серия:
0075



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 1 x 22 ml

R2: 1 x 8,5 ml

R3: 1 x 250 ml

LOT

0075



2025.04



Vital Development Corporation
Doroga v Kamensk, 56 A - 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



82202212000072

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF В 15.71-1.150

1 22 мл

РЕАГЕНТ
LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF В 15.71-1.150

2 8,5 мл

РЕАГЕНТ
LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

3 гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



REF B 15.711-1.150

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 22 мл
Реагент №2: 2 x 8,5 мл
Реагент №3: 1 x 250 мл

LOT Серия: 0075 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 2 x 22 мл
R2: 2 x 8,5 мл
R3: 1 x 250 мл

LOT 0075
2025.04

Vital Development Corporation
Doroga v Kamensk, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



157111501802120230

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF B 15.711-1.150

РЕАГЕНТ 1 22 мл

LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF B 15.711-1.150

РЕАГЕНТ 1 22 мл

LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF B 15.711-1.150

РЕАГЕНТ 2 8,5 мл

LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF B 15.711-1.150

РЕАГЕНТ 2 8,5 мл

LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 3

гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



REF В 15.71-1.200

**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**

Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 14 мл ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
Реагент №2: 1 x 5 мл РЗН 2020/12521 от 11.11.2020
Реагент №3: 1 x 250 мл

LOT Серия: **0075** Дата выпуска: **2023.04** Годен до: **2025.04**

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
184356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 1 x 14 ml
R2: 1 x 5 ml
R3: 1 x 250 ml

LOT 0075

Годен до: **2025.04**

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk, 58 A, 184356
St. Petersburg, Russia

IVD



81202303000074

**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**

РЕАГЕНТ 1 **14 мл** REF В 15.71-1.200

LOT 0075

Годен до: **2025.04**

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**

РЕАГЕНТ 2 **5 мл** REF В 15.71-1.200

LOT 0075

Годен до: **2025.04**

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**

РЕАГЕНТ 3 **гемолизирующий
реагент**

250 мл

LOT 0075

Годен до: **2025.04**

только для in vitro диагностики



REF В 15.711-1.200

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 14 мл ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
Реагент №2: 2 x 5 мл РЗН 2020/12621 от 11.11.2020
Реагент №3: 1 x 250 мл

LOT

Серия:
0075



Дата выпуска:
2023.04



Годеи до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 2 x 14 ml

R2: 2 x 5 ml

R3: 1 x 250 ml

LOT

0075



2025.04



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenku, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

MD



157111501802120230

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

14 мл

REF В 15.711-1.200

LOT

0075



годеи до: 2025.04



только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

14 мл

REF В 15.711-1.200

LOT

0075



годеи до: 2025.04



только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



РЕАГЕНТ 2

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

5 мл

REF В 15.711-1.200

LOT

0075



годеи до: 2025.04



только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



РЕАГЕНТ 2

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

5 мл

REF В 15.711-1.200

LOT

0075



годеи до: 2025.04



только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 3

гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT

0075



годеи до: 2025.04



только для in vitro диагностики



REF B 15.71-1.300

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 21 мл ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
Реагент №2: 1 x 9 мл РЗН 2020/12521 от 11.11.2020
Реагент №3: 1 x 250 мл

LOT

Серия:
0075



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 1 x 21 ml
R2: 1 x 9 ml
R3: 1 x 250 ml

LOT

0075



2025.04



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu: 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

MD



84302207000070

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF B 15.71-1.300

РЕАГЕНТ 1 21 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF B 15.71-1.300

РЕАГЕНТ 2 9 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 3

гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT 0075



Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия

REF В 15.711-1.300

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ



Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 21 мл ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
Реагент №2: 2 x 9 мл РЗН 2020/12521 от 11.11.2020
Реагент №3: 1 x 250 мл

LOT Серия: 0075 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Кеманку,
дом 56, литера А

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 2 x 21 мл LOT 0075 Vital Development Corporation
R2: 2 x 9 мл 2025.04 Дорога в Кеманку 56 А 194356
R3: 1 x 250 мл St. Petersburg, Russia

IVD



157111501802120230

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF В 15.711-1.300

РЕАГЕНТ 1 21 мл



LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF В 15.711-1.300

РЕАГЕНТ 1 21 мл



LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF В 15.711-1.300

РЕАГЕНТ 2 9 мл



LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF В 15.711-1.300

РЕАГЕНТ 2 9 мл



LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 3 гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT 0075



Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



REF В 15.71-1.420

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ



Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 30 мл ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
Реагент №2: 1 x 11,5 мл РЗН 2020/12521 от 11.11.2020
Реагент №3: 1 x 250 мл

LOT Серия: Дата выпуска: Годен до:
0075 2023.04 2025.04

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 1 x 30 ml LOT 0075 Vital Development Corporation
R2: 1 x 11,5 ml 2025.04 Dorozh v Kamenu 56 A 194356
R3: 1 x 250 ml St Petersburg, Russia

IVD



84202303000074

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF В 15.71-1.420



РЕАГЕНТ 1 30 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF В 15.71-1.420



РЕАГЕНТ 2 11,5 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия


ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 3

гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT 0075



Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



REF B 15.711-1.420

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови имунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 30 мл ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
Реагент №2: 2 x 11,5 мл РЗН 2020/12521 от 11.11.2020
Реагент №3: 2 x 250 мл

LOT Серия: 0075 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2025.04
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 58, литера А

только для in vitro диагностики

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 2 x 30 ml **LOT** 0075 Vital Development Corporation
R2: 2 x 11,5 ml 2025.04 Дорога в Каменку, 58 А 194358
R3: 2 x 250 ml St. Petersburg, Russia

IVD



86422304000075

ГЛИКО- ЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН- ВИТАЛ

REF B 15.711-1.420

РЕАГЕНТ 1 30 мл



LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКО- ЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН- ВИТАЛ

REF B 15.711-1.420

РЕАГЕНТ 1 30 мл



LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT 0075



годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



ГЛИКО- ЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН- ВИТАЛ

REF B 15.711-1.420

РЕАГЕНТ 2 11,5 мл



LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКО- ЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН- ВИТАЛ

REF B 15.711-1.420

РЕАГЕНТ 2 11,5 мл



LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT 0075



годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



REF В 15.71-2.200

**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**

Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 33 мл ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
Реагент №2: 1 x 13 мл РЗН 2020/12521 от 11.11.2020
Реагент №3: 1 x 250 мл

LOT

Серия:
0075



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
184356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 5Б, литера А

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 1 x 33 ml

R2: 1 x 13 ml

R3: 1 x 250 ml

LOT

0075



2025.04



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 5B A 184356
St. Petersburg, Russia

IMD



81222207000070

**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**

REF В 15.71-2.200

РЕАГЕНТ 1

33 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ**

REF В 15.71-2.200

РЕАГЕНТ 2

13 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия


**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**

РЕАГЕНТ 3

гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT 0075



Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



REF В 15.71-2.300

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ



Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 46 мл ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
Реагент №2: 1 x 18 мл РЗН 2020/12521 от 11.11.2020
Реагент №3: 1 x 250 мл

LOT

Серия:
0075



Дата выпуска:
2023.04



Годен до:
2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 1 x 46 ml
R2: 1 x 18 ml
R3: 1 x 250 ml

LOT

0075



2025.04



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A *194356
St. Petersburg, Russia

MD



157111501802120230

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

REF В 15.71-2.300

РЕАГЕНТ 1

46 мл

LOT

0075



годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ

REF В 15.71-2.300

РЕАГЕНТ 2

18 мл



LOT 0075

годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 3

гемолизирующий
реагент

250 мл

LOT

0075



Годен до: 2025.04


только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

REF В 15.711-2.300

**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**



Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 34,5 мл ТУ 21.20.23-090-94568735-2020
Реагент №2: 1 x 26 мл РЗН 2020/12521 от 11.11.2020
Реагент №3: 2 x 250 мл

LOT

Серия:

0075



Дата выпуска:

2023.04



Годен до:

2025.04

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
184356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK GLYCATED HEMOGLOBIN-VITAL

R1: 2 x 34,5 ml

R2: 1 x 26 ml

R3: 2 x 250 ml

LOT

0075



2025.4



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 184356
St. Petersburg, Russia

MD



157111501802120230

**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**

REF В 15.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

34,5 мл

LOT

0075



Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**

REF В 15.711-2.300

РЕАГЕНТ 1

34,5 мл

LOT

0075



Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

**ГЛИКО-
ЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-
ВИТАЛ**

REF В 15.711-2.300

РЕАГЕНТ 2

26 мл



LOT

0075

Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн Россия

**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**


РЕАГЕНТ 3

**гемолизирующий
реагент**

250 мл

LOT

0075



Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



**ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ**


РЕАГЕНТ 3

**гемолизирующий
реагент**

250 мл

LOT

0075



Годен до: 2025.04

только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью


Всего 15 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.





«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов


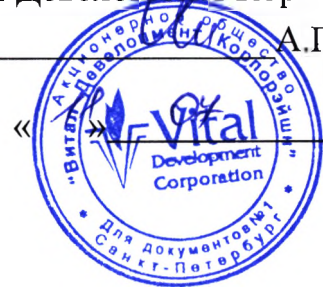



2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Набор реагентов для определения концентрации
гликозилированного гемоглобина (HbA1c)
в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом
«ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-090-94568735-2020**

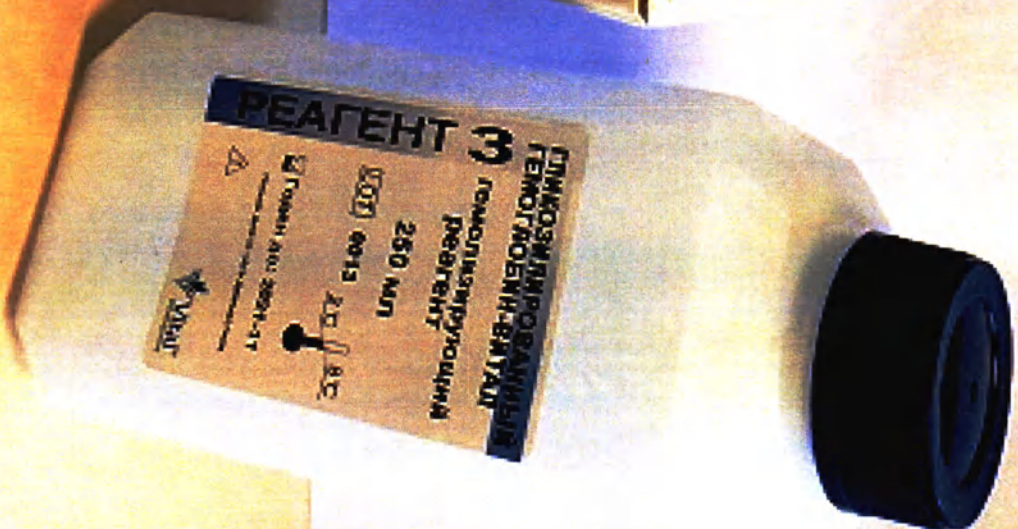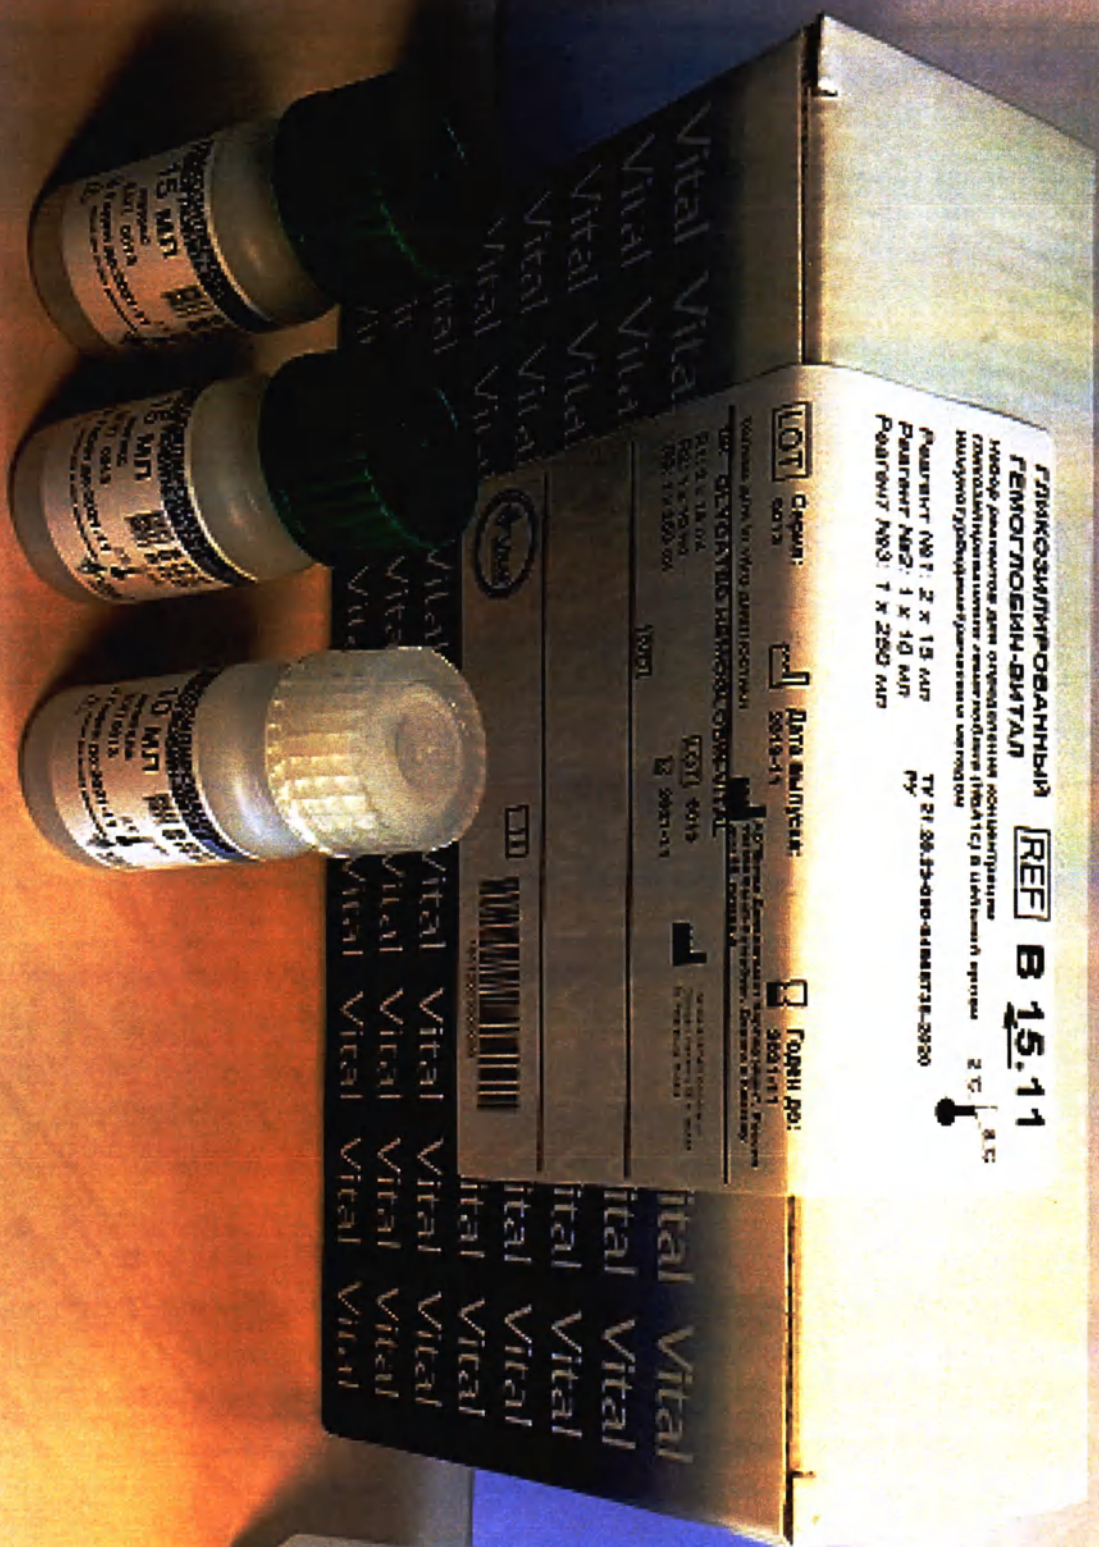

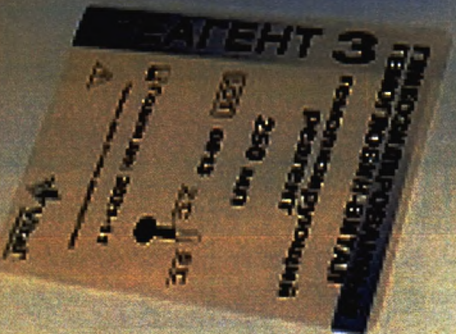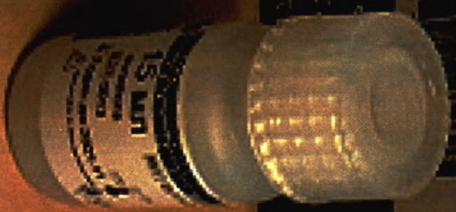

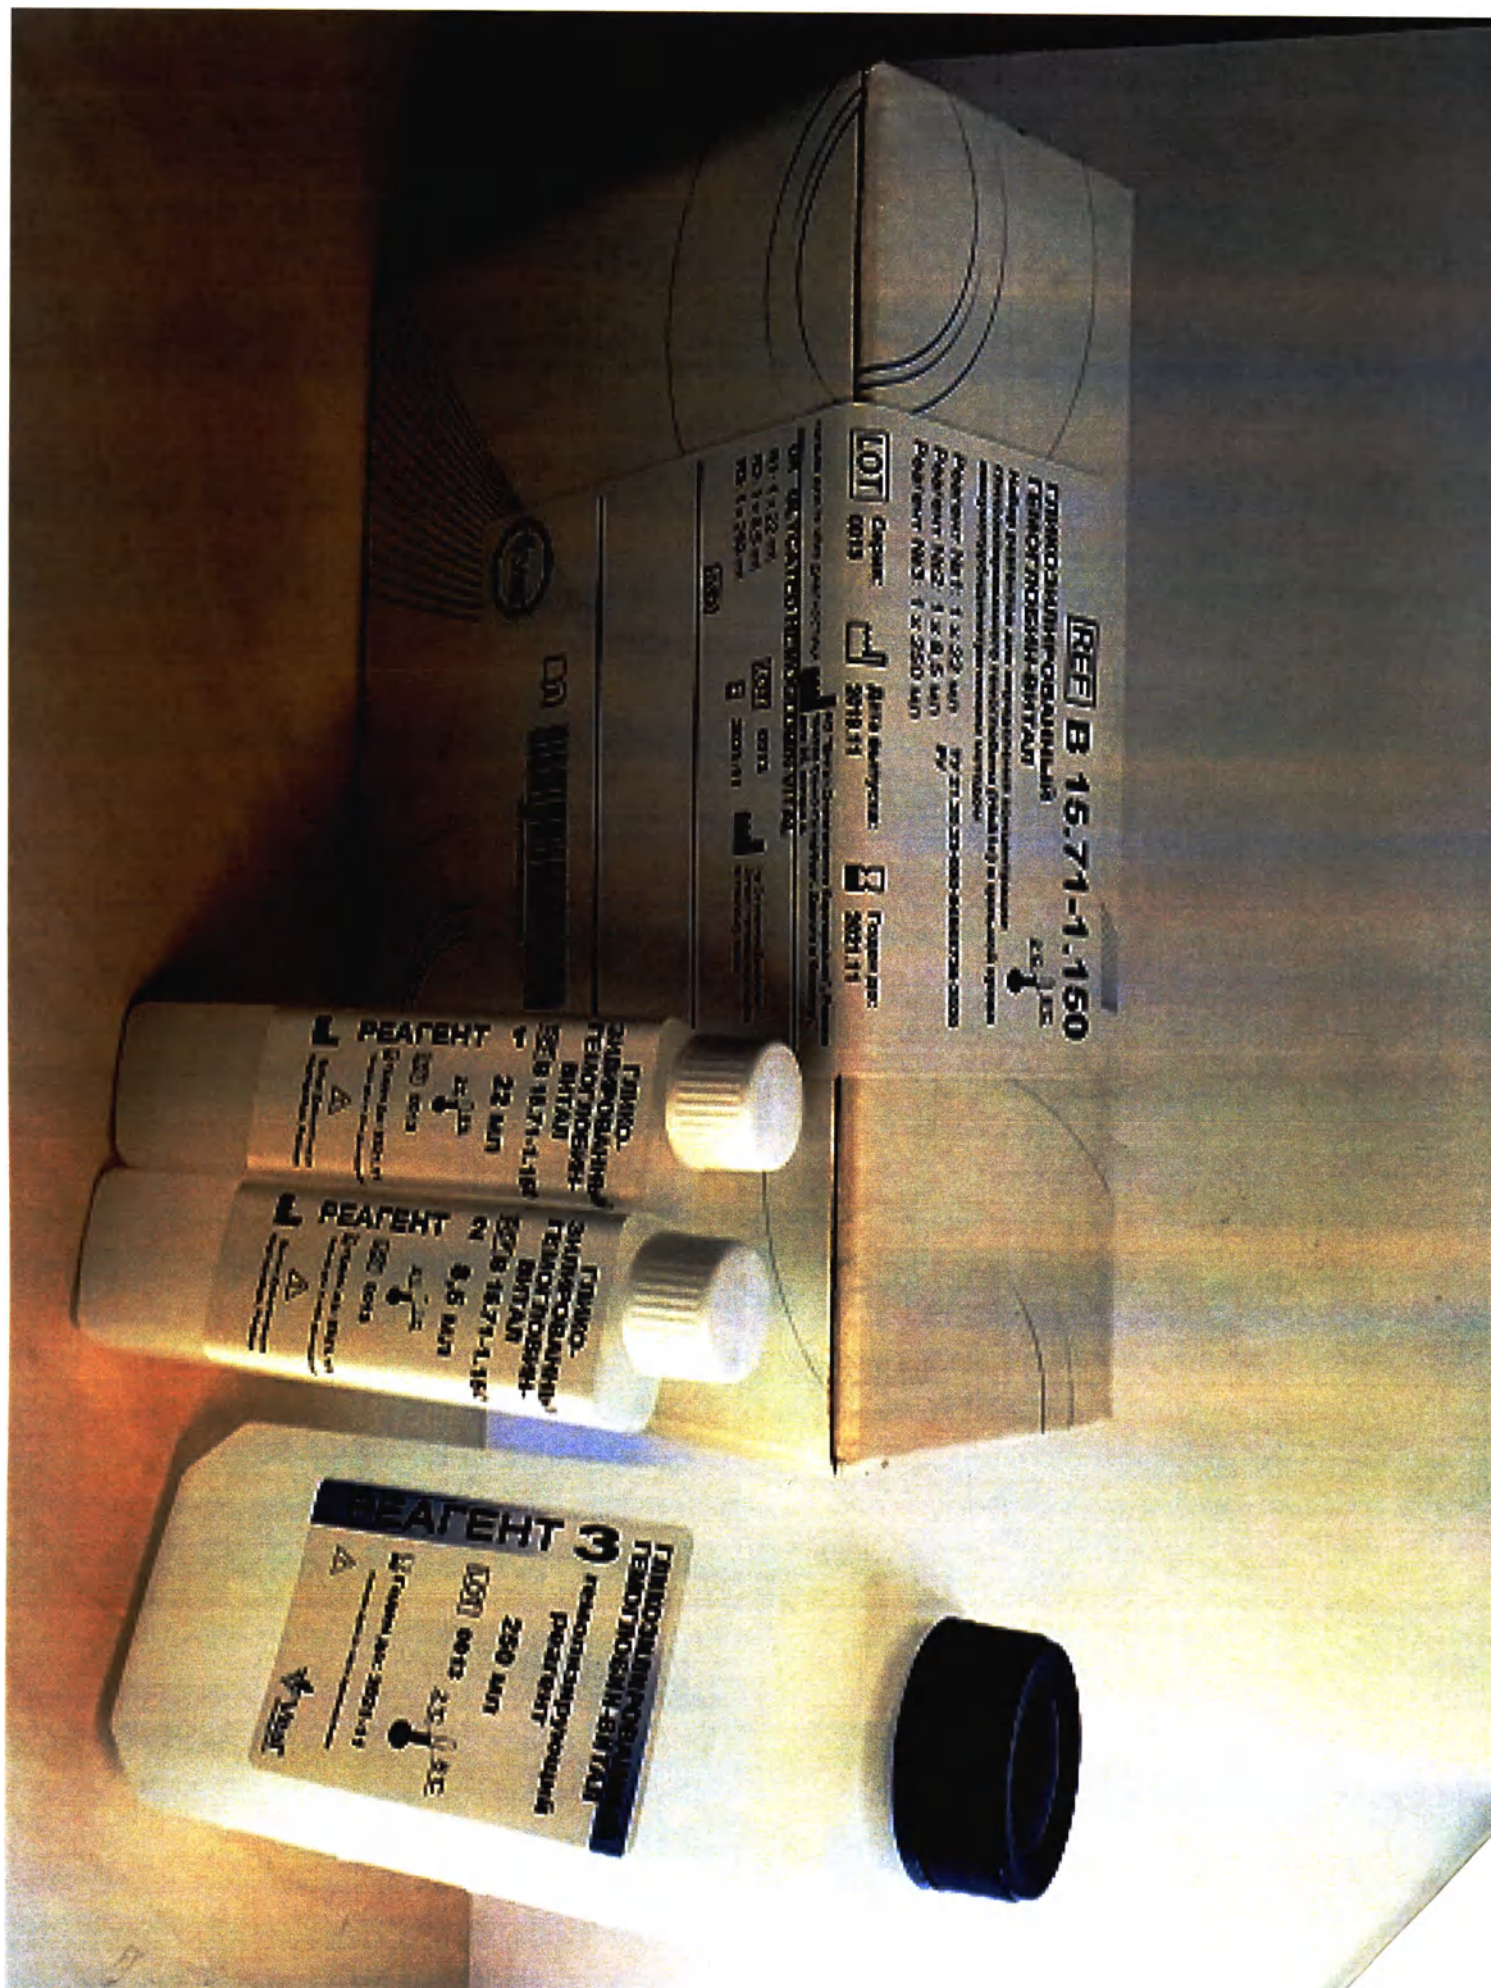


REF B 16.71-1.150
ТРИКОМА-БИТАЛ
 25 шт.
 Анализы проводятся в соответствии с инструкцией.
 Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления.
 Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °С.
 Производитель: ООО «Цирми»
 Адрес: 105080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1
 Контакт: 8 (495) 105-10-10
 E-mail: info@cirml.ru
 Сайт: www.goszdravnadzor.ru


ЛОТ 0013 Дата анализа: **2018.11** **2021.11**

РЕАГЕНТ 1
 ТРИКОМА-БИТАЛ
 22 шт.
 16.71-1.150
 2018.11

РЕАГЕНТ 2
 ТРИКОМА-БИТАЛ
 8,5 шт.
 16.71-1.150
 2018.11

РЕАГЕНТ 3
 ТРИКОМА-БИТАЛ
 250 шт.
 2018.11

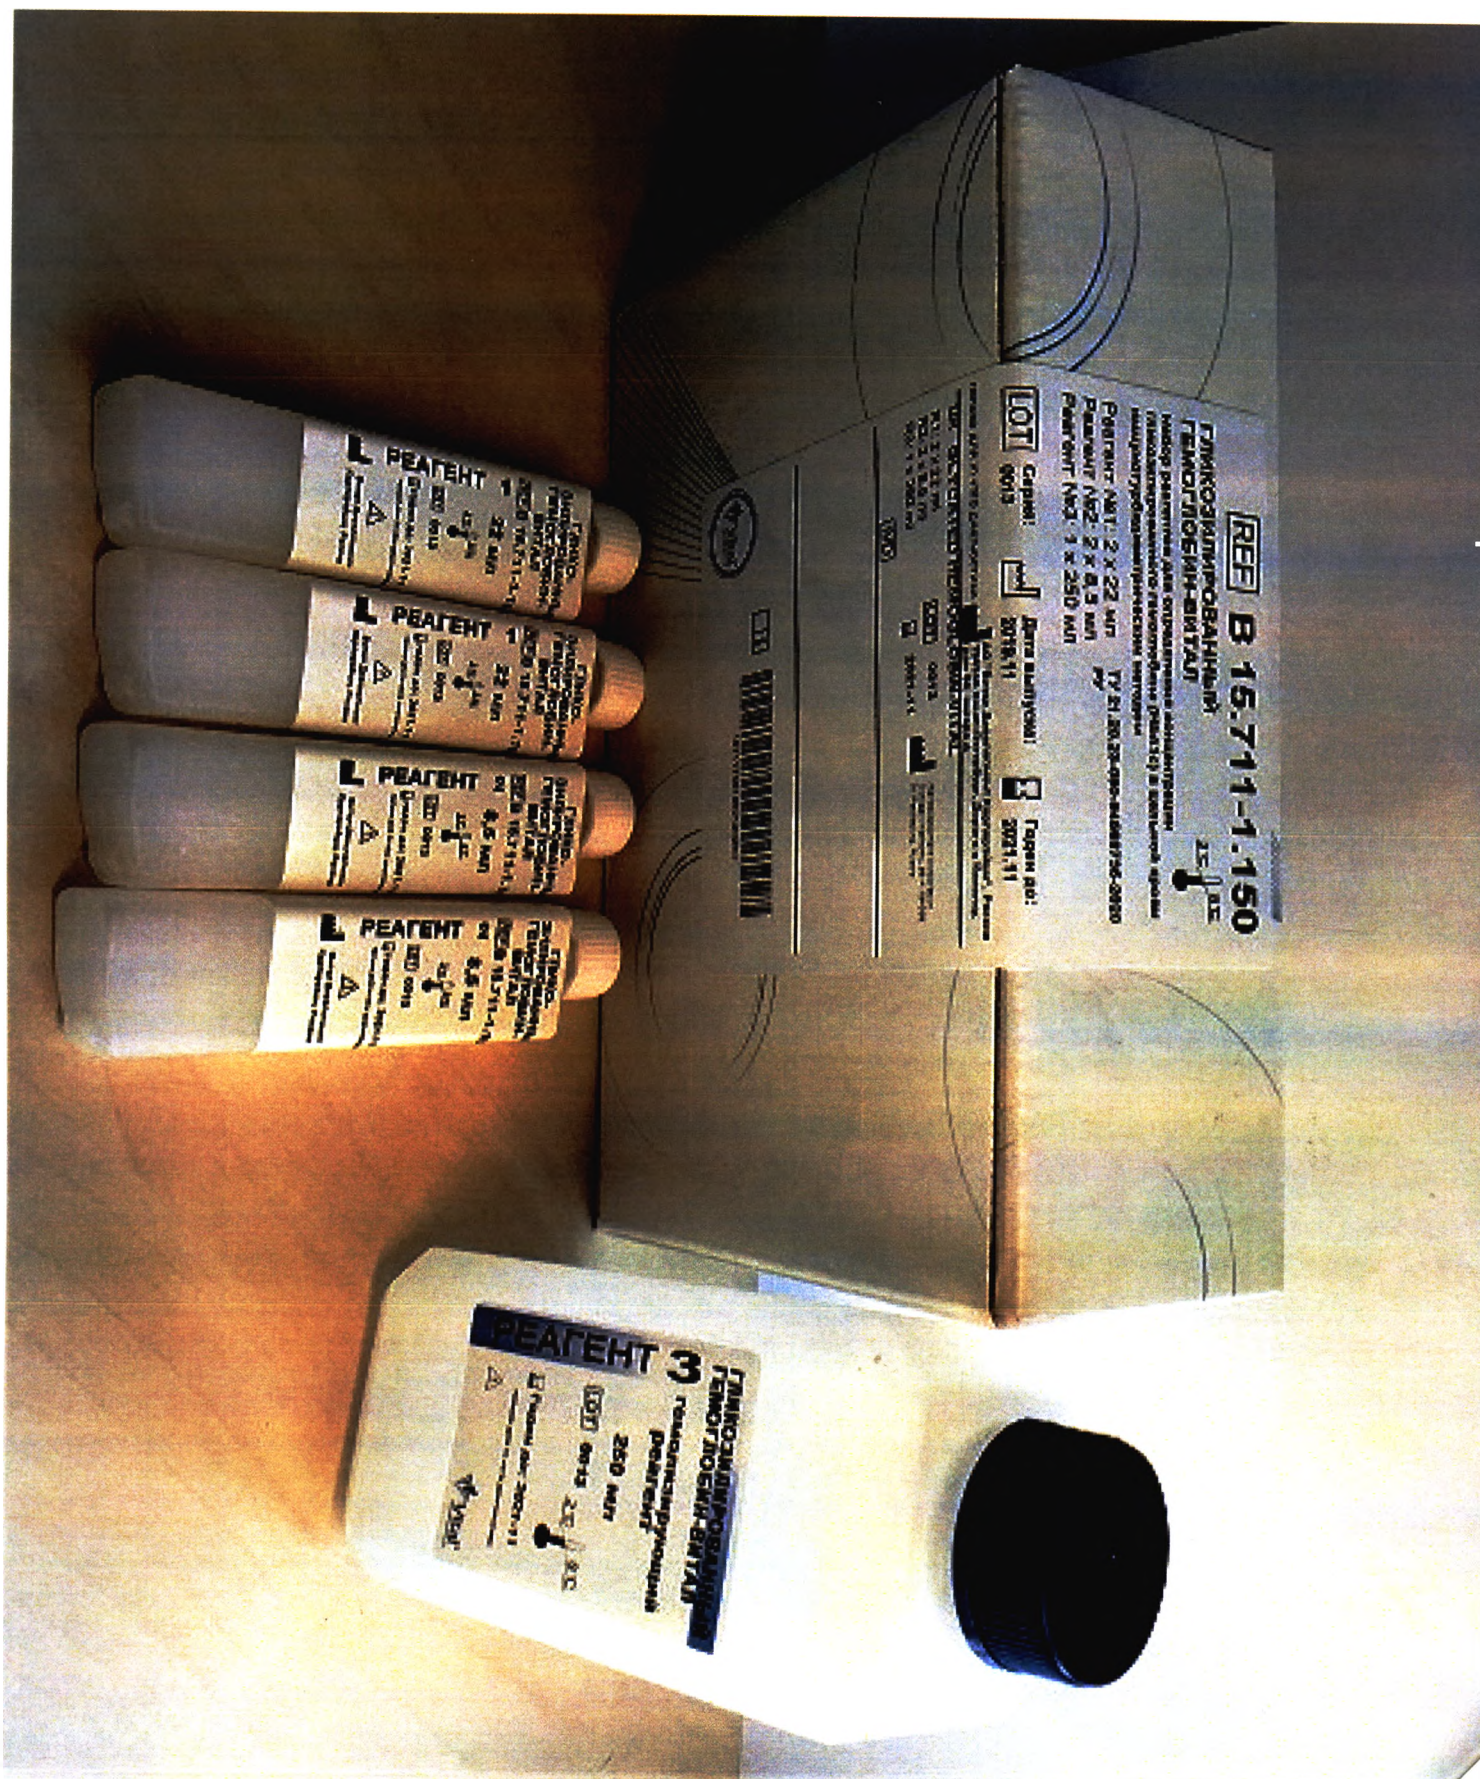

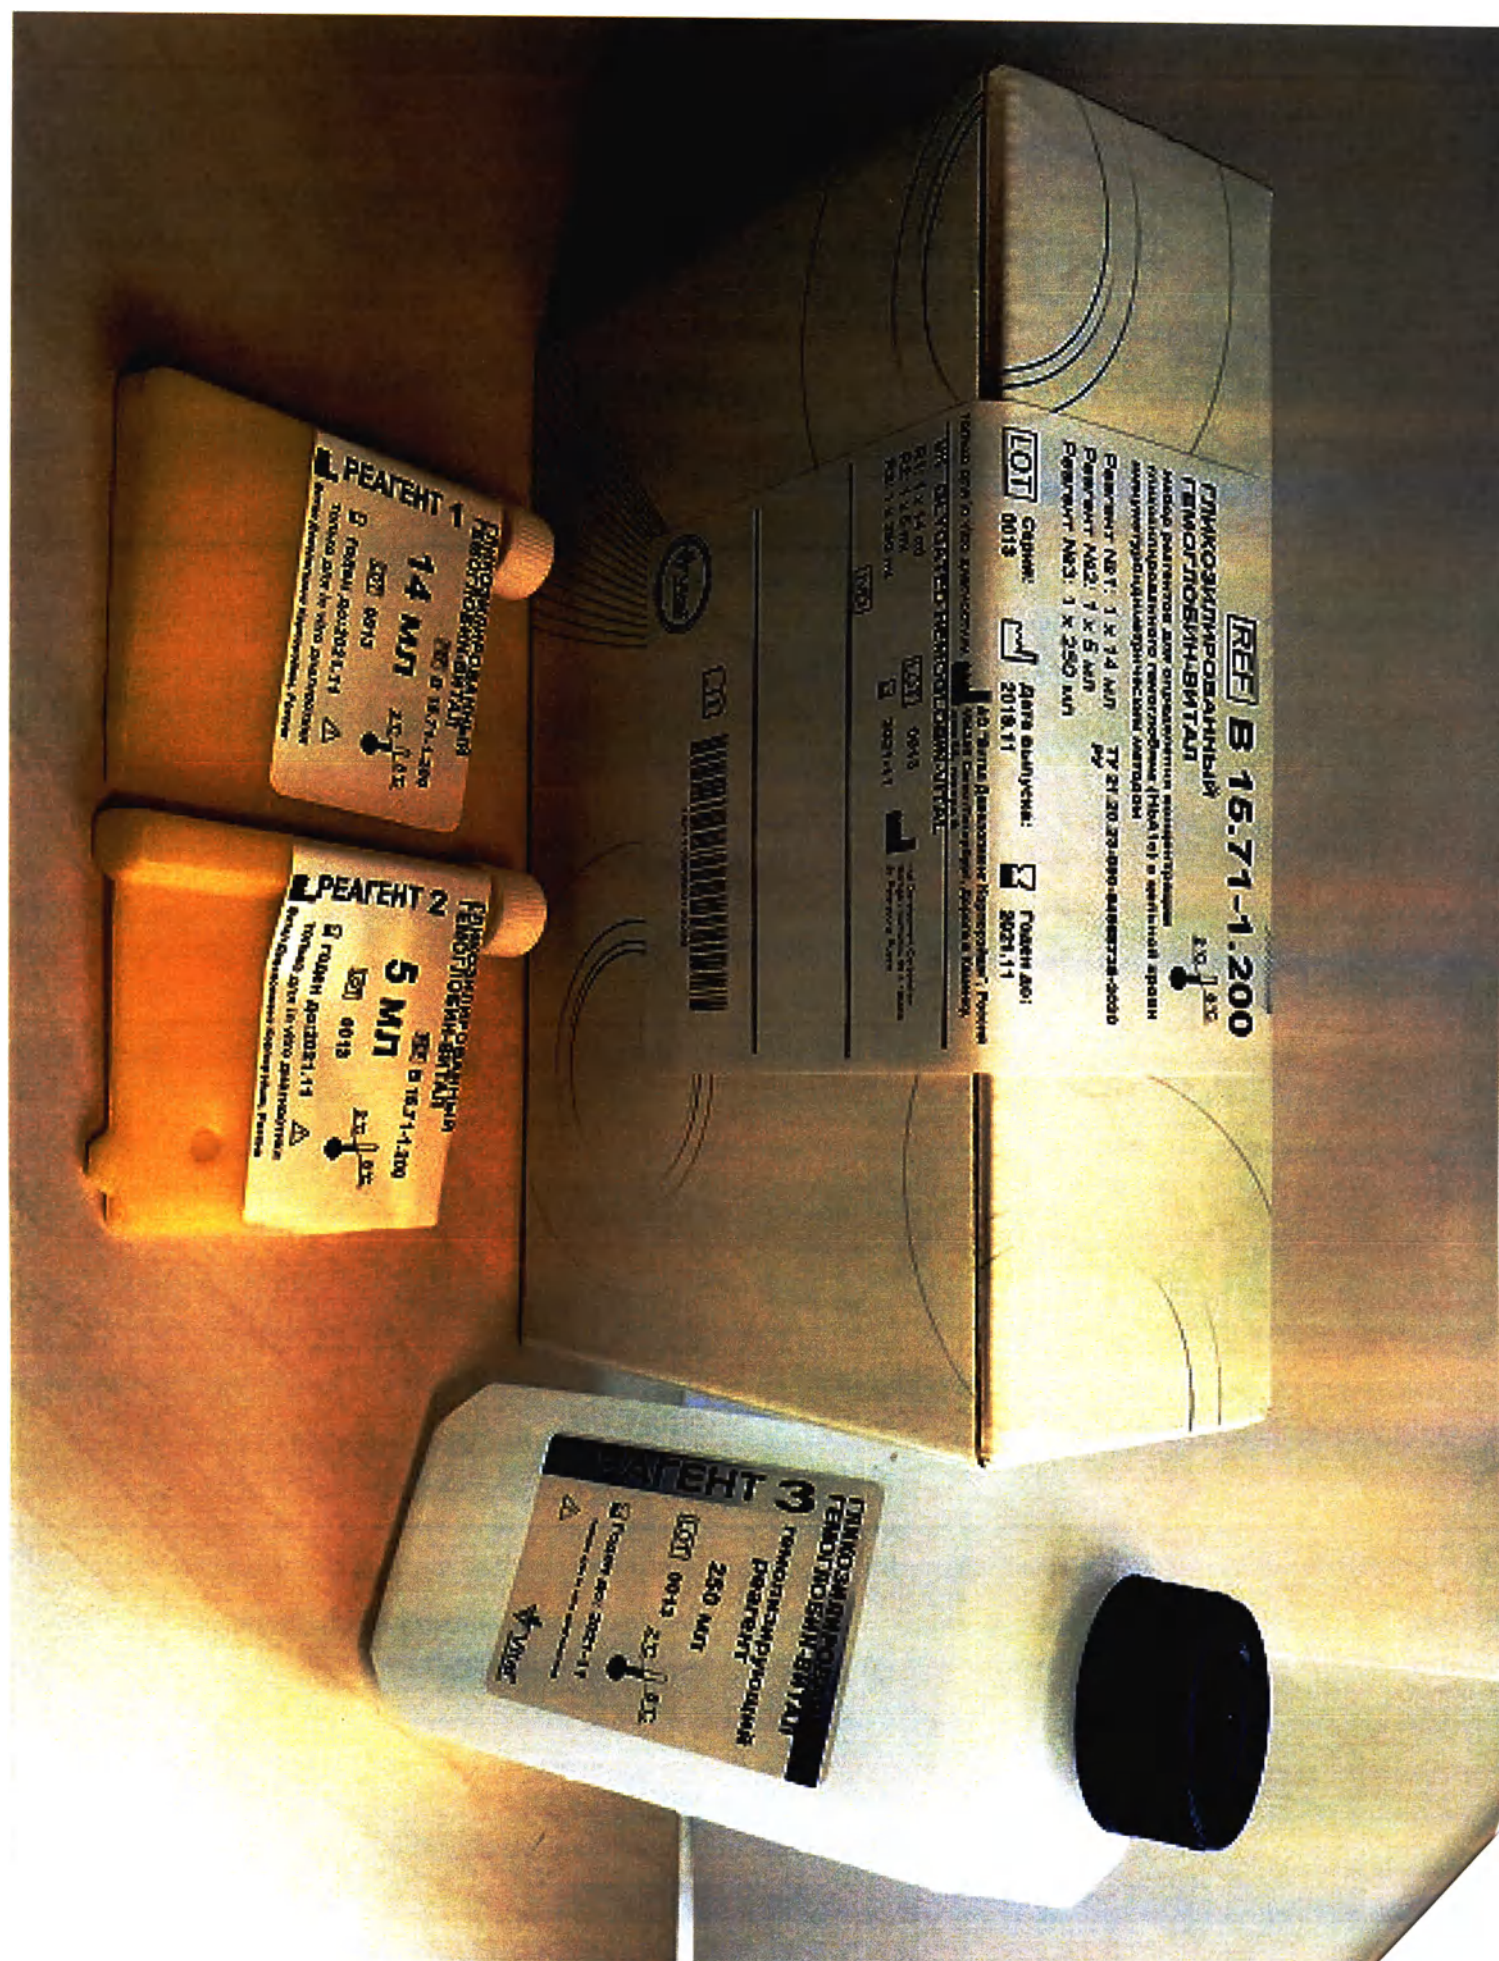



REF B 16.711-1.200

ЛИНКОЗИМИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

Анализатор для определения концентрации гемоглобина в крови (Hb) и гемоглобинов (HbA1c) в капле крови

Реагент №1: 2 x 14 мл
Реагент №2: 2 x 5 мл
Реагент №3: 1 x 250 мл

Серия: 0013
Дата выпуска: 2018.11
Годен до: 2021.11

ООО ЦРПМ
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10
Тел: 8 (495) 100-00-00
E-mail: info@cirpm.ru

РЕАГЕНТ 1
14 мл
Годен до: 2021.11

РЕАГЕНТ 1
14 мл
Годен до: 2021.11

РЕАГЕНТ 2
5 мл
Годен до: 2021.11

РЕАГЕНТ 2
5 мл
Годен до: 2021.11

РЕАГЕНТ 3
250 мл
Годен до: 2021.11

6

REF B 15.71-1.300

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-BITALL

Наблюдение за содержанием гемоглобина в крови
пациентов с сахарным диабетом (гипер- и гипогликемия)
и другими заболеваниями, сопровождающимися
нарушением углеводного обмена

Реагент №1: 1 x 21 мл
Реагент №2: 1 x 9 мл
Реагент №3: 1 x 250 мл

LOT 0013 Сериал: 3018.11 Дата выпуска: 2021.11

Содержит 1 шт. в упаковке
Годен для использования в течение 12 месяцев
с даты выпуска

ГРП-0013
ГРП-0013
ГРП-0013



ГРП-0013
ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-BITALL

РЕАГЕНТ 1 21 мл

РЕАГЕНТ 2 9 мл

ГРП-0013
ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-BITALL

РЕАГЕНТ 3 250 мл

REF B 16.711-1.300

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в нативной крови на автоматизированном анализаторе

Реагент №1: 2 x 21 мл
Реагент №2: 2 x 8 мл
Реагент №3: 1 x 250 мл

Срок: 2018.11

LOT 6018

Дата выпуска: 2018.11

Годен до: 2021.11

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) - это форма гемоглобина, в которой сахар (глюкоза) прикреплен к гемоглобину. Его уровень в крови является важным показателем контроля диабета. Этот набор реагентов предназначен для определения концентрации HbA1c в нативной крови на автоматизированном анализаторе.

ИНСТРУКЦИЯ

РЕАГЕНТ №1

РЕАГЕНТ №2

РЕАГЕНТ №3

РЕАГЕНТ №4

РЕАГЕНТ №5

REF B 16.71-1.420

**ГЛИКОЗИЛПРОВАНИЙ
ТЕМОЛДОСИН-ВИТАЛ**

Набор препаратов для определения глюкозы в моче (глюкоза) и мочевины (мочевина) методом ферментативного анализа

Пациент №1: 1 x 30 мл TV 21.06.20-080-0468724-2020

Пациент №2: 1 x 11,5 мл

Пациент №3: 1 x 250 мл

LOT 0013

Серия:



Дата выписки: 2019.11



Годен до: 2021.11

Содержит 30 мл раствора препарата (0,1% раствор глюкозы) и 11,5 мл раствора мочевины (0,1% раствор мочевины) в ампулах. Упаковка: 1 x 30 мл, 1 x 11,5 мл, 1 x 250 мл.



ГЛИКОЗИЛПРОВАНИЙ
ТЕМОЛДОСИН-ВИТАЛ

ГЛИКОЗИЛПРОВАНИЙ
ТЕМОЛДОСИН-ВИТАЛ
REF B 16.71-1.420
30 мл
LOT 0013
Выпускается по заказу

ГЛИКОЗИЛПРОВАНИЙ
ТЕМОЛДОСИН-ВИТАЛ
REF B 16.71-1.420
11,5 мл
LOT 0013
Выпускается по заказу

ГЛИКОЗИЛПРОВАНИЙ
ТЕМОЛДОСИН-ВИТАЛ
REF B 16.71-1.420
250 мл
LOT 0013
Выпускается по заказу



6/



REF B 16.71-2.300
ГИКОЗИМПОРАНИЙ
ГЕМОЦИМ-ВИТАЛ
250 ml
Насколько известно, для дезинфекции помещений, помещений общественного назначения (Ресторан) и помещений для животных (зоопарк) рекомендуется использовать препарат.


Размер №1: 1 x 40 ml
Размер №2: 1 x 18 ml
Размер №3: 1 x 250 ml

TV 21.50.25-000-00000000-0000
PY

LOT Сериал: 201811
Дата выпуска: 2018.11
Годен до: 2021.11

ОБЪЕМ: 250 ml
МАССА: 1 x 40 ml
МАССА: 1 x 18 ml
МАССА: 1 x 250 ml

ОБЪЕМ: 250 ml
МАССА: 1 x 40 ml
МАССА: 1 x 18 ml
МАССА: 1 x 250 ml

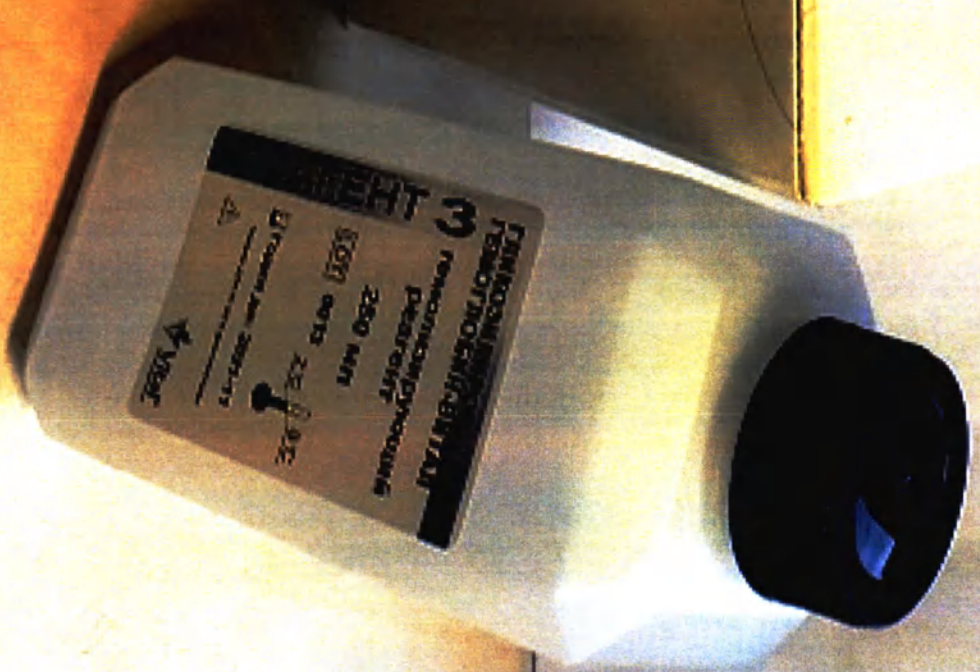

REF B 16.711-2.300

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ
ПЕМОЛТОСИН-ЭНТАЛ

Набор реактивов для определения активности
глюкозилтрансферазы (глюкоза) в нативной среде
методом ингибирования ферментативной активности

Реактив №1: 3 x 34,5 мл 1% в 250 мл

Реактив №2: 1 x 250 мл

Реактив №3: 2 x 250 мл

LOT 0013

Адрес выпуска: 2019.11

Регистр АИ: 2021.11

АО "Берег Здоровья" (г. Москва)

г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10

Тел: +7 (495) 234-10-10

Факс: +7 (495) 234-10-10

Сайт: www.bereg-zdorovya.ru

Эл. почта: info@bereg-zdorovya.ru

ИНН: 50-07-0000000

ОГРН: 1055000000000

КПП: 50-07-0000000

ОКВЭД: 28.20.00

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

ОКПД: 28.20.00.000

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 15 листа(ов)



Плехов А.Г.