

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов
_____ 2023 г.




МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения концентрации калия
в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без осаждения
«КАЛИЙ-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-091-94568735-2020**

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.01

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации



Реагент №1: 1 x 50 мл
Калибратор: 1 x 2 мл

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
РЗН 2020/12497 от 11.11.2020

LOT

Серия: 0451



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2026.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
184366 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 66, литера А

UK POTASSIUM-VITAL

R1: 1 x 50 ml
Calibrator: 1 x 2 ml

LOT 0451



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 66 A 184366
St. Petersburg, Russia

2026.05

IVD

K2 КАЛИЙ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
11.11.2020 ж. РЗН 2020/12497

Қан сарысуындағы (плазмадағы) калий концентрациясын бойынша депротеинизациясыз турбидиметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 1 x 50 мл
Калибратор: 1 x 2 мл


Сериясы: 0451
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2026.05

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
184366 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
66-й Литера А




26012305510451

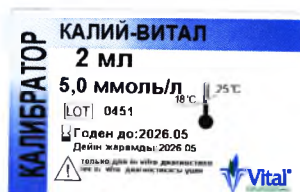

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.11

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации



Реагент №1: 2 x 50 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
РЗН 2020/12497 от 11.11.2020

LOT

Серия:
0451



Дата выпуска:
2023.05



Годен до:
2026.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А

UK POTASSIUM-VITAL

R1: 2 x 50 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT

0451



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 55 A 194356
St. Petersburg, Russia



2026.05

IVD

KZ КАЛИЙ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
11.11.2020 ж. РЗН 2020/12497

Қан сарысуындағы (плазмадағы) калий концентрациясын бойынша депротеинизациясыз турбидиметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 50 мл
Калибратор: 2 x 2 мл


Сериясы: 0451
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2026.05

тек in vitro диагностикасы үшін


"Витал Девелопмент Корпорэйшн", АО Россия,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, Литера А



26112305510451



Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации



Реагент №1: 3 x 50 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
РЗН 2020/12497 от 11.11.2020

LOT

Серия: 0451



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2026.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK POTASSIUM-VITAL

R1: 3 x 50 мл
Calibrator: 3 x 2 мл

LOT

0451

Vita Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2026.05

IVD

K2 КАЛИЙ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
11.11.2020 ж. РЗН 2020/12497

Қан сывороткасындағы (плазмадағы) калий концентрациясын бойынша депротеинизациясыз турбидиметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 3 x 50 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

Сериясы: 0451

Шығарылған күні: 2023.05

Дейін жарамды: 2026.05

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн", АО Россия,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й литер А

26212305510451




REF В 26.71-1.150

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации

Реагент №1: 1 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
РЗН 2020/12497 от 11.11.2020



LOT

Серия:
0451



Дата выпуска:
2023.05



Годен до:
2026.05

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А

UK POTASSIUM-VITAL

R1: 1 x 40 ml

LOT

0451



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 58 A, 194358
St. Petersburg, Russia

Calibrator: 2 x 2 ml



2026.05

MD

KZ КАЛИЙ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
11.11.2020 ж. РЗН 2020/12497

Қан сарысуындағы (плазмадағы) калий концентрациясын бойынша депротеинизациясыз турбидиметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 1 x 40 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

Сериясы: 0451
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2026.05

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А



92612305510451



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF В 26.71-1.150

40 мл

LOT

0451

годен до: 2026.05
Дейн жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



REF B 26.711-1.150

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации

Реагент №1: 2 x 40 мл

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020

Калибратор: 3 x 2 мл

РЭН 2020/12497 от 11.11.2020

18°C 25°C

LOT

Серия: 0451



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2026.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

POTASSIUM-VITAL

R1: 2 x 40 ml

LOT

0451



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 194358
St. Petersburg, Russia

Calibrator: 3 x 2 ml



2026.05

IVD

KZ КАЛИЙ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020

11.11.2020 ж. РЭН 2020/12497

Қан сарысуындағы (плазмадағы) калий концентрациясын бойынша депротеинизациясыз турбидиметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Сериясы: 0451
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2026.05

Реагент №1: 2 x 40 мл

Калибратор: 3 x 2 мл

тек in vitro диагностикасы үшін

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



267111501802120230



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.711-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0451

18°C 25°C

годен до: 2026.05
Дейн жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.711-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл




LOT 0451

18°C 25°C

годен до: 2026.05
Дейн жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

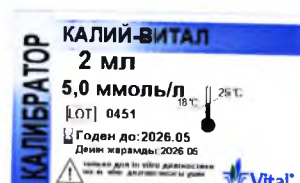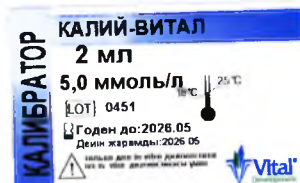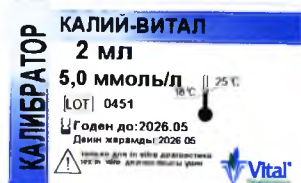

REF В 26.71-1.200

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации

Реагент №1: 2 x 20 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
РЭН 2020/12497 от 11.11.2020



LOT

Серия:
0451



Дата выпуска:
2023.05



Годен до:
2026.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

POTASSIUM-VITAL

R1: 2 x 20 ml

LOT

0451



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

Calibrator: 2 x 2 ml



2026.05

IVD

K2 КАЛИЙ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
11.11.2020 ж. РЭН 2020/12497

Қан сарысуындағы (плазмадағы) калий концентрациясын бойынша депротеинизациясыз турбидиметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Сериясы: 0451
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2026.05

Реагент №1: 2 x 20 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



92632210470448



КАЛИЙ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

20 мл

REF В 26.71-1.200

LOT

0451

годен до: 2026.05

Дейн жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



КАЛИЙ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

20 мл

REF В 26.71-1.200

LOT

0451


годен до: 2026.05

Дейн жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



8

REF В 26.71-1.300

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации

Реагент №1: 1 x 50 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
РЗН 2020/12497 от 11.11.2020



LOT Серия: 0451 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2026.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А

UK POTASSIUM-VITAL

R1: 1 x 50 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT 0451

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 55 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2026.05

IVD

K2 КАЛИЙ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
11.11.2020 ж. РЗН 2020/12497

Кен сарысуындағы (плазмадағы) калий концентрациясын бойынша депротеинизациясыз турбидиметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Сериясы: 0451
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2026.05

Реагент №1: 1 x 50 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", АО "Ресей"
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А



92622203420442




КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF В 26.71-1.300



РЕАГЕНТ 1 50 мл


LOT 0451



годен до: 2026.05
Дейн жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей




REF B 26.711-1.300

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации

Реагент №1: 2 x 50 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
РЭН 2020/12497 от 11.11.2020



LOT

Серия: 0451



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2026.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK POTASSIUM-VITAL

R1: 2 x 50 ml

LOT

0451



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

Calibrator: 3 x 2 ml



2026.05

IVD

K2 КАЛИЙ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
11.11.2020 ж. РЭН 2020/12497

Қан сывороткасындағы (плазмадағы) калий концентрациясын бойынша депротеинизациясыз турбидиметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Сериясы: 0451
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2026.05

Реагент №1: 2 x 50 мл

Калибратор: 3 x 2 мл

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн", АО Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



92532203420442



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.711-1.300




1 50 мл

РЕАГЕНТ

LOT

0451



годен до: 2026.05
Дейн жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АО Россия

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.711-1.300




1 50 мл

РЕАГЕНТ

LOT

0451



годен до: 2026.05
Дейн жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АО Россия

КАЛИЙ-ВИТАЛ
2 мл
5,0 ммоль/л
LOT 0451
годен до: 2026.05
Дейн жарамды: 2026.05
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

КАЛИЙ-ВИТАЛ
2 мл
5,0 ммоль/л
LOT 0451
годен до: 2026.05
Дейн жарамды: 2026.05
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

КАЛИЙ-ВИТАЛ
2 мл
5,0 ммоль/л
LOT 0451
годен до: 2026.05
Дейн жарамды: 2026.05
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

REF B 26.71-1.420

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации

Реагент №1: 2 x 30 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
РЗН 2020/12497 от 11.11.2020



LOT

Серия: 0451



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2026.05

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK POTASSIUM-VITAL

R1: 2 x 30 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

LOT

0451



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194358
St. Petersburg, Russia



2026.05

IVD

KZ КАЛИЙ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
11.11.2020 ж. РЗН 2020/12497

Қан сарысуындағы (плазмадағы) калий концентрациясын бойынша депротеинизациясыз турбидиметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Сериясы: 0451
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2026.05

Реагент №1: 2 x 30 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



92422207460446



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.71-1.420



РЕАГЕНТ 1

30 мл

LOT

0451



годен до: 2026.05
Дейн жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.71-1.420




РЕАГЕНТ 1

30 мл

LOT

0451





годен до: 2026.05
Дейн жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей




REF В 26.711-1.420

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации

Реагент №1: 2 x 60 мл
Калибратор: 4 x 2 мл

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020
РЗН 2020/12497 от 11.11.2020



LOT

Серия: 0451



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2026.05

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А

UK POTASSIUM-VITAL

R1: 2 x 60 ml

LOT

0451



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 55 A * 194356
St. Petersburg, Russia

Calibrator: 4 x 2 ml



2026.05

IVD

KZ КАЛИЙ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-091-94568735-2020

11.11.2020 ж. РЗН 2020/12497

Қан сарысуындағы (плазмадағы) калий концентрациясын бойынша депротеинизациясыз турбидиметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Сериясы: 0451

Реагент №1: 2 x 60 мл

Шығарылған күні: 2023.05

Калибратор: 4 x 2 мл

Дейін жарамды: 2026.05

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 55, литера А



267111501002120220



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF В 26.711-1.420




РЕАГЕНТ 1

60 мл

LOT

0451



Годен до: 2026.05
Дейин жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF В 26.711-1.420




РЕАГЕНТ 1

60 мл

LOT

0451



Годен до: 2026.05
Дейин жарамды: 2026.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

КАЛИЙ-ВИТАЛ
КАЛИБРАТОР
2 мл
5,0 ммоль/л
LOT 0451
Годен до: 2026.05
Дейин жарамды: 2026.05
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



КАЛИЙ-ВИТАЛ
КАЛИБРАТОР
2 мл
5,0 ммоль/л
LOT 0451
Годен до: 2026.05
Дейин жарамды: 2026.05
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



КАЛИЙ-ВИТАЛ
КАЛИБРАТОР
2 мл
5,0 ммоль/л
LOT 0451
Годен до: 2026.05
Дейин жарамды: 2026.05
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



КАЛИЙ-ВИТАЛ
КАЛИБРАТОР
2 мл
5,0 ммоль/л
LOT 0451
Годен до: 2026.05
Дейин жарамды: 2026.05
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 12 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
_____ А.Г.Плехов



_____ 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Набор реагентов для определения концентрации калия
в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без осаждения
«КАЛИЙ-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-091-94568735-2020**

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.01

Набор реагентов для определения концентрации
калия в сыворотке (плазме) крови
турбидиметрическим методом без депротеинизации

18°C 25°C

Реагент №1 1 x 50 мл
Калибратор 1 x 2 мл

ТУ 21.20.23-001-04505730-2020
РУ

LOT

Серия:
0012



Дата выпуска:
2018.02



Годен до:
2021.02

только для in vitro диагностики

UK POTASSIUM-VITAL

R1: 1 x 50 ml
Calibrator: 1 x 2 ml

MD

LOT 0012

2021.02

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194360 Санкт-Петербург, Дорога в Коммуны
дом 55, литер А

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн"
Санкт-Петербург, 194360
55 литер А



КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.11

Метод реагента для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации

Реагент №1: 2 x 50 мл

18 °C 26 °C

Калибратор: 2 x 2 мл

LOT Серия: 0012



Дата выпуска: 2018.02

Годен до: 2021.02

Только для in vitro диагностики

АО "Витал Реагенты и Контроль", Россия
105326 Санкт-Петербург, Девятая в Копейку
Адрес: Петровка

UK POTASSIUM-VITAL

R1: 2 x 50 мл
Calibrator: 2 x 2 мл



LOT 0012

2021.02

АО "Витал Реагенты и Контроль"
Санкт-Петербург, Девятая в Копейку
Адрес: Петровка



КАЛИЙ-ВИТАЛ
50 мл
Реагент №1
Lot 0012
Дата выпуска: 2018.02
Годен до: 2021.02

КАЛИЙ-ВИТАЛ
50 мл
Реагент №1
Lot 0012
Дата выпуска: 2018.02
Годен до: 2021.02

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.21

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (интравен) способом турбидиметрическим методом без депротеинизации

18 °C 25 °C

Реагент №1: 3 x 50 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

ТУ 21.50.23-001-04268736-2020
РФ

LOT

Серия: 0012

Дата выпуска: 2018.02

Годен до: 2021.02

Торговая марка in vitro диагностика
UK POTASSIUM-VIT AL


АО "Витам Дианалогизм Коперация", Россия
125160, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1

Р1: 2 x 50 мл
Содержатель: 2 x 2 мл

INVO

LOT 0012

2017.02

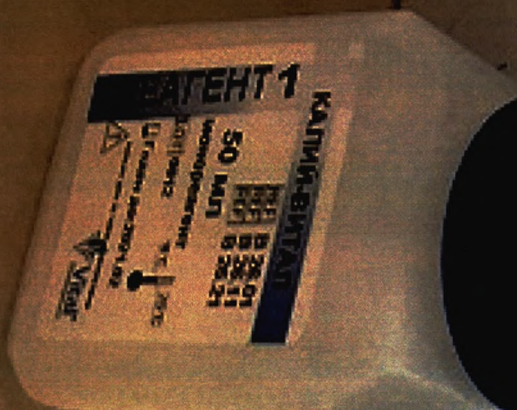

REF B 26.71-1.150

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Индикатор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации

Реагент №1: 1 x 40 мл ТУ 21.20.23-091-9488756-2020
Калибратор: 2 x 2 мл РУ

18 °C / 25 °C

LOT Серия: 0012 Дата выпуска: 2018.02 Годен до: 2021.02

только для in vitro диагностики АО "Синтез-Диагностика-Медиа-Технологии", Россия
г. Москва, Савеловский бульвар, д. 10, корпус А

UK POTASSIUM-VITAL

LOT 0012

RU: 1 x 40 мл
Содержимое: 2 x 2 мл

2024.02

г. Москва, Савеловский
бульвар, д. 10, корпус А

2017110010031202

КАЛИЙ-ВИТАЛ

40 мл

REF B 26.71-1.150

LOT 0012

18 °C / 25 °C

годен до: 2021.02
только для in vitro диагностики

АО "Синтез-Диагностика-Медиа-Технологии", Россия
г. Москва, Савеловский бульвар, д. 10, корпус А



REF B 26.711-1.150

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Реагент для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации

Реагент №1: 2 x 40 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

18°C / 25°C

LOT Серии: 0012
Дата выпуска: 2018.02
Годен до: 2021.02

Торгов. для in vitro диагностики
АО "Битан Девелопмент Корпорейшн", Россия
551324 Санкт-Петербург, Адмирал в Космический,
дом 5А, литера А

OK POTASSIUM-VITAL

Р1: 2 x 40 мл
Содержит: 3 x 2 мл
LOT 0012
2021.02

КАЛИЙ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 40 мл

REF B 26.711-1.150
Годен до: 2021.02
Только для in vitro диагностики

18°C / 25°C

26.711-1.150

18°C / 25°C

02

ИНСТРУКЦИЯ

Синтез, Россия

АО "Битан Девелопмент Корпорейшн", Россия

[REF] В 26.71-1.200

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реактивов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови трибоимпедансным методом без электролиза

Реагент №1: 2 x 20 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 21-80-23-091-датыт-0000
ТУ 21-80-23-091-датыт-0000

[LOT] Серия: 0012
[LOT] Дата выпуска: 2018.02
[LOT] Годен до: 2021.02

Только для in vitro диагностики
АО "Витал Диагностикс" (ООО "Витал Диагностикс"), Россия
194326 Санкт-Петербург, Репина в. 14/15, литер А

UK POTASSIUM-VITAL

П1: 2 x 20 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

[LOT] 0012
[LOT] 0012
2021.02

КАЛИЙ-ВИТАЛ

[REF] В 26.71-1.200
20 МЛ

[LOT] 0012

Годен до: 2021.02

Только для in vitro диагностики
АО "Витал Диагностикс" (ООО "Витал Диагностикс"), Россия



REF B 26.711-1.200

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реактивов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротенизации

Реагент №1: 5 x 20 мл
Калибратор: 3x 2 мл

25°C

LOT 0012



Дата выпуска: 2018.02



Годен до: 2021.02

Используется in vitro диагностика

АО "Финанс-Биоанализы Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Аэропорт в Клипину,
дом 88, литера А

UK POTASSIUM-VITAL

RU: 5 x 20 ml

LOT 0012


RU: 5 x 20 ml

UK

LOT 0012

RU: 5 x 20 ml



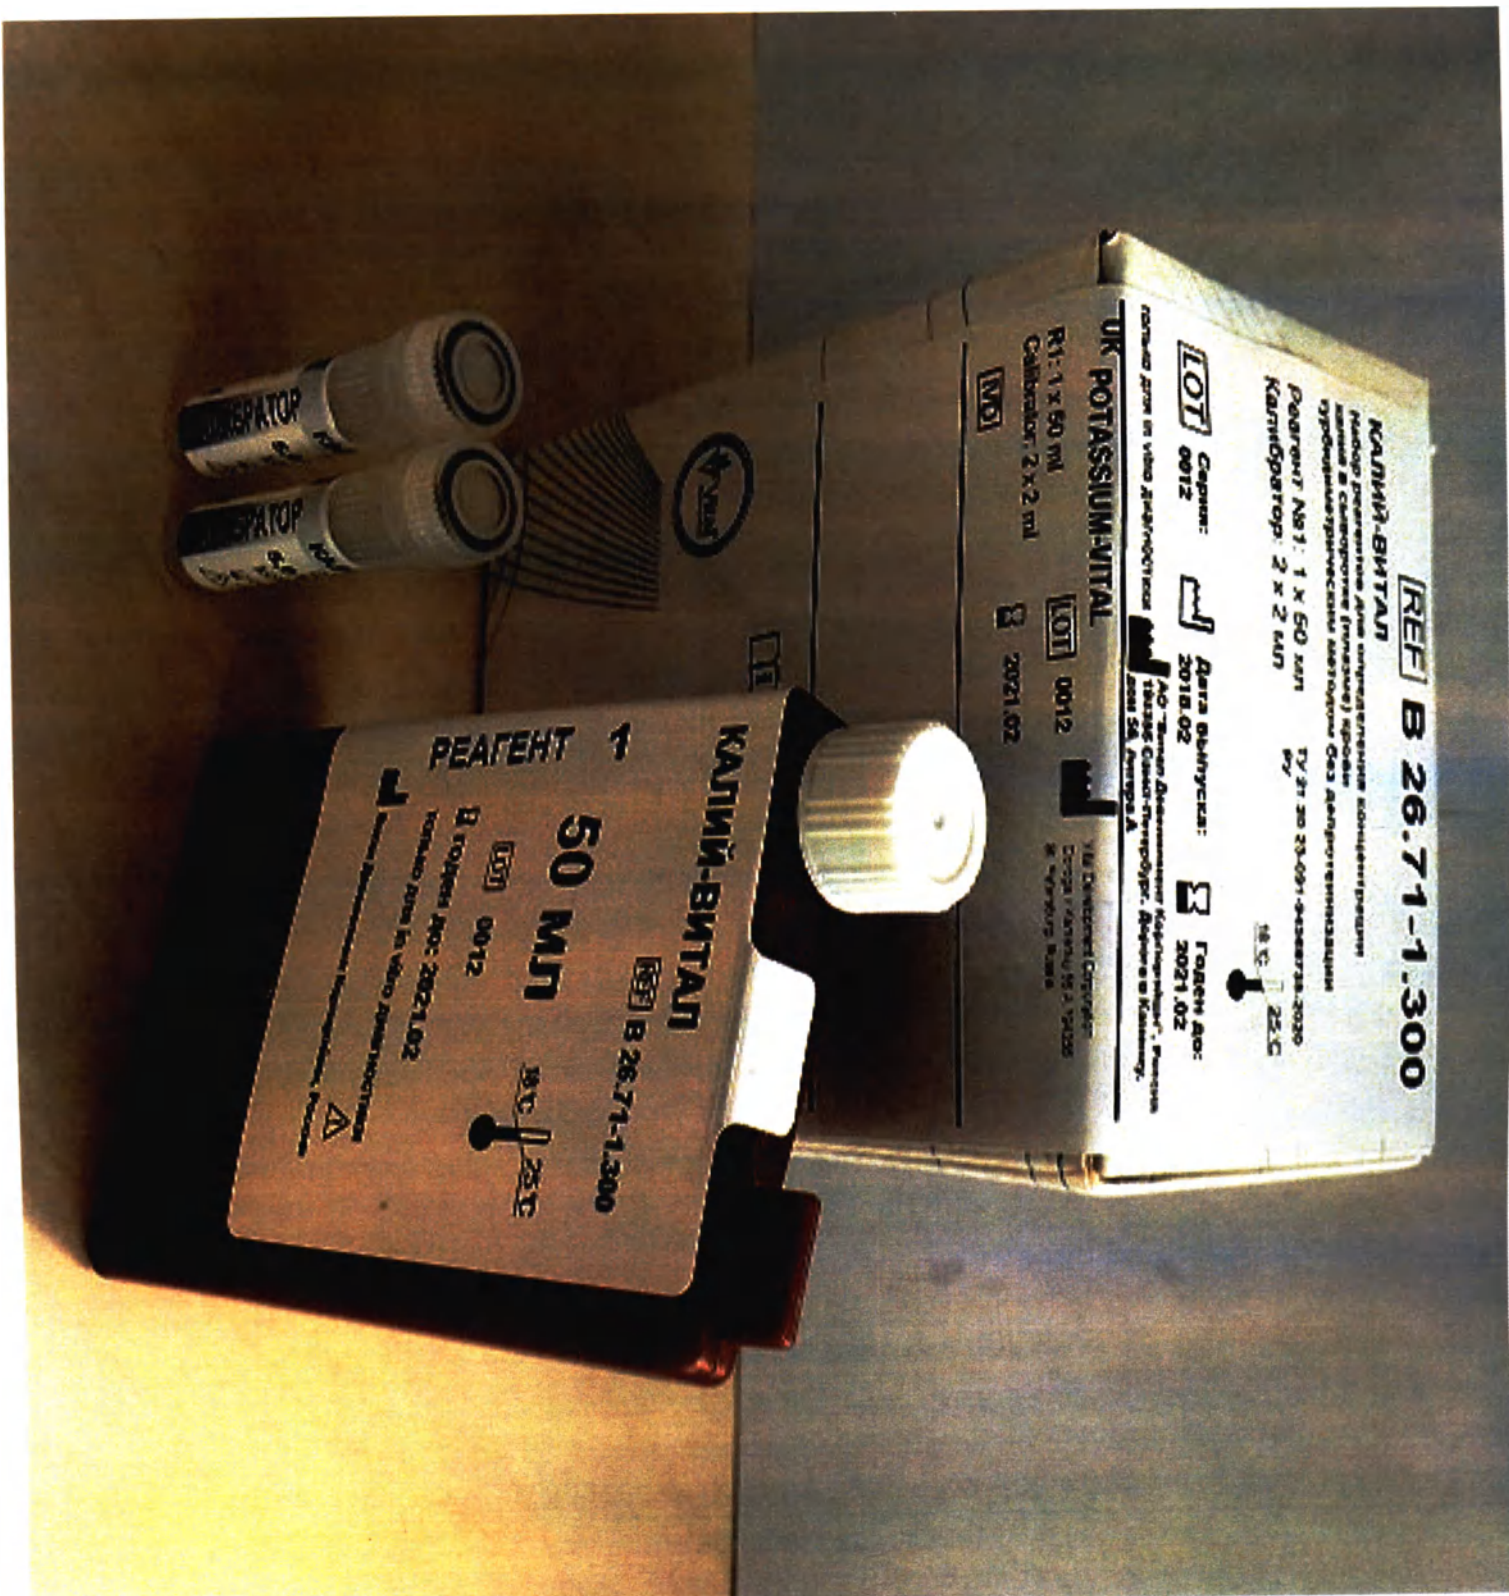

REF B 26.71-1.300

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реактивов для определения концентрации калия в биологических жидкостях (гематина) методом фотометрического измерения оптической плотности раствора

Реагент №1: 1 x 50 мл
Калисбор: 2 x 2 мл

18°C / 25°C

LOT 0012 **Серия:** 2018.02 **Дата выпуска:** 2021.02 **Годен до:** 2021.02

Комплект для in vitro диагностики АО "Биофарм" (г. Москва) и АО "Биофарм" (г. Санкт-Петербург). Адрес в Калининграде: 236000, ул. Ленинградская, д. 10

UK POTASSIUM-VITAL

R1: 1 x 50 ml
Calibrator: 2 x 2 ml

MOI 2021.02

Yale Diagnostics Corporation
20001 / 10000 / 10000
St. Louis, MO 63103

КАЛИЙ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1
50 мл
REF B 26.71-1.300

LOT 0012

Годен до: 2021.02

Комплект для in vitro диагностики АО "Биофарм" (г. Москва) и АО "Биофарм" (г. Санкт-Петербург). Адрес в Калининграде: 236000, ул. Ленинградская, д. 10

REF B 26.711-1.300

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (ионах) крови
Дифференциальный метод с использованием ион-селективного электрода

Реагент №1: 2 x 50 мл
Калибратор: 3 x 2 мл

18°C 25°C

LOT 0012



Дата выпуска:
2018.02



Годен до:
2021.02

Использовать в vitro диагностик
АО "Витал-Диагностика" (г. Москва)
104104, Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 1

UK POTASSIUM-VITAL

NO

EV: 2 x 50 ml

Calibrator: 3 x 2 ml

LOT 0012



Use before expiry date
2018.02

2021.02

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.711-1.300

50 мл

LOT 0012

18°C 25°C

В годен до: 2021.02

Использовать в vitro диагностик

АО "Витал-Диагностика" (г. Москва)
104104, Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 1

REF B 26.71-1.420

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови
Турбидиметрическим методом без депротеинизации

Реагент №1: 2 x 30 мл
Калибратор: 2 x 2 мл

ТУ 31-20-23-091-9456735-9030

18°C / 25°C

LOT Серии: 0012



Дата выпуска: 2010.02

Годен до: 2021.02

Пользоваться для in vitro диагностики
АО "Техно Диагностика Корпорация", Россия
191128 Санкт-Петербург, Дворца Олимпийского.
800 66 1111111111

UK POTASSIUM-VITAL

Мл: 2 x 30 мл
Содержимое: 2 x 2 мл



LOT 0012

В 2009.02

РЕАГЕНТ 1

КАЛИЙ-ВИТАЛ

REF B 26.71-1.420

30 МЛ

LOT 0012

18°C / 25°C

В годен до: 2021.02

Только для in vitro диагностики



АО "Техно Диагностика Корпорация", Россия

REF B 26.711-1.420

КАЛИЙ-ВИТАЛ

Препарат предназначен для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови

тубидиметрическим методом без дигорения

Размерет №1: 2 x 60 мл

Калибровоч: 4 x 2 мл

Т/з 30-35-001-0466703-0000

20°C

LOT 0012

Сери:

Дата выпуска:

Годен до:

2018.02

2021.02

Пошаговое описание в инструкции

UK POTASSIUM-VITAL

№1: 2 x 60 мл

Калибровоч: 4 x 2 мл

20°C

LOT 0012

2021.02

КАЛИЙ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

60 мл

REF B 26.711-1.420

20°C

LOT 0012

годен до: 2021.02

только для in vitro диагностики

⚠

Самостоятельно использовать препарат нельзя

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 12 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

