

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»

 Виленский А.В.
2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL в вариантах исполнения
(NEOSIL CO., LTD. («НЕОСИЛ КО., ЛТД.»), Республика Корея

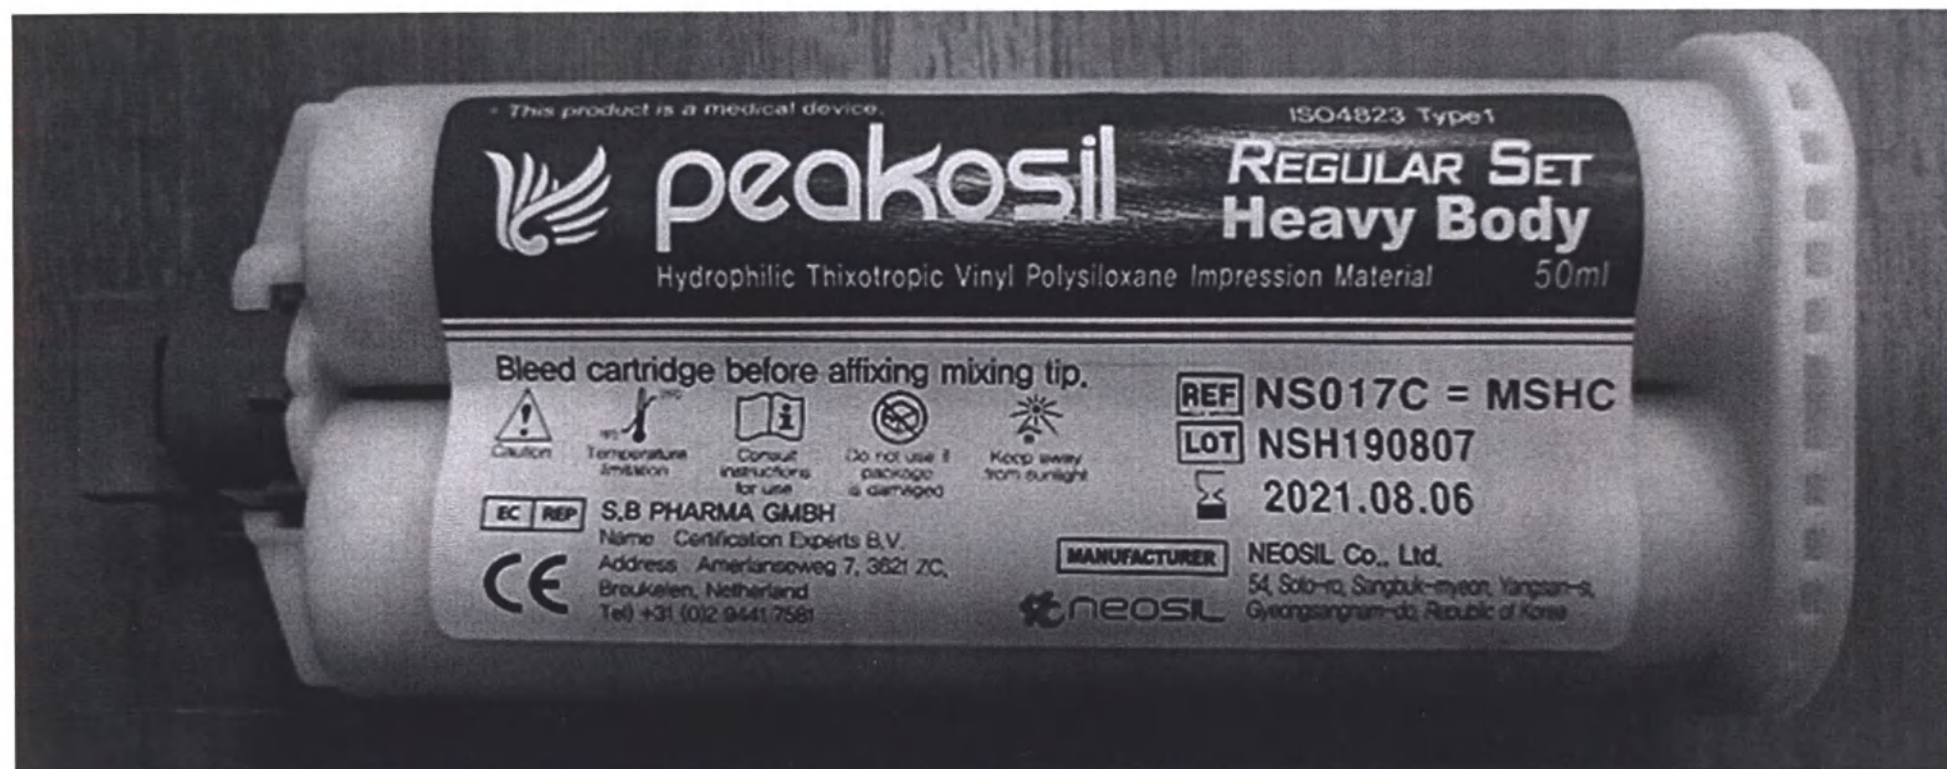


Фото 1. Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Heavy Body Regular Set (NS017C).

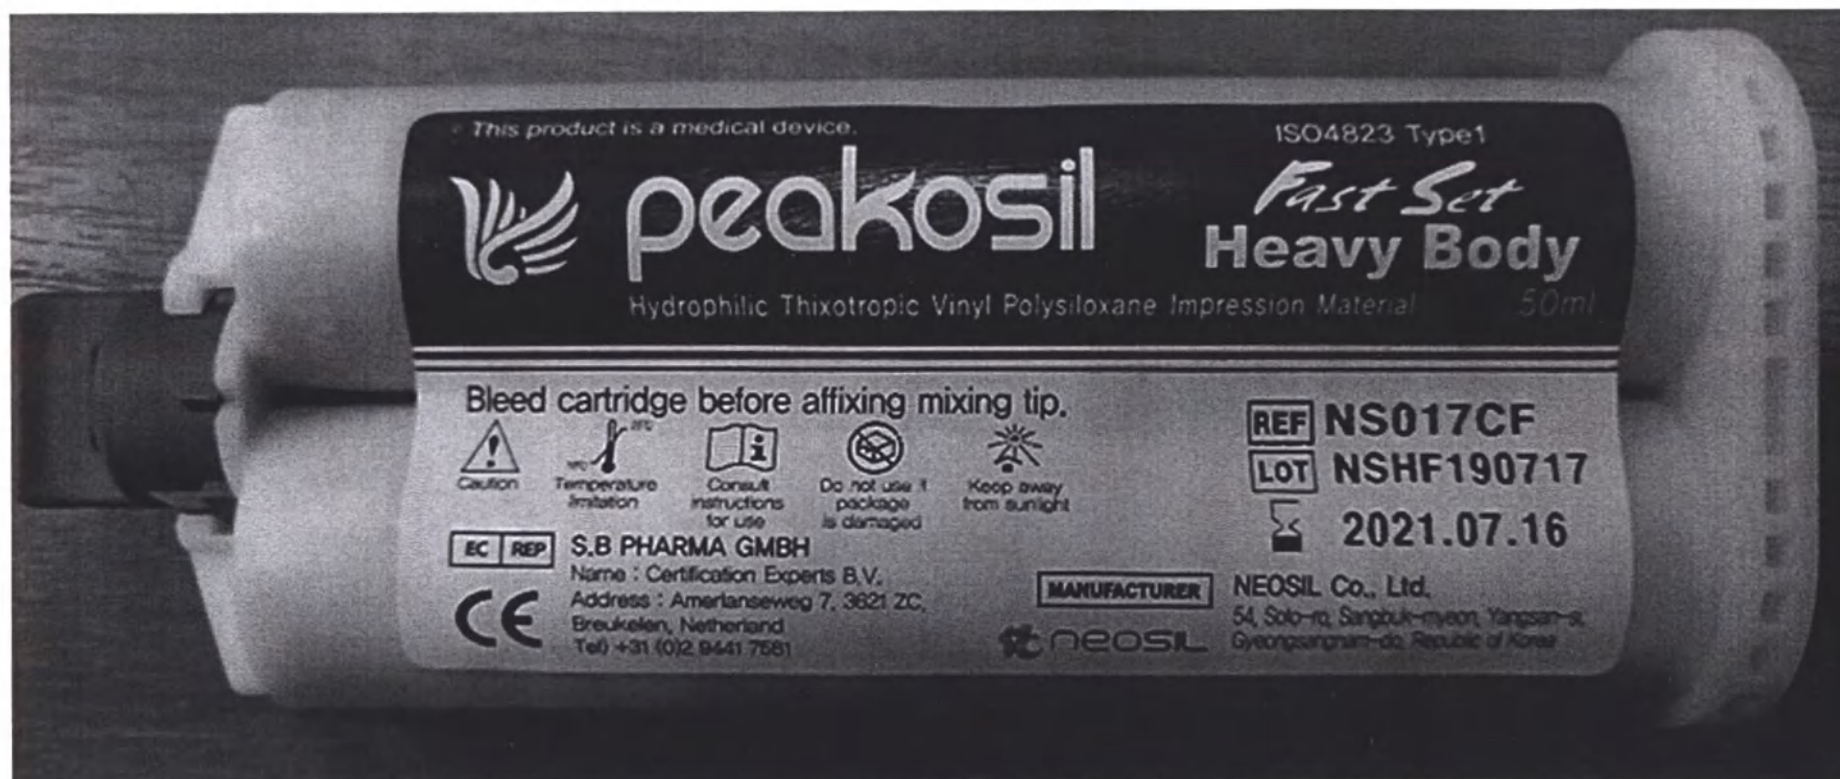


Фото 2. Материал стоматологический оттискной силиконовый PEAKOSIL Heavy Body Fast Set (NS017CF).

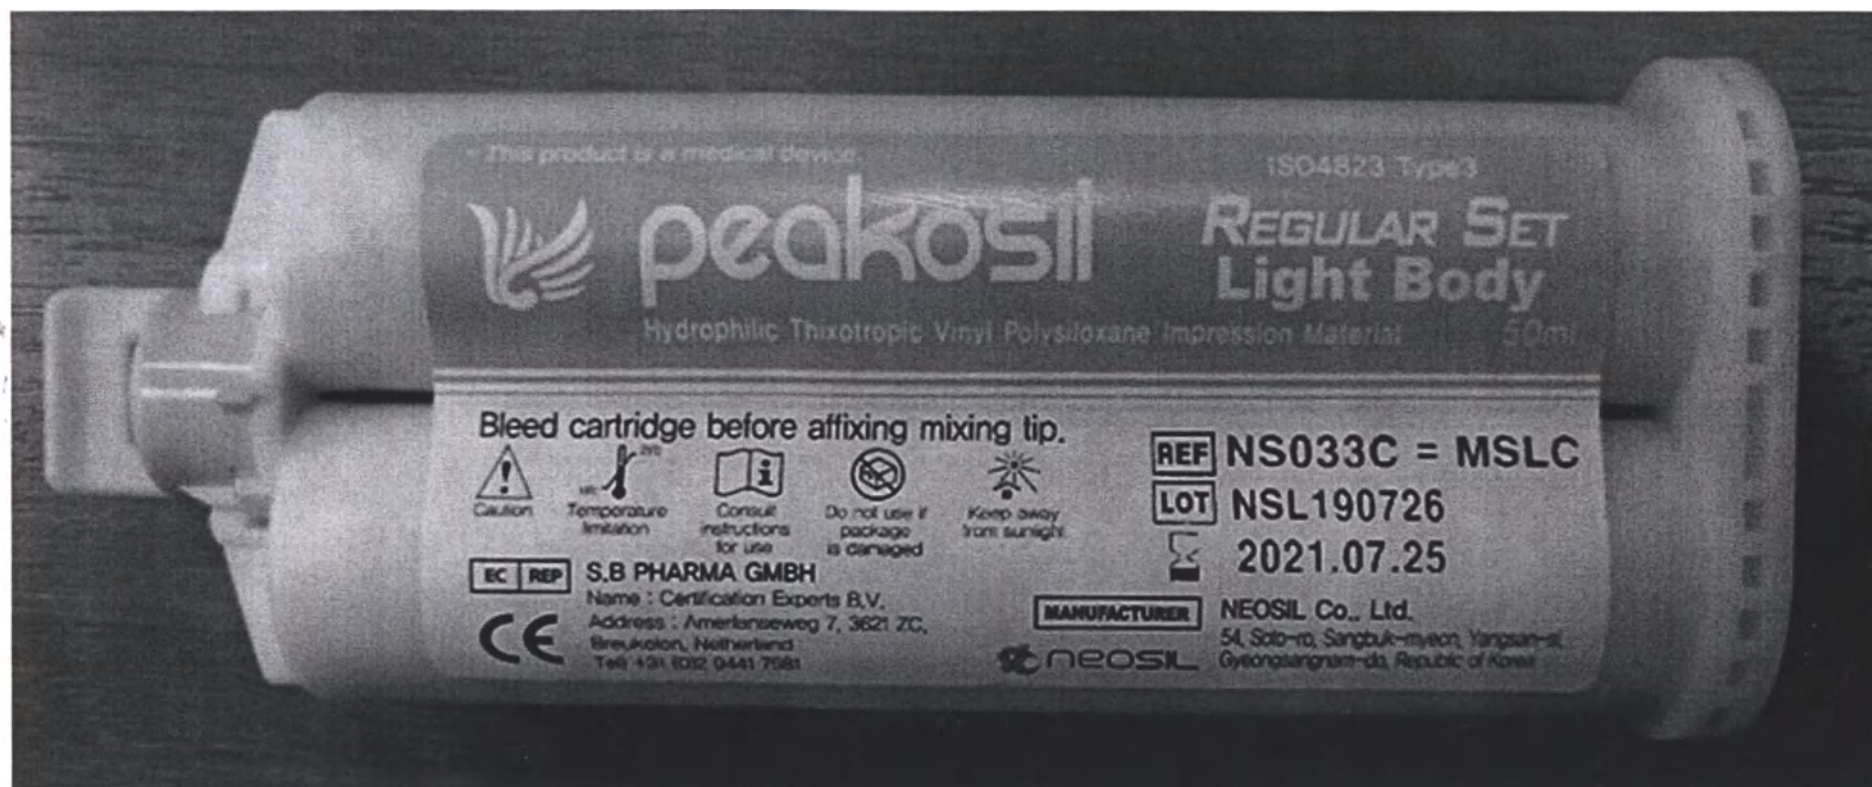


Фото 3. Материал стоматологический оттисковый силиконовый PEAKOSIL Light Body Regular Set (NS033C).

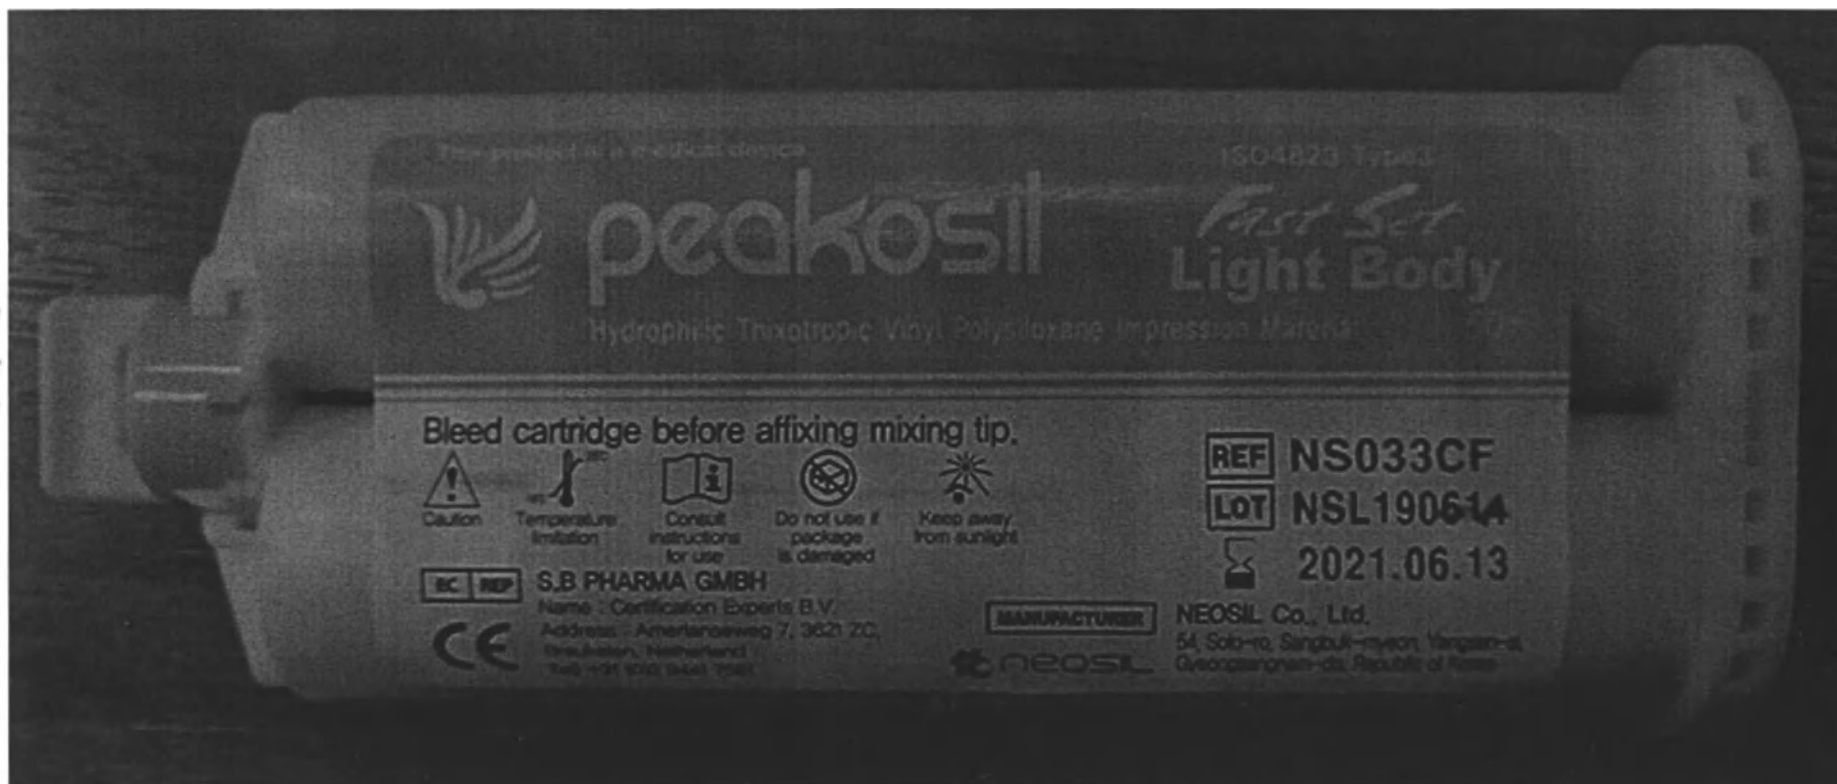


Фото 4. Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Light Body Fast Set (NS033CF).

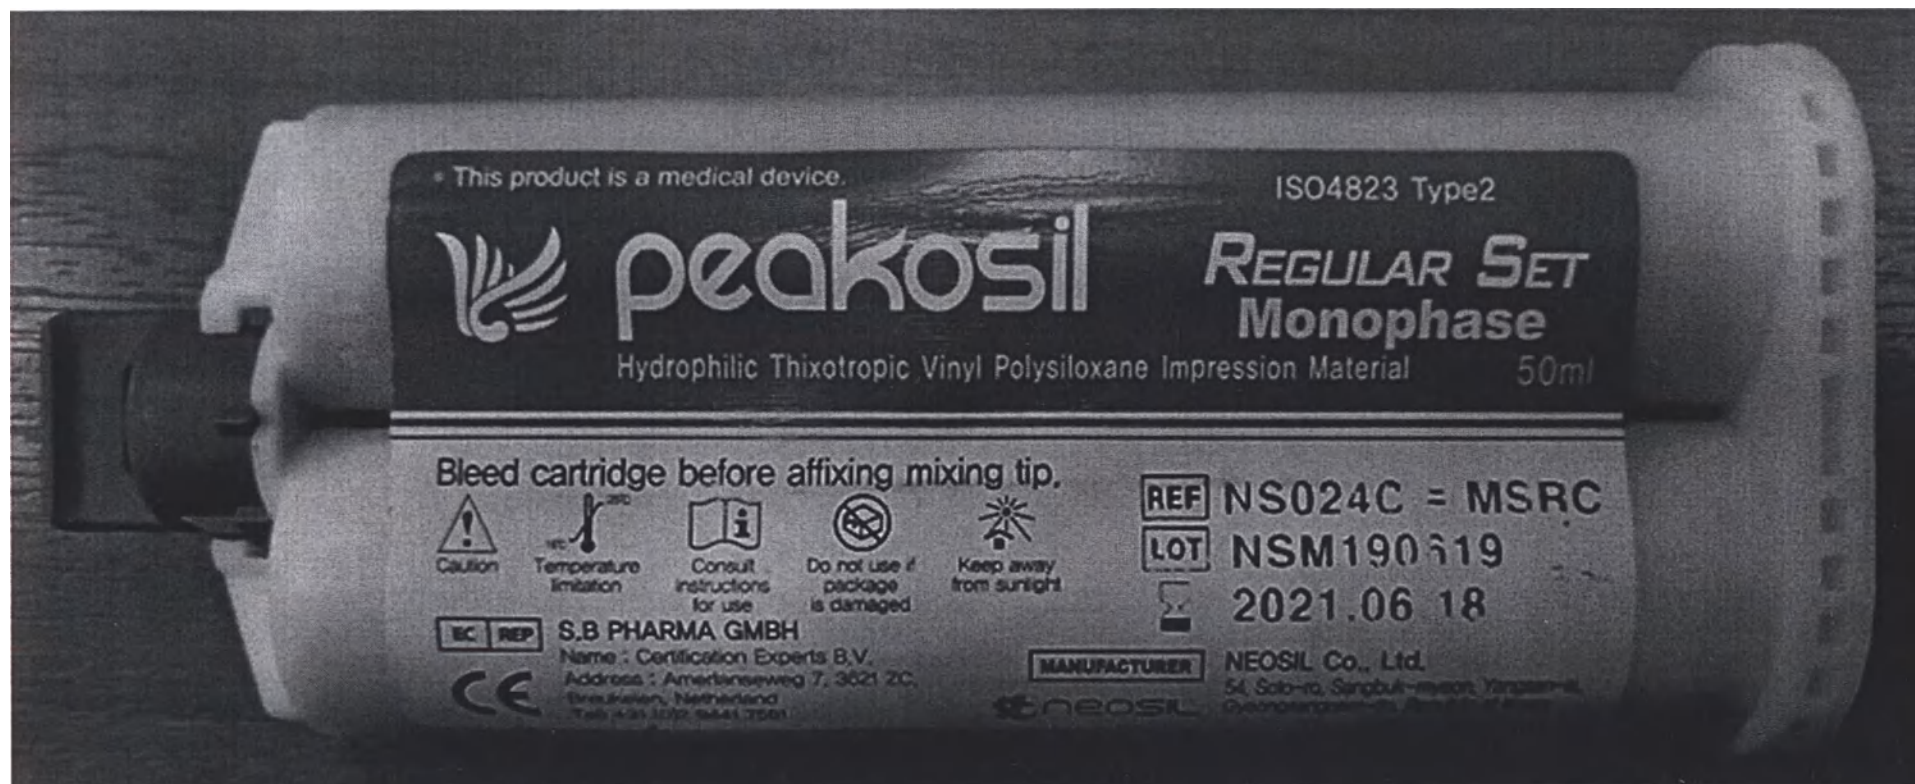


Фото 5. Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Monophase Regular Set (NS024C).

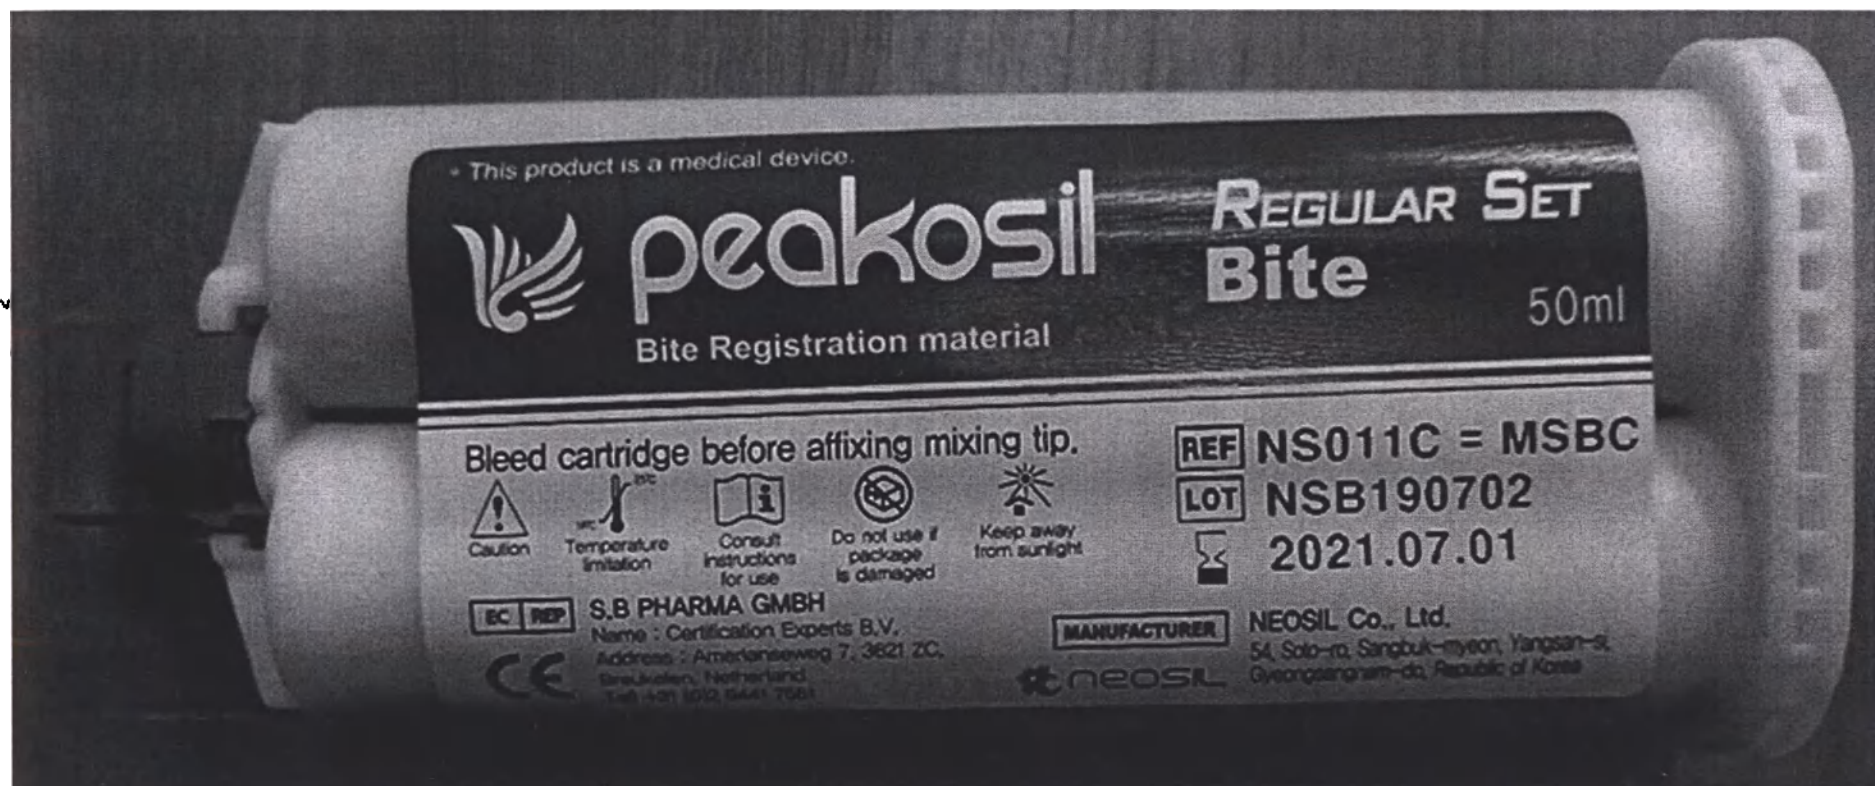


Фото 6. Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Bite Regular Set (NS011C).

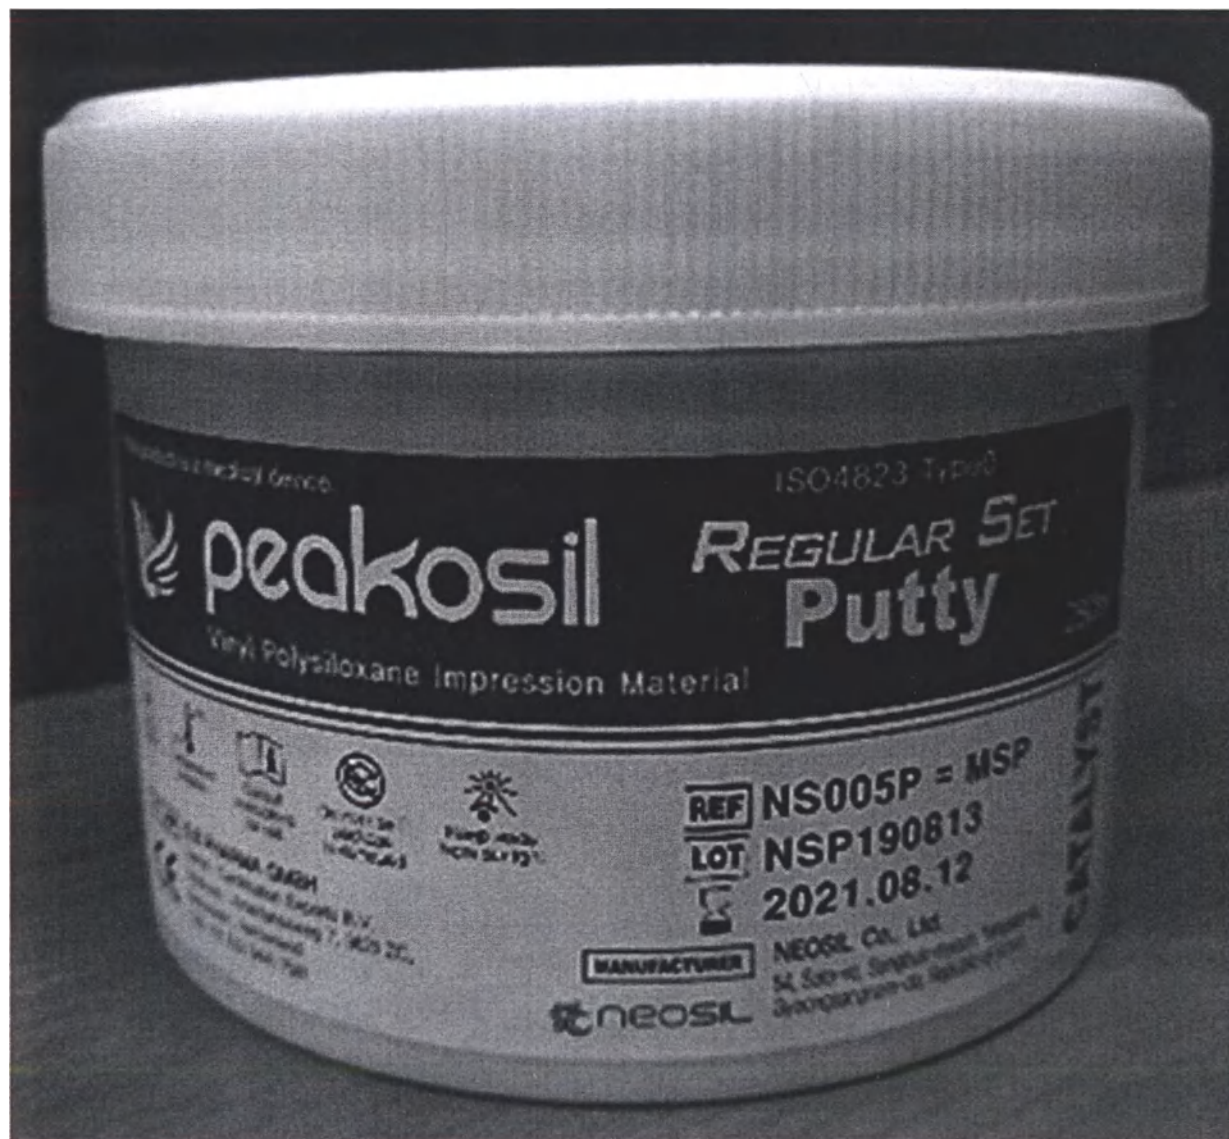


Фото 7. Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Putty Regular Set (NS005P). Компонент каталитический Catalyst.

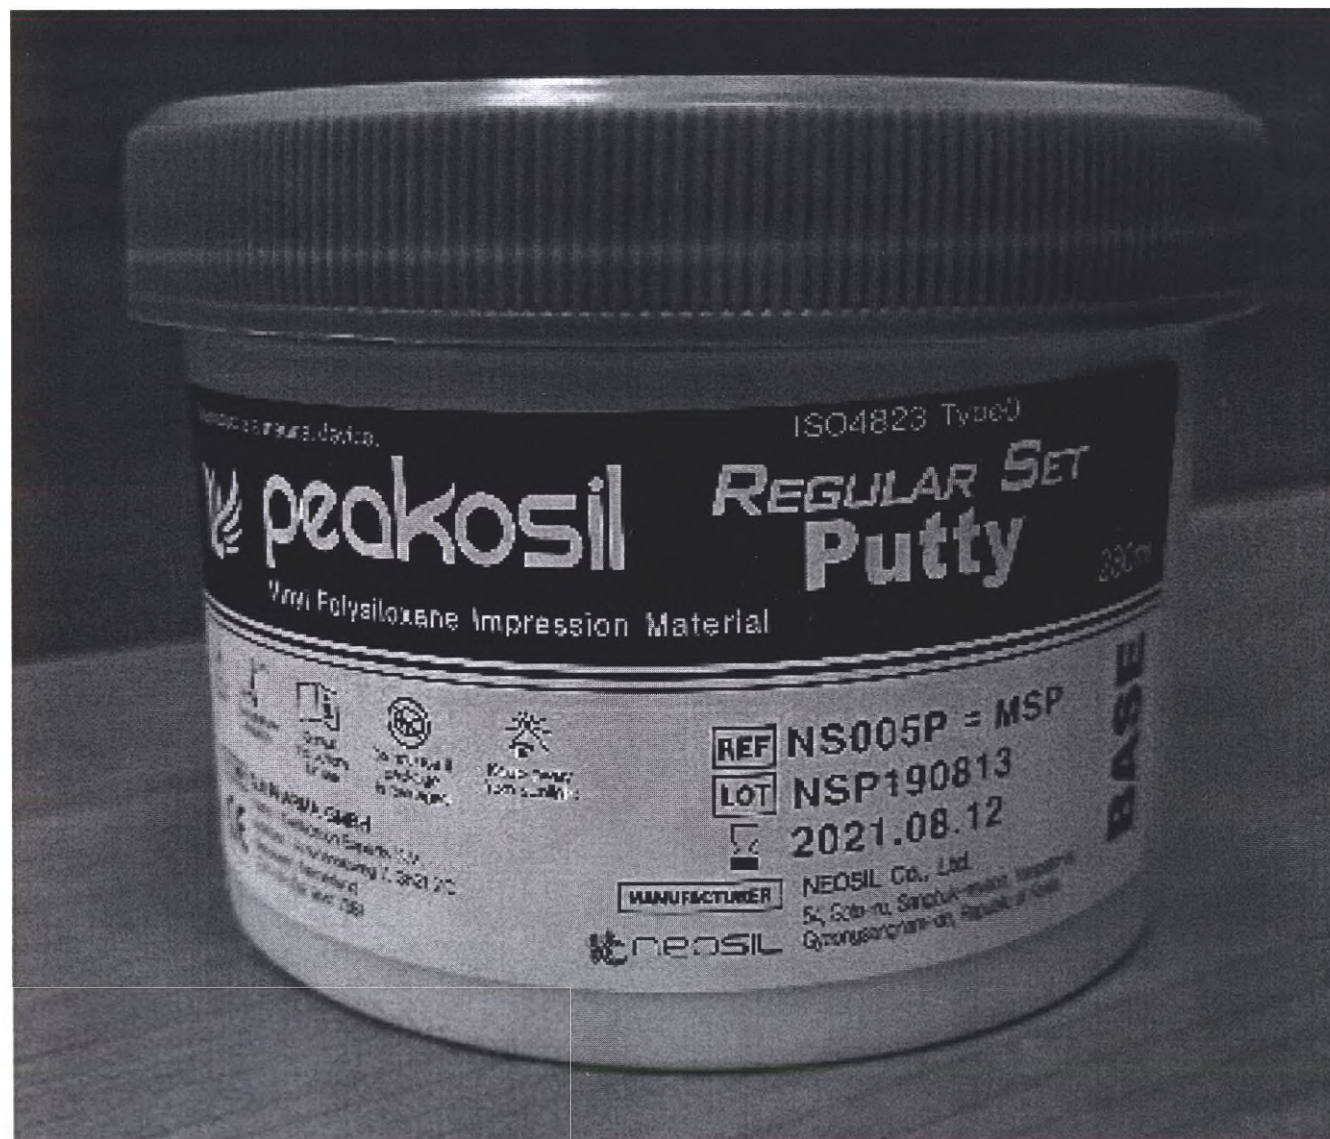


Фото 8. Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Putty Regular Set (NS005P). Компонент базовый Base.

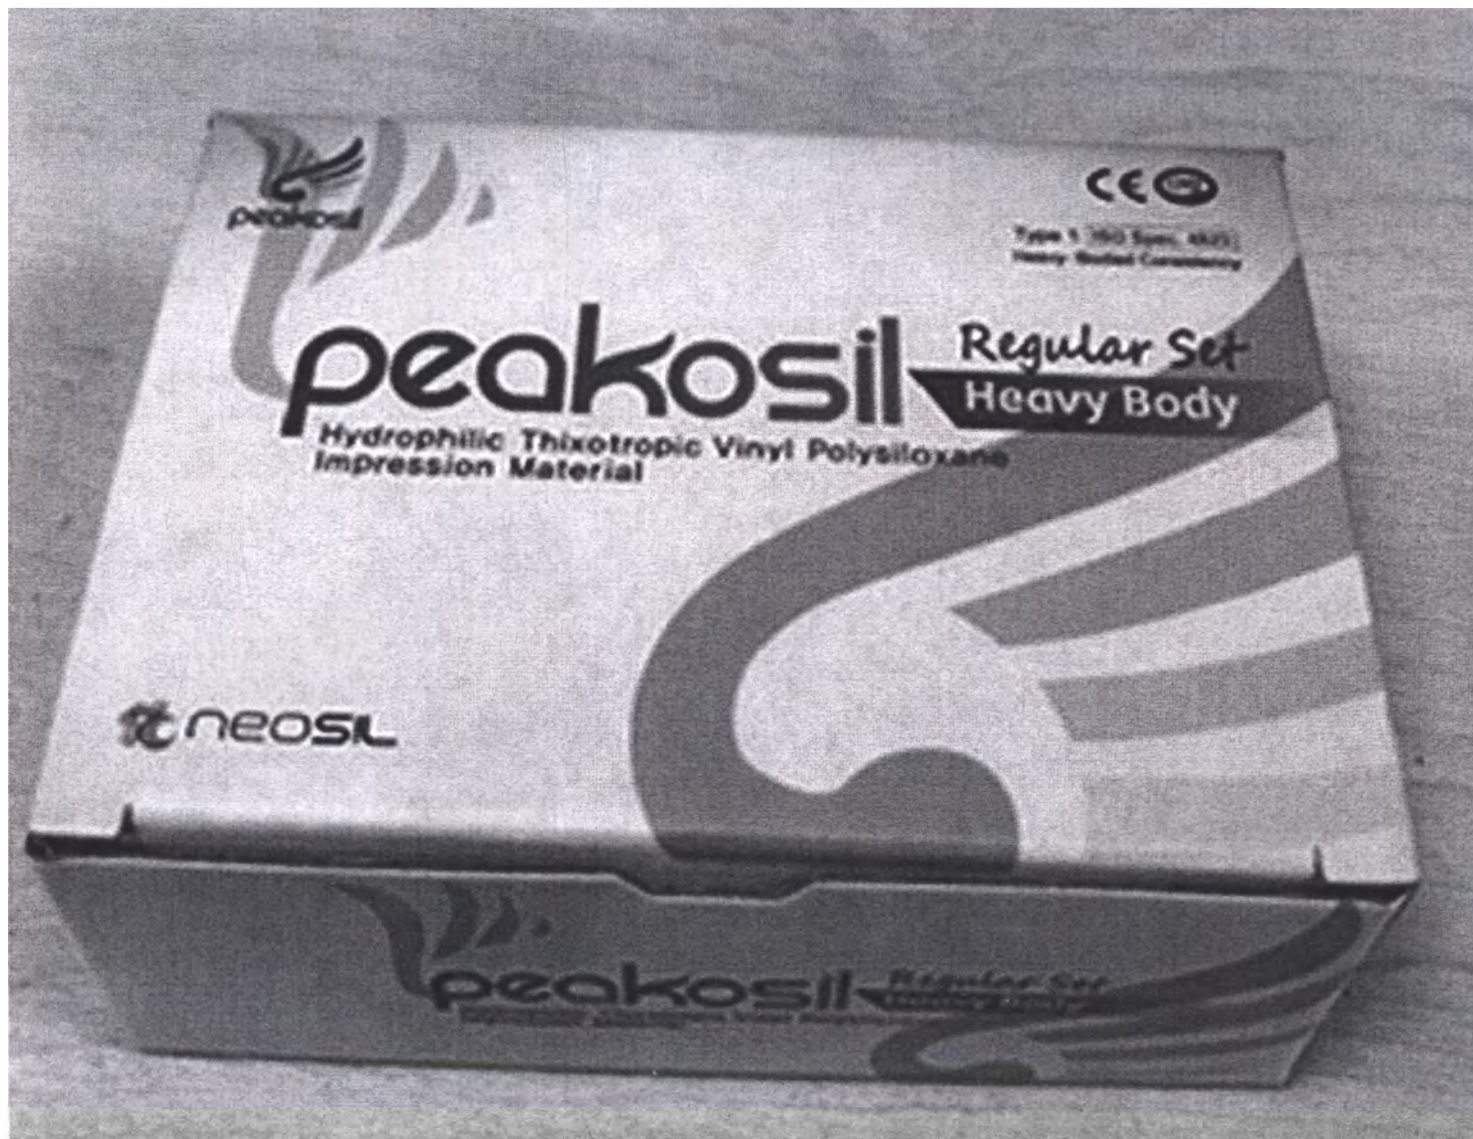


Фото 9. Групповая упаковка материала стоматологического оттискового силиконового PEAKOSIL Heavy Body Regular Set (NS017C).

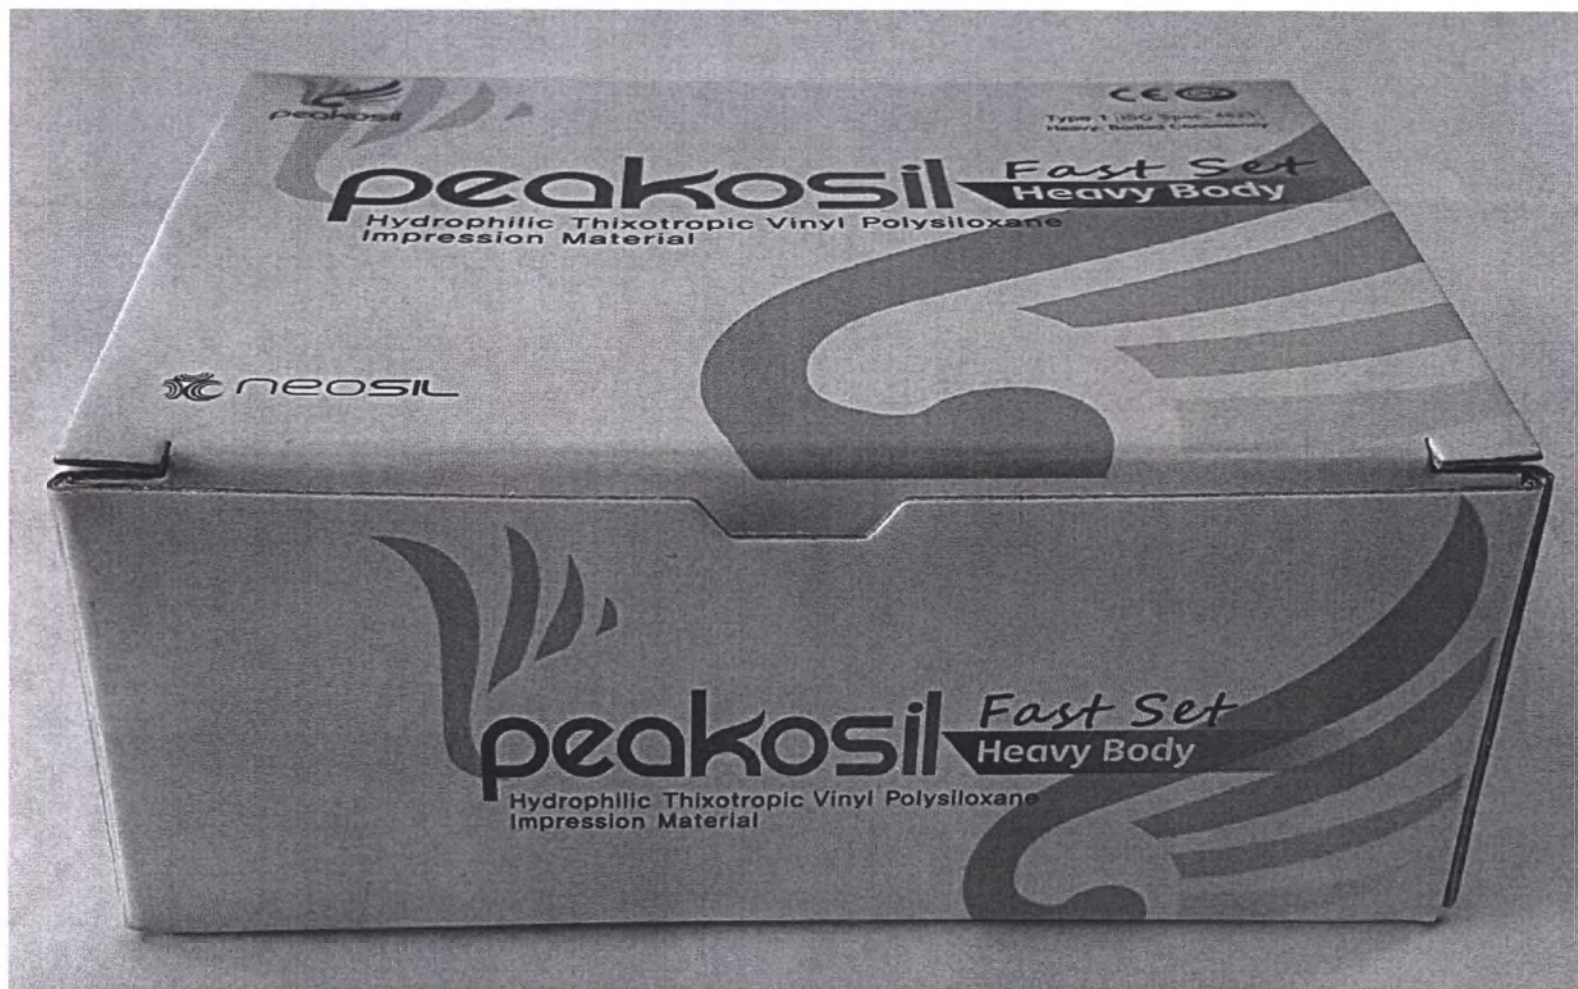


Фото 10. Групповая упаковка материала стоматологического оттискового силиконового PEAKOSIL Heavy Body Fast Set (NS017CF).

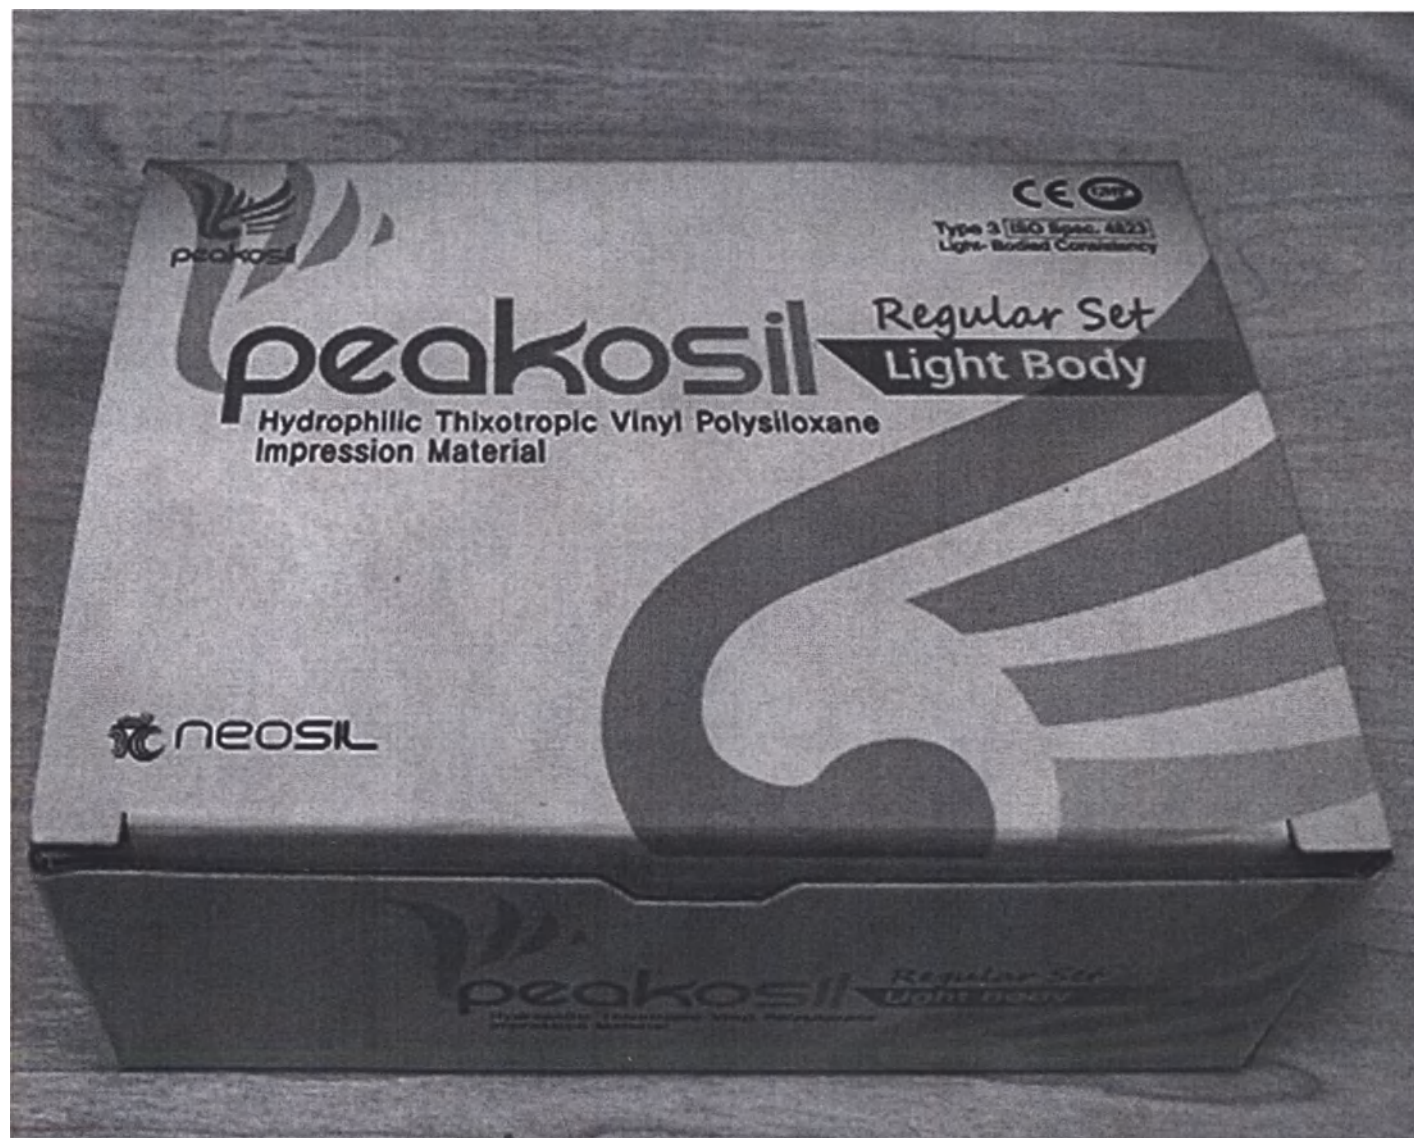


Фото 11. Групповая упаковка материала стоматологического оттискового силиконового PEAKOSIL Light Body Regular Set (NS033C).

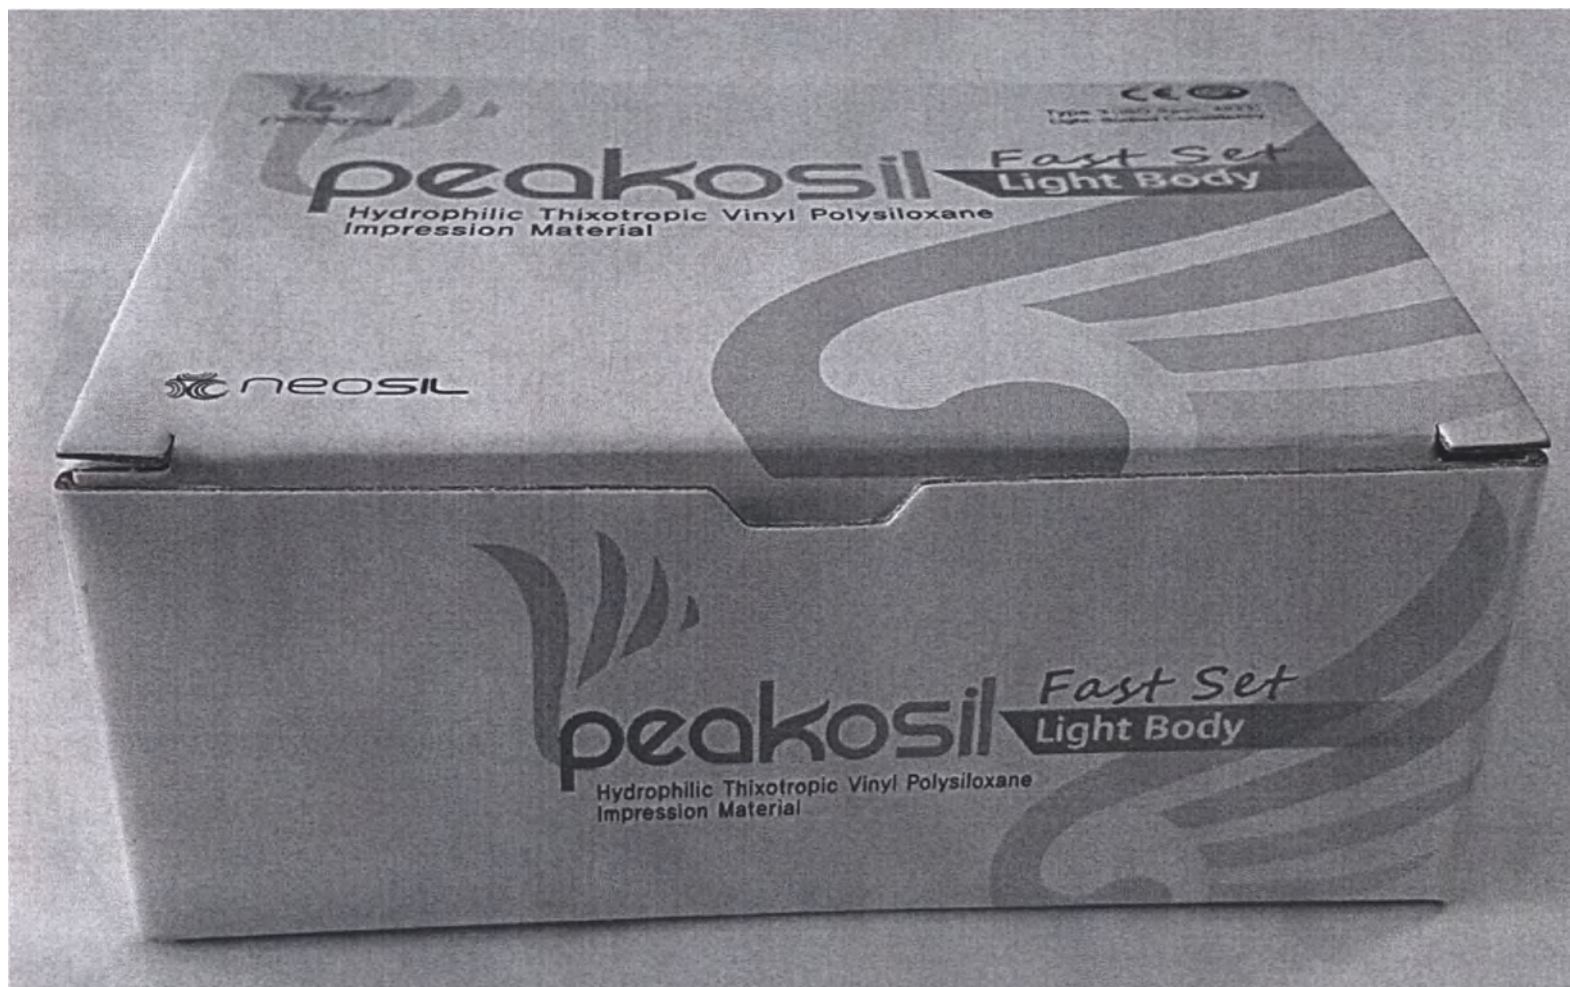


Фото 12. Групповая упаковка материала стоматологического оттискового силиконового PEAKOSIL Light Body Fast Set (NS033CF).

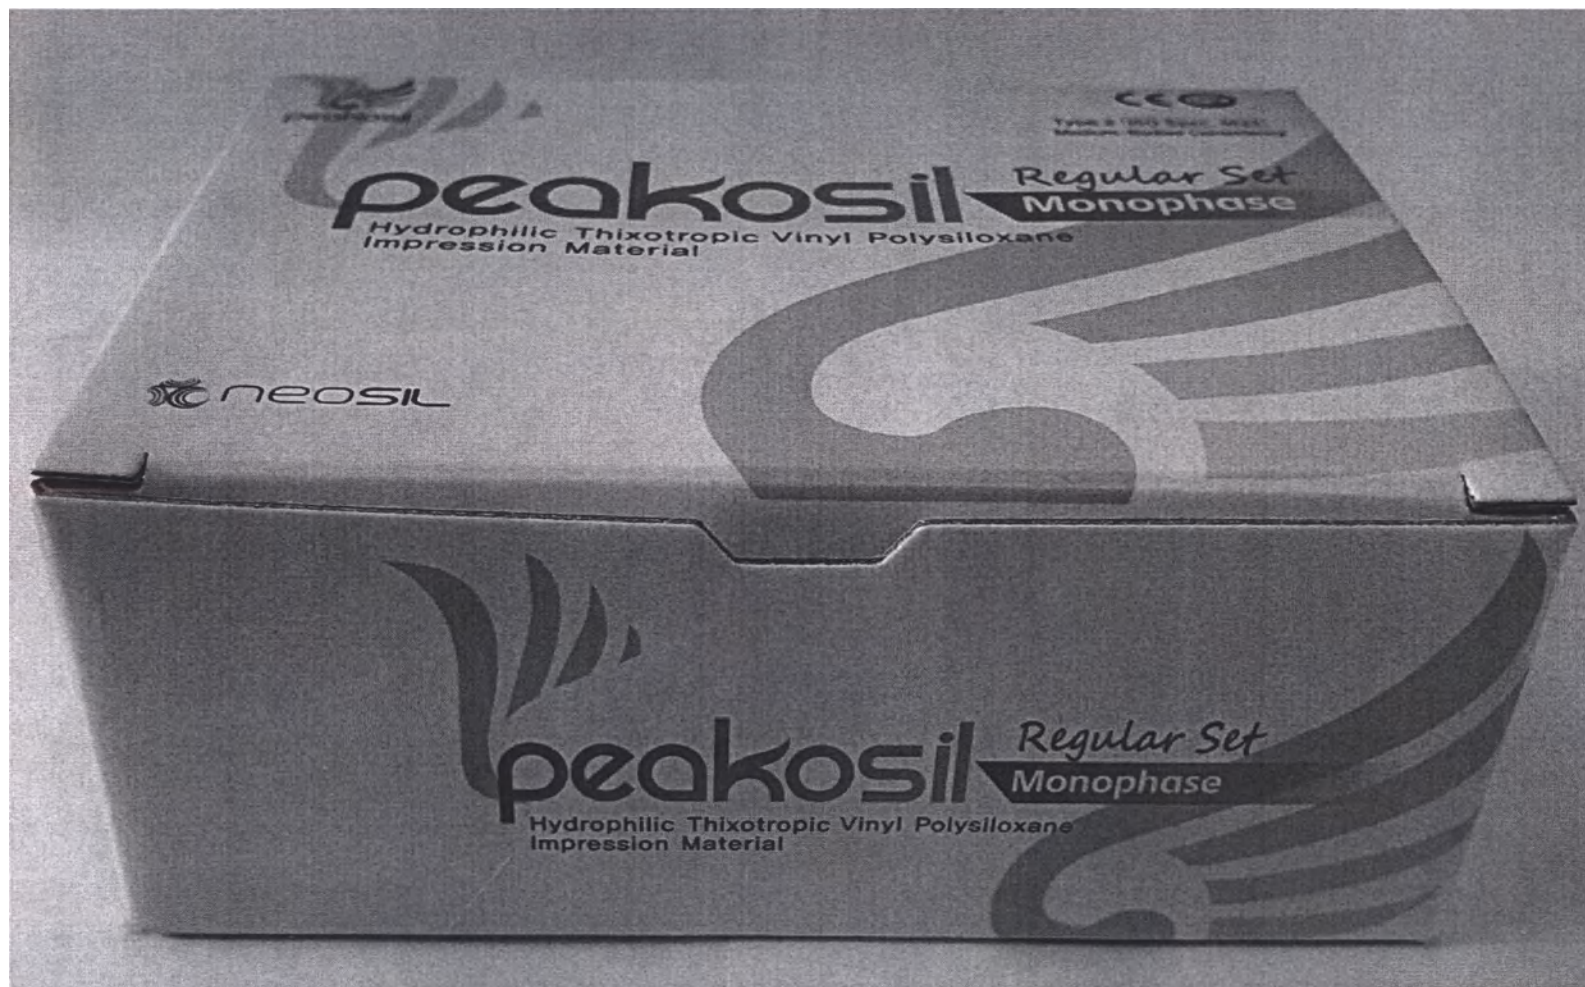


Фото 13. Групповая упаковка материала стоматологического оттискового силиконового PEAKOSIL Monophase Regular Set (NS024C).



Фото 14. Групповая упаковка материала стоматологического оттискового силиконового PEAKOSIL Bite Regular Set (NS011C).

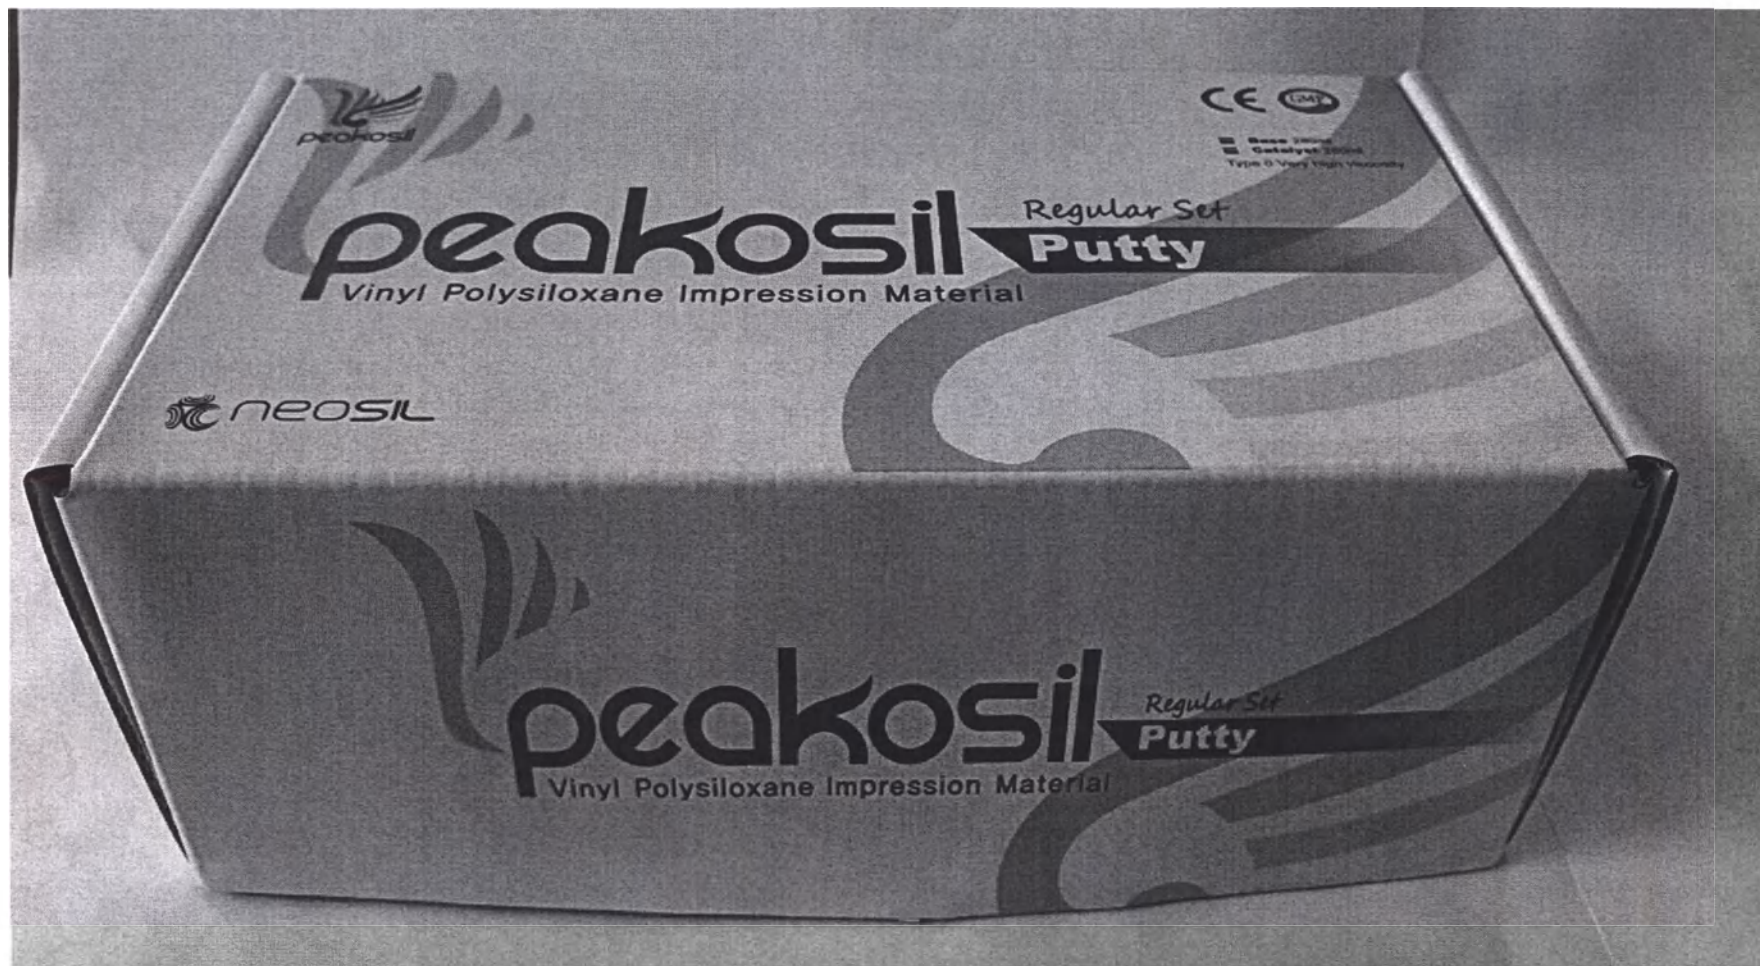
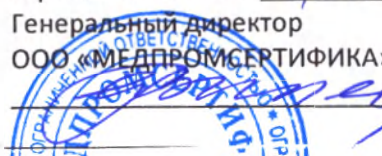


Фото 15. Групповая упаковка материала стоматологического оттискового силиконового PEAKOSIL Putty Regular Set (NS005P).

В документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16/шестнадцати лист-(а)(ов)

Генеральный директор

ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»

 /А.В. Виленский/



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»



МАРКИРОВКА НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Материал стоматологический оттисковый силиконовый PEAKOSIL в вариантах исполнения



Производитель:

NEOSIL CO., LTD. («НЕОСИЛ КО. ЛТД.»)

54, Soto-ro, Sangbuk-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea (Республика Корея)

Тел: + 82 55-375-5144

Факс: + 82 55-374-5140

E-mail: neosilkorea@gmail.com

1. Макеты маркировок индивидуальных упаковок изделия

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Heavy Body Regular Set (NS017C):



Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Heavy Body Fast Set (NS017CF):



Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Light Body Regular Set (NS033C):

* Данный продукт является медицинским изделием

 **peakosil** *REGULAR SET*
Light Body

Материал стоматологический оттисковой силиконовый 50 мл

Выдавить небольшое количество содержимого перед применением

 Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

 Температурный диапазон 18°C - 25°C

 Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

 Не допускать воздействия солнечного света

REF

LOT

РУ № _____

 Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 **neosil** НЕОСИЛ КО., ЛТД
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си,
Кёнсаннам-до, Республика Корея

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Light Body Fast Set (NS033CF):

* Данный продукт является медицинским изделием

 **peakosil** *Fast Set*
Light Body

Материал стоматологический оттисковой силиконовый 50 мл

Выдавить небольшое количество содержимого перед применением

 Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

 Температурный диапазон 18°C - 25°C

 Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

 Не допускать воздействия солнечного света

REF

LOT

РУ № _____

 Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 **neosil** НЕОСИЛ КО., ЛТД
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си,
Кёнсаннам-до, Республика Корея

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Monophase Regular Set (NS024C):

* Данный продукт является медицинским изделием



peakosil

REGULAR SET Monophase

Материал стоматологический оттисковой силиконовый 50 мл

Выдавить небольшое количество содержимого перед применением



Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению



Температурный диапазон
18°C - 25°C



Обратитесь к инструкции по применению



Не использовать при повреждении упаковки



Не допускать воздействия солнечного света



REF



LOT



РУ № _____



Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2



ИЗГОТОВИТЕЛЬ
НЕОСИЛ КО., ЛТД
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си,
Кёнсаннам-до, Республика Корея

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Bite Regular Set (NS011C)

* Данный продукт является медицинским изделием



peakosil

REGULAR SET Bite

Материал стоматологический оттисковой силиконовый 50 мл

Выдавить небольшое количество содержимого перед применением



Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению



Температурный диапазон
18°C - 25°C



Обратитесь к инструкции по применению



Не использовать при повреждении упаковки



Не допускать воздействия солнечного света



REF



LOT



РУ № _____



Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2



ИЗГОТОВИТЕЛЬ
НЕОСИЛ КО., ЛТД
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си,
Кёнсаннам-до, Республика Корея

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Putty Regular Set (NS005P):

* Данный продукт является медицинским изделием

ISO 4823 Тип 0

 **peakosil** *REGULAR SET*
Putty

Материал стоматологический оттисковой силиконовый

280 мл

Внимание Температурный диапазон 18°C - 25°C Обратитесь к инструкции по применению Не использовать, если упаковка повреждена Беречь от солнечных лучей

REF LOT

ПУ № _____

CE Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **НЕОСИЛ КО., ЛТД**
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си,
Кёнсаннам-до, Республика Корея

компонент **BASE** базовый

* Данный продукт является медицинским изделием

ISO 4823 Тип 0

 **peakosil** *REGULAR SET*
Putty

Материал стоматологический оттисковой силиконовый

280 мл

Внимание Температурный диапазон 18°C - 25°C Обратитесь к инструкции по применению Не использовать, если упаковка повреждена Беречь от солнечных лучей

REF LOT

ПУ № _____

CE Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **НЕОСИЛ КО., ЛТД**
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си,
Кёнсаннам-до, Республика Корея

компонент **CATALYST** каталитический

2. Макеты этикеток для РФ на индивидуальных упаковках изделий

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Heavy Body Regular Set (NS017C):

* Данный продукт является медицинским изделием



peakosil

REGULAR SET Heavy Body

Материал стоматологический оттисковой силиконовый 50 мл

Выдавить небольшое количество содержимого перед применением

 Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
 Температурный диапазон 18°C - 25°C
 Обратитесь к инструкции по применению
 Не использовать при повреждении упаковки
 Не допускать воздействия солнечного света

REF
LOT


РУ № _____



Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 **neosil**

НЕОСИЛ КО., ЛТД
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си,
Кёнсаннам-до, Республика Корея

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Heavy Body Fast Set (NS017CF):

* Данный продукт является медицинским изделием



peakosil

Fast Set Heavy Body

Материал стоматологический оттисковой силиконовый 50 мл

Выдавить небольшое количество содержимого перед применением

 Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
 Температурный диапазон 18°C - 25°C
 Обратитесь к инструкции по применению
 Не использовать при повреждении упаковки
 Не допускать воздействия солнечного света

REF
LOT


РУ № _____



Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 **neosil**

НЕОСИЛ КО., ЛТД
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си,
Кёнсаннам-до, Республика Корея

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Light Body Regular Set (NS033C):

* Данный продукт является медицинским изделием

 **peakosil** *REGULAR SET*
Light Body

Материал стоматологический оттисковой силиконовый 50 мл

Выдавить небольшое количество содержимого перед применением

 Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

 Температурный диапазон 18°C - 25°C

 Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

 Не допускать воздействия солнечного света

REF

LOT



РУ № _____

 Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 **neosil** **НЕОСИЛ КО., ЛТД**
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си,
Кёнсаннам-до, Республика Корея

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Light Body Fast Set (NS033CF):

* Данный продукт является медицинским изделием

 **peakosil** *Fast Set*
Light Body

Материал стоматологический оттисковой силиконовый 50 мл

Выдавить небольшое количество содержимого перед применением

 Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

 Температурный диапазон 18°C - 25°C

 Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

 Не допускать воздействия солнечного света

REF

LOT



РУ № _____

 Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 **neosil** **НЕОСИЛ КО., ЛТД**
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си,
Кёнсаннам-до, Республика Корея

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Monophase Regular Set (NS024C):

* Данный продукт является медицинским изделием

 **peakosil** **REGULAR SET Monophase** 50 мл

Материал стоматологический оттисковой силиконовый

Выдавить небольшое количество содержимого перед применением

 Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

 Температурный диапазон 18°C - 25°C

 Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

 Не допускать воздействия солнечного света

REF

LOT

РУ № _____

 Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 **neosil** **НЕОСИЛ КО., ЛТД**
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си, Кёнсаннам-до, Республика Корея

Материал стоматологический оттисковой силиконовый PEAKOSIL Bite Regular Set (NS011C)

* Данный продукт является медицинским изделием

 **peakosil** **REGULAR SET Bite** 50 мл

Материал стоматологический оттисковой силиконовый

Выдавить небольшое количество содержимого перед применением

 Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

 Температурный диапазон 18°C - 25°C

 Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

 Не допускать воздействия солнечного света

REF

LOT

РУ № _____

 Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 **neosil** **НЕОСИЛ КО., ЛТД**
54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си, Кёнсаннам-до, Республика Корея

* Данный продукт является медицинским изделием

peakosil *REGULAR SET* **Putty**

Материал стоматологический оттисковой силиконовый



Осторожно!
Обратитесь к
инструкции по
применению



Температурный
диапазон



Обратитесь к
инструкции по
применению



Не использовать
при повреждении
упаковки



Не допускать
воздействия
солнечного света

REF

LOT



компонент
базовый Base -
250 мл
компонент
катализаторный
Catalyst - 250 мл

РУ № _____



Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8,
строение 1, комната 57, пом. XIV, эт. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ




neosil


НЕОСИЛ КО., ЛТД


54, Сото-ро, Сангбук-мён, Янгсан-си,
Кёнсаннам-до, Республика Корея

3. Макеты маркировок вторичных (потребительских) упаковок


Материал стоматологический оттискной силиконовый PEAKOSIL Heavy Body Regular Set (NS017C)

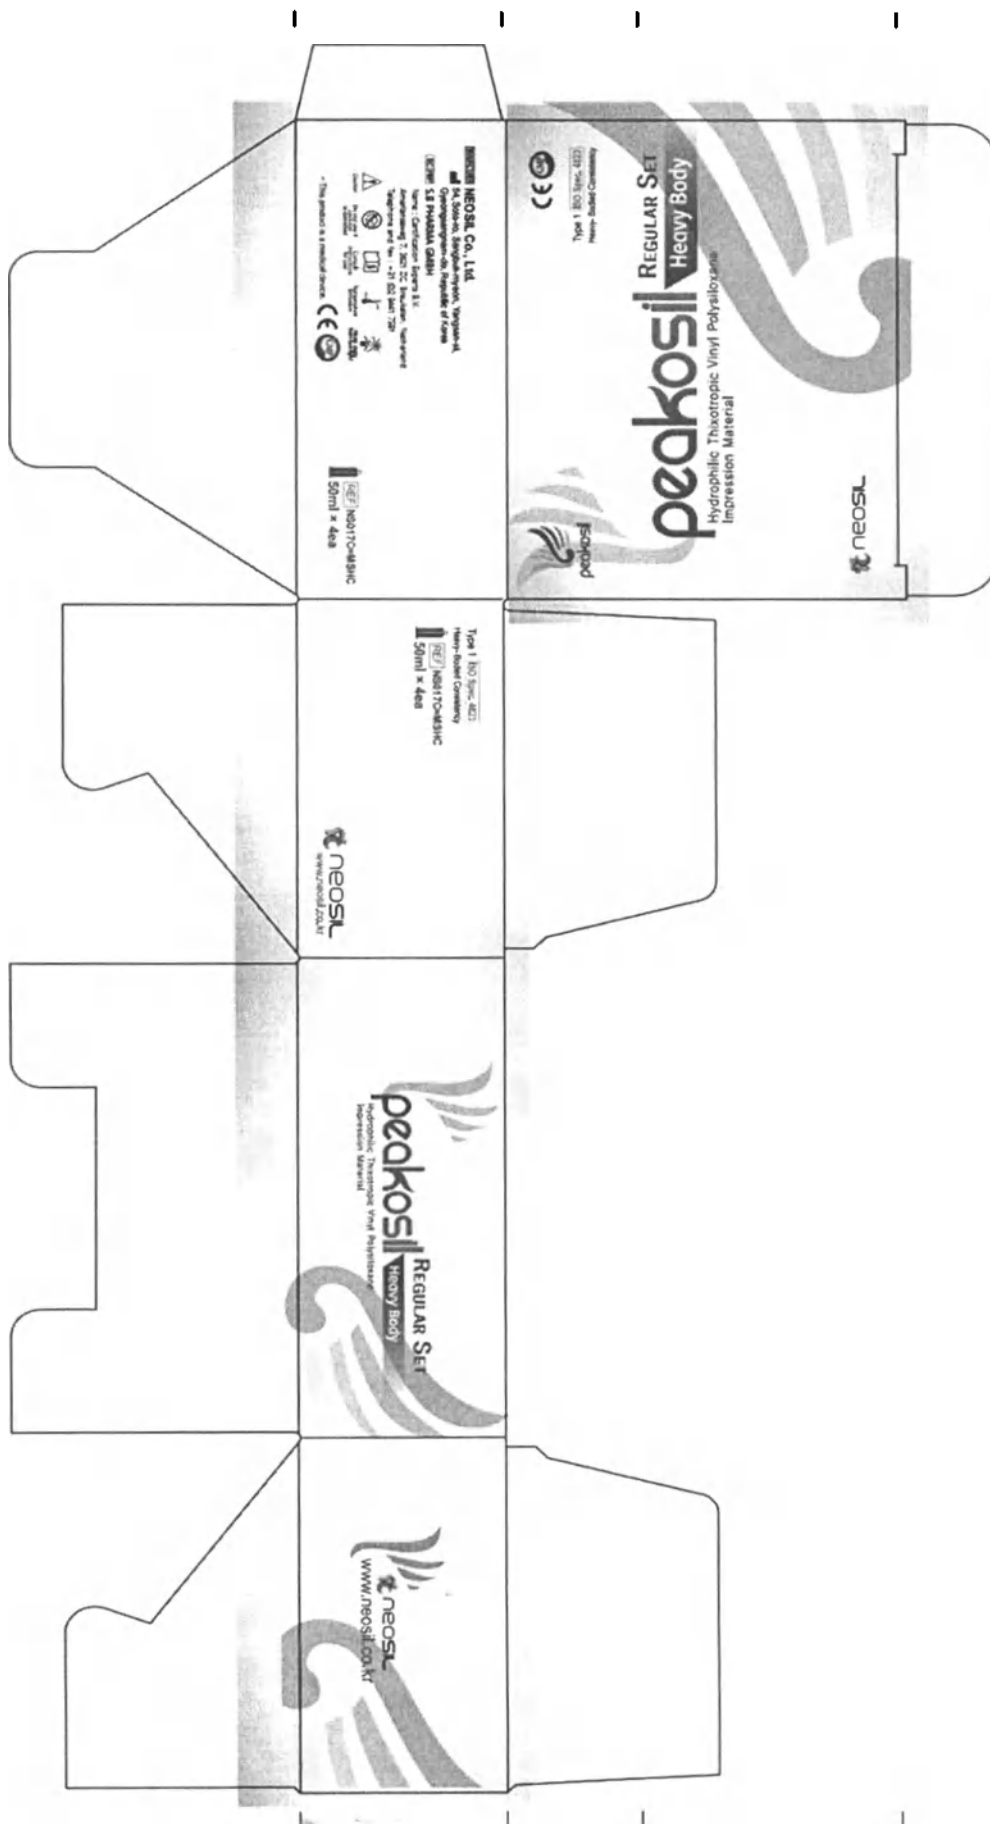

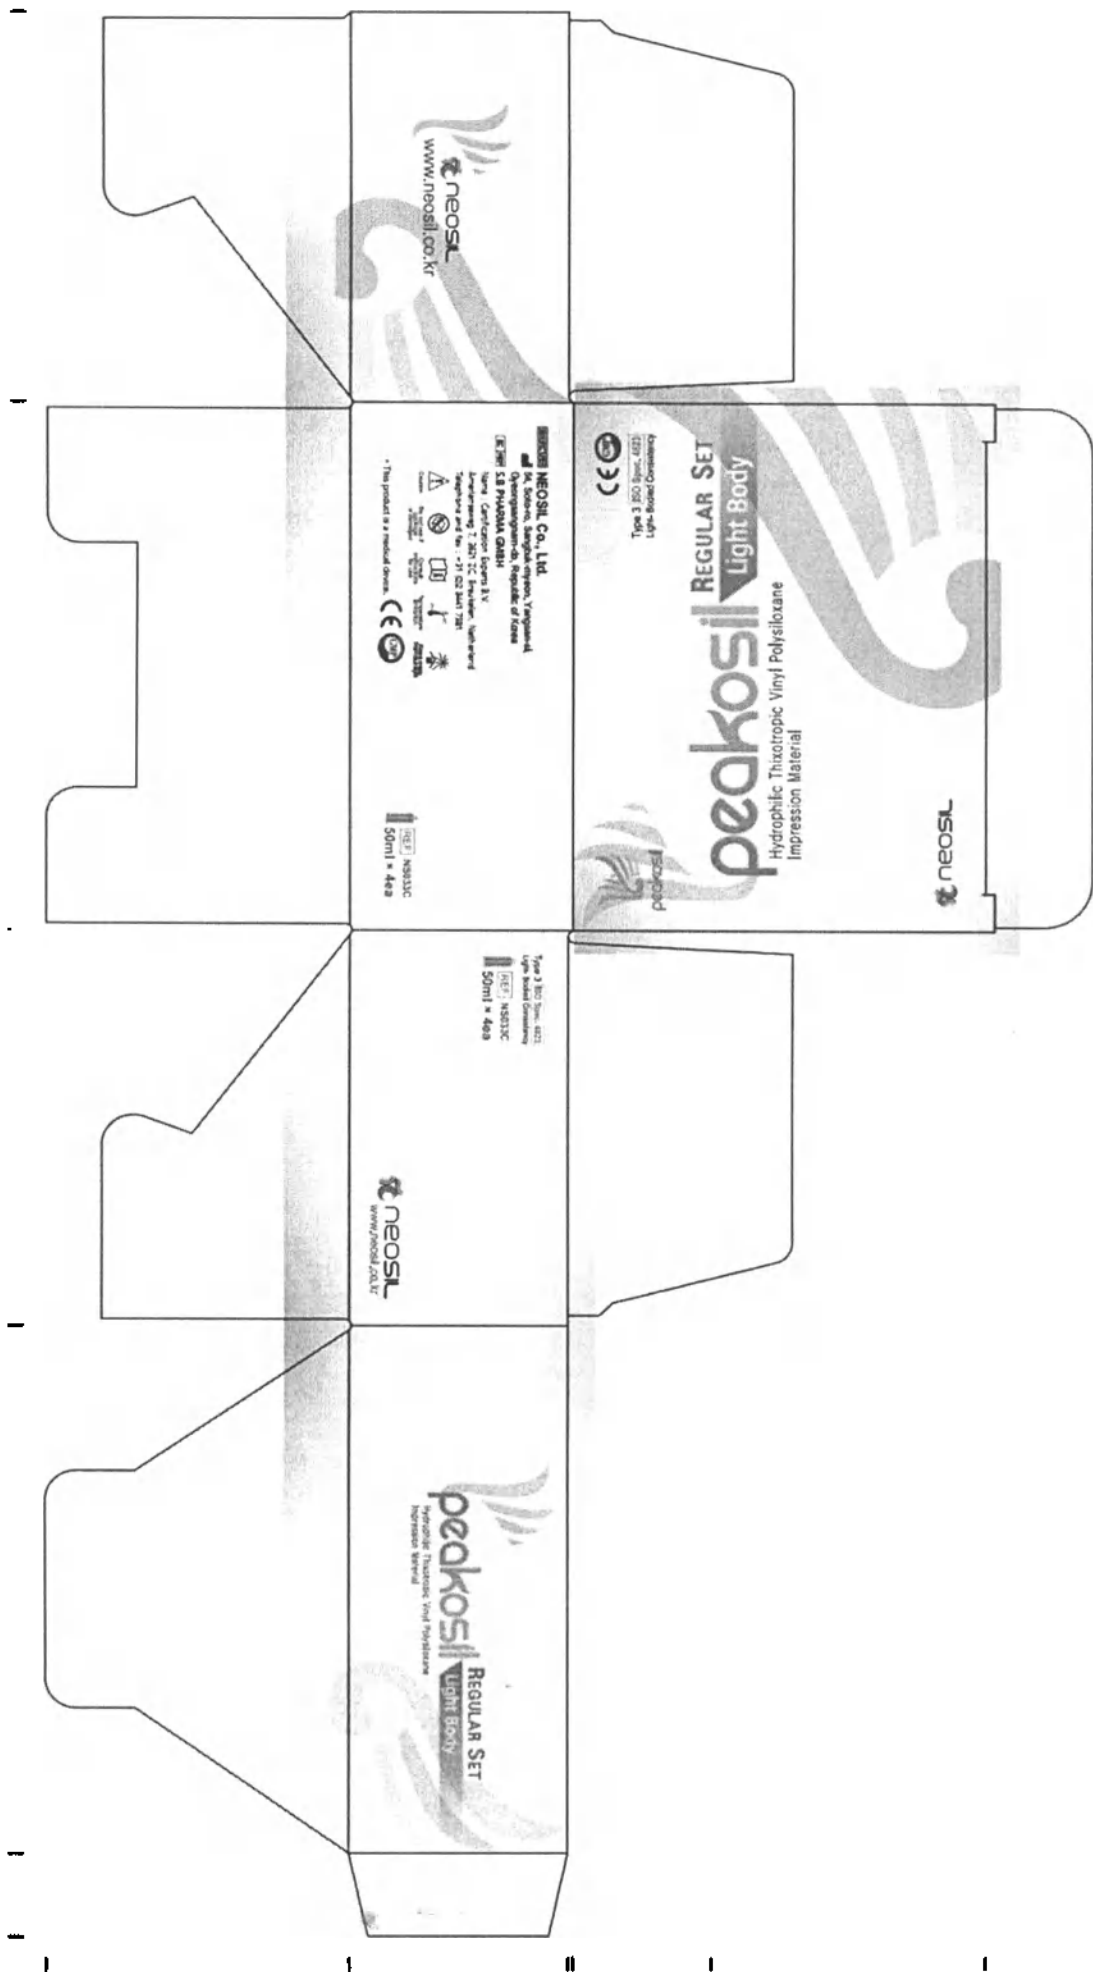

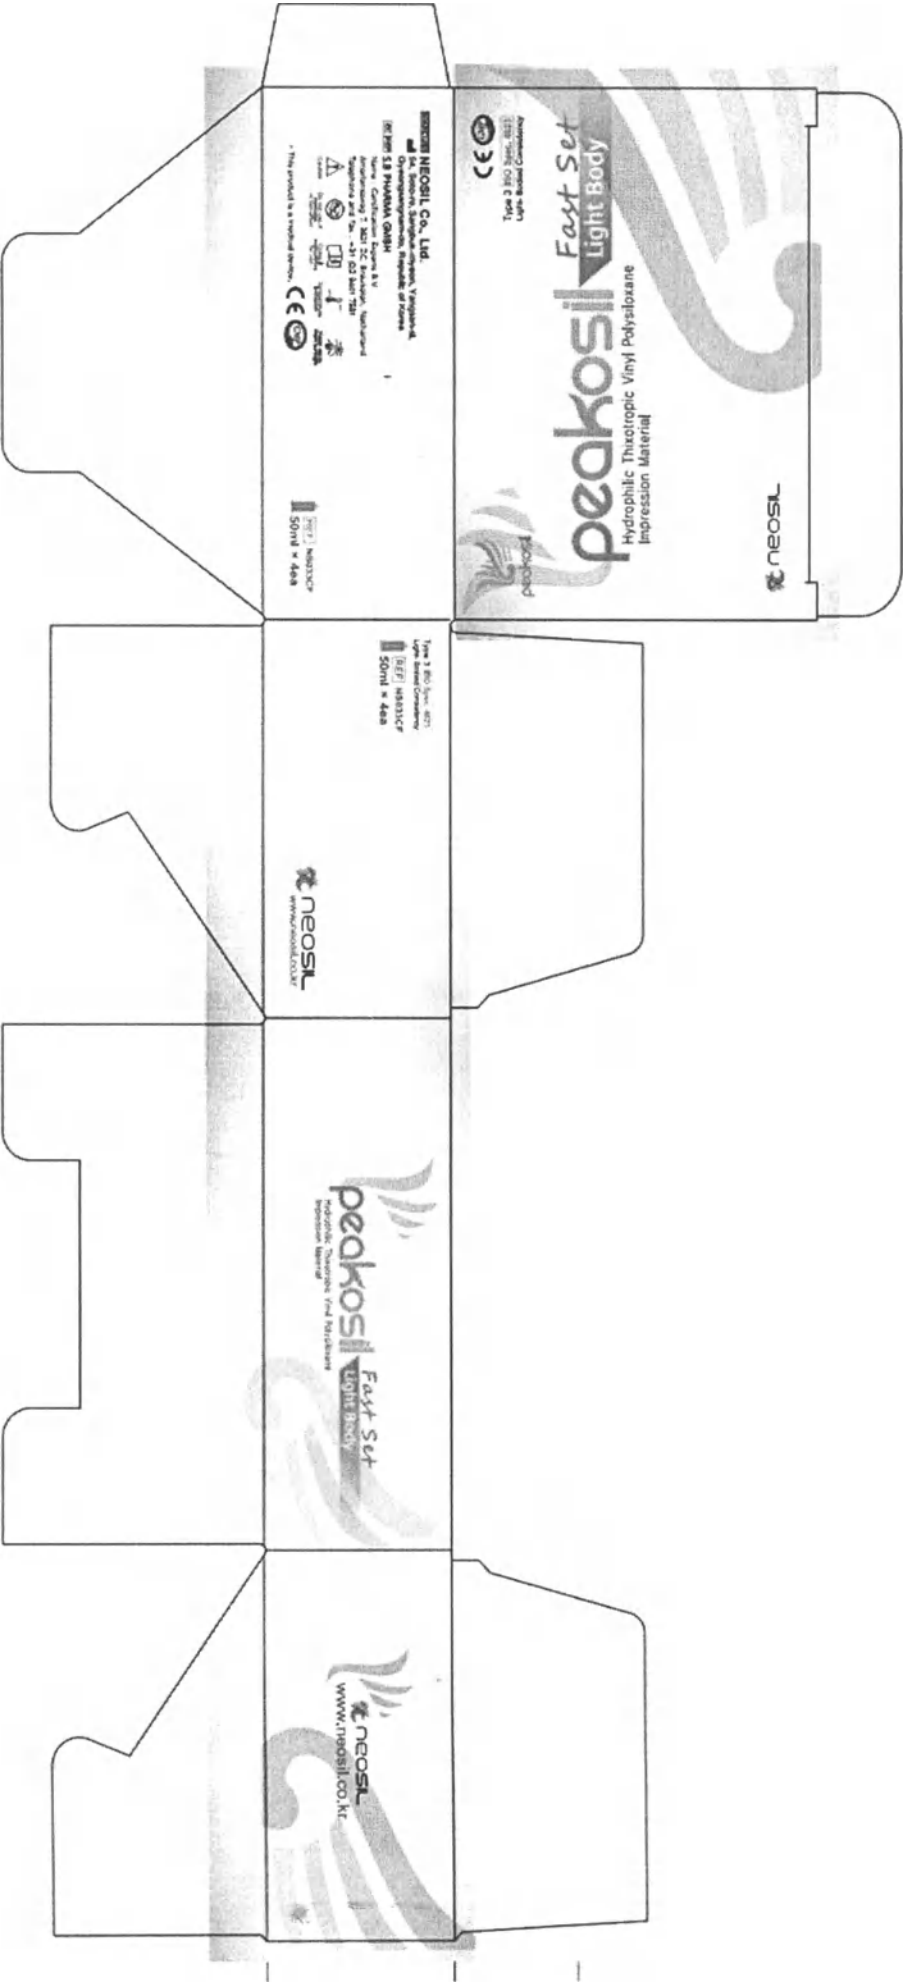



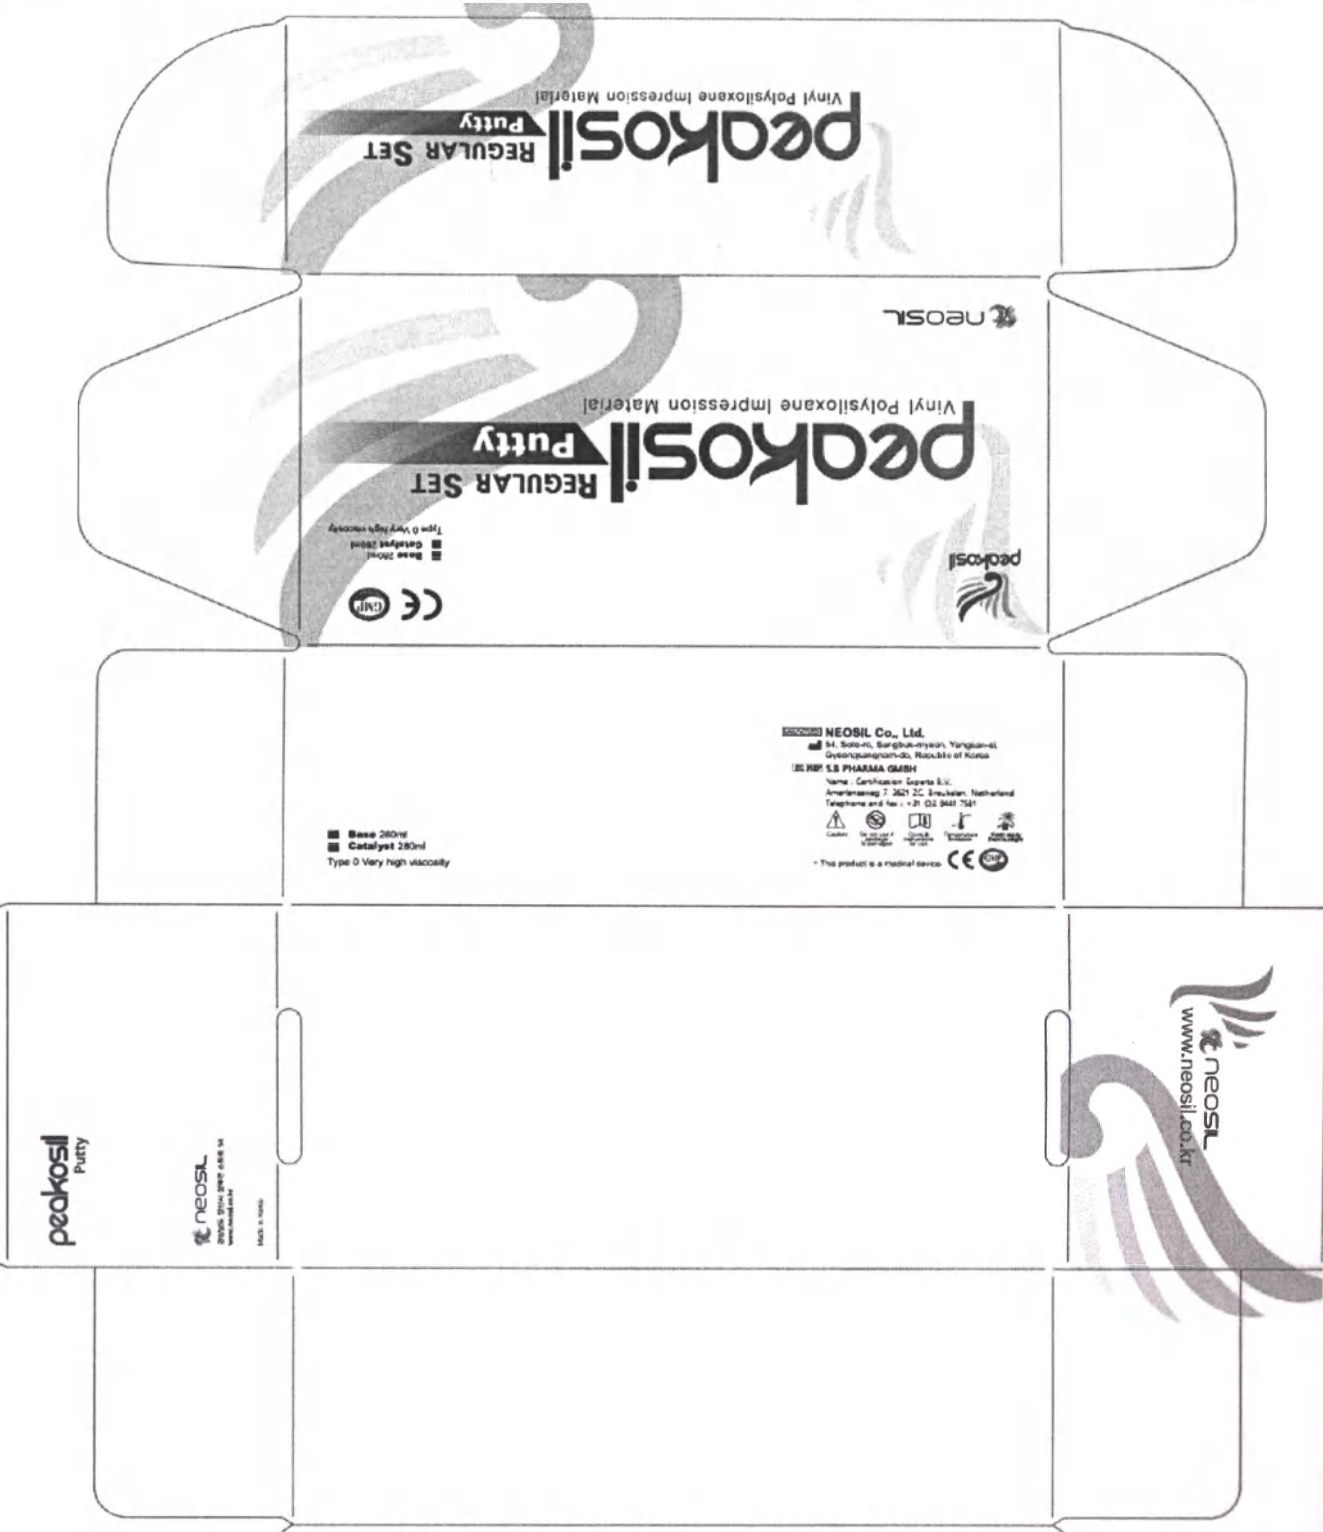

В документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16/исстара.мск лист-(а)(ов)
Генеральный директор
ООО «МЕДПРОМСЕРТИФИКА»



/А.В. Виленский/