

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»


Чэнь Син
по 25 ноября 2020 года



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ВИДЕОСИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СЕРИЙ HD3, ЕС3

производства компании
Нанджин Миндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. /
Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

2020

Головка видеокамеры HD3



Устройство для обработки видеоизображения ЕС3. Блок основной ЕС3 и головка видеокамеры ЕС3. Общий вид




Блок основной ЕС3




Головка видеокамеры ЕС3




Устройство для обработки видеонизображения HD3, ЕС3. Кабель DVI






**Устройство для обработки видеоизображения HD3, ЕС3.
Кабель S-VIDEO**

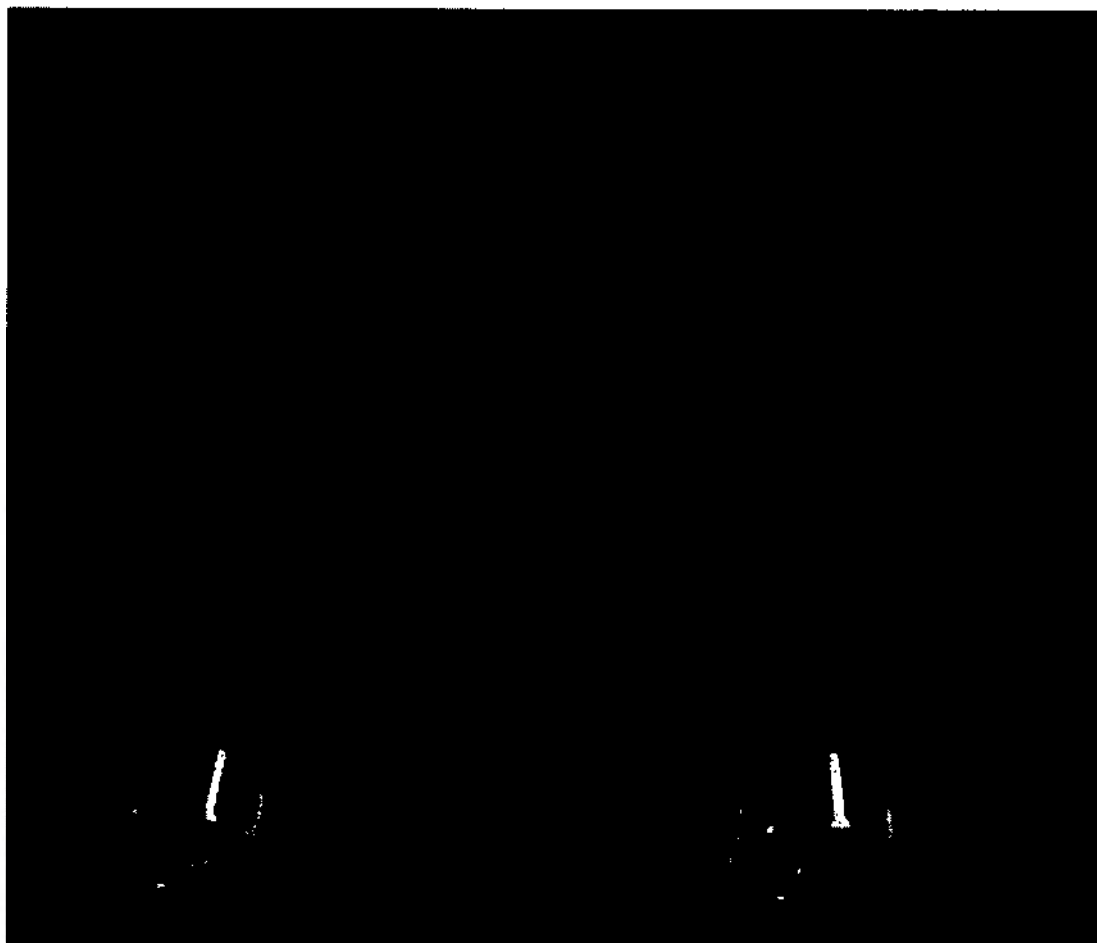


**Устройство для обработки видеоизображения HD3, ЕС3.
Кабель SDI**

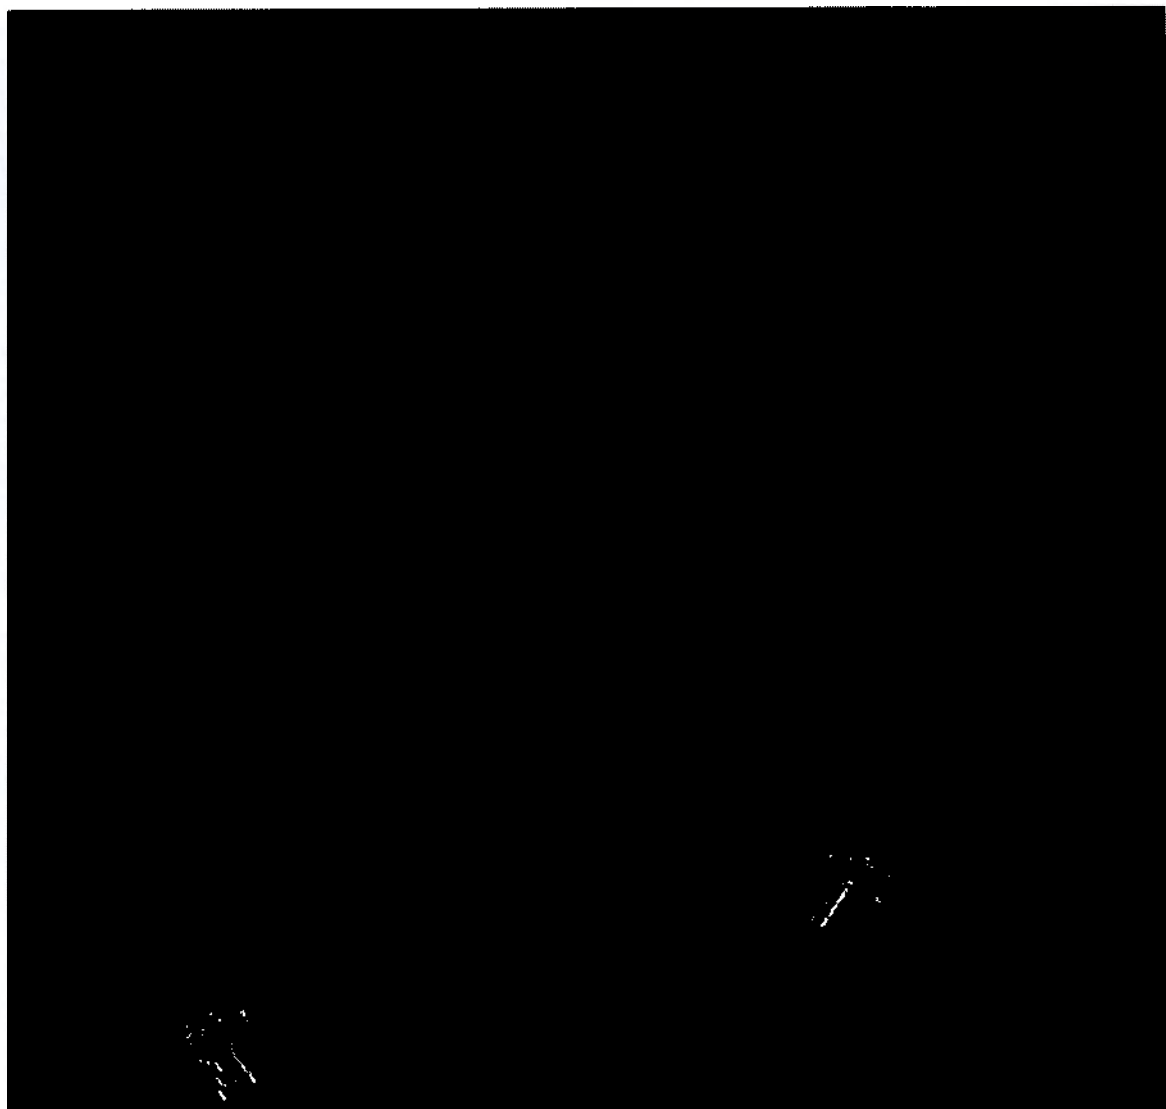

**Устройство для обработки видеоизображения HD3, EC3.
Кабель питания, кабель заземления, предохранители Time-Lag
250V 1.6A CER D5x20 (T1.6AH250V)**

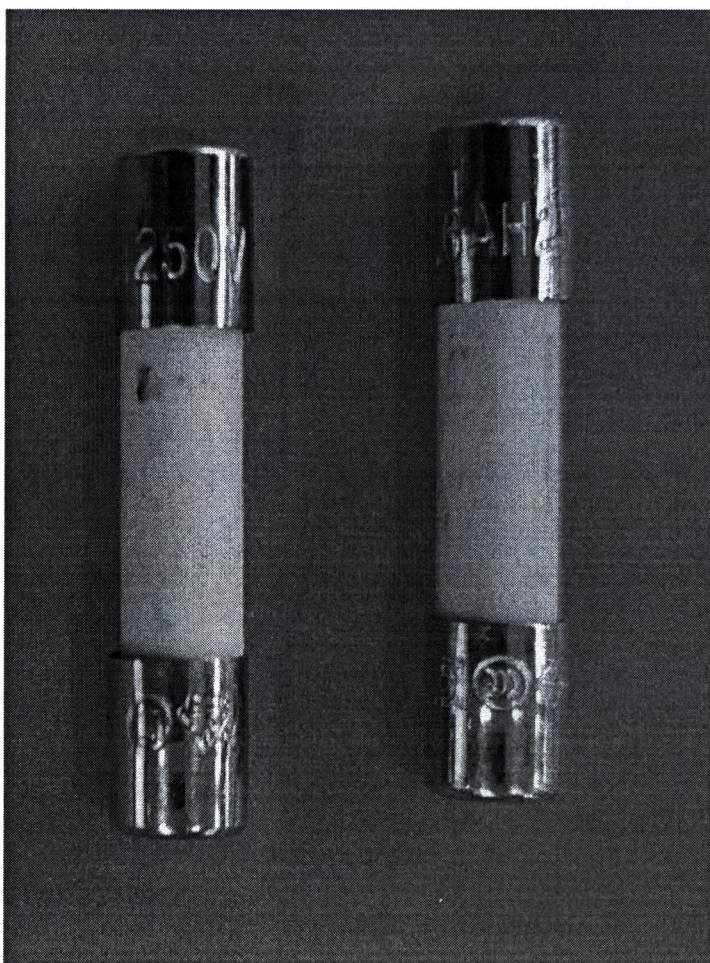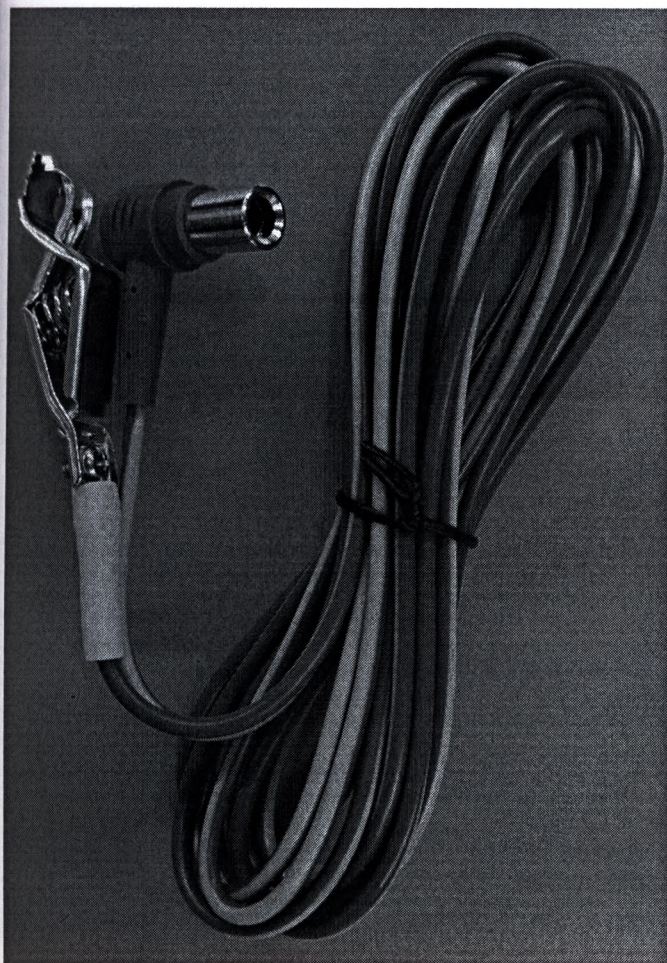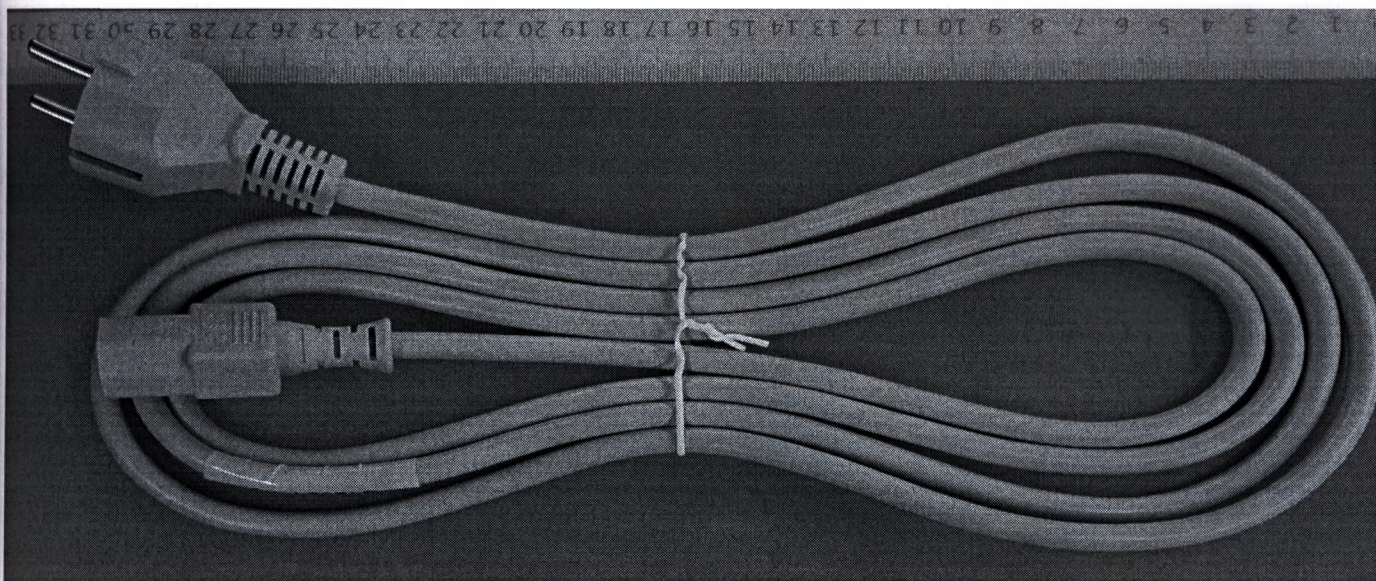


Устройство для обработки видеоизображения HD3, ЕС3.
Маркировочная этикетка на корпусе блока основного.

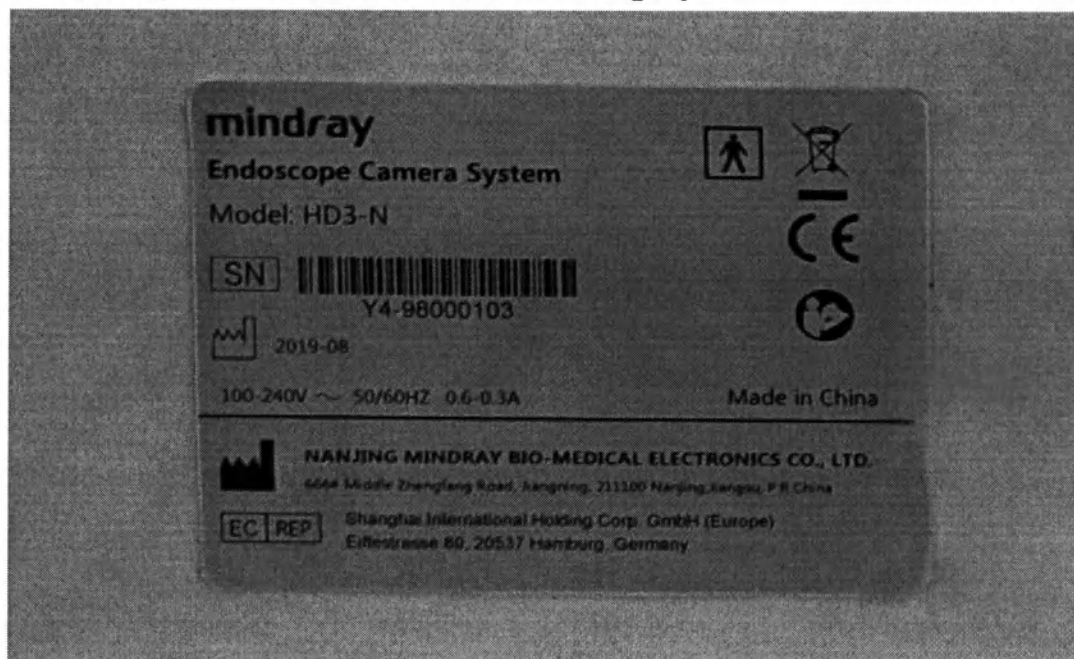


Устройство для обработки видеоизображения HD3, ЕС3.
Макет маркировочной этикетки на корпусе блока основного на
русском языке






Устройство для обработки видеозображения HD3, ЕС3
Потребительская упаковка. Общий вид

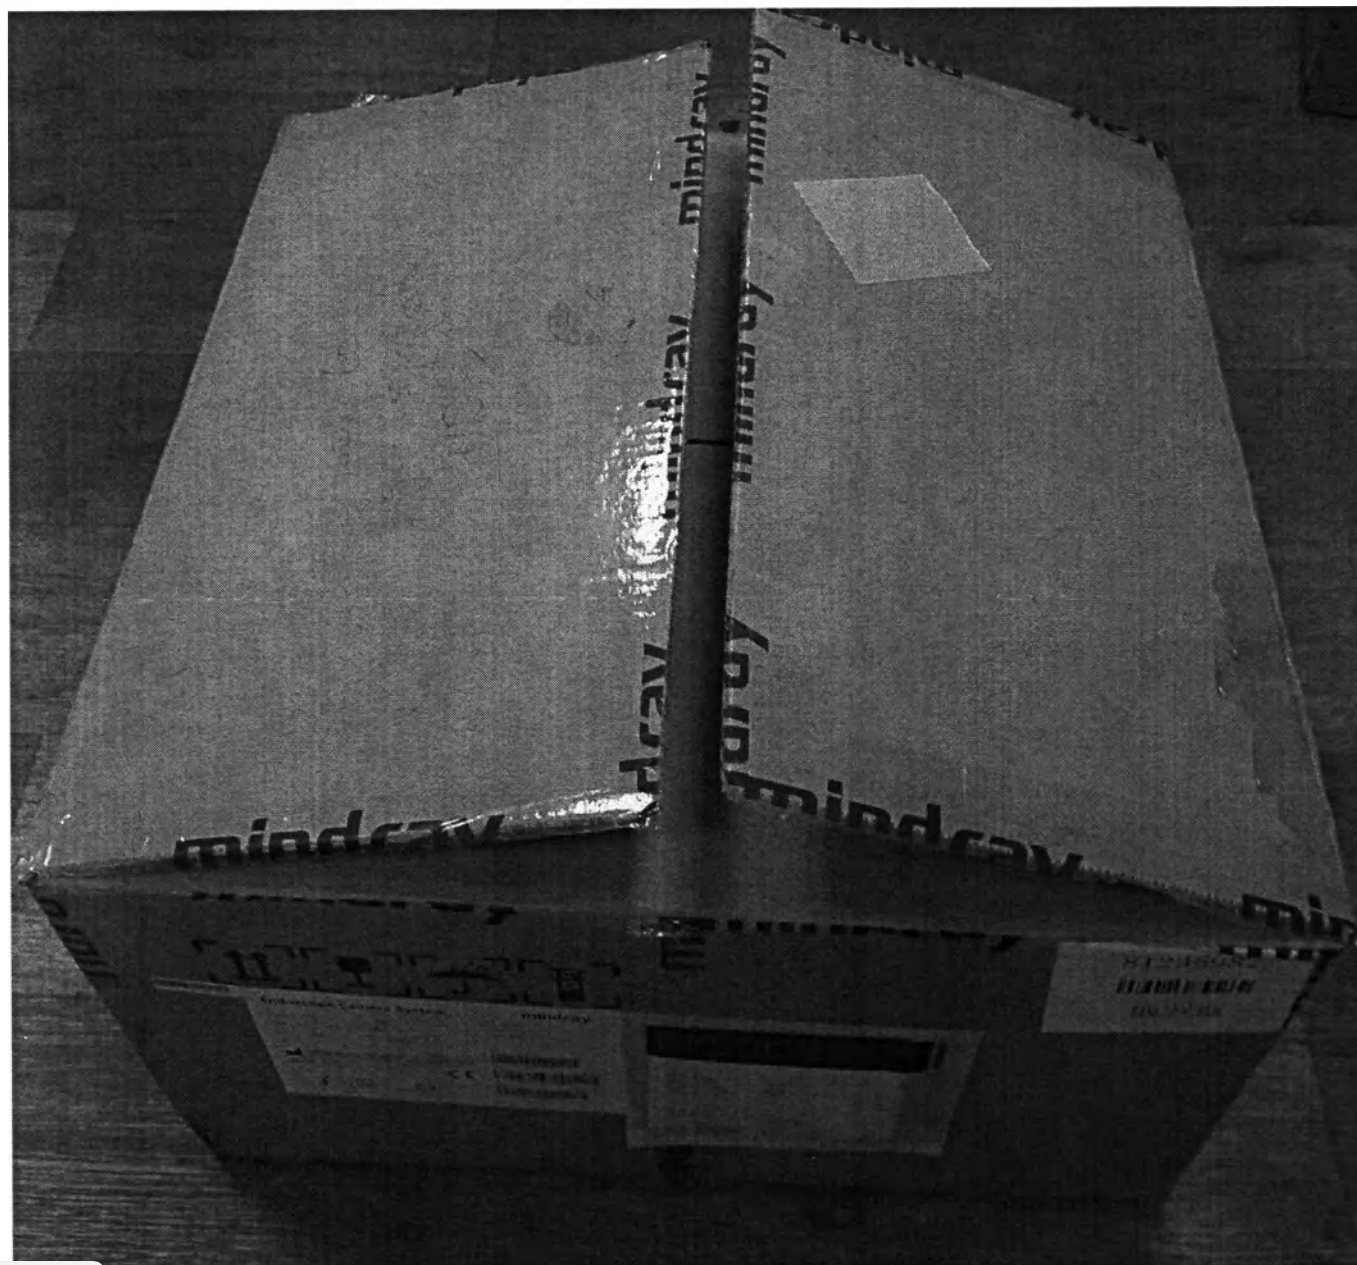


Устройство для обработки видеоизображения HD3, ЕС3. Потребительская упаковка. Вид внутри

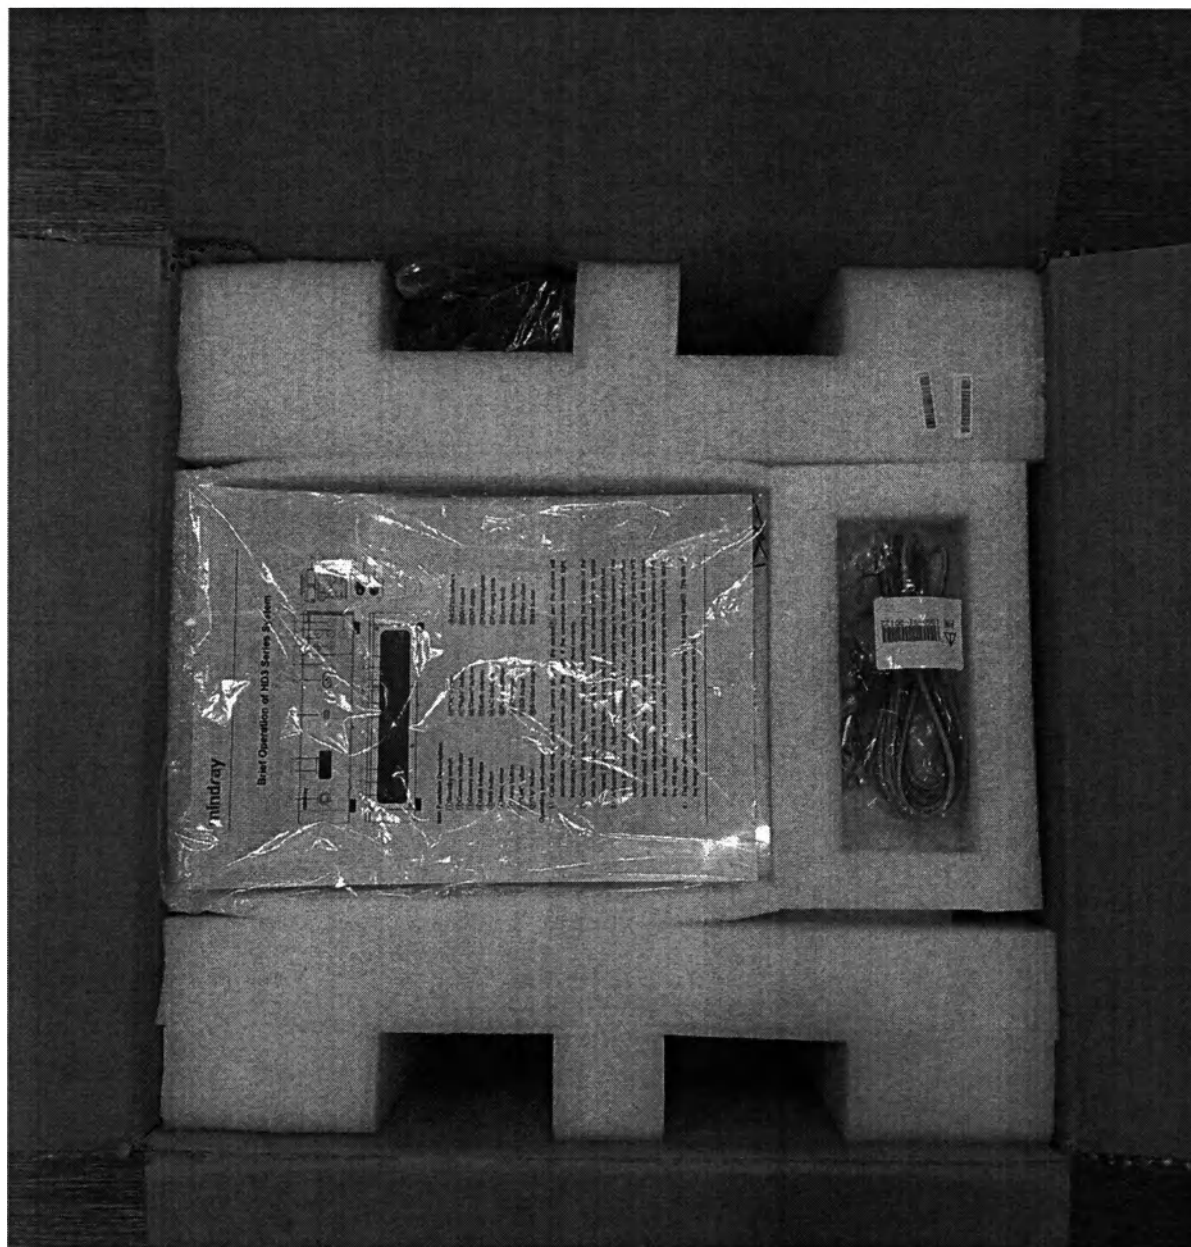


Устройство для обработки видеоизображения HD3, ЕС3.
Макет маркировочной этикетки потребительской упаковки
на русском языке

Устройство для обработки видеоизображения		mindray		
Модель	К-во: 1			
Габаритные размеры: ____ мм х ____ мм х ____ мм				
Масса нетто: ____ кг. Масса брутто: ____ кг.				
		Made in China		
	Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 666# Middle Zhengfang Road, Jiangning, 211111 Nanjing, Jiangsu, P.R. China			
<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany	
EC	REP			
				

Источник света эндоскопический HB200L. Вид спереди. Вид сзади

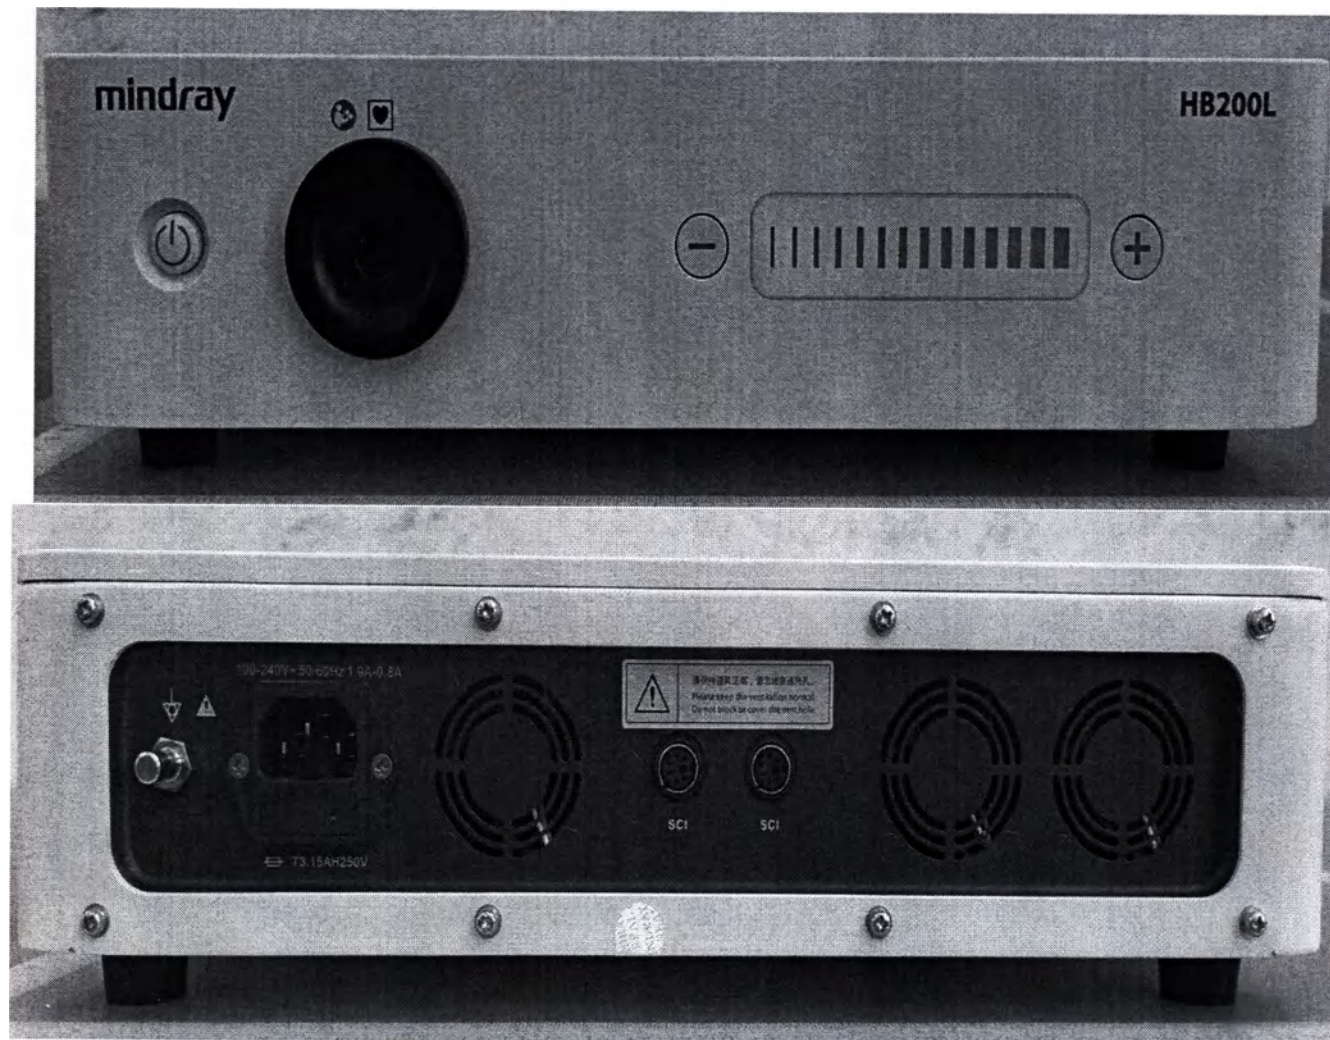


Источник света эндоскопический LS200L. Вид спереди. Вид сзади

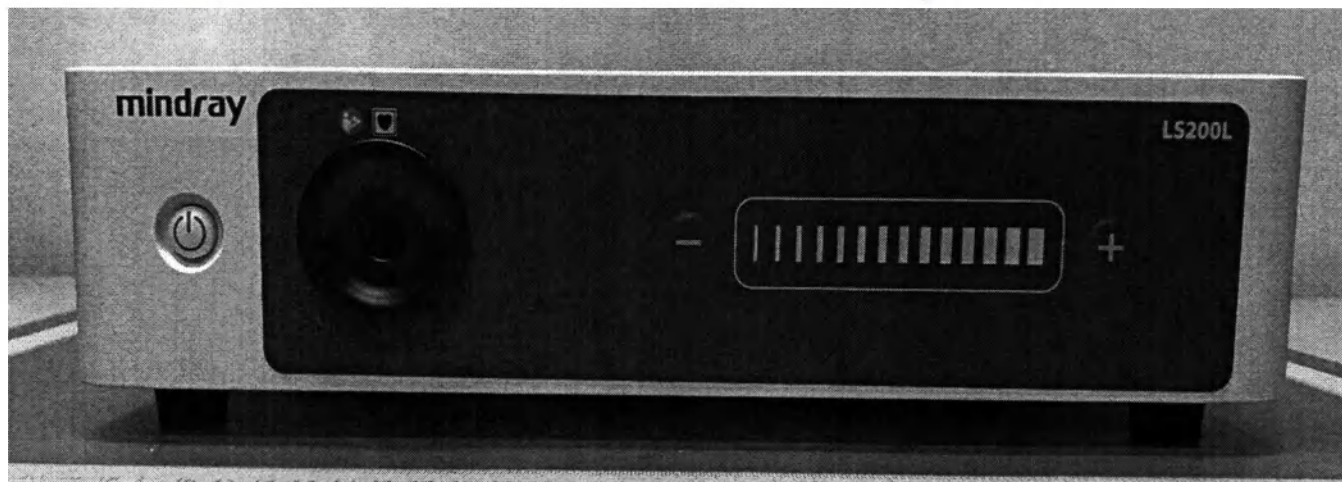

Источник света эндоскопический HB200L, LS200L
Кабель световодный эндоскопический $\varnothing$ 3,5X3000.




Источник света эндоскопический HB200L, LS200L
Кабель световодный эндоскопический ø 4,8X3000

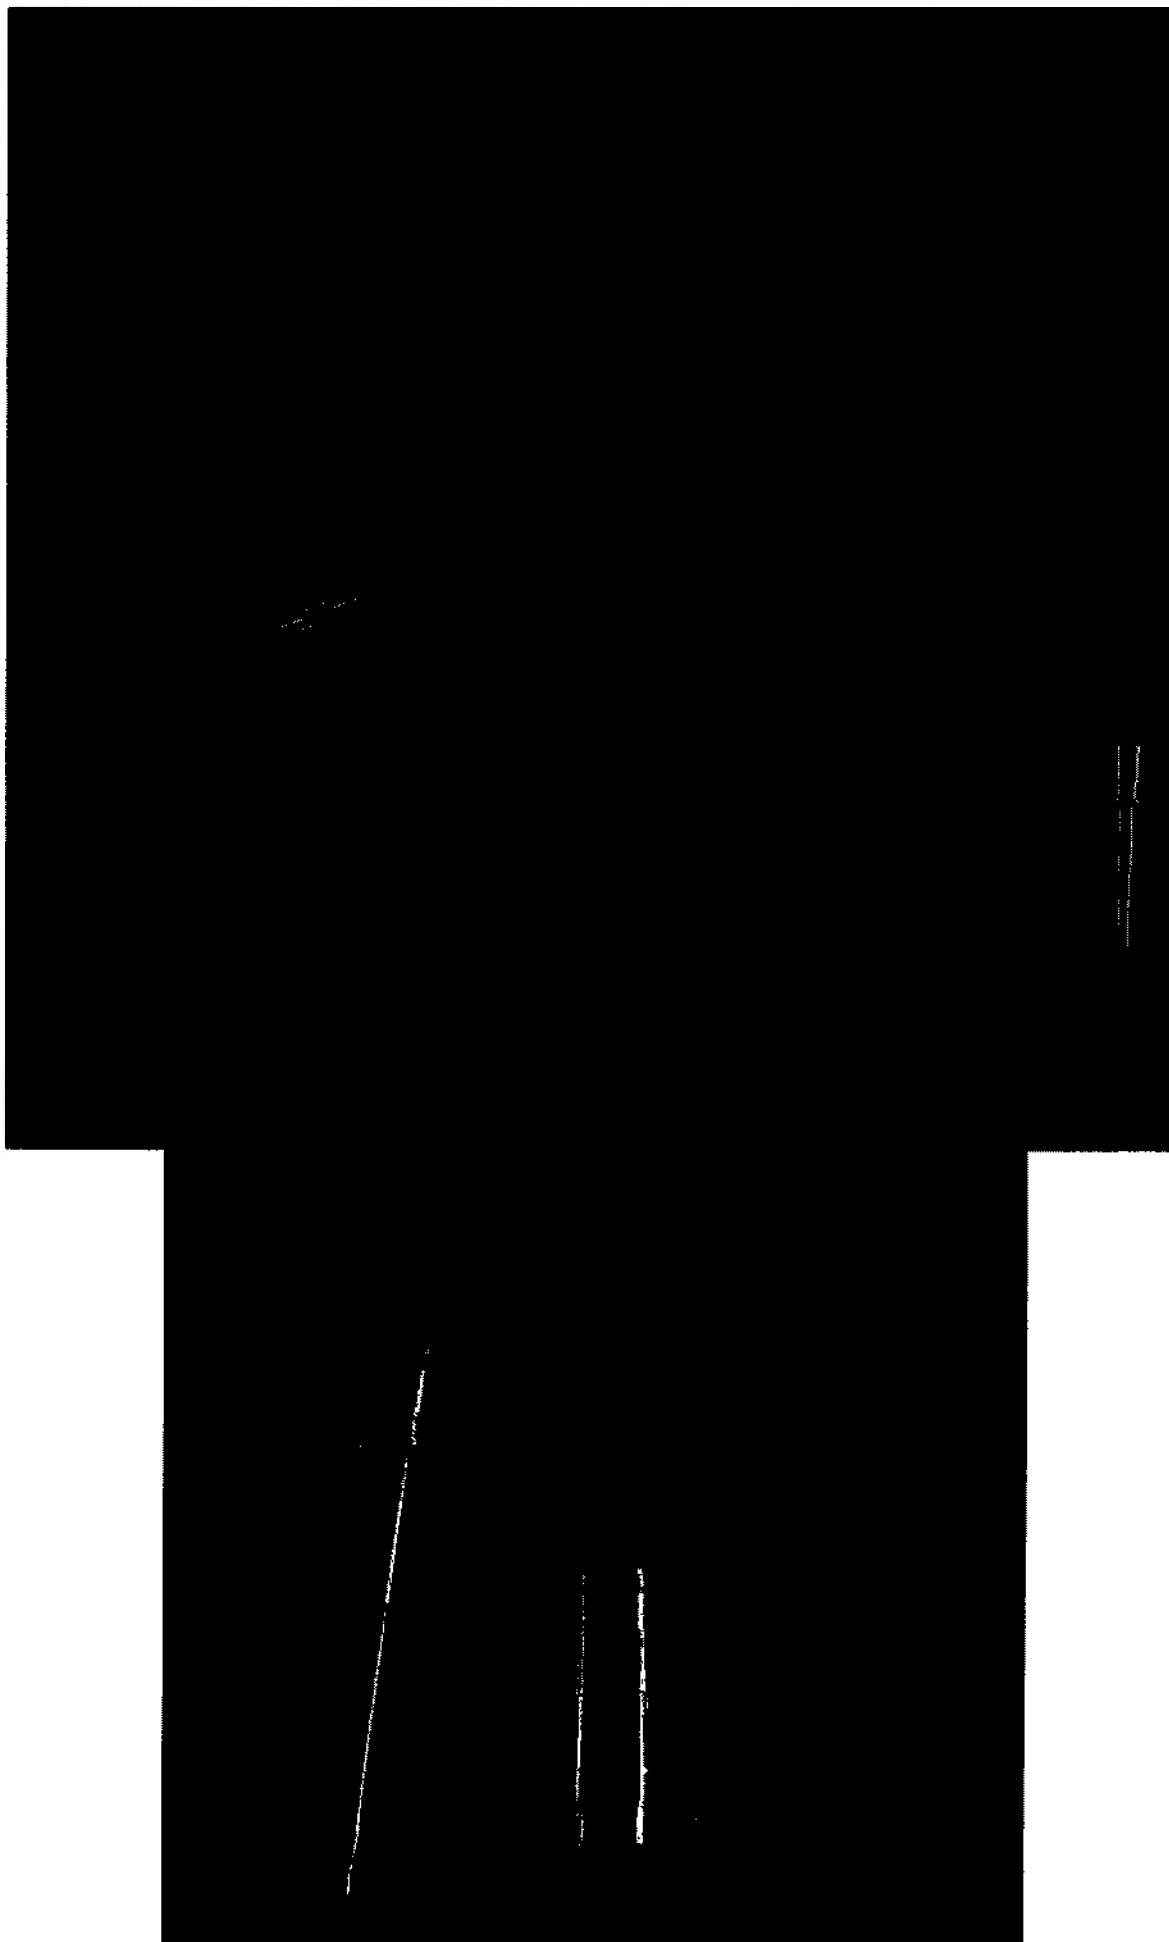


**Источник света эндоскопический HB200L, LS200L.
Адаптер/переходник для кабеля световодного (для OLIMPUS)**



**Источник света эндоскопический HB200L, LS200L.
Кабель питания**

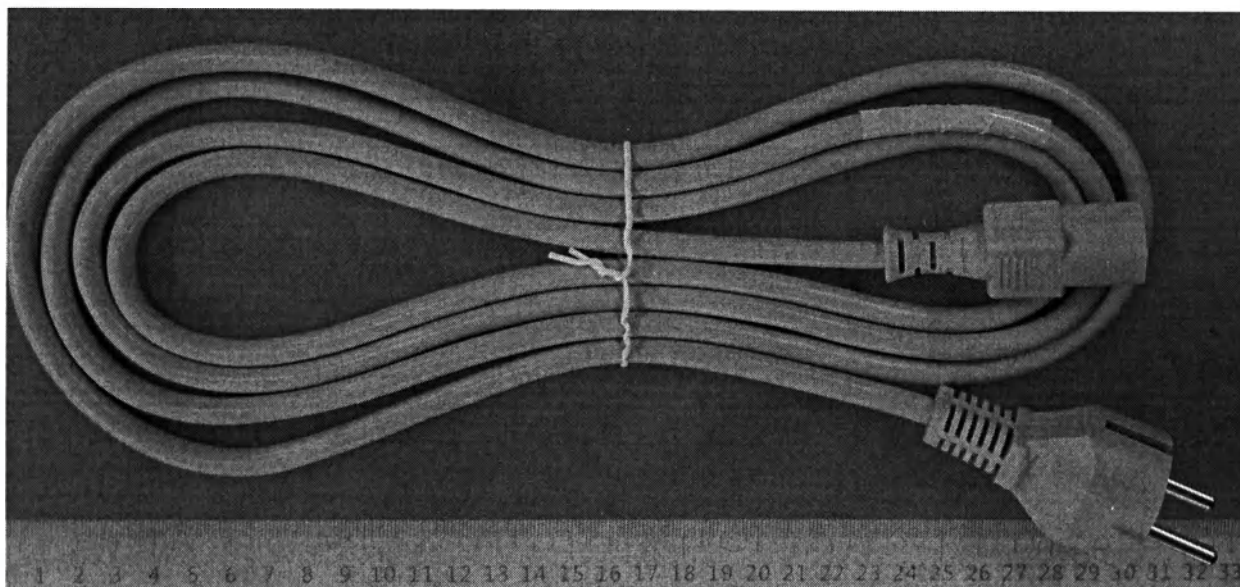


**Источник света эндоскопический HB200L, LS200L.
Кабель заземления**

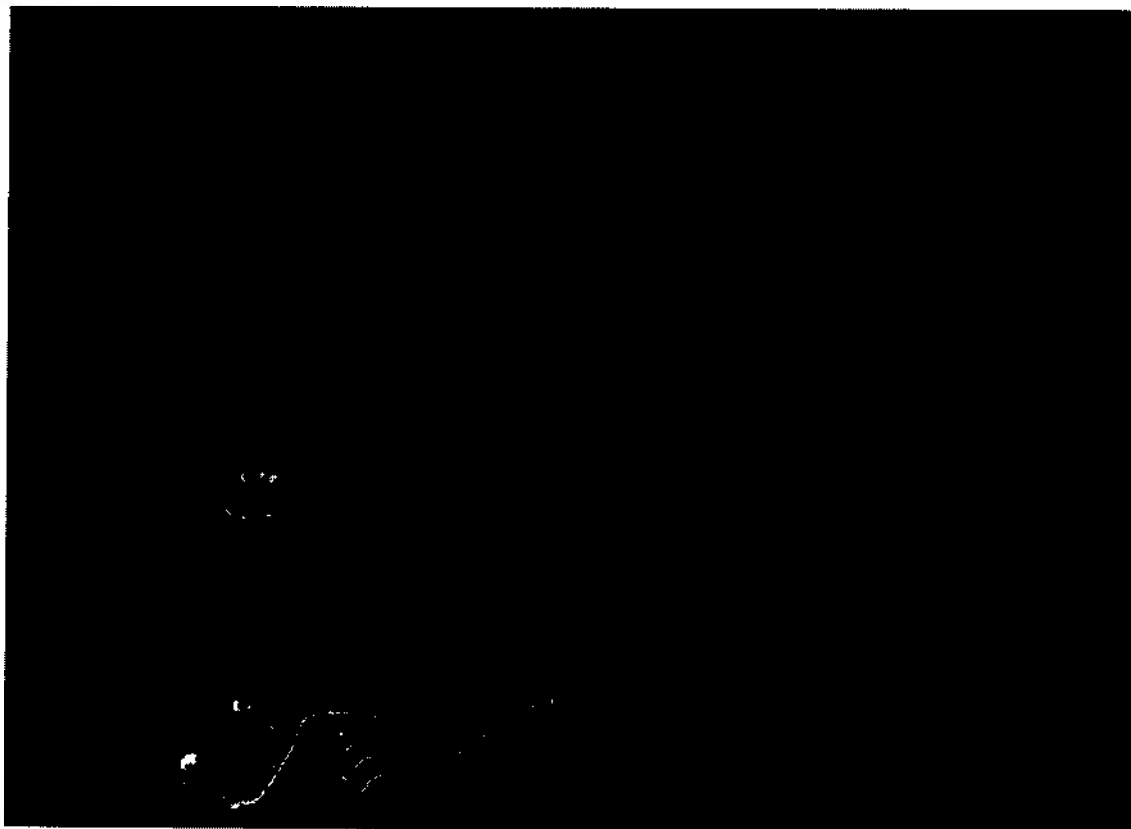


**Источник света эндоскопический HB200L, LS200L.
Кабель интерфейса последовательного управления**



**Источник света эндоскопический HB200L, LS200L.
Предохранители Time-lag 250V 3.15AD5X20 (T3.15AH250V)**

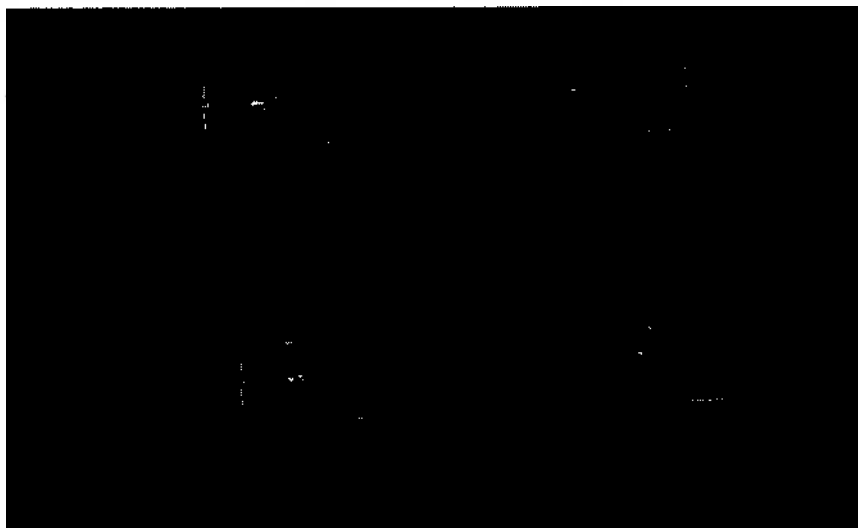


**Источник света эндоскопический HB200L, LS200L. Маркировочная
этикетка на корпусе блока основного.**

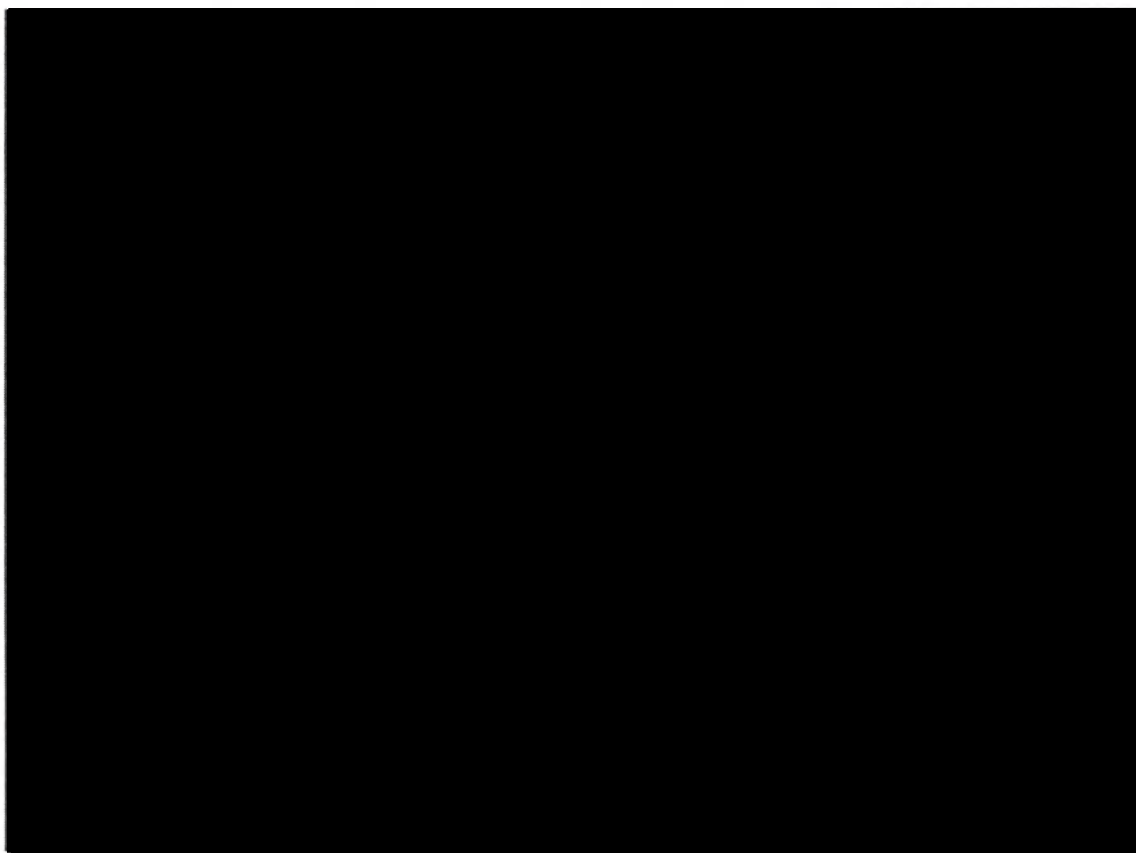

Источник света эндоскопический HB200L, LS200L. Макет
маркировочной этикетки на корпусе блока основного на русском
языке

mindray		
Источник света эндоскопический		
Модель		
SN		
		
100-240В ~ 50/60 Гц 1,9 – 0,8 А		MADE IN CHINA
	Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.) 666# Middle Zhengfang Road, Jiangning, 211111 Nanjing, Jiangsu, P.R. China	
EC REP	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany	



Источник света эндоскопический HB200L, LS200L. Потребительская упаковка. Общий вид





Источник света эндоскопический HB200L, LS200L. Потребительская упаковка. Вид внутри




**Источник света эндоскопический HB200L, LS200L. Макет
маркировочной этикетки на потребительской упаковке на русском
языке**

Источник света эндоскопический		mindray		
Модель	К-во: 1			
Габаритные размеры: ____ мм х ____ мм х ____ мм				
Масса нетто: ____ кг. Масса брутто: ____ кг.				
		Made in China		
	Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 666# Middle Zhengfang Road, Jiangning, 211111 Nanjing, Jiangsu, P.R. China			
<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany	
EC	REP			
				


**Источник света эндоскопический HB200L, LS200L. Макет
маркировочной этикетки на потребительской упаковке на русском
языке**

Источник света эндоскопический		mindray		
Модель	К-во: 1			
Габаритные размеры: ____ мм х ____ мм х ____ мм				
Масса нетто: ____ кг. Масса брутто: ____ кг.				
Made in China				
	Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 666# Middle Zhengfang Road, Jiangning, 211111 Nanjing, Jiangsu, P.R. China			
<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany	
EC	REP			
				

Монитор LCD 26". Монитор LCD (с пьедесталом)

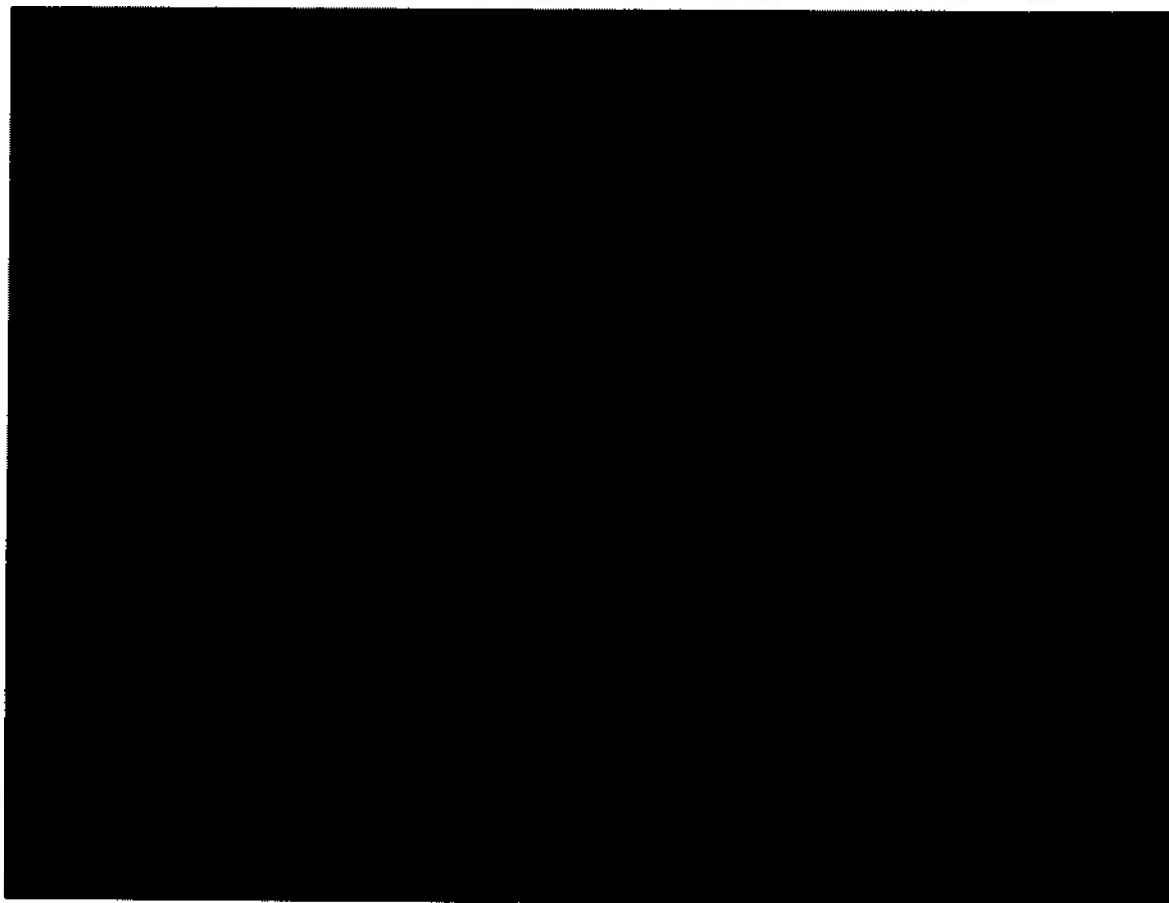


Вид спереди

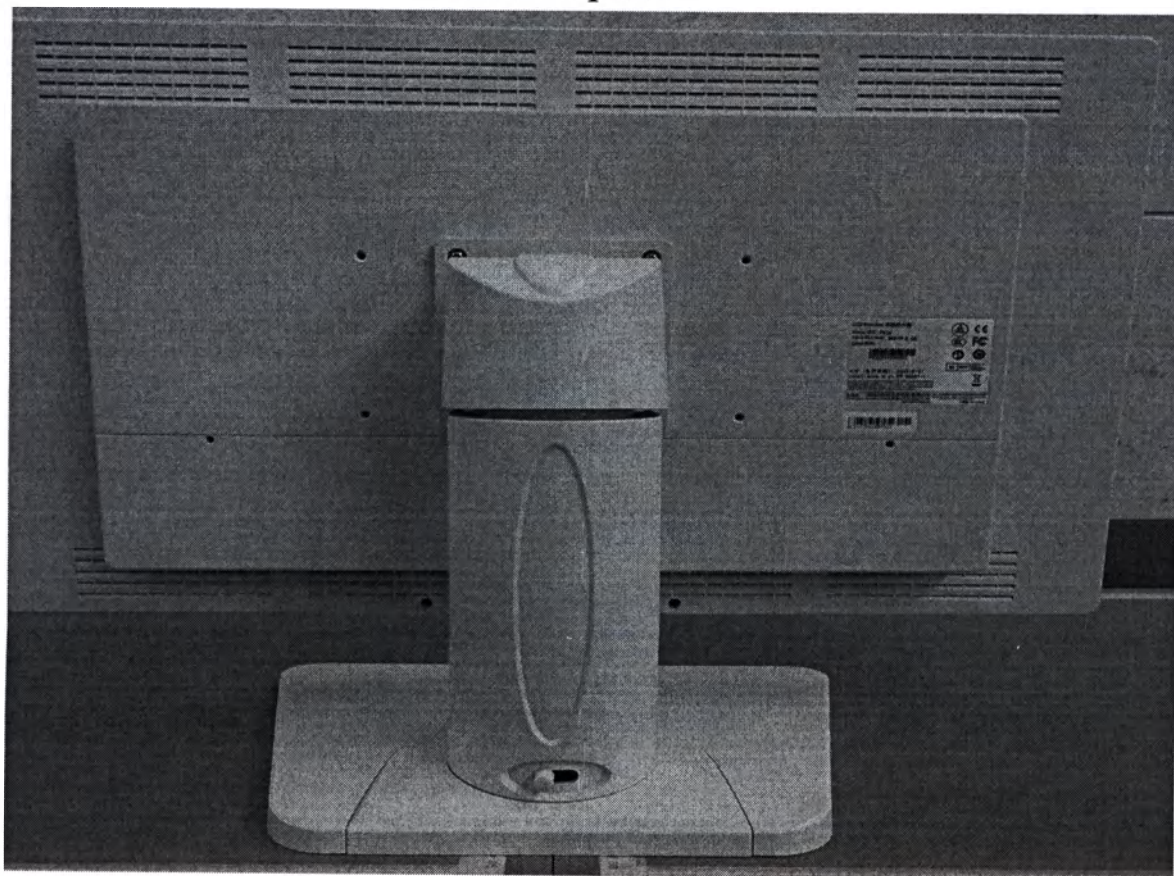


Вид сзади

Монитор LCD 27". Монитор LCD (с пьедесталом)

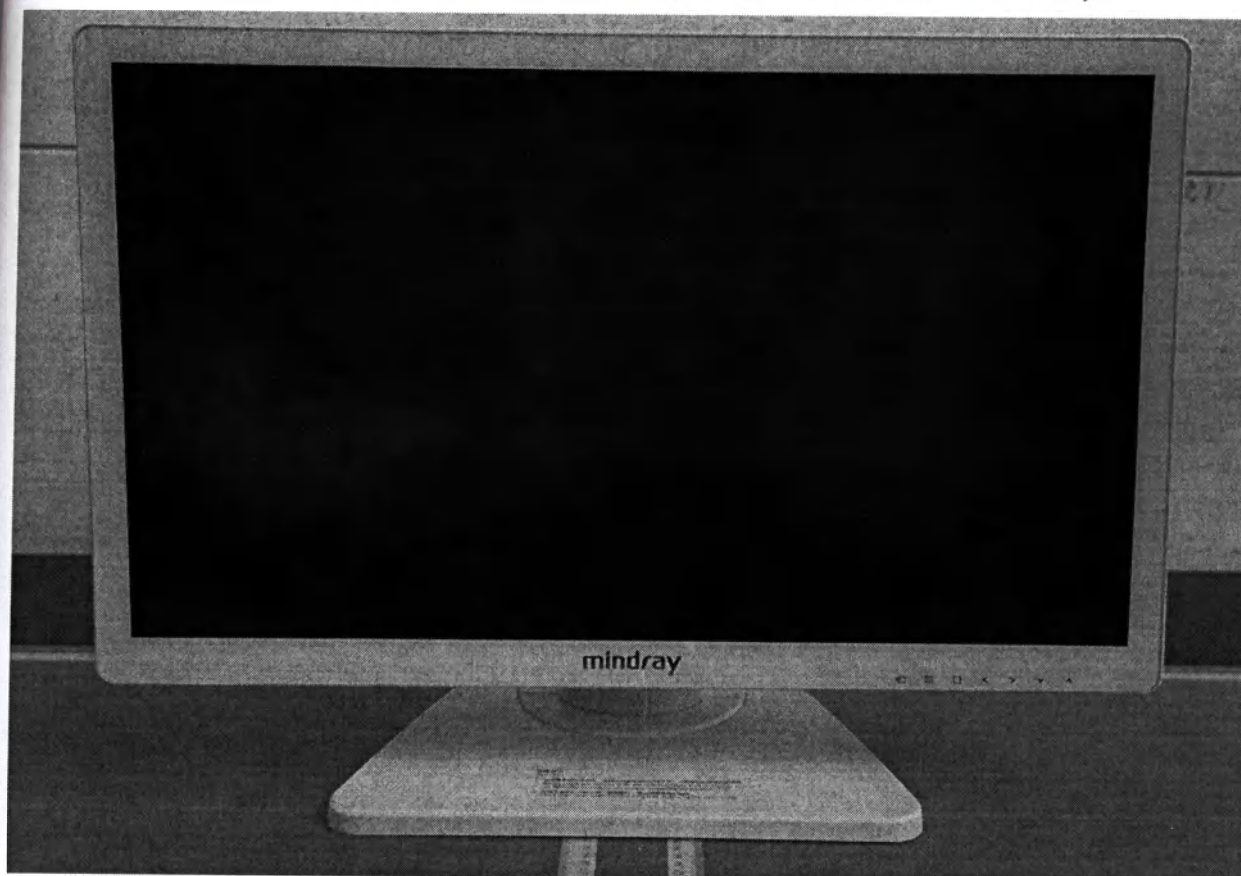


Вид спереди

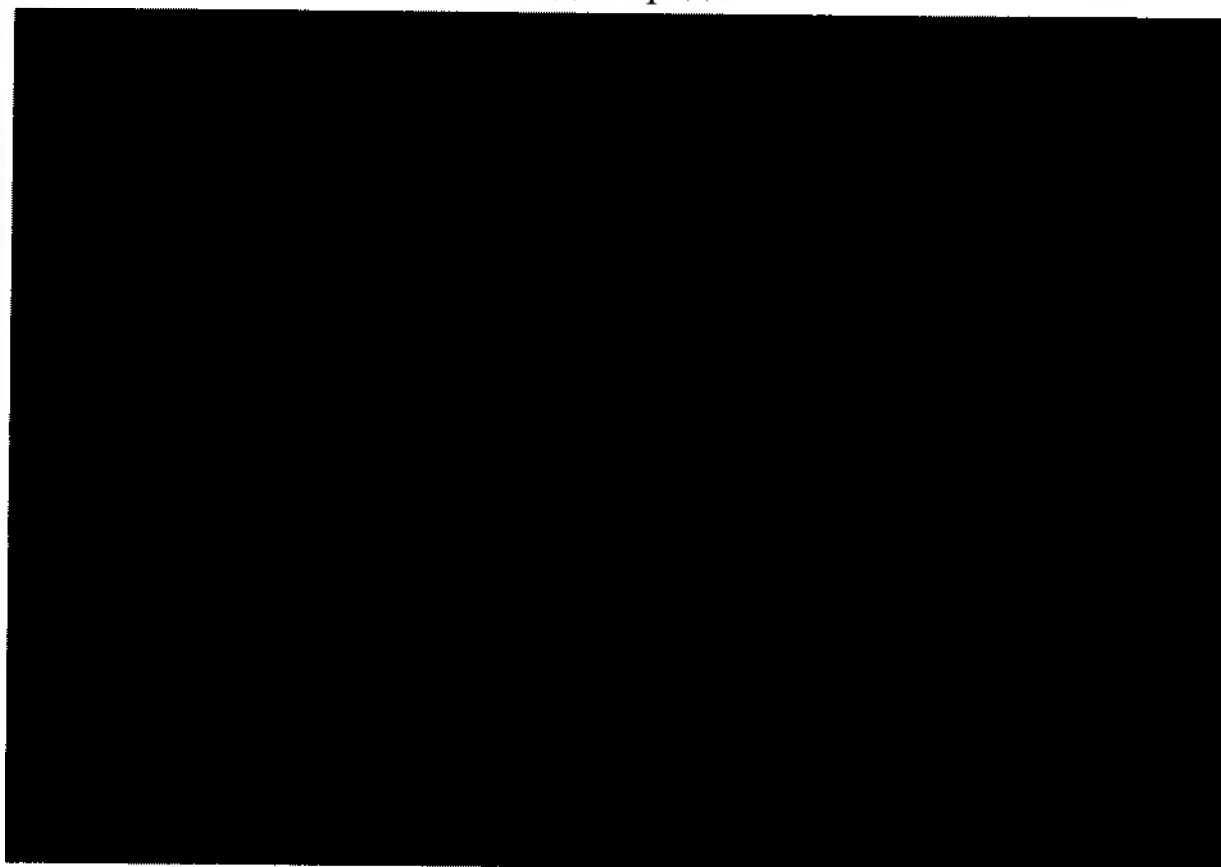


Вид сзади

**Монитор LCD 26", Монитор LCD 27".
Кабель питания (вилка типа E/F)**

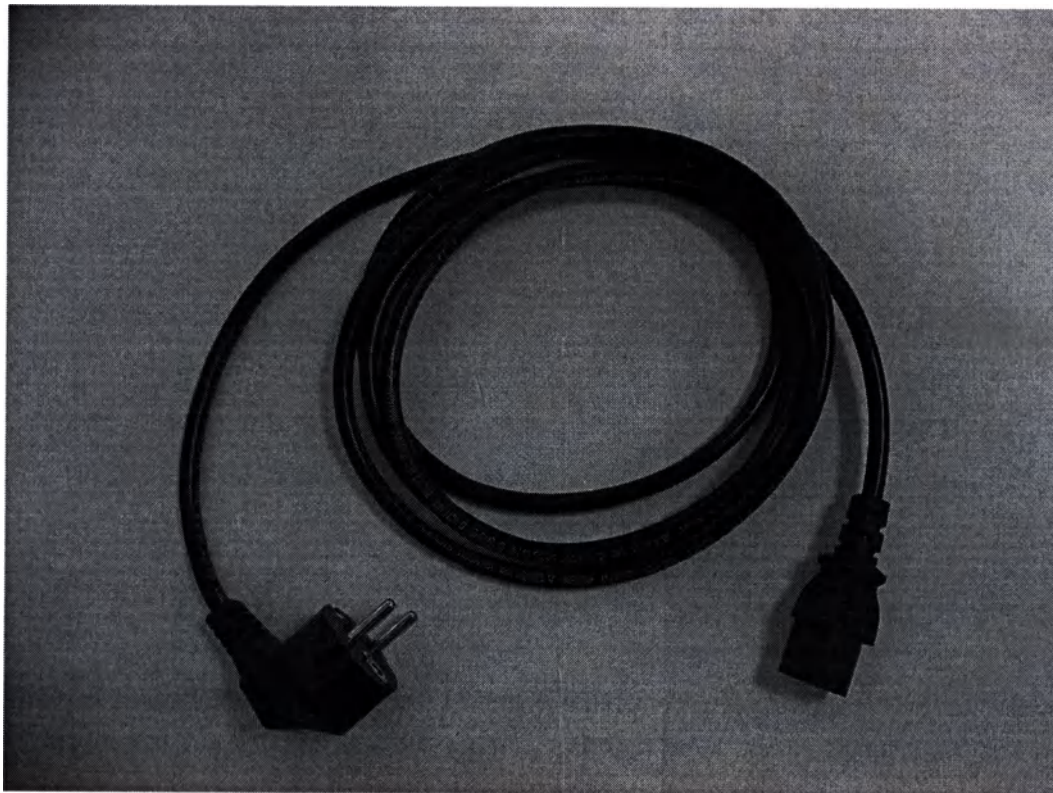


**Монитор LCD 26", Монитор LCD 27".
Кабель питания (вилка типа I)**

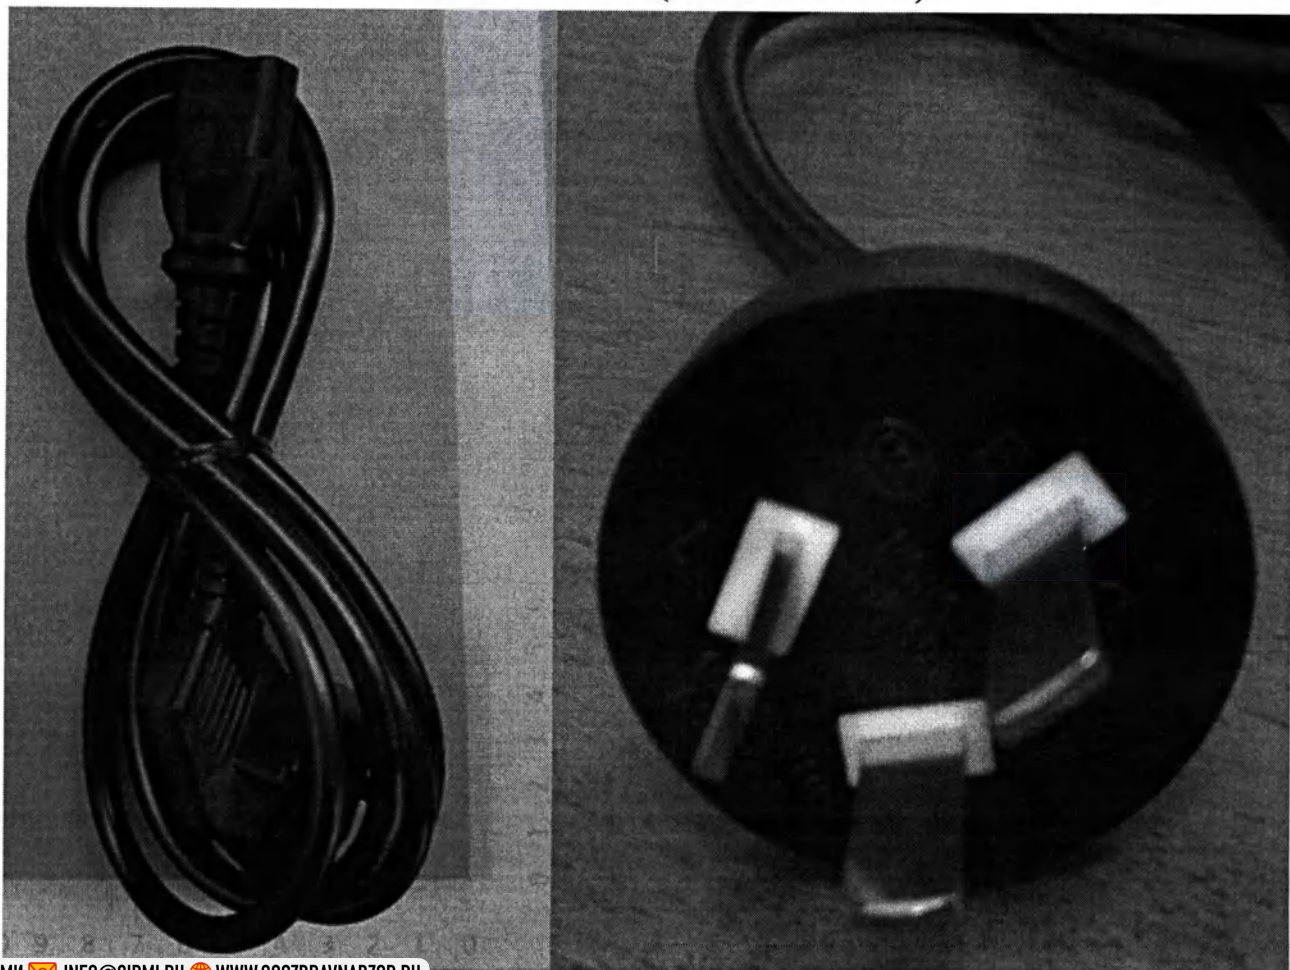

**Монитор LCD 26", Монитор LCD 27".
Адаптер**





**Монитор LCD 26", Монитор LCD 27".
Кабель заземления**

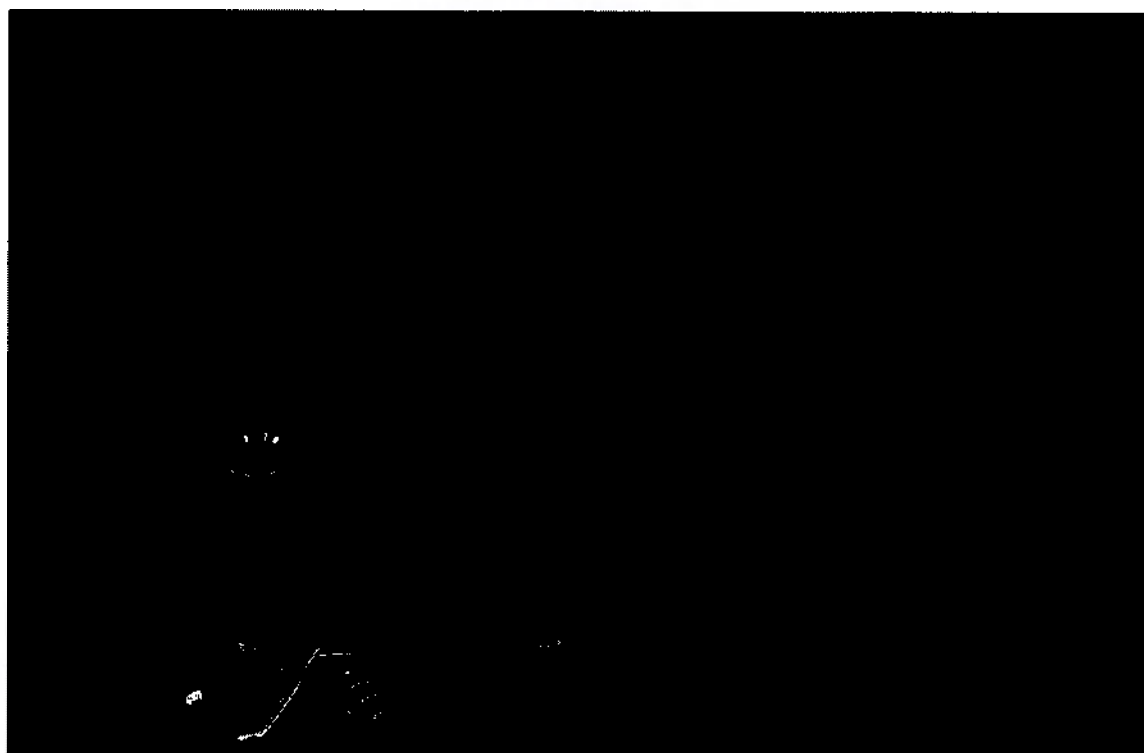


**Монитор LCD 26", Монитор LCD 27".
Кабель DVI**



**Монитор LCD 26", Монитор LCD 27".
Кабель S-VIDEO**

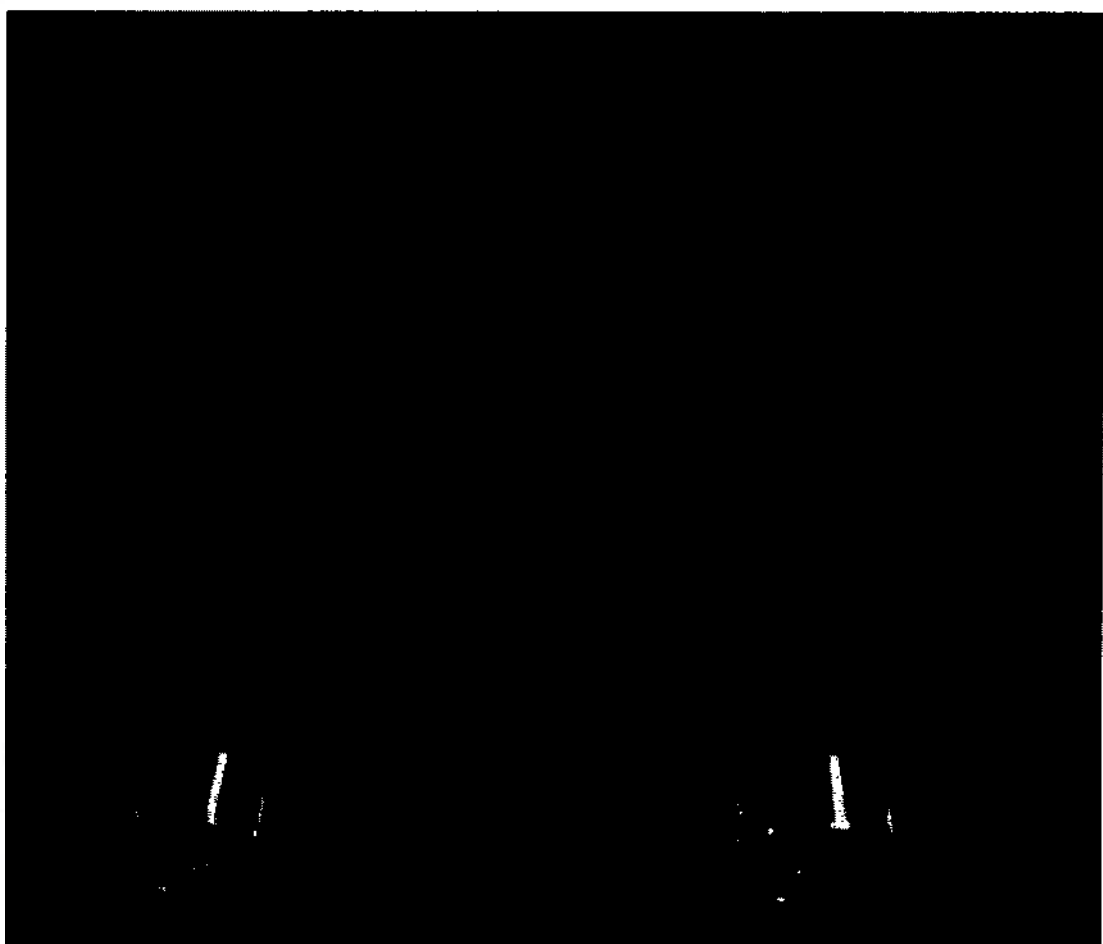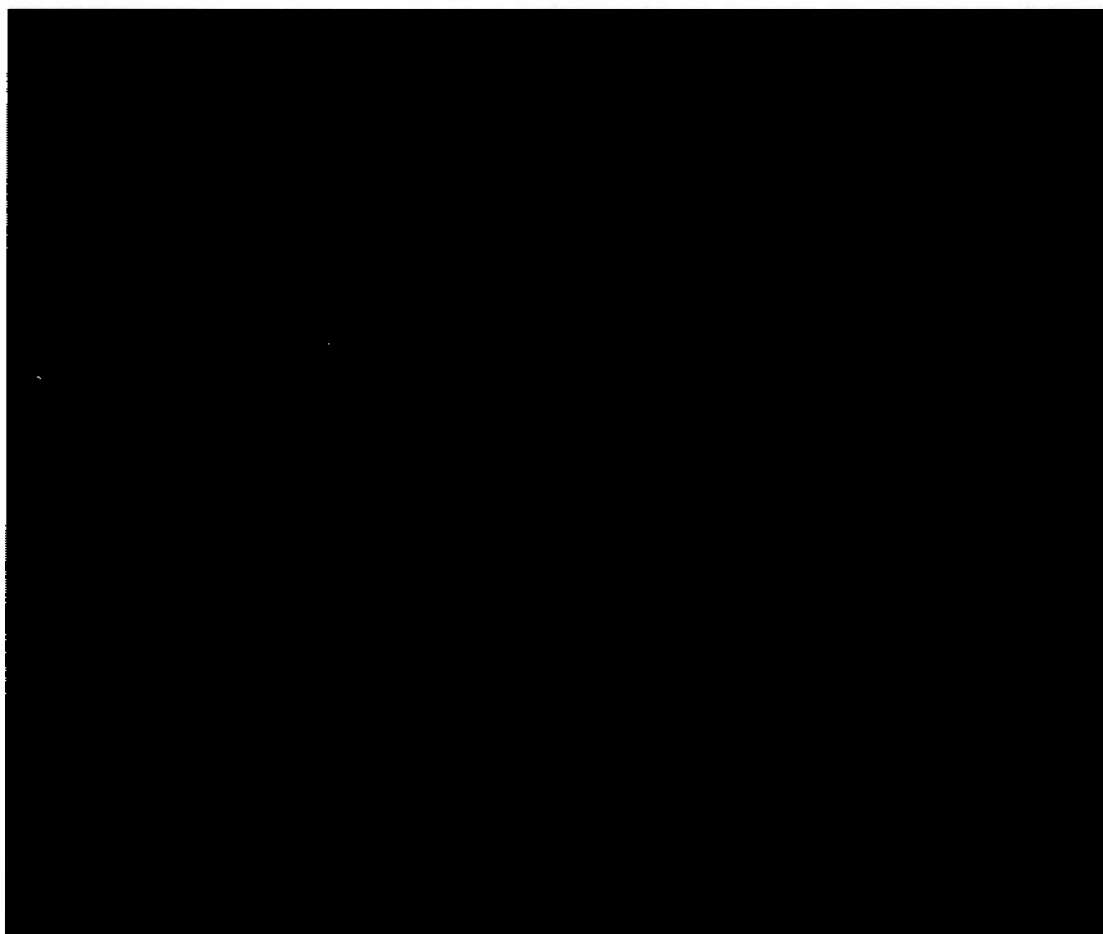


**Монитор LCD 26", Монитор LCD 27".
Кабель SDI**

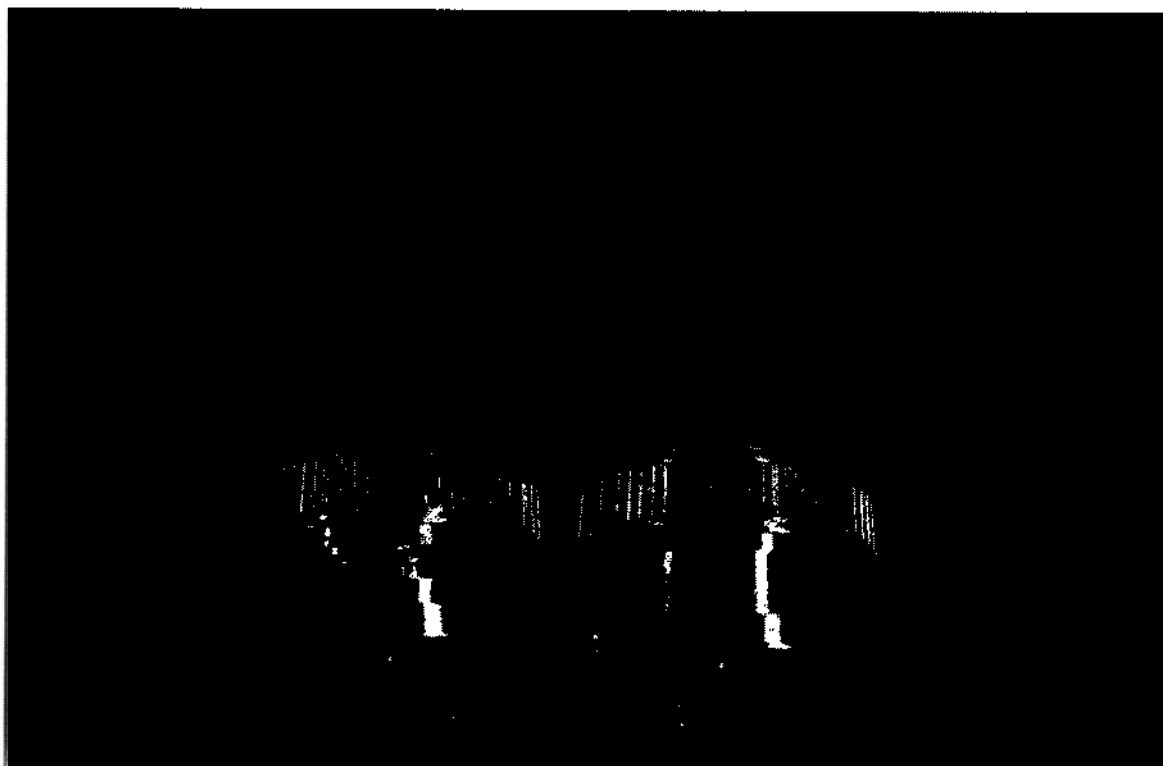


Монитор LCD 26", Монитор LCD 27".
Маркировочная этикетка на корпусе.




Монитор LCD 26", Монитор LCD 27".
Макет маркировочной этикетки на корпусе на русском языке

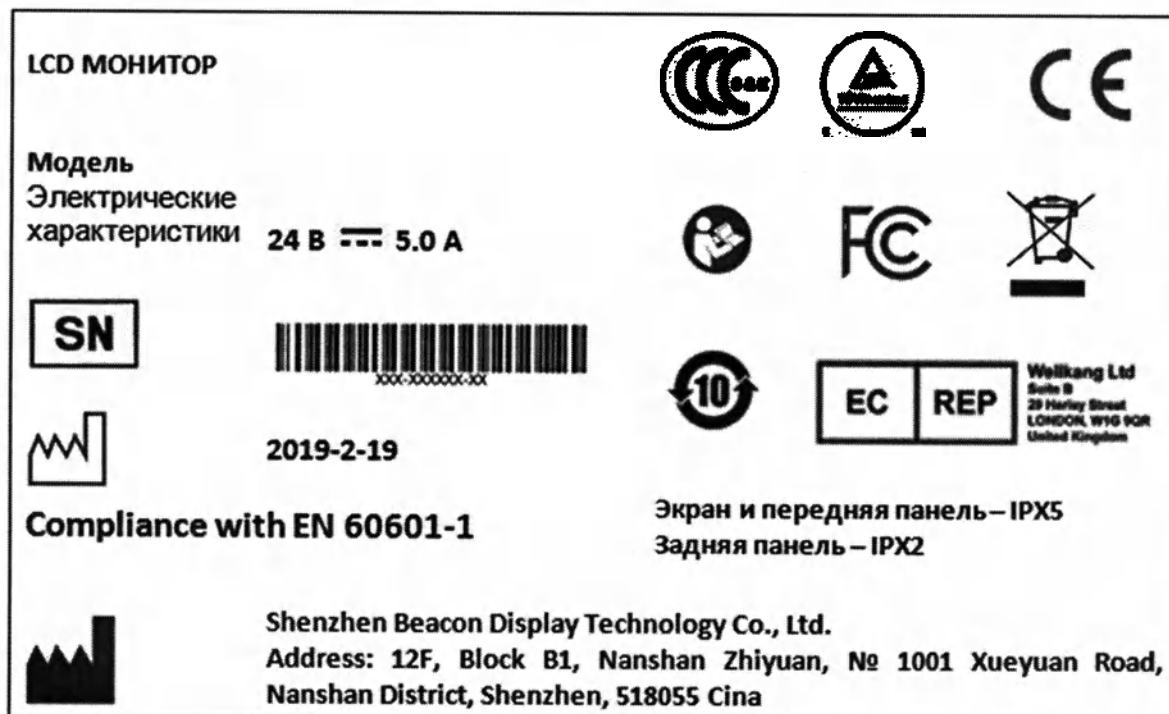

Монитор LCD 26", Монитор LCD 27". Потребительская упаковка. Общий вид

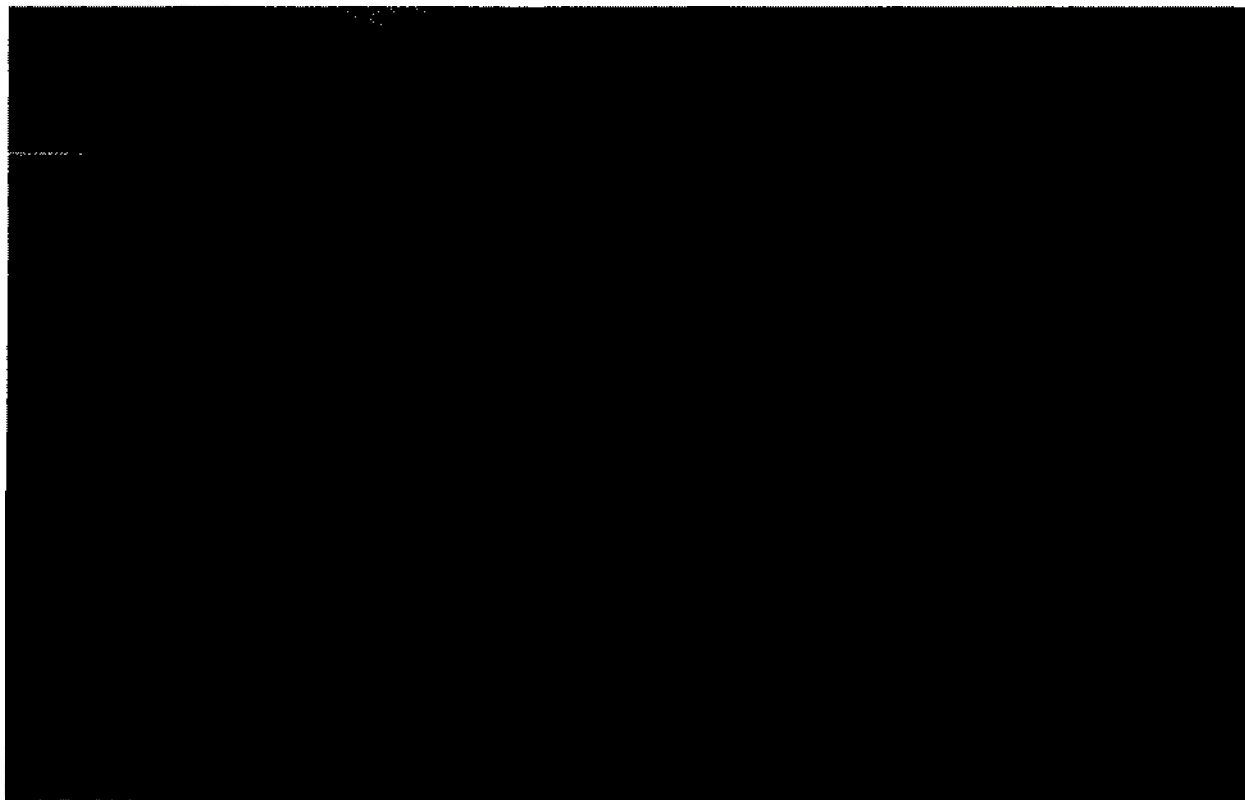


Монитор LCD 26", Монитор LCD 27". Маркировочные этикетки на потребительской упаковке.

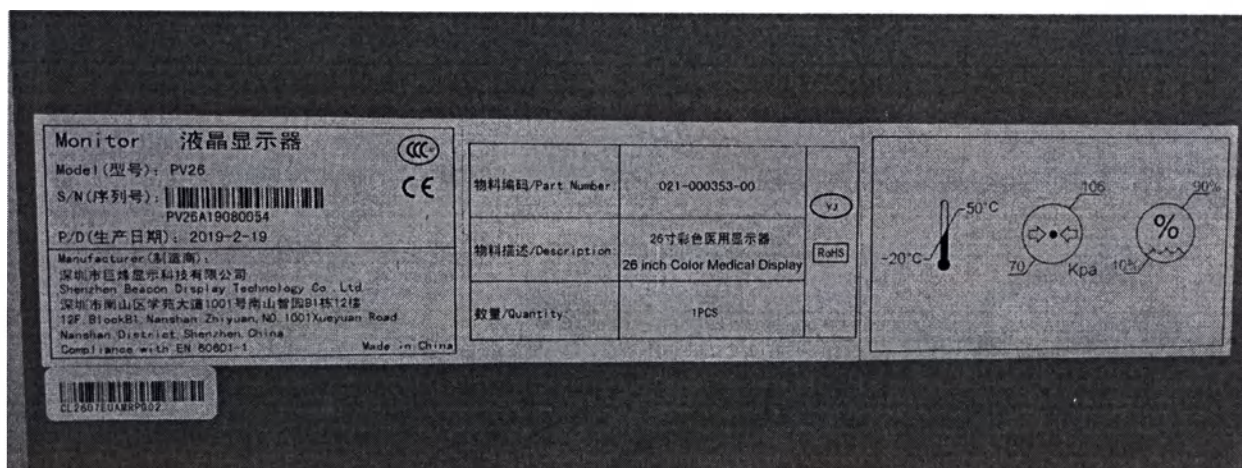

**Монитор LCD 26", Монитор LCD 27".
Макет маркировочных этикеток на потребительской упаковке на
русском языке**

LCD МОНИТОР		
Модель		CE
Электрические характеристики	24 В  5.0 А	
SN	 xxx-xxxxxx-xx	
	2019-2-19	
Compliance with EN 60601-1		

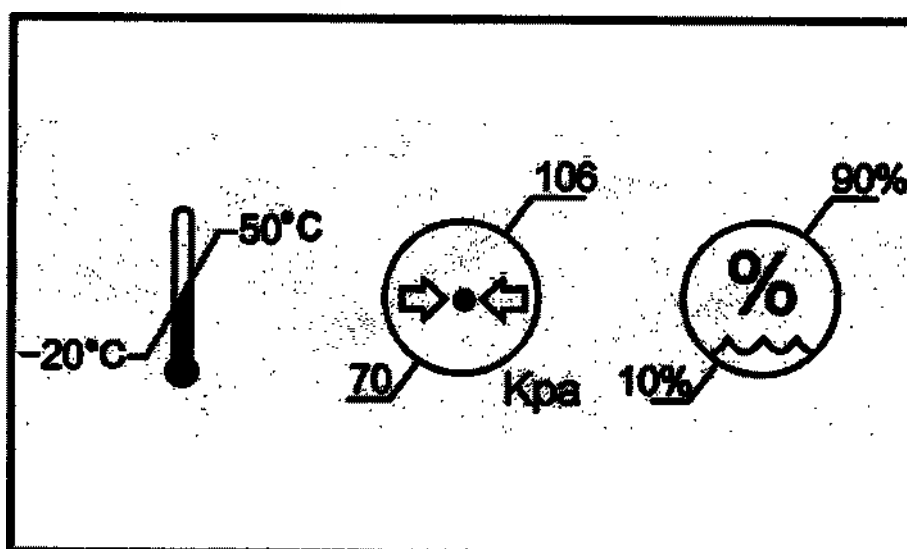

Номер партии	023-001989-00	 RoHS
Наименование	Монитор LCD 26"	
Количество	1 штука	

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью:
33 (тридцать три) лист(а/ов)

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Чэнь Син



20.08.20г