

Утверждаю

Директор

ООО «ГЕОСТРОЙИМПОРТ»

Фабульян А.Э.

«15» июня 2020

М.П.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДИЗАЙН МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19
(COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device)

HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.



4th Floor, #12 Building, Eastern Medicine Town,


Xiasha Economic&Technology Development,

310018 Hangzhou, Zhejiang, P.R. China



Общий вид потребительской упаковки Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device) , 1 тест в наборе

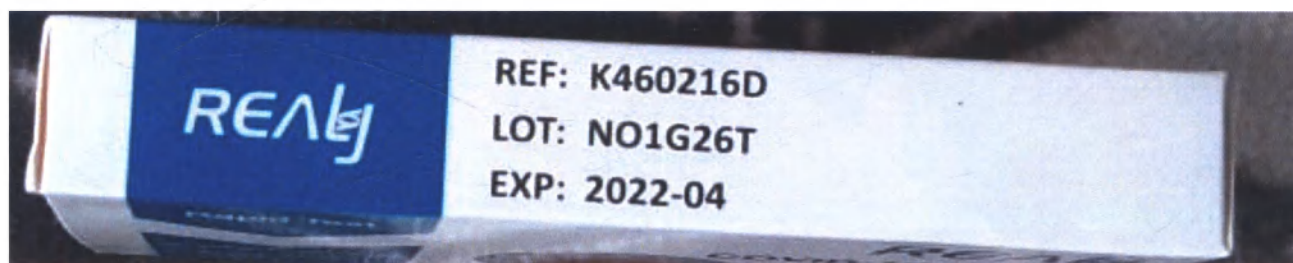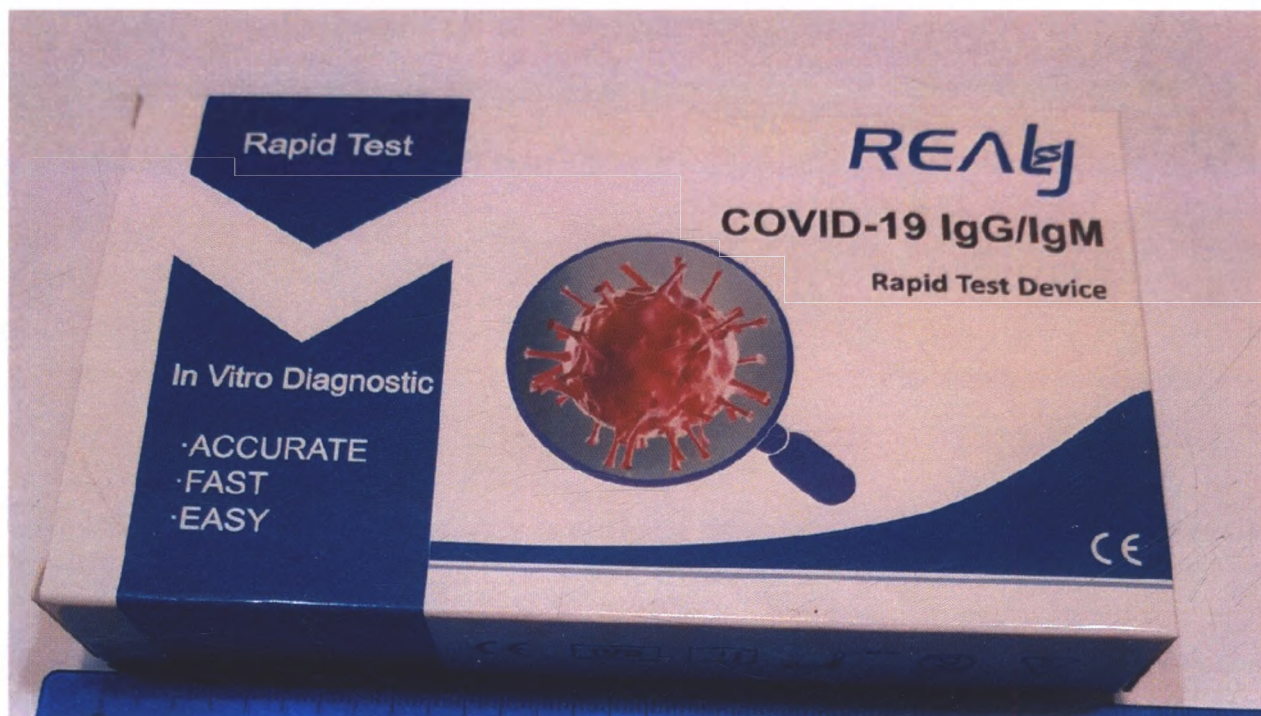

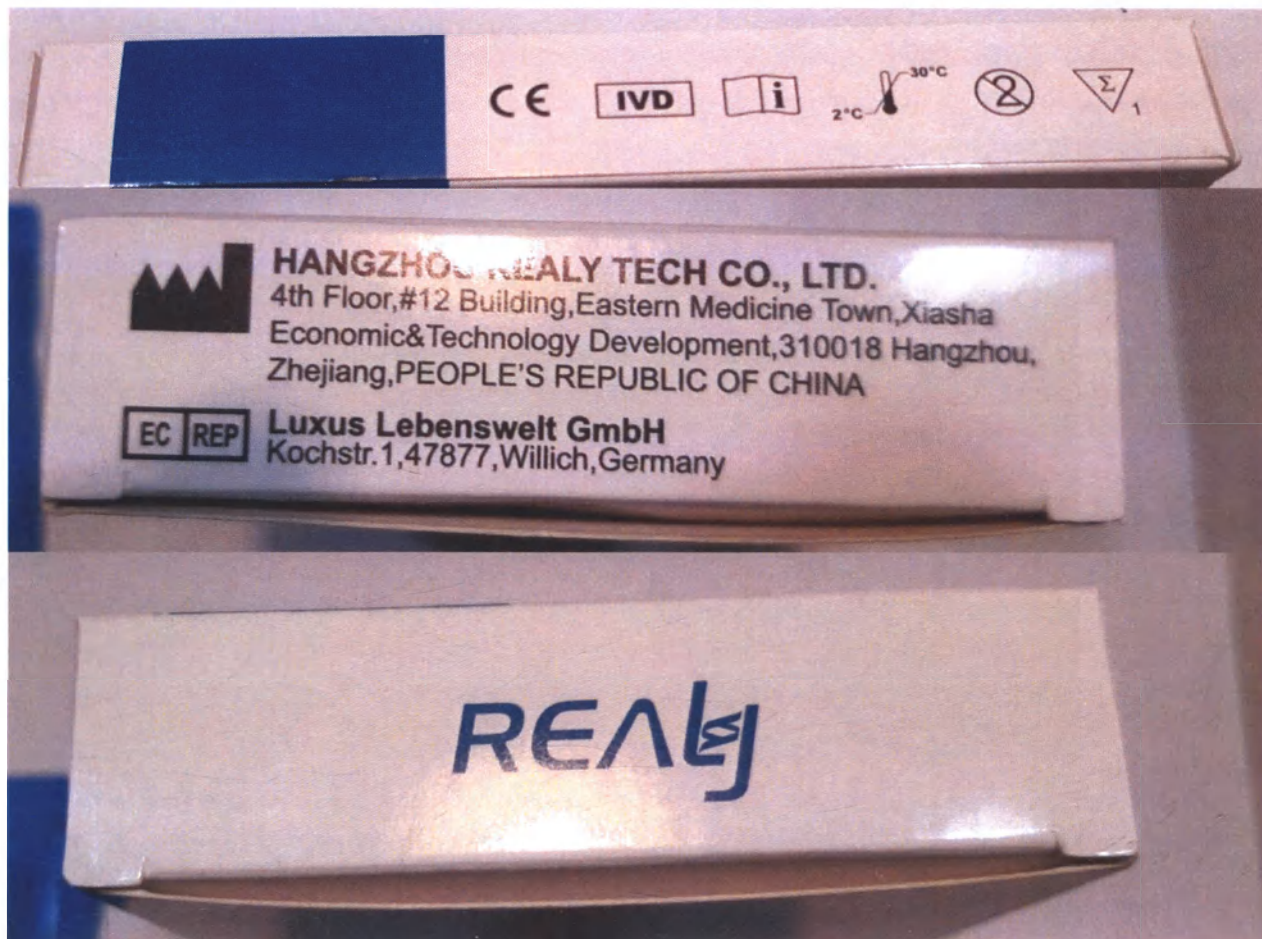

Маркировка потребительской упаковки Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device), 1 тест в наборе





Порядок укладки потребительских упаковок с тестами в транспортной упаковке (1 тест в наборе)



Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device), в составе:

1. Тест-кассета (в индивидуальной упаковке с осушителем) – 1 шт.
2. Вспомогательные компоненты для экспресс-теста (в индивидуальной упаковке), в составе:
 - Буферный раствор - 1 флакон объемом 3 мл.
 - Одноразовая пластиковая пипетка - 1 шт.
 - Спиртовая салфетка - 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

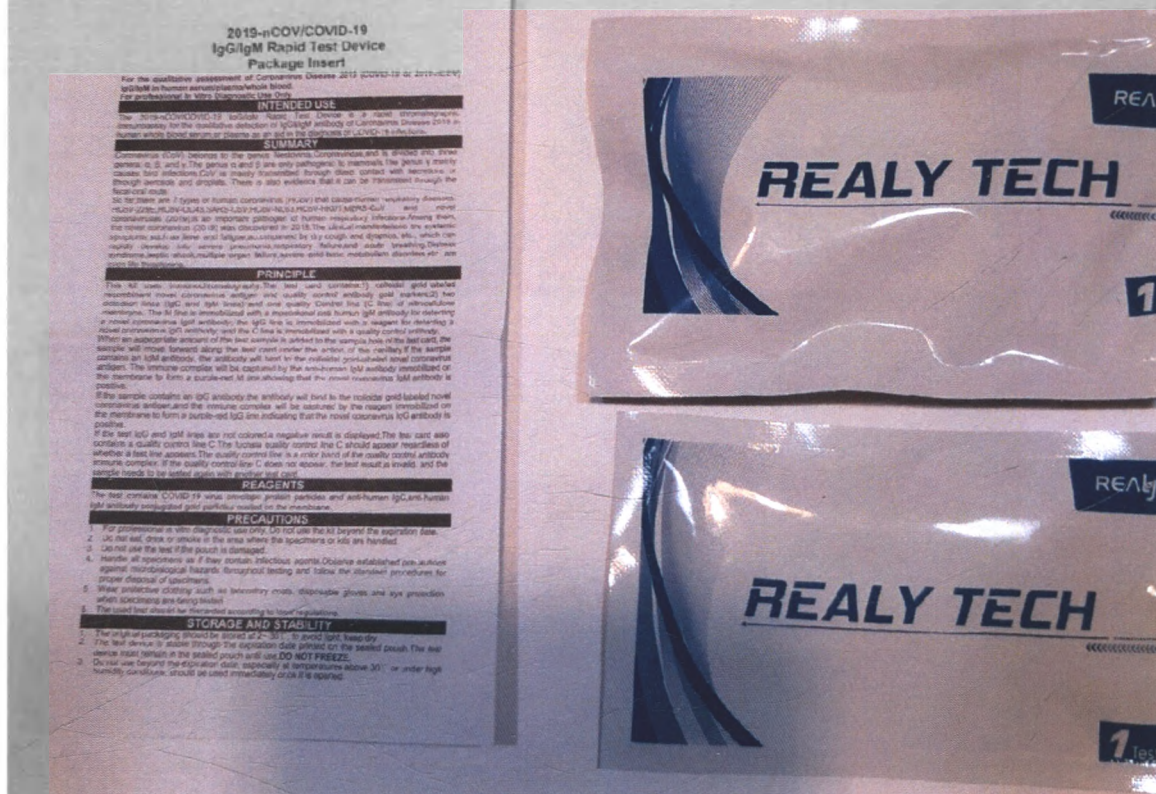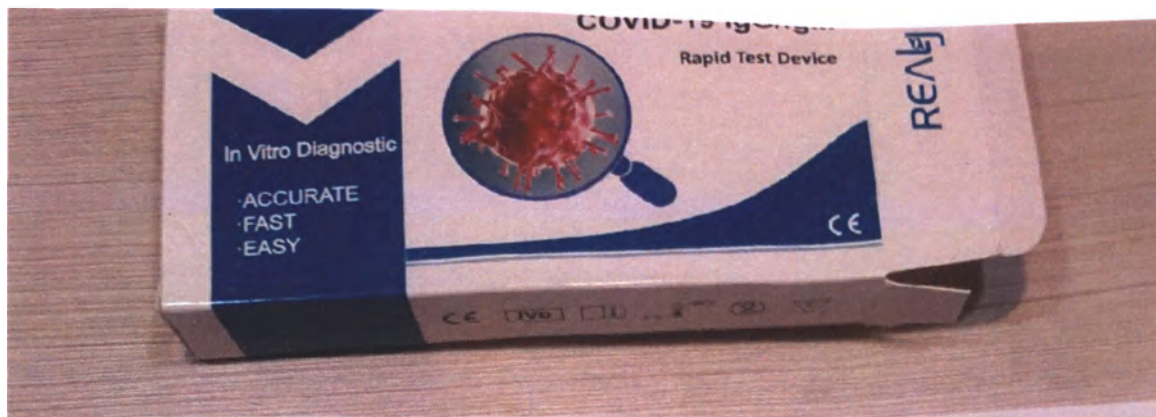

Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device), в составе:

1. Тест-кассета (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем) – 1 шт.
2. Вспомогательные компоненты для экспресс-теста (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги), в составе:
 - Буферный раствор - 1 флакон объемом 3 мл
 - Одноразовая пластиковая пипетка - 1 шт.
 - Спиртовая салфетка - 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.




Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device), в составе:

1. Тест-кассета (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем) – 1 шт.
2. Вспомогательные компоненты для экспресс-теста (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги), в составе:
 - Буферный раствор - 1 флакон объемом 3 мл
 - Одноразовая пластиковая пипетка - 1 шт.
 - Спиртовая салфетка - 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.



Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device), в составе: 1. Тест-кассета (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем) – 1 шт. 2. Вспомогательные компоненты для экспресс-теста (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги), в составе: - Буферный раствор - 1 флакон объемом 3 мл. - Одноразовая пластиковая пипетка - 1 шт. - Спиртовая салфетка - 1 шт. 3. Инструкция по применению – 1 шт.



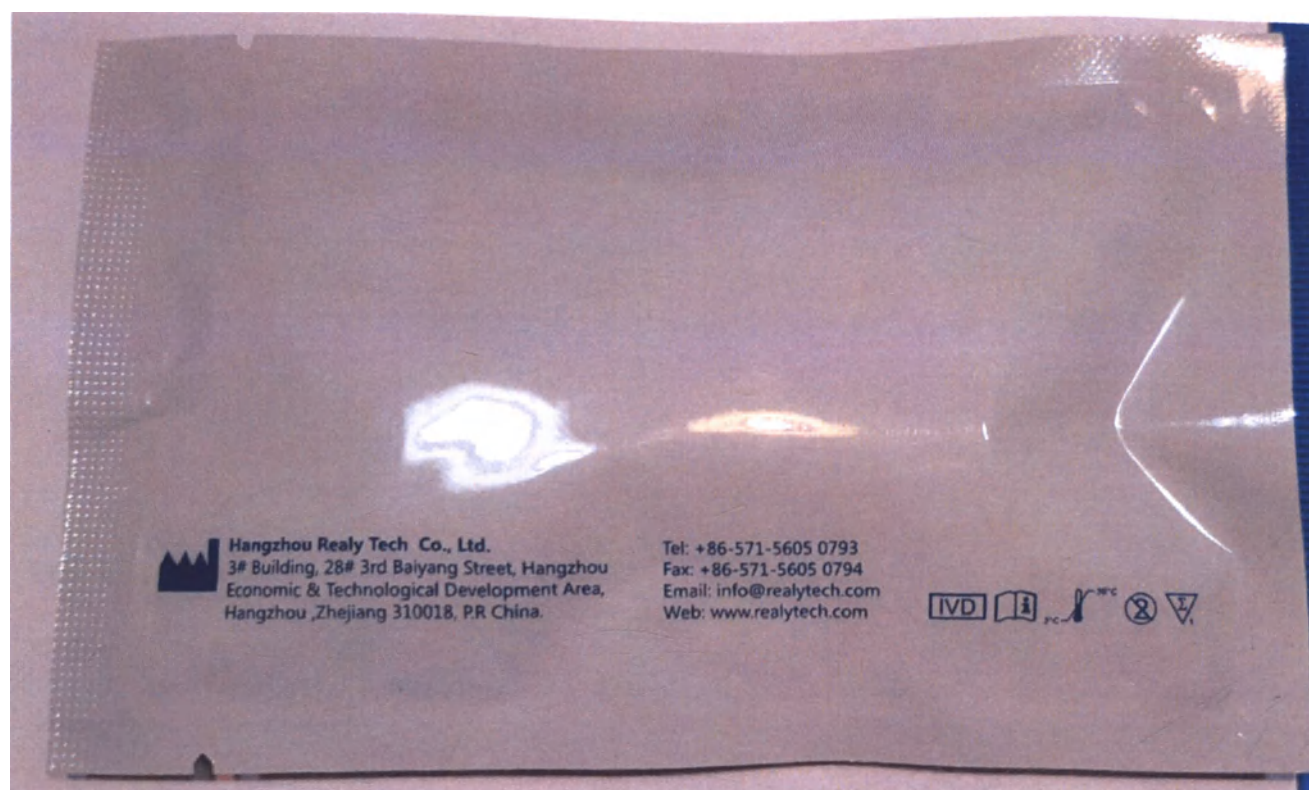

**Маркировка индивидуальной упаковки вспомогательных компонентов для 1 теста в наборе (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги)
(вид спереди. вид сзади)**



Вспомогательные компоненты (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги) для 1 теста в наборе: буферный раствор – 1 флакон объемом 3 мл, одноразовая пластиковая пипетка, спиртовая салфетка



Общий вид спиртовой салфетки, одноразовая пластиковая пипетка, буферный раствор – 1 флакон объемом 3 мл (для 1 теста в наборе и 25 тестов в наборе)



Маркировка индивидуальной вакуумной упаковки из алюминиевой фольги с осушителем для тест-кассеты (для 1 теста в наборе и 25 тестов в наборе): вид спереди, вид сзади

Rapid Test

REAL

COVID-19 IgG / IgM


Rapid Test Device

In Vitro Diagnostic


- ACCURATE
- FAST
- EASY

REF K460216D

CE

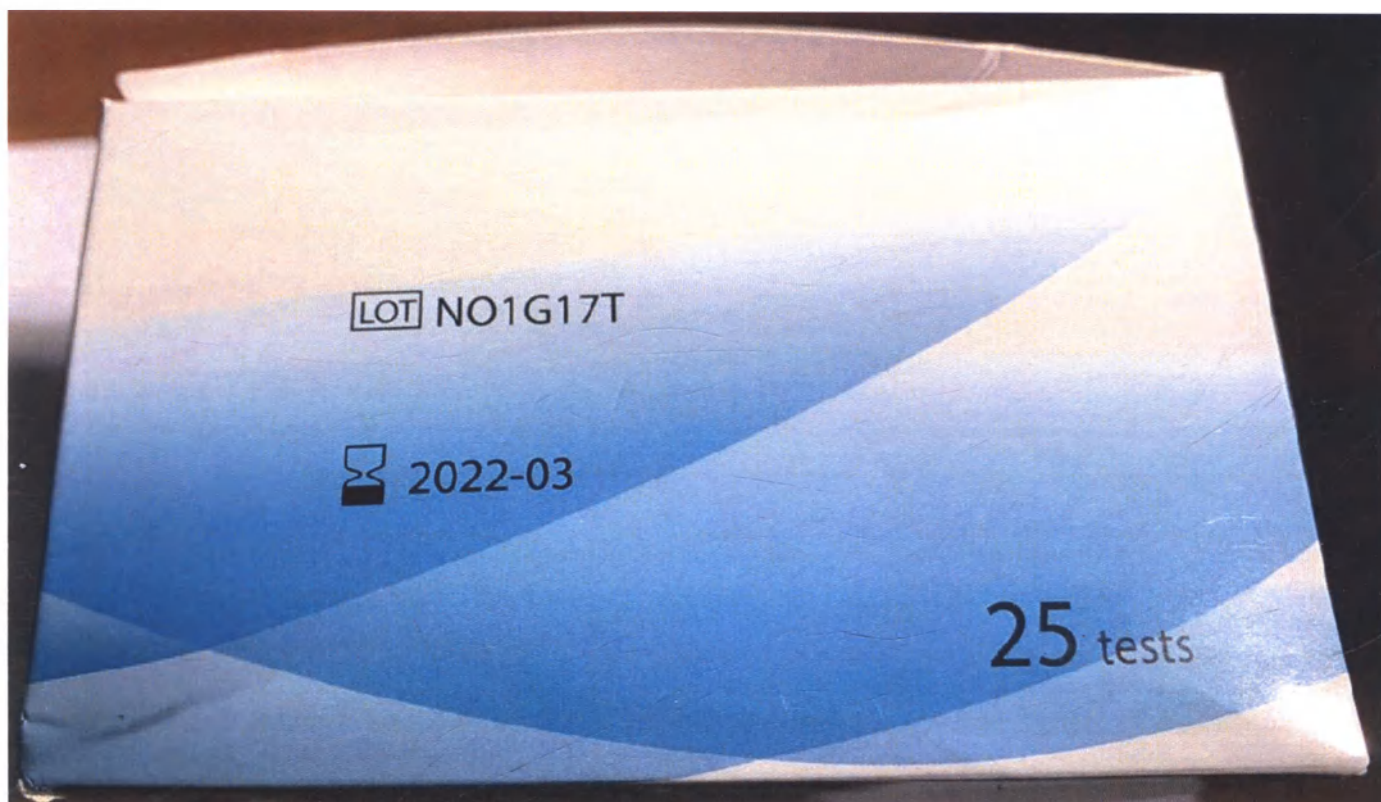

Общий вид потребительской упаковки и маркировки Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (25 тестов в наборе)

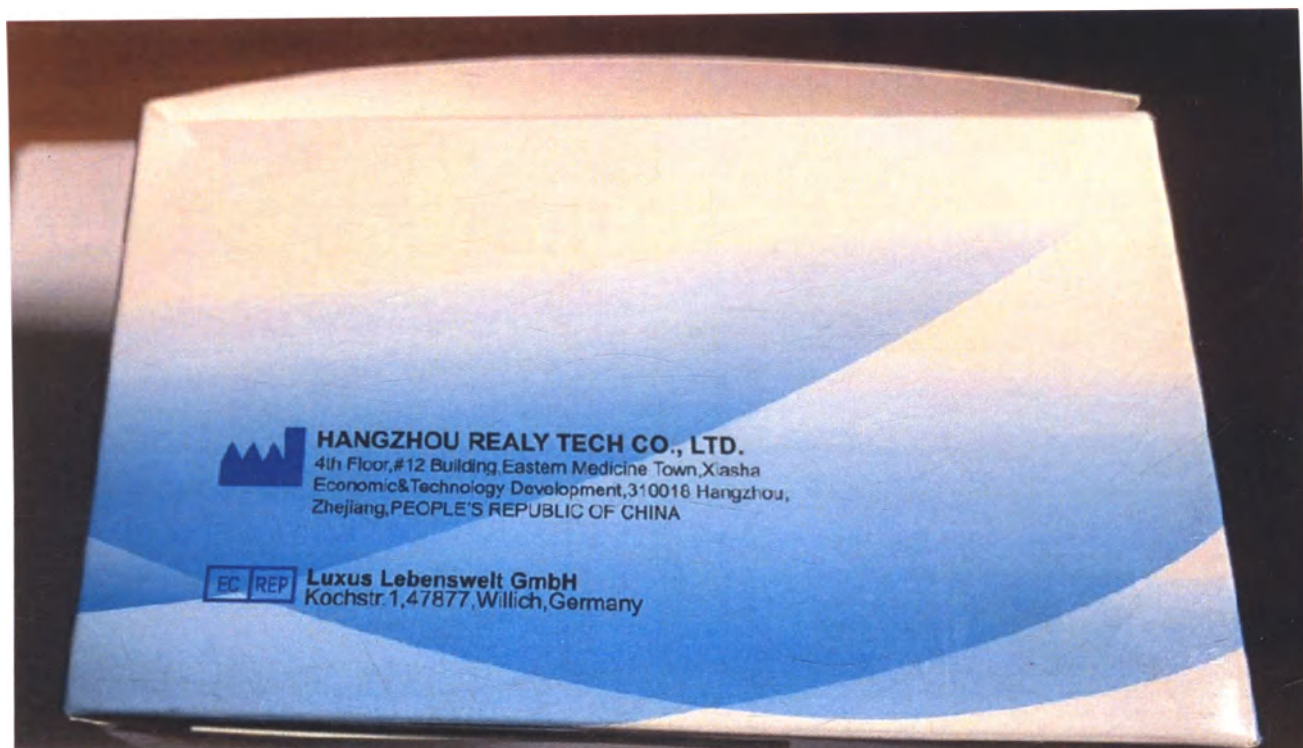

HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.

4th Floor, #12 Building, Eastern Medicine Town, Xiasha
Economic & Technology Development, 310018 Hangzhou,
Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1, 47877 Willich, Germany



Общий вид потребительской упаковки и маркировки Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (25 тестов в наборе)




- Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device), в составе:
1. Тест-кассета (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем) – 25 шт.
 2. Вспомогательные компоненты для экспресс-теста, в составе:
 - Буферный раствор - 1 флакон объемом 3 мл.
 - Одноразовая пластиковая пипетка - 25 шт./уп.
 - Спиртовая салфетка - 25шт/уп.
 3. Инструкция по применению – 1 шт.




**Порядок укладки Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19
в потребительской упаковке (25 тестов в наборе)**



Одноразовая пластиковая пипетка в зип-пакете (для 25 тестов в наборе) и маркировка

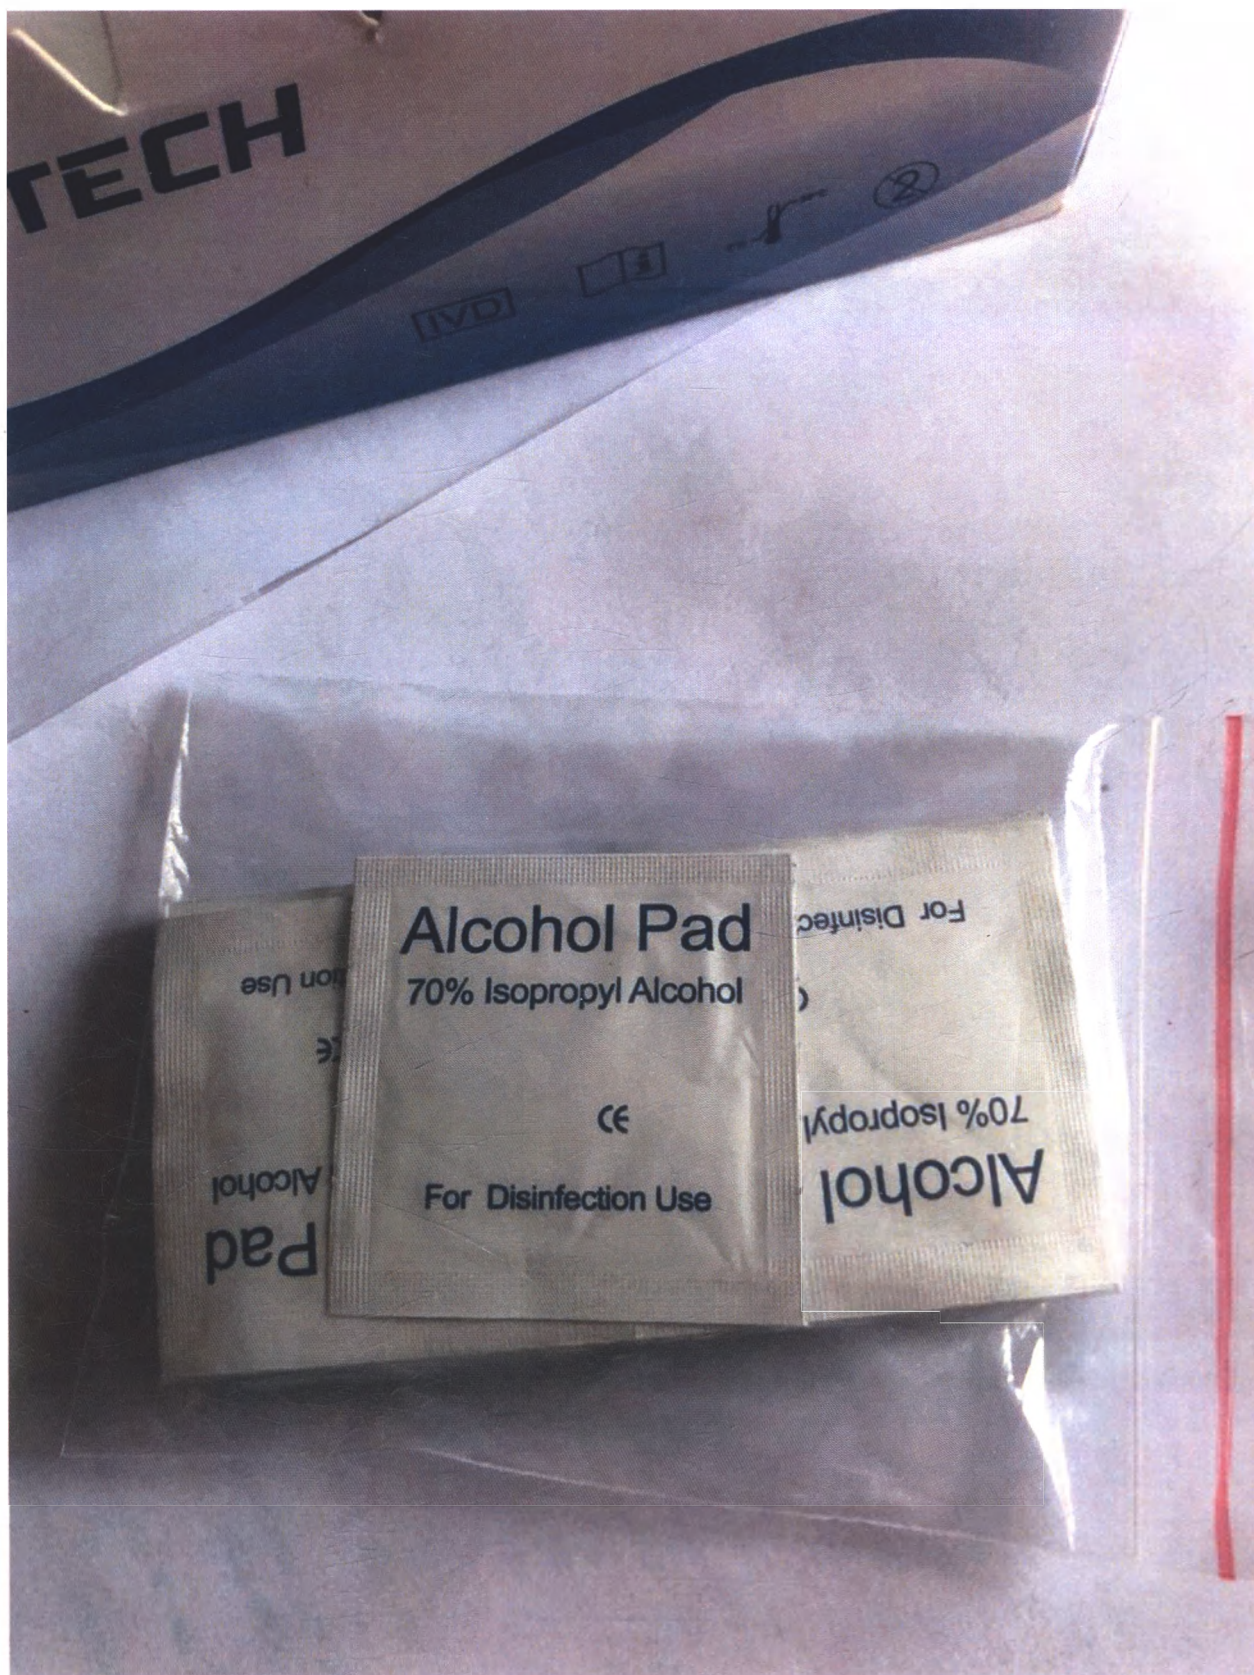

Общий вид индивидуальной упаковки спиртовой салфетки в зип-пакете (для 25 тестов в наборе)

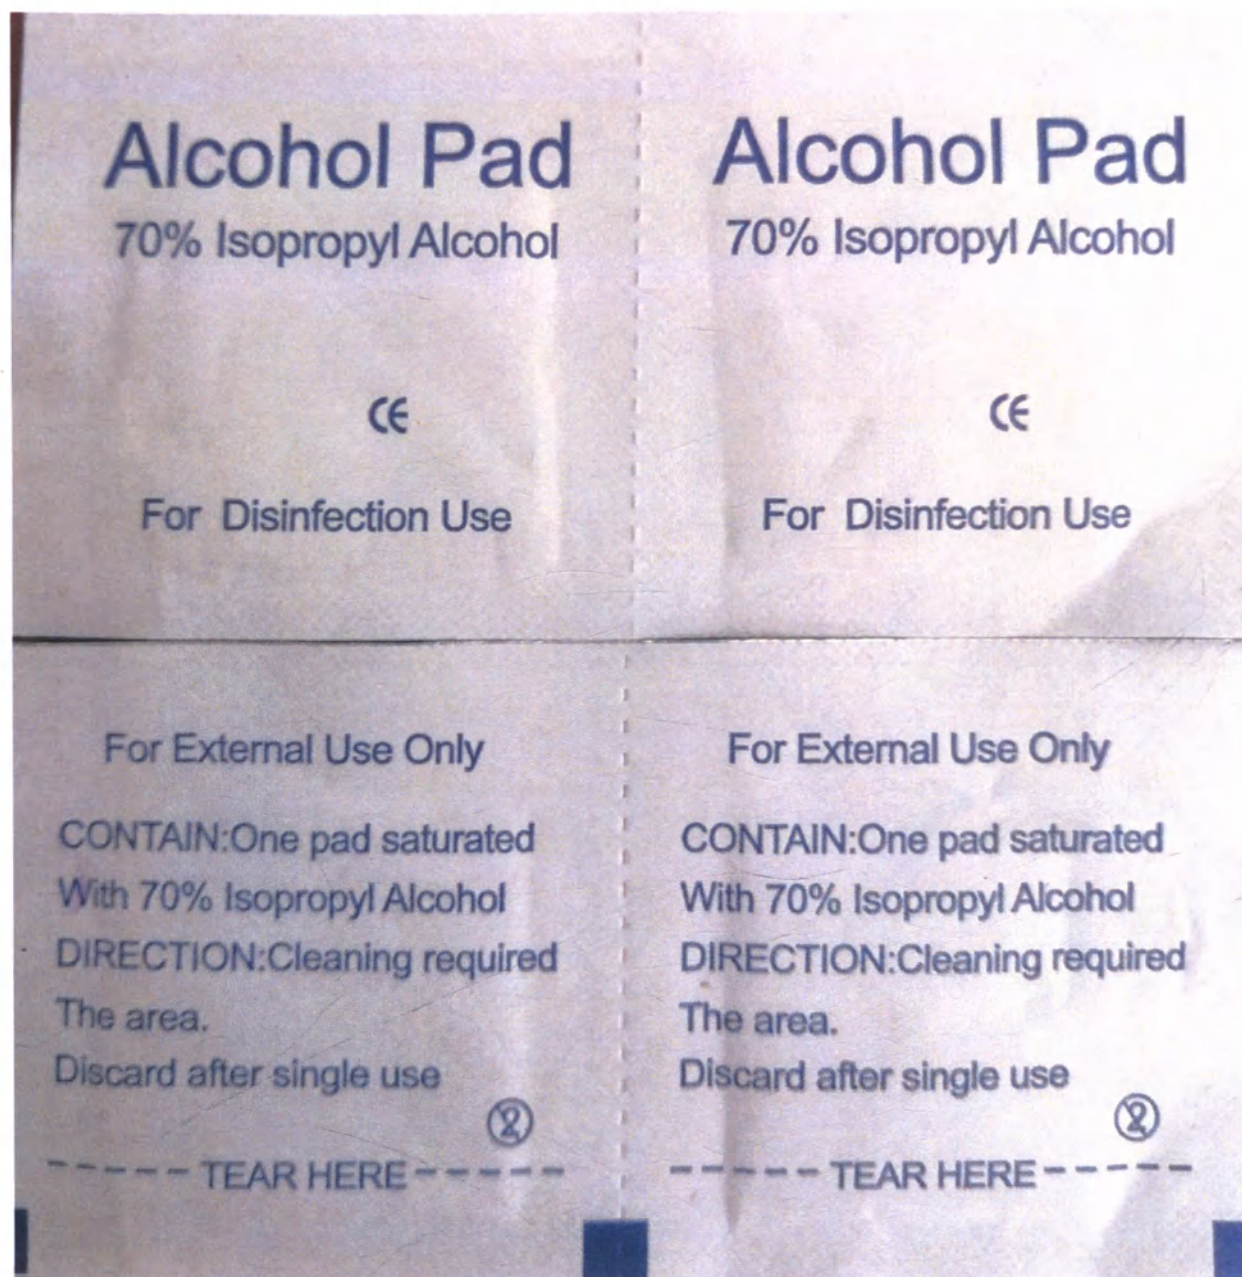

Общий вид индивидуальной упаковки и маркировки спиртовой салфетки, маркировка (для 25 тестов в наборе)






NCOV IgG/IgM Buffer

LOT: BF2005007 EXP: 2022-07

Volume: 3ml Storage: 2~30°C

- маркировка флакона с буферным раствором

Буферный раствор объемом 3 мл (для 1 теста в наборе и 25 тестов в наборе)

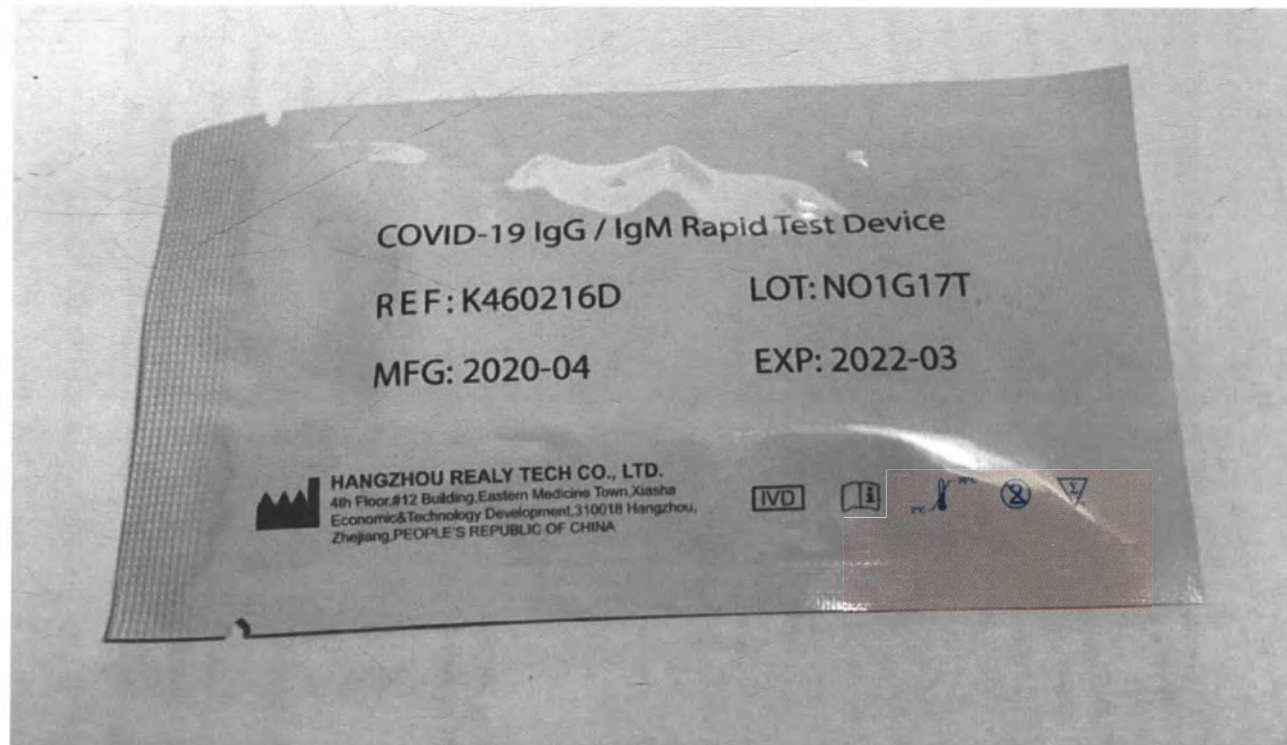

Тест-кассета (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем)



Тест-кассета (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем), спиртовая салфетка, одноразовая пластиковая пипетка



Буферный раствор объемом 3 мл, спиртовая салфетка, одноразовая пластиковая пипетка, тест-кассета (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги)

Для 1 теста в наборе:

Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19

Состав:

1. Тест-кассета (в индивидуальной упаковке с осушителем) – 1 шт.
2. Вспомогательные компоненты для экспресс-теста (в индивидуальной упаковке), в составе:
 - Буферный раствор - 1 флакон объемом 3 мл.
 - Одноразовая пластиковая пипетка - 1 шт.
 - Спиртовая салфетка - 1шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «ГЕОСТРОЙИМПОРТ», Россия, 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул.Командорская, д.11. Тел/факс (423) 221-23-61.

E-mail: extper@mail.ru

РУ №__ от __ до __

25 тестов в наборе:

Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19

Состав:

1. Тест-кассета (в индивидуальной упаковке с осушителем) – 25 шт.
2. Вспомогательные компоненты для экспресс-теста, в составе:
 - Буферный раствор - 1 флакон объемом 3 мл.
 - Одноразовая пластиковая пипетка - 25 шт./уп.
 - Спиртовая салфетка - 25шт/уп.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «ГЕОСТРОЙИМПОРТ», Россия, 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул.Командорская, д.11. Тел/факс (423) 221-23-61.

E-mail: extper@mail.ru

РУ №__ от __ до __

Макет потребительской этикетки при поставке в РФ
(является дополнительным ярлыком основной маркировки)

Приложение (справочное)

Варианты исполнения медицинского изделия

Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device), варианты исполнения:

I. Комплектность поставки №1: Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device), номер партии: NO1G26T,

в составе:

- 1. Тест-кассета (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем) – 1 шт.**
- 2. Вспомогательные компоненты для экспресс-теста (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги), в составе:**
 - Буферный раствор - 1 флакон объемом 3 мл.**
 - Одноразовая пластиковая пипетка - 1 шт.**
 - Спиртовая салфетка - 1шт.**
- 3. Инструкция по применению – 1 шт.**

II. Комплектность поставки №2: Экспресс-тест IgG/IgM на выявление COVID-19 (COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device), номер партии: NO1G24T,

в составе:

- 1. Тест-кассета (в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем) – 25 шт.**
- 2. Вспомогательные компоненты для экспресс-теста, в составе:**
 - Буферный раствор - 1 флакон объемом 3 мл.**
 - Одноразовая пластиковая пипетка - 25 шт./уп.**
 - Спиртовая салфетка - 25шт/уп.**
- 3. Инструкция по применению – 1 шт.**

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 30 (тридцать) листов
Должность Директор ООО
"ГеоСтройИнвест"
Подпись [подпись] / Григорьев
« 10 » июня 20 20 года

