

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Медиклон»



Н.А. Викторов


«17» марта 2020 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия


«Планшет многоразовый для проведения серологических реакций»

по ТУ 32.50.50-105-51203590-2020

2020

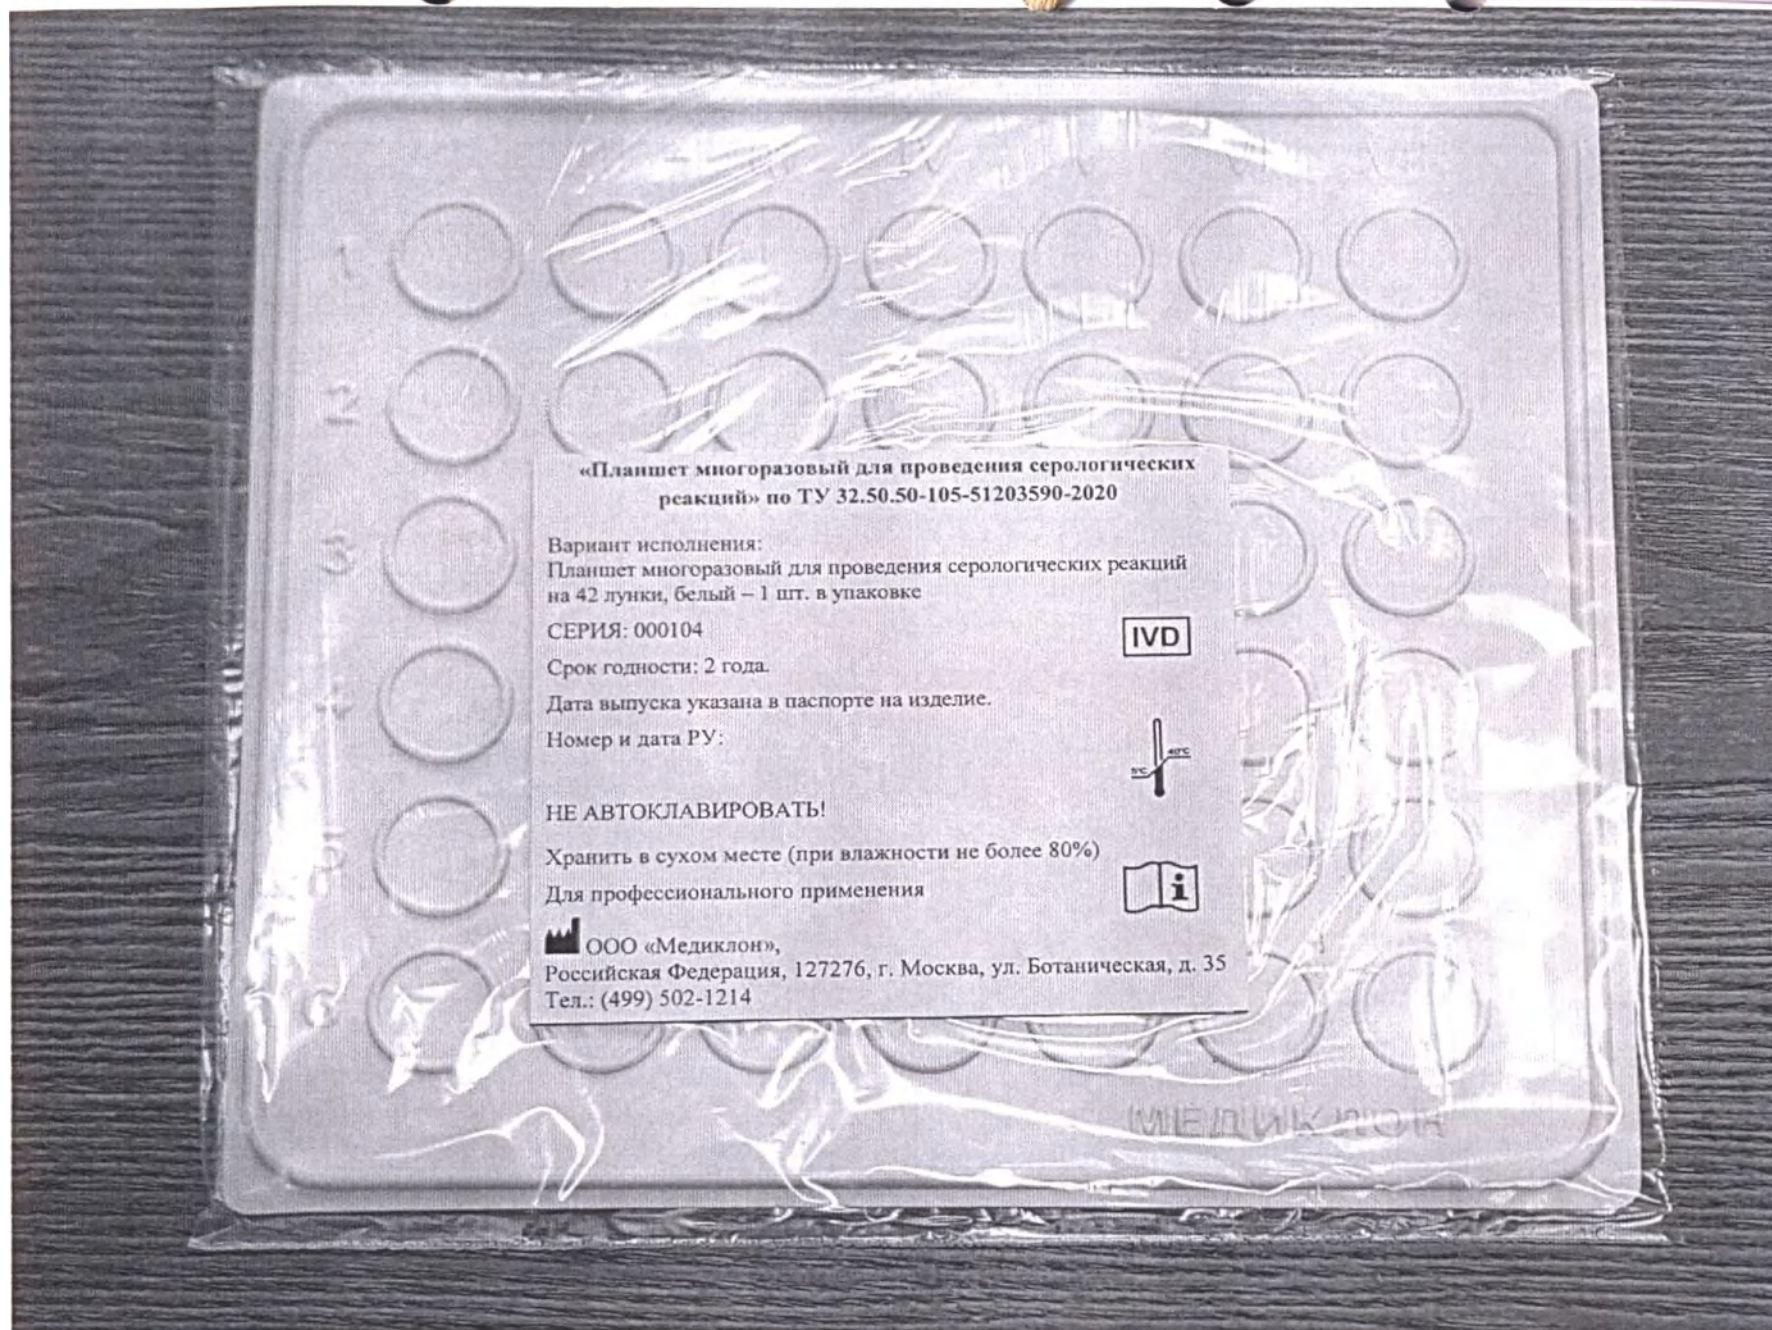

Фотографическое изображение 1. Планшет многоразовый для проведения серологических реакций на 42 лунки, белый – 1 шт. в упаковке

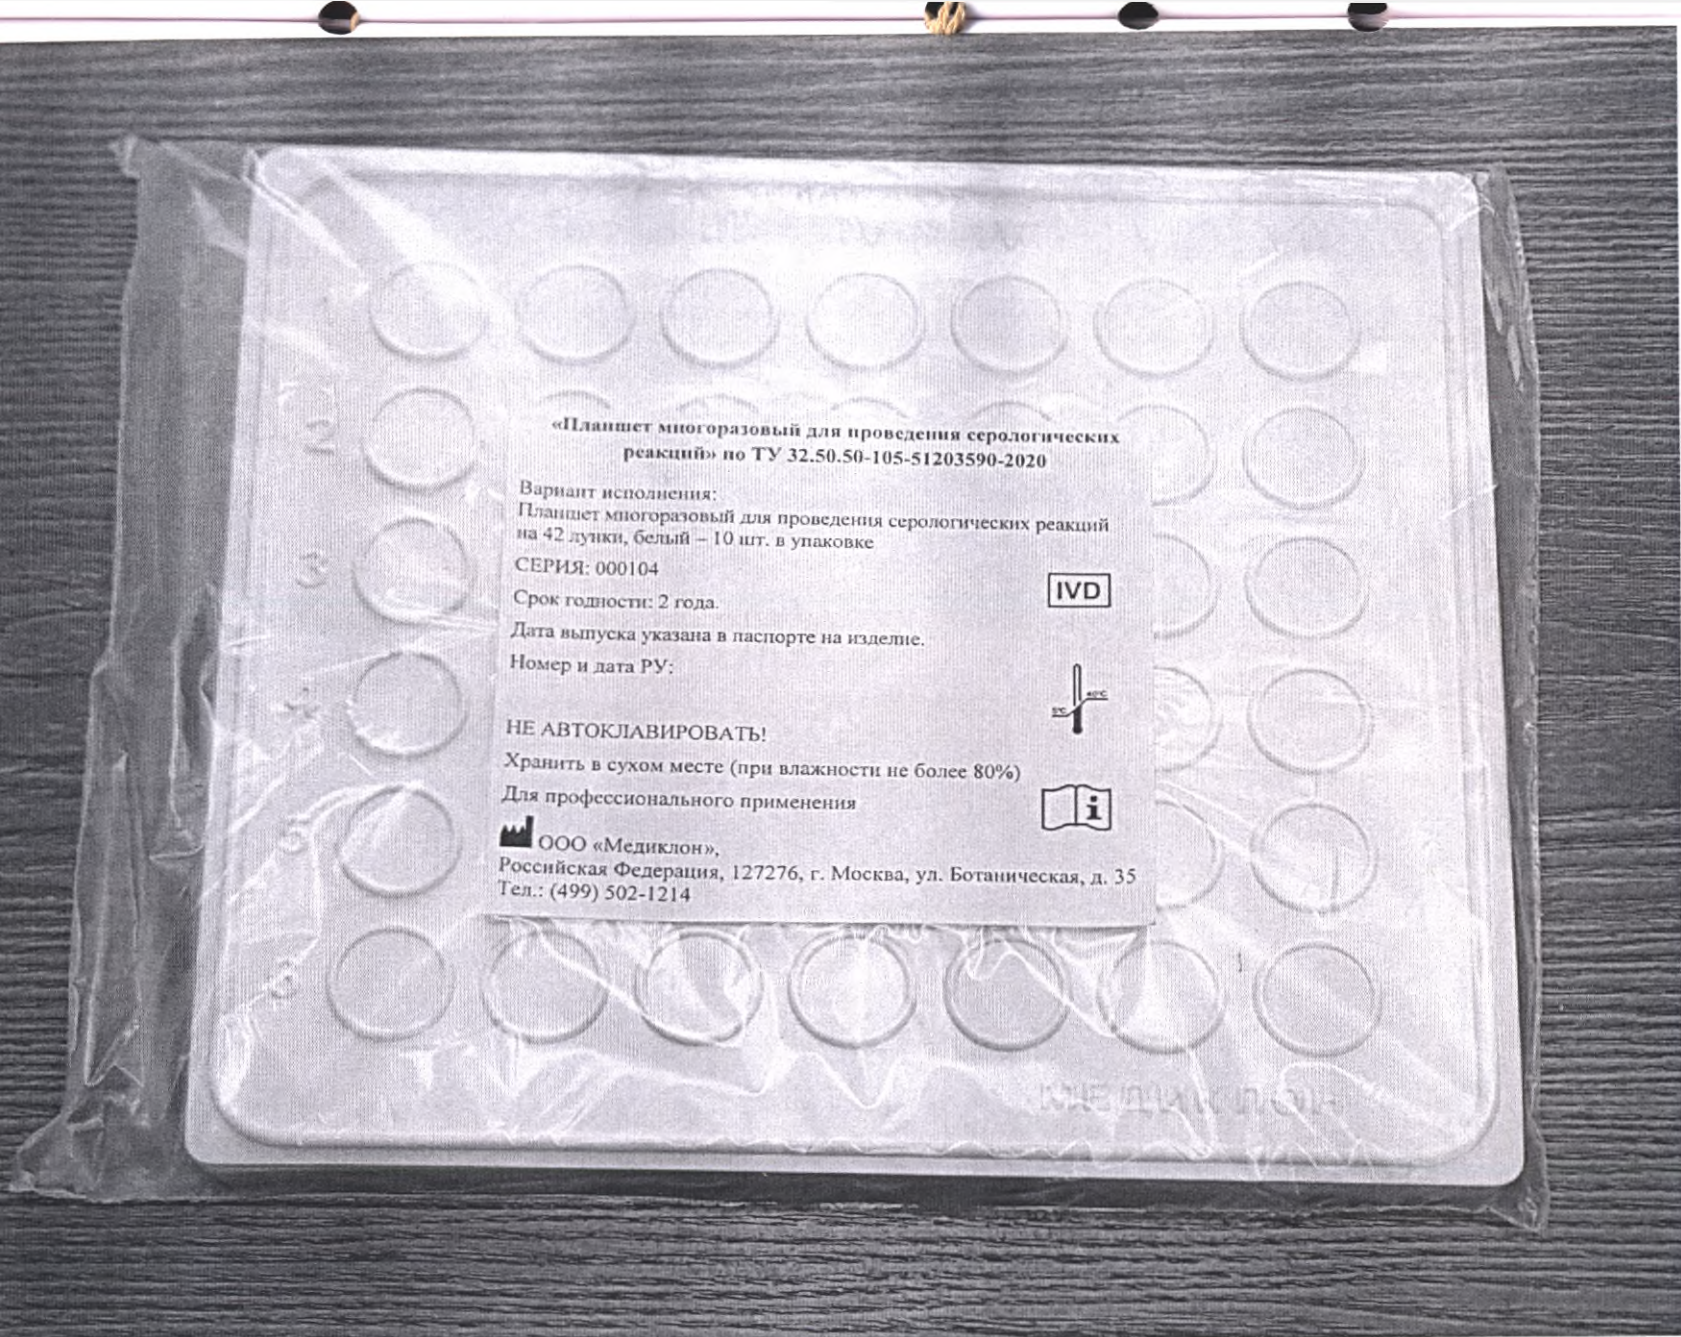

«Планшет многократный для проведения серологических реакций» по ТУ 32.50.50-105-51203590-2020

Вариант исполнения:

Планшет многократный для проведения серологических реакций на 42 лунки, белый – 10 шт. в упаковке

СЕРИЯ: 000104

Срок годности: 2 года.

Дата выпуска указана в паспорте на изделие.

Номер и дата РУ:

IVD



НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ!


Хранить в сухом месте (при влажности не более 80%)

Для профессионального применения




ООО «Медиклон»,
Российская Федерация, 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 35
Тел.: (499) 502-1214


Фотографическое изображение 2. Планшет многократный для проведения серологических реакций на 42 лунки, белый – 10 шт. в упаковке

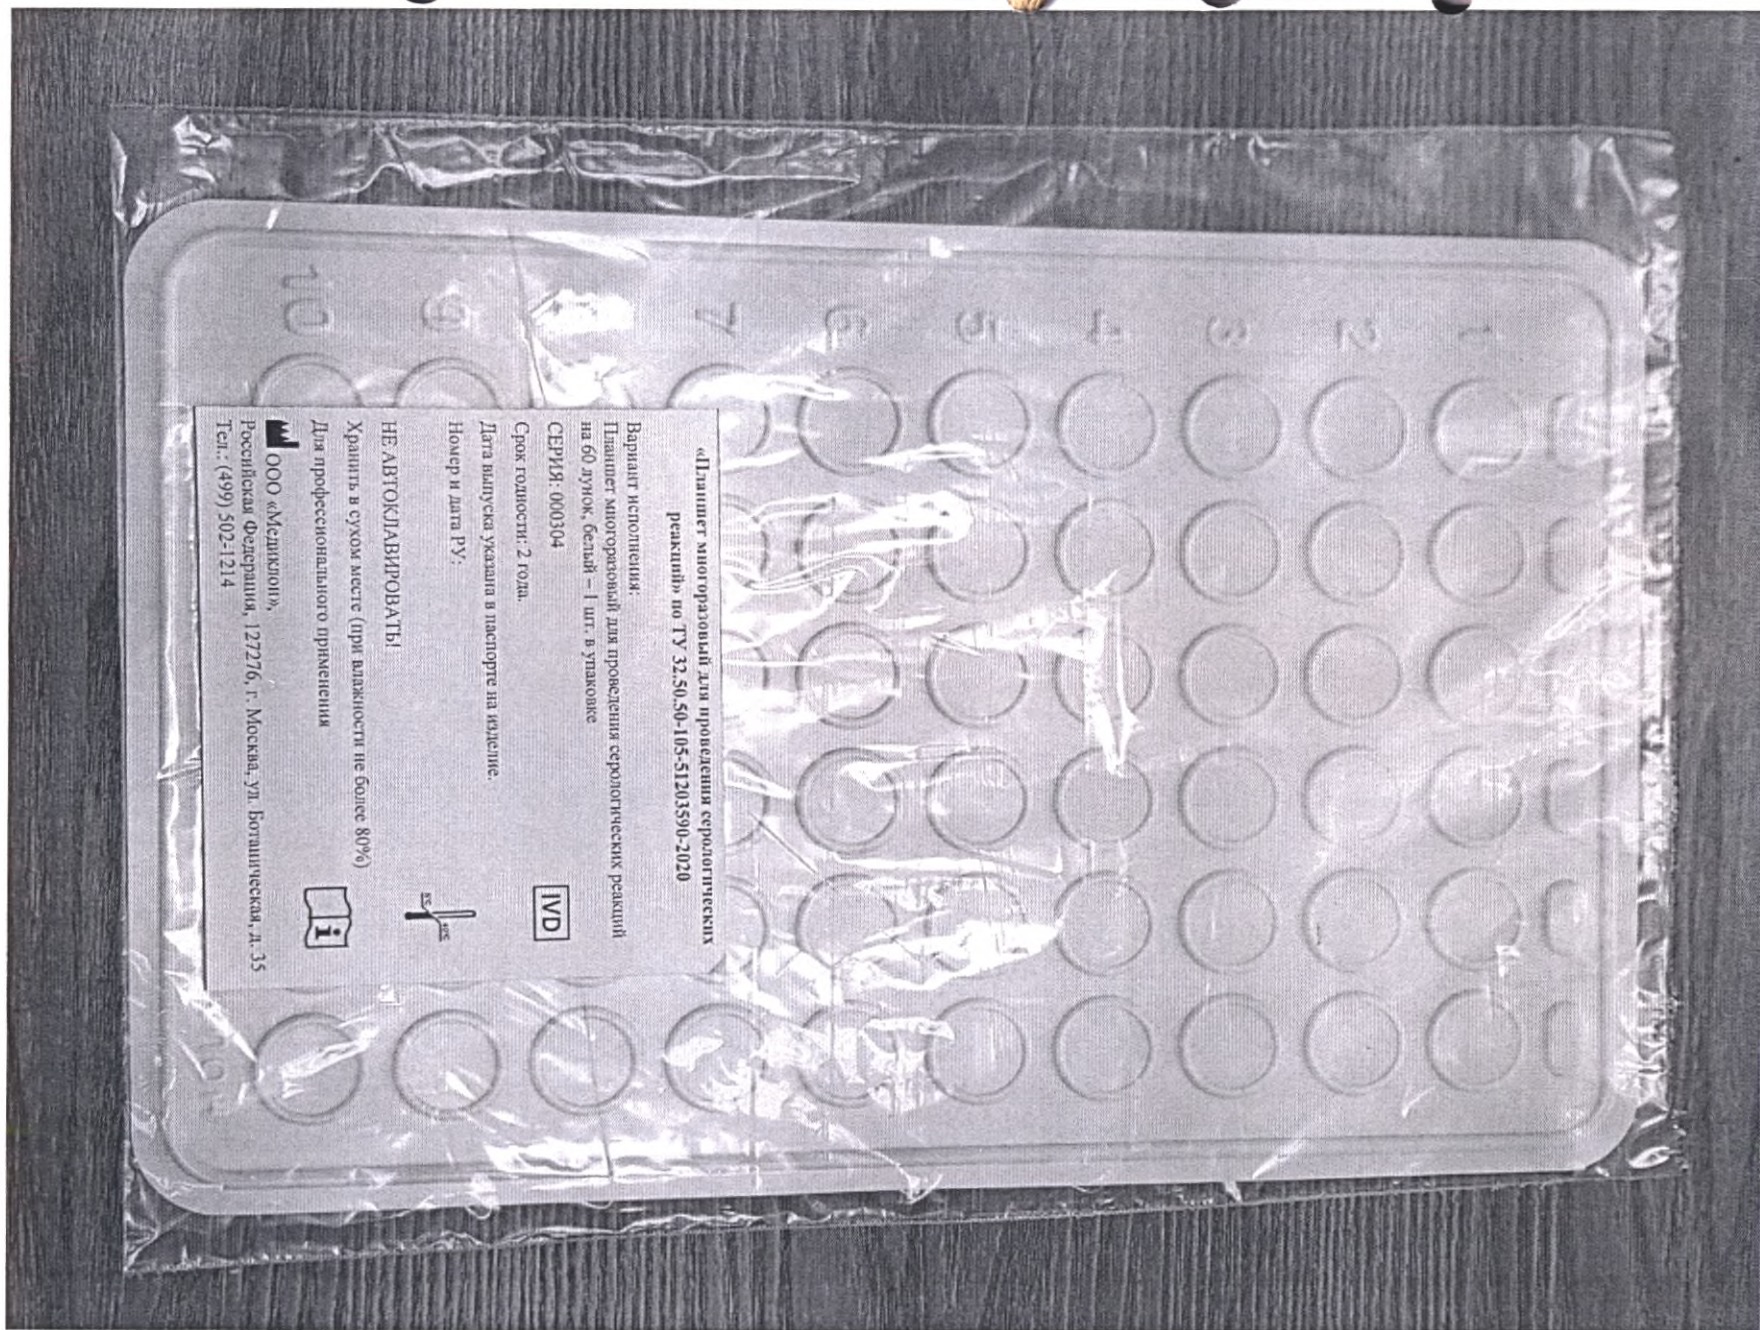

Фотографическое изображение 3. Планшет многоцветный для проведения серологических реакций на 60 лунок, белый – 1 шт. в упаковке

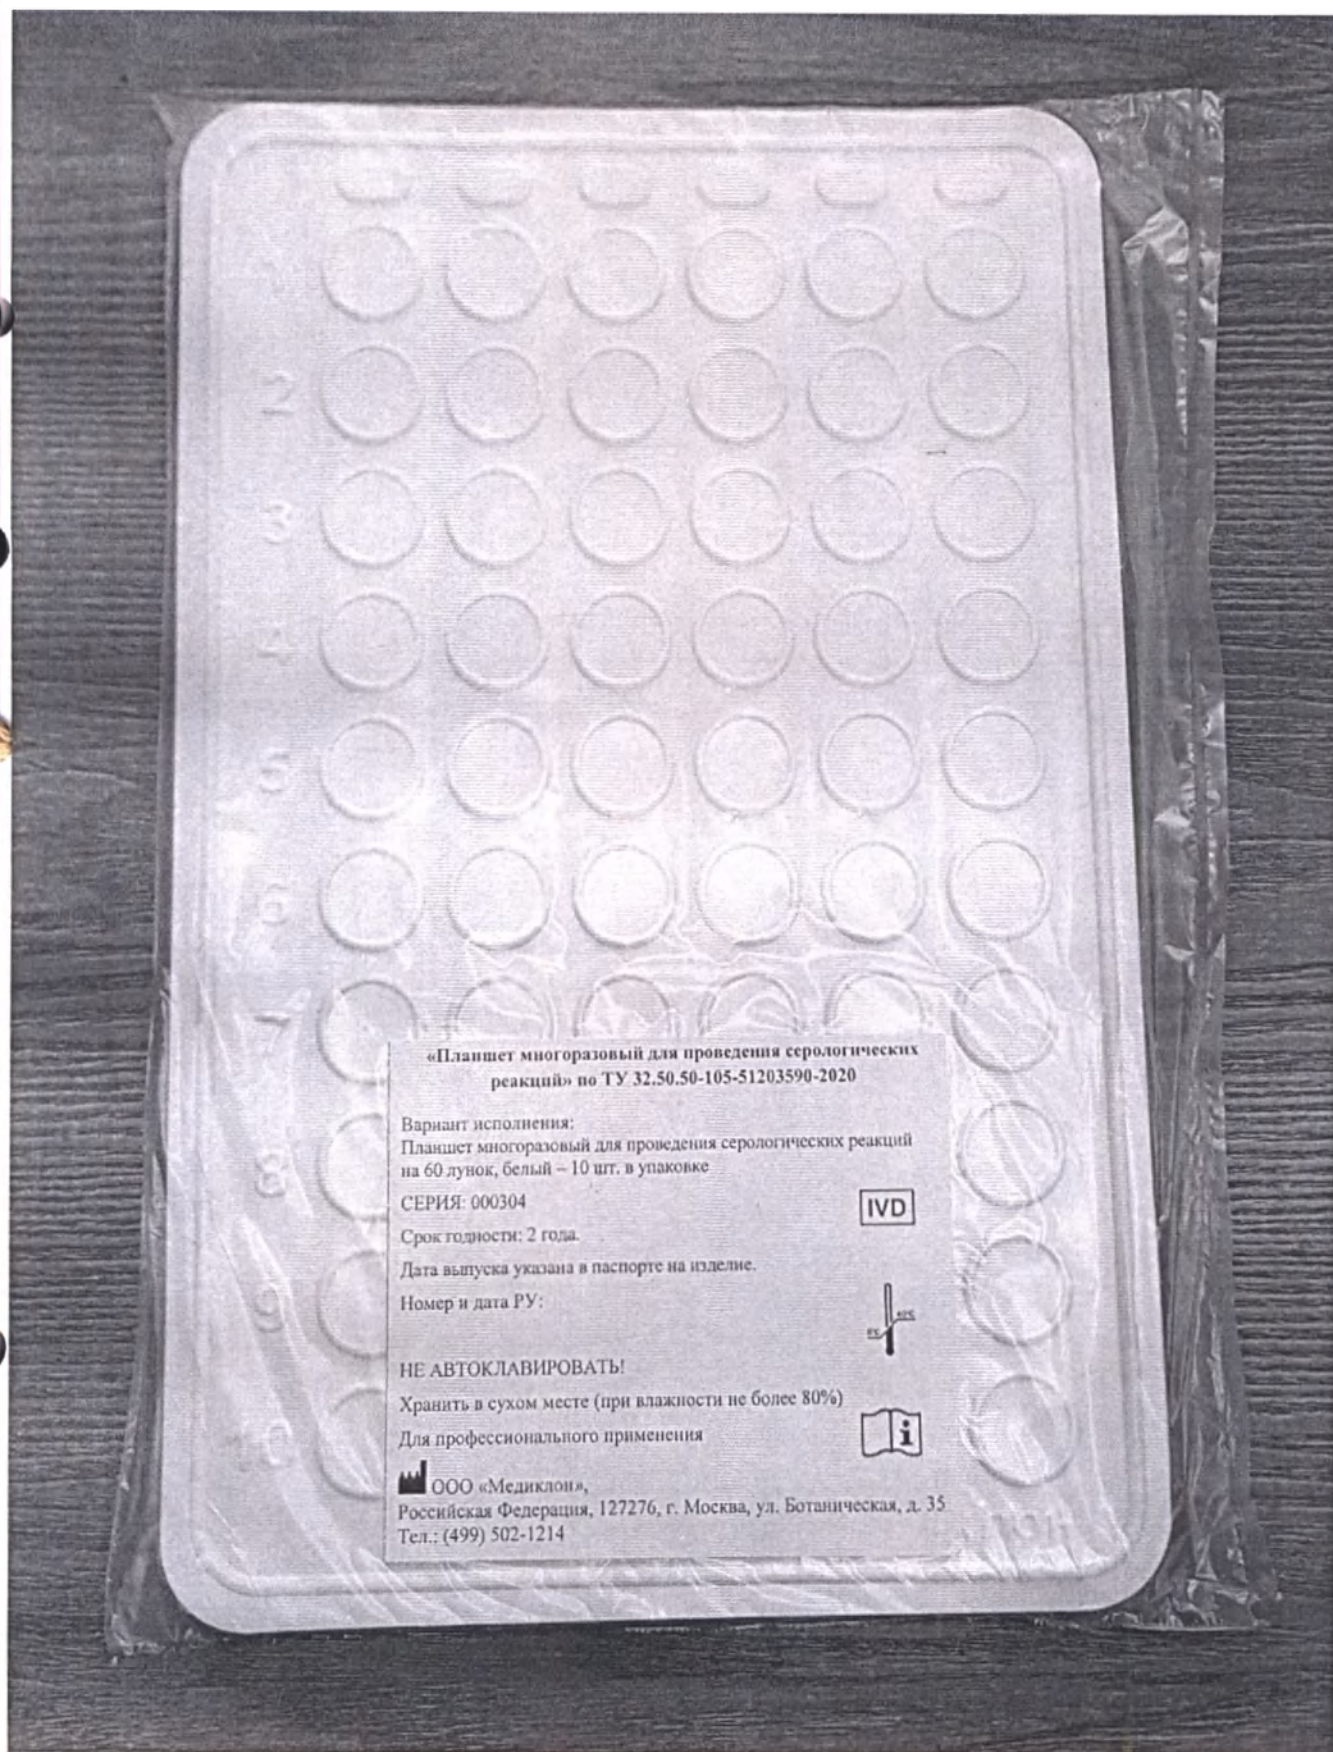

Фотографическое изображение 4. Планшет многообразный для проведения серологических реакций на 60 лунок, белый – 10 шт. в упаковке

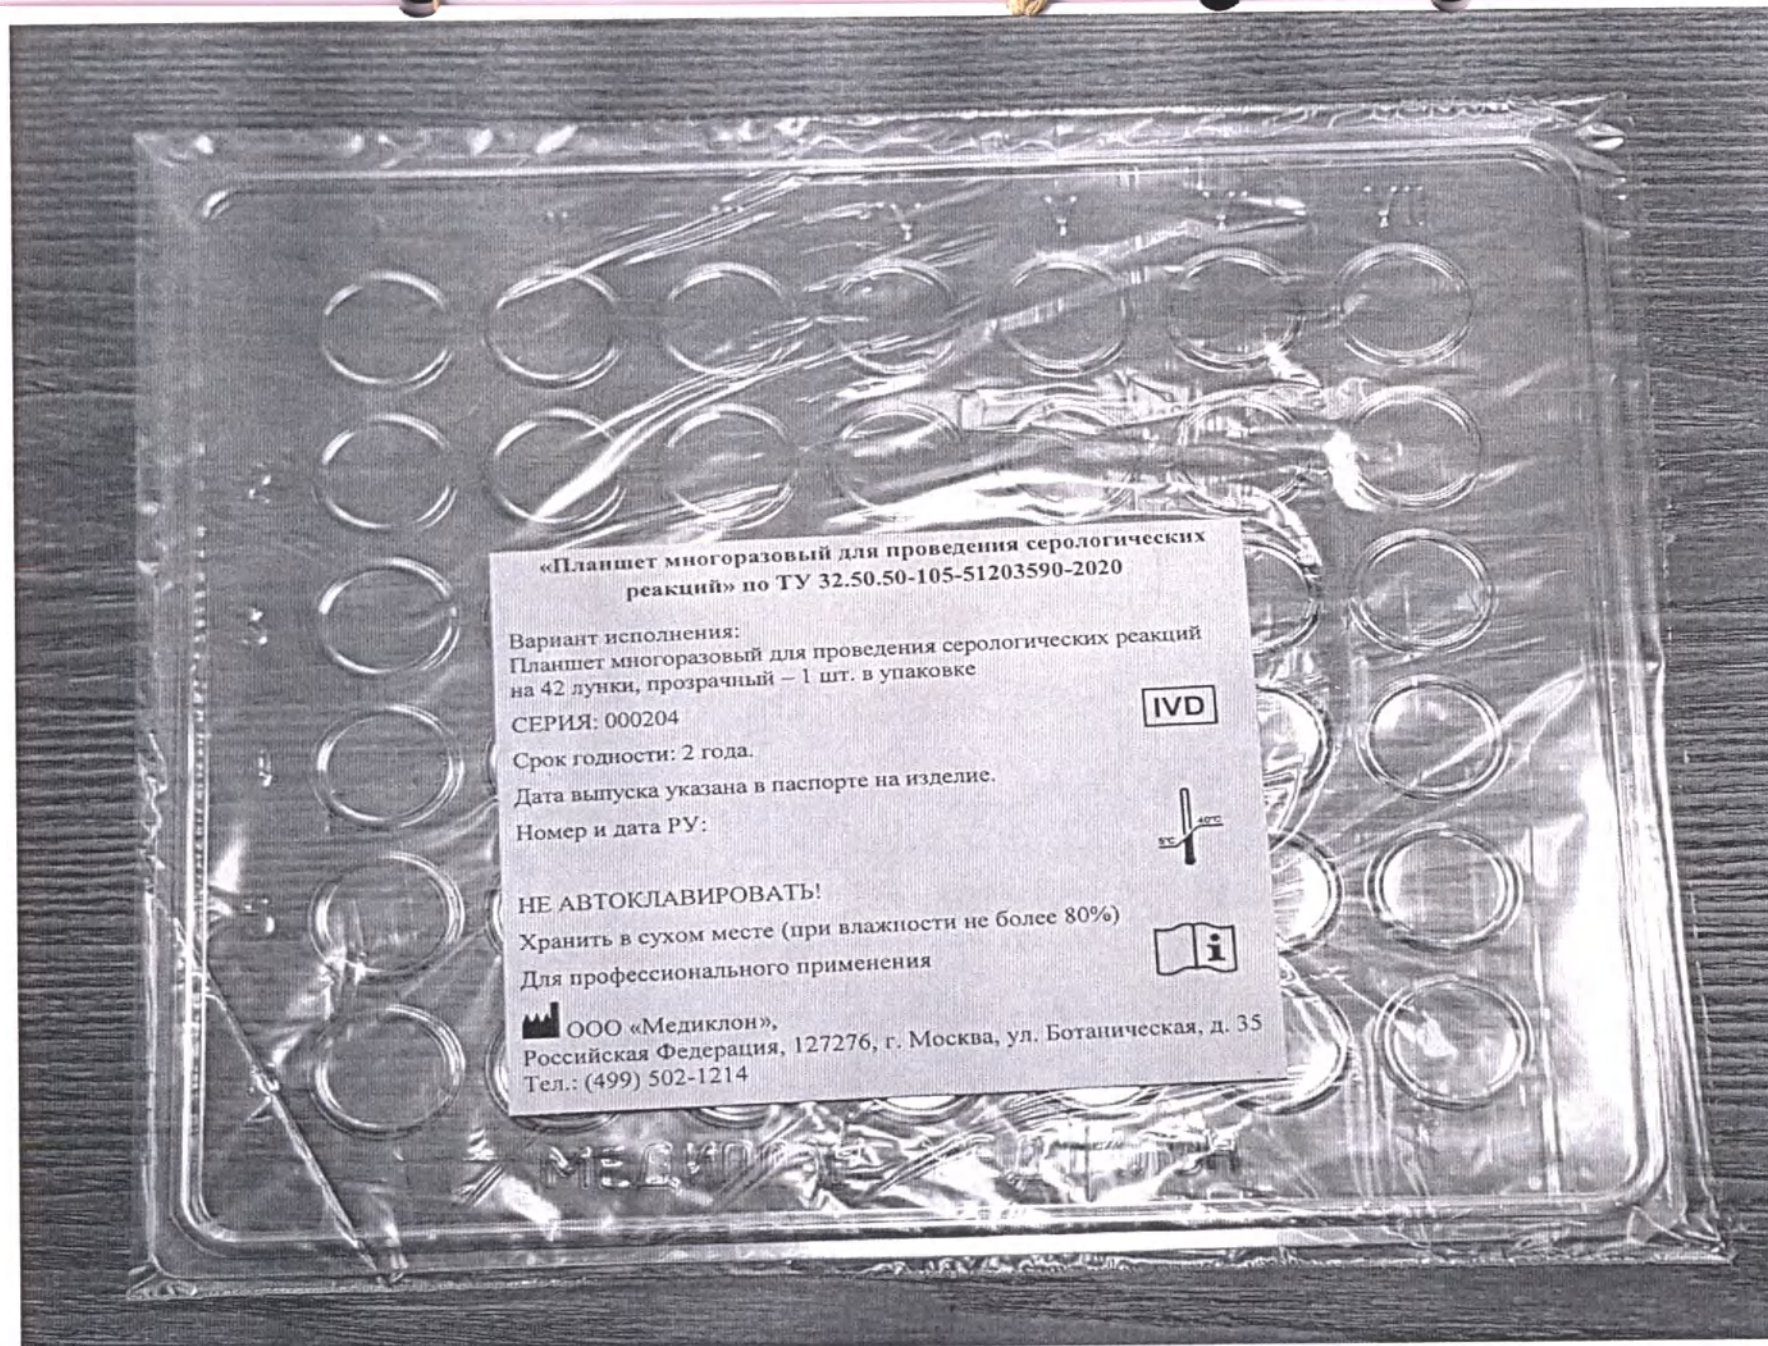

«Планшет многоразовый для проведения серологических реакций» по ТУ 32.50.50-105-51203590-2020

Вариант исполнения:
Планшет многоразовый для проведения серологических реакций
на 42 лунки, прозрачный – 1 шт. в упаковке
СЕРИЯ: 000204

Срок годности: 2 года.
Дата выпуска указана в паспорте на изделие.
Номер и дата РУ:


НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ!
Хранить в сухом месте (при влажности не более 80%)
Для профессионального применения

 ООО «Медиклон»,
Российская Федерация, 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 35
Тел.: (499) 502-1214


IVD



Фотографическое изображение 5. Планшет многоразовый для проведения серологических реакций на 42 лунки, прозрачный – 1 шт. в упаковке

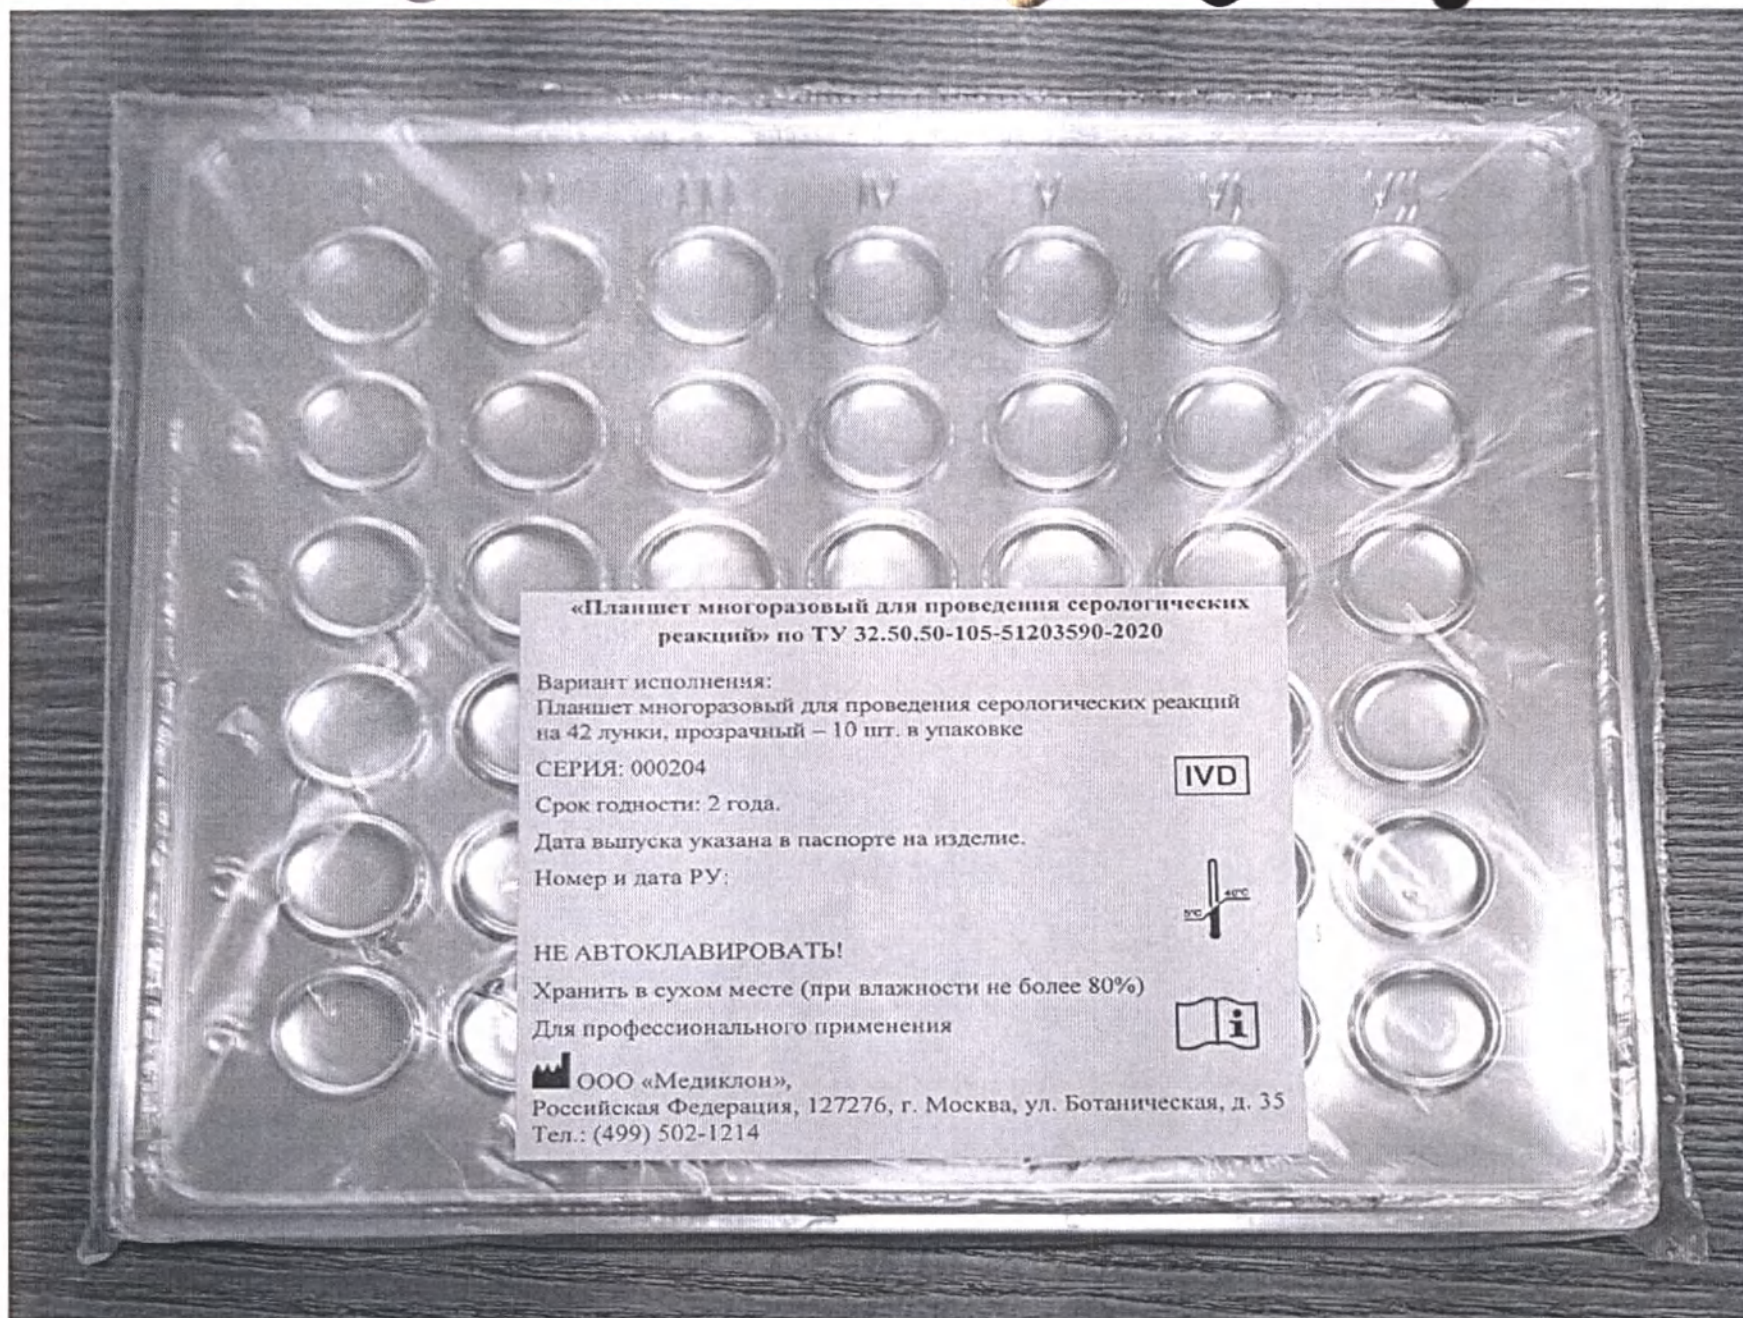

Фотографическое изображение 6. Планшет многоразовый для проведения серологических реакций на 42 лунки, прозрачный – 10 шт. в упаковке

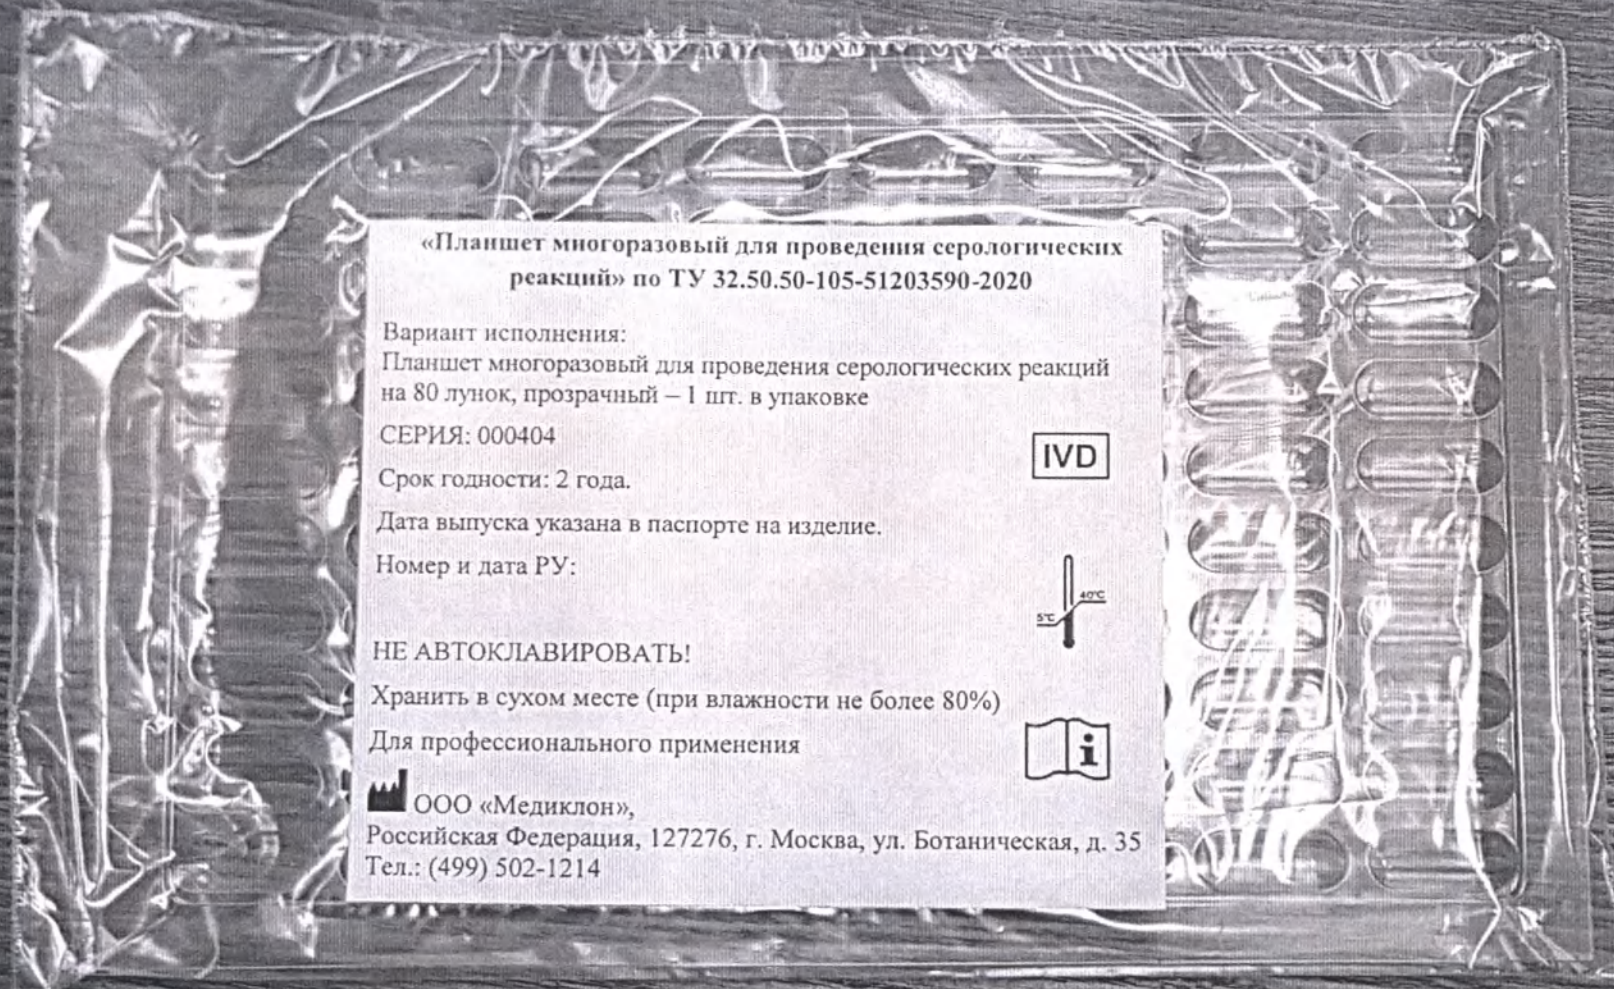

«Планшет многоразовый для проведения серологических реакций» по ТУ 32.50.50-105-51203590-2020

Вариант исполнения:

Планшет многоразовый для проведения серологических реакций на 80 лунок, прозрачный – 1 шт. в упаковке

СЕРИЯ: 000404

Срок годности: 2 года.

Дата выпуска указана в паспорте на изделие.

Номер и дата РУ:

IVD



НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ!

Хранить в сухом месте (при влажности не более 80%)

Для профессионального применения



ООО «Медиклон»,

Российская Федерация, 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 35

Тел.: (499) 502-1214

Фотографическое изображение 7. Планшет многоразовый для проведения серологических реакций на 80 лунки, прозрачный – 1 шт. в упаковке

«Планшет многоразовый для проведения серологических реакций» по ТУ 32.50.50-105-51203590-2020

Вариант исполнения:

Планшет многоразовый для проведения серологических реакций на 80 лунок, прозрачный – 10 шт. в упаковке

СЕРИЯ: 000404

Срок годности: 2 года.

Дата выпуска указана в паспорте на изделие.

Номер и дата РУ:

НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ!

Хранить в сухом месте (при влажности не более 80%)

Для профессионального применения



ООО «Медиклон»,

Российская Федерация, 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 35

Тел.: (499) 502-1214

IVD



Фотографическое изображение 8. Планшет многоразовый для проведения серологических реакций на 80 лунки, прозрачный – 10 шт. в упаковке

Всего прошито
и пронумеровано



Виктор

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Н.А. Викторов".

Генеральный директор
ООО «Медиклон»
Викторов Н.А.