

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»

_____ Н.А. Горшкова
«22» июня 2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM
Calibrator A (Atellica IM CAL A))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

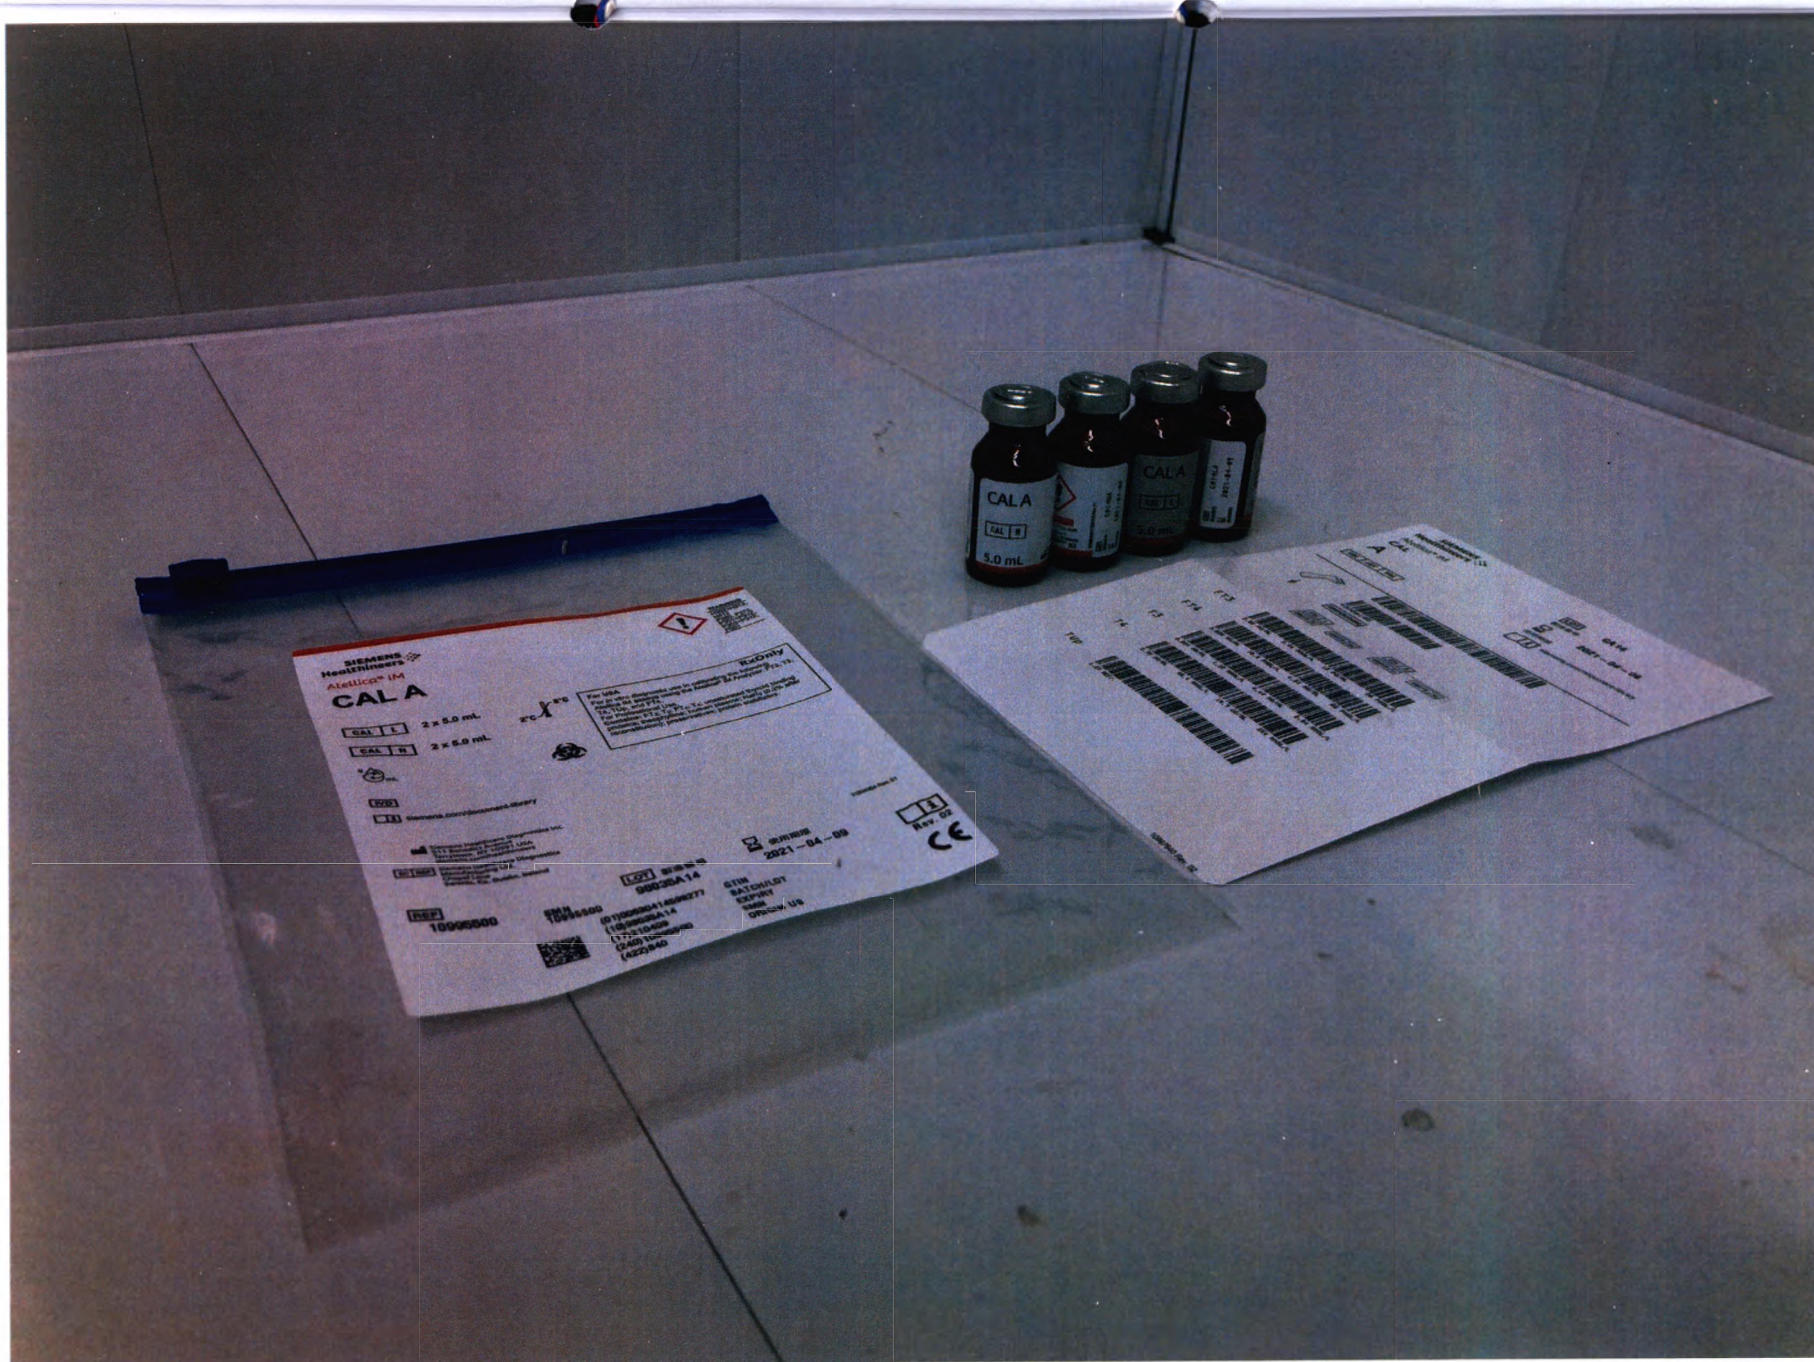


Рисунок 1. Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator A (Atellica IM CAL A)): Фасовка 2 упаковки. Общий вид

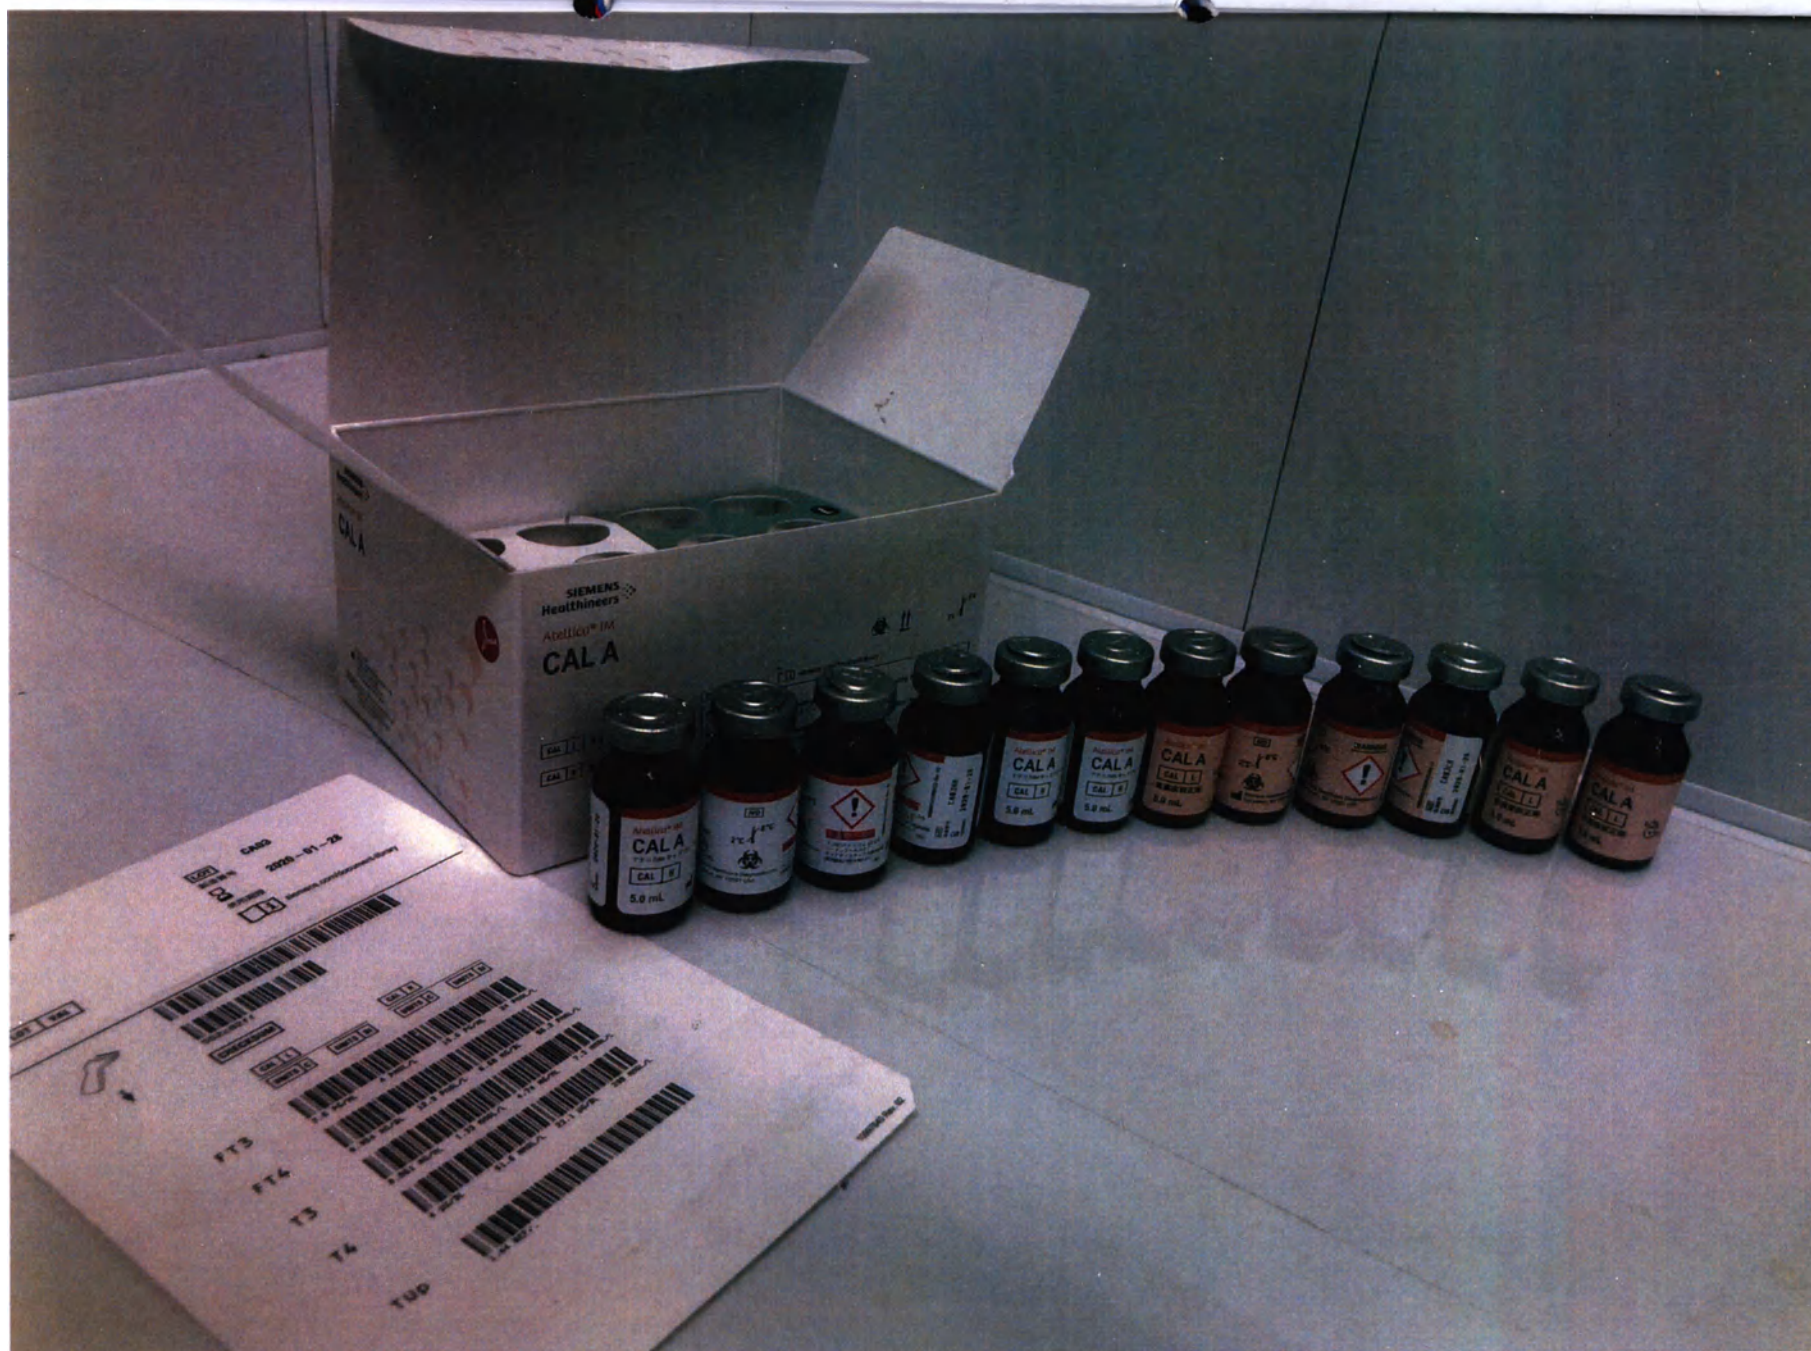


Рисунок 2. Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator A (Atellica IM CAL A)): Фасовка 6 упаковок. Общий вид

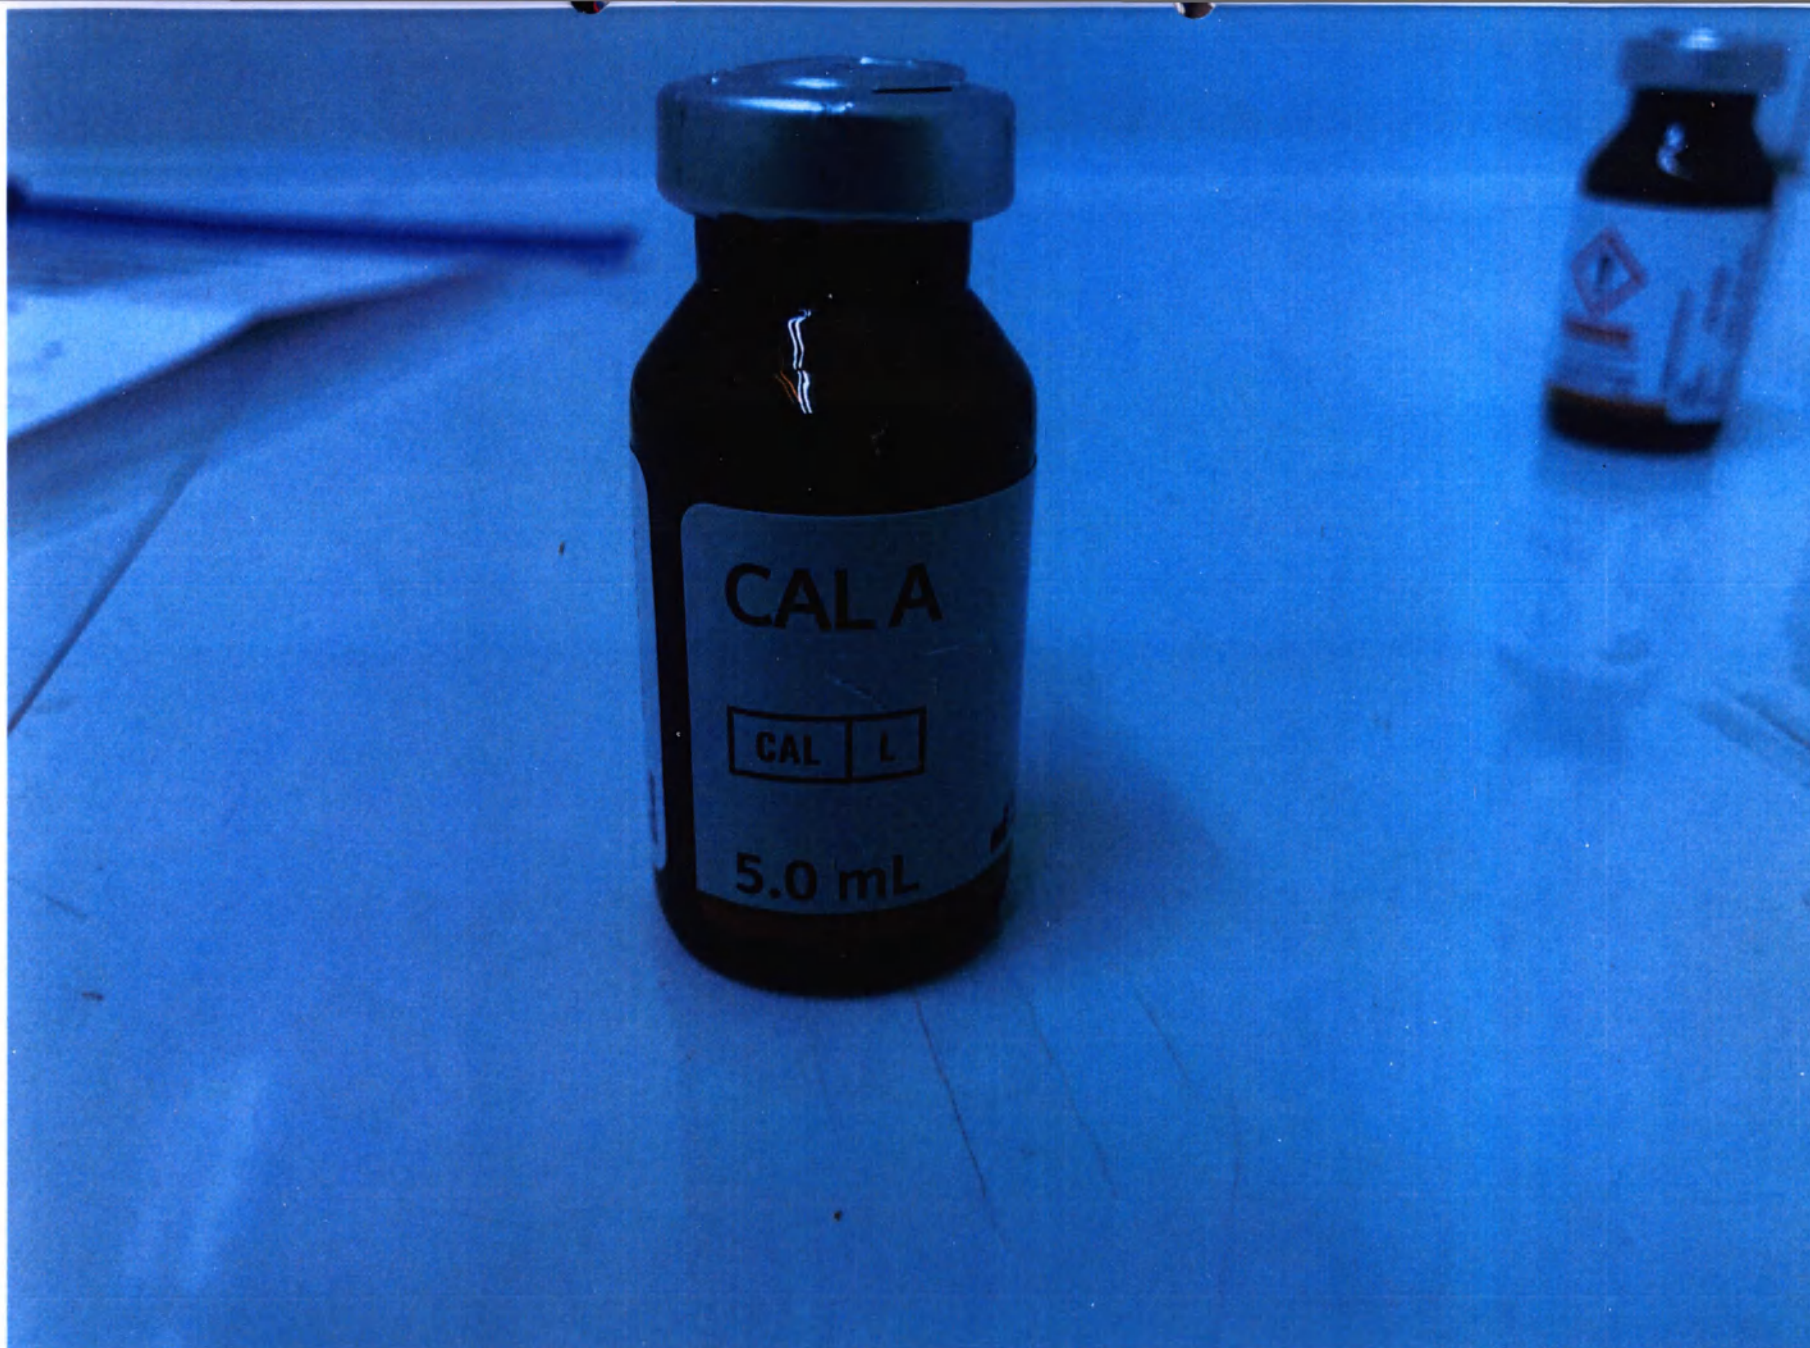


Рисунок 3. Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator A (Atellica IM CAL A)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CAL A L, 5,0 мл

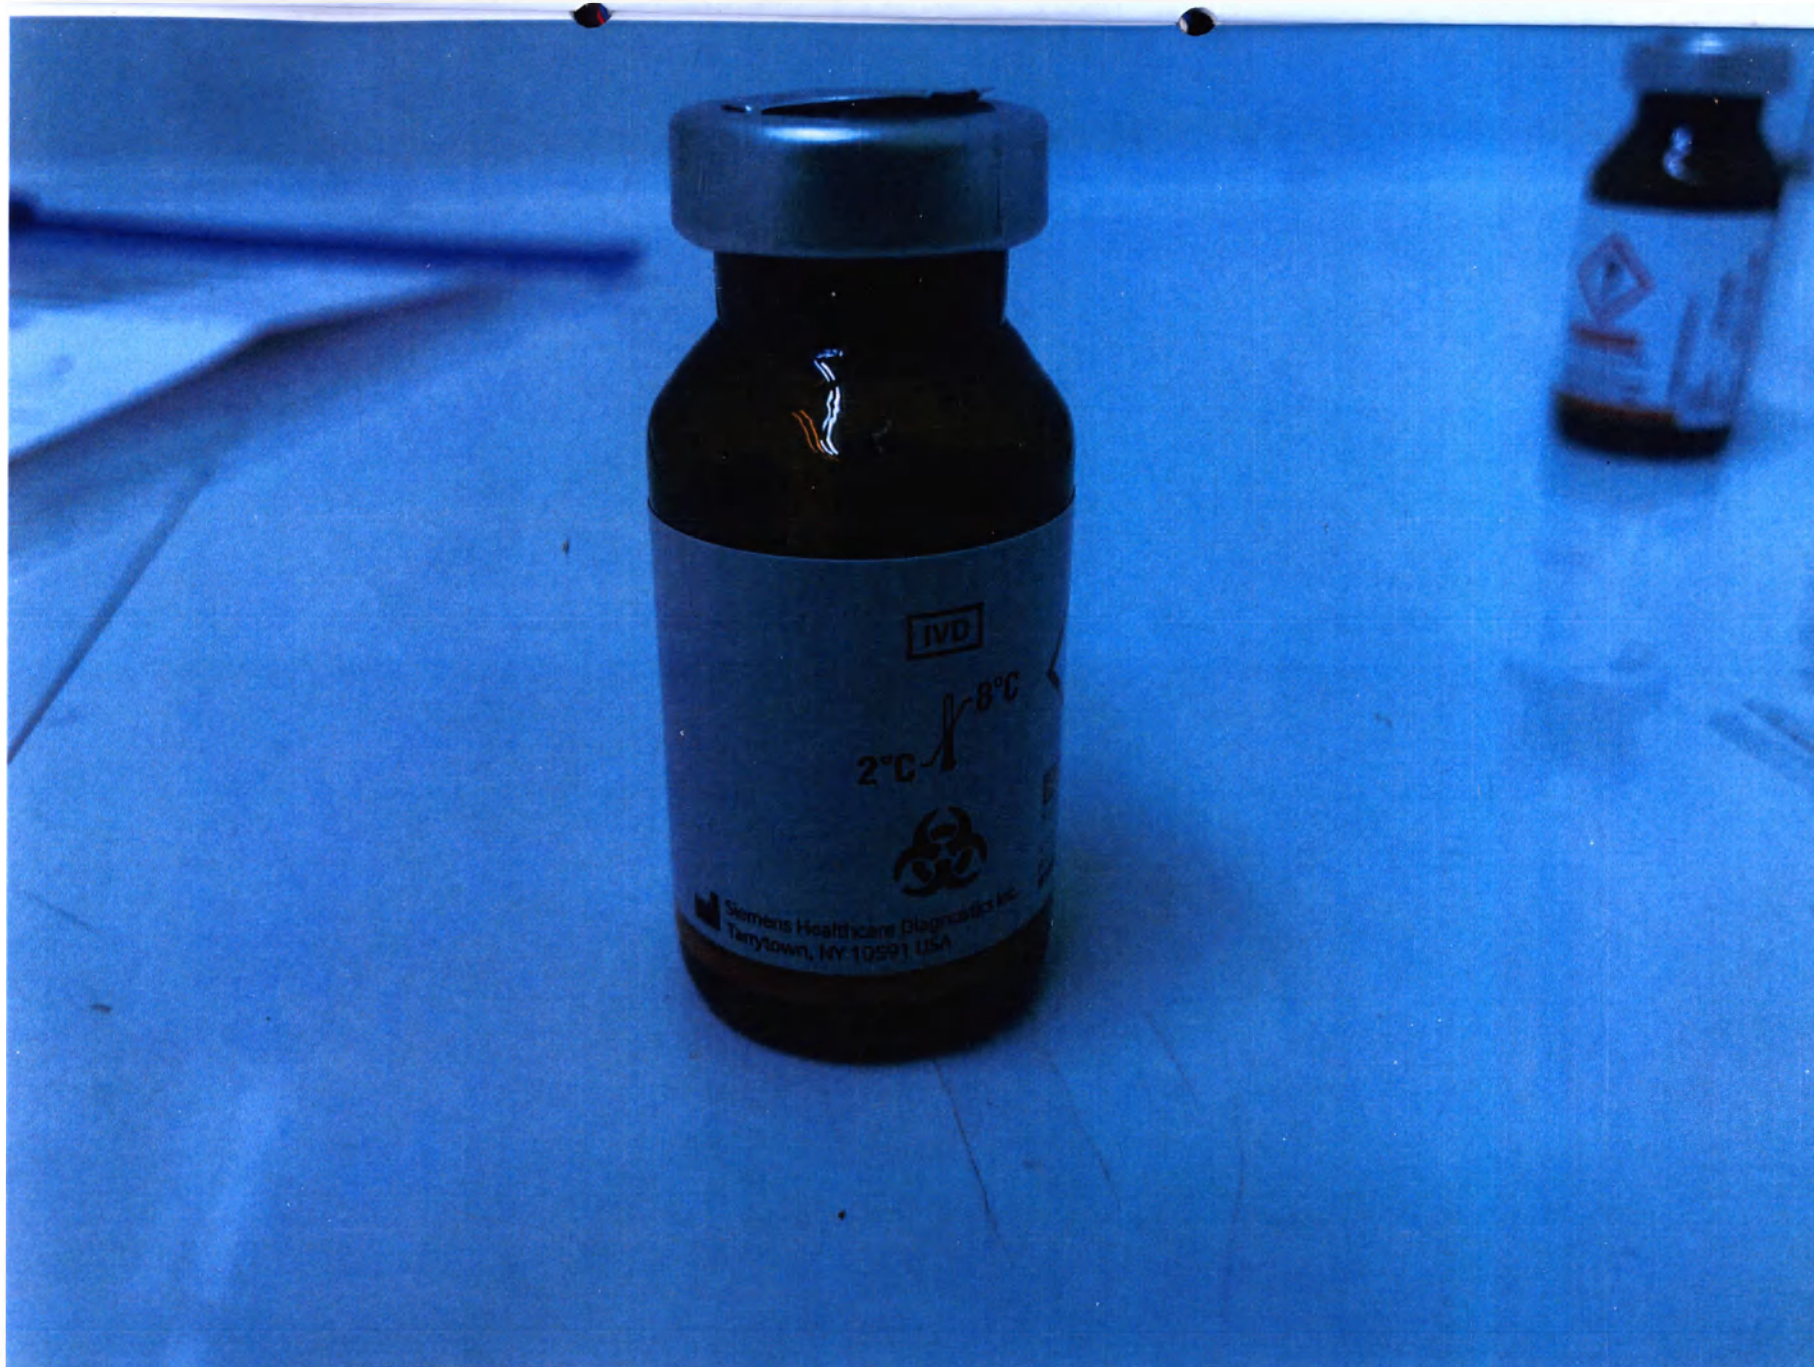


Рисунок 4. Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator A (Atellica IM CAL A)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CAL A 1 50 мЛ

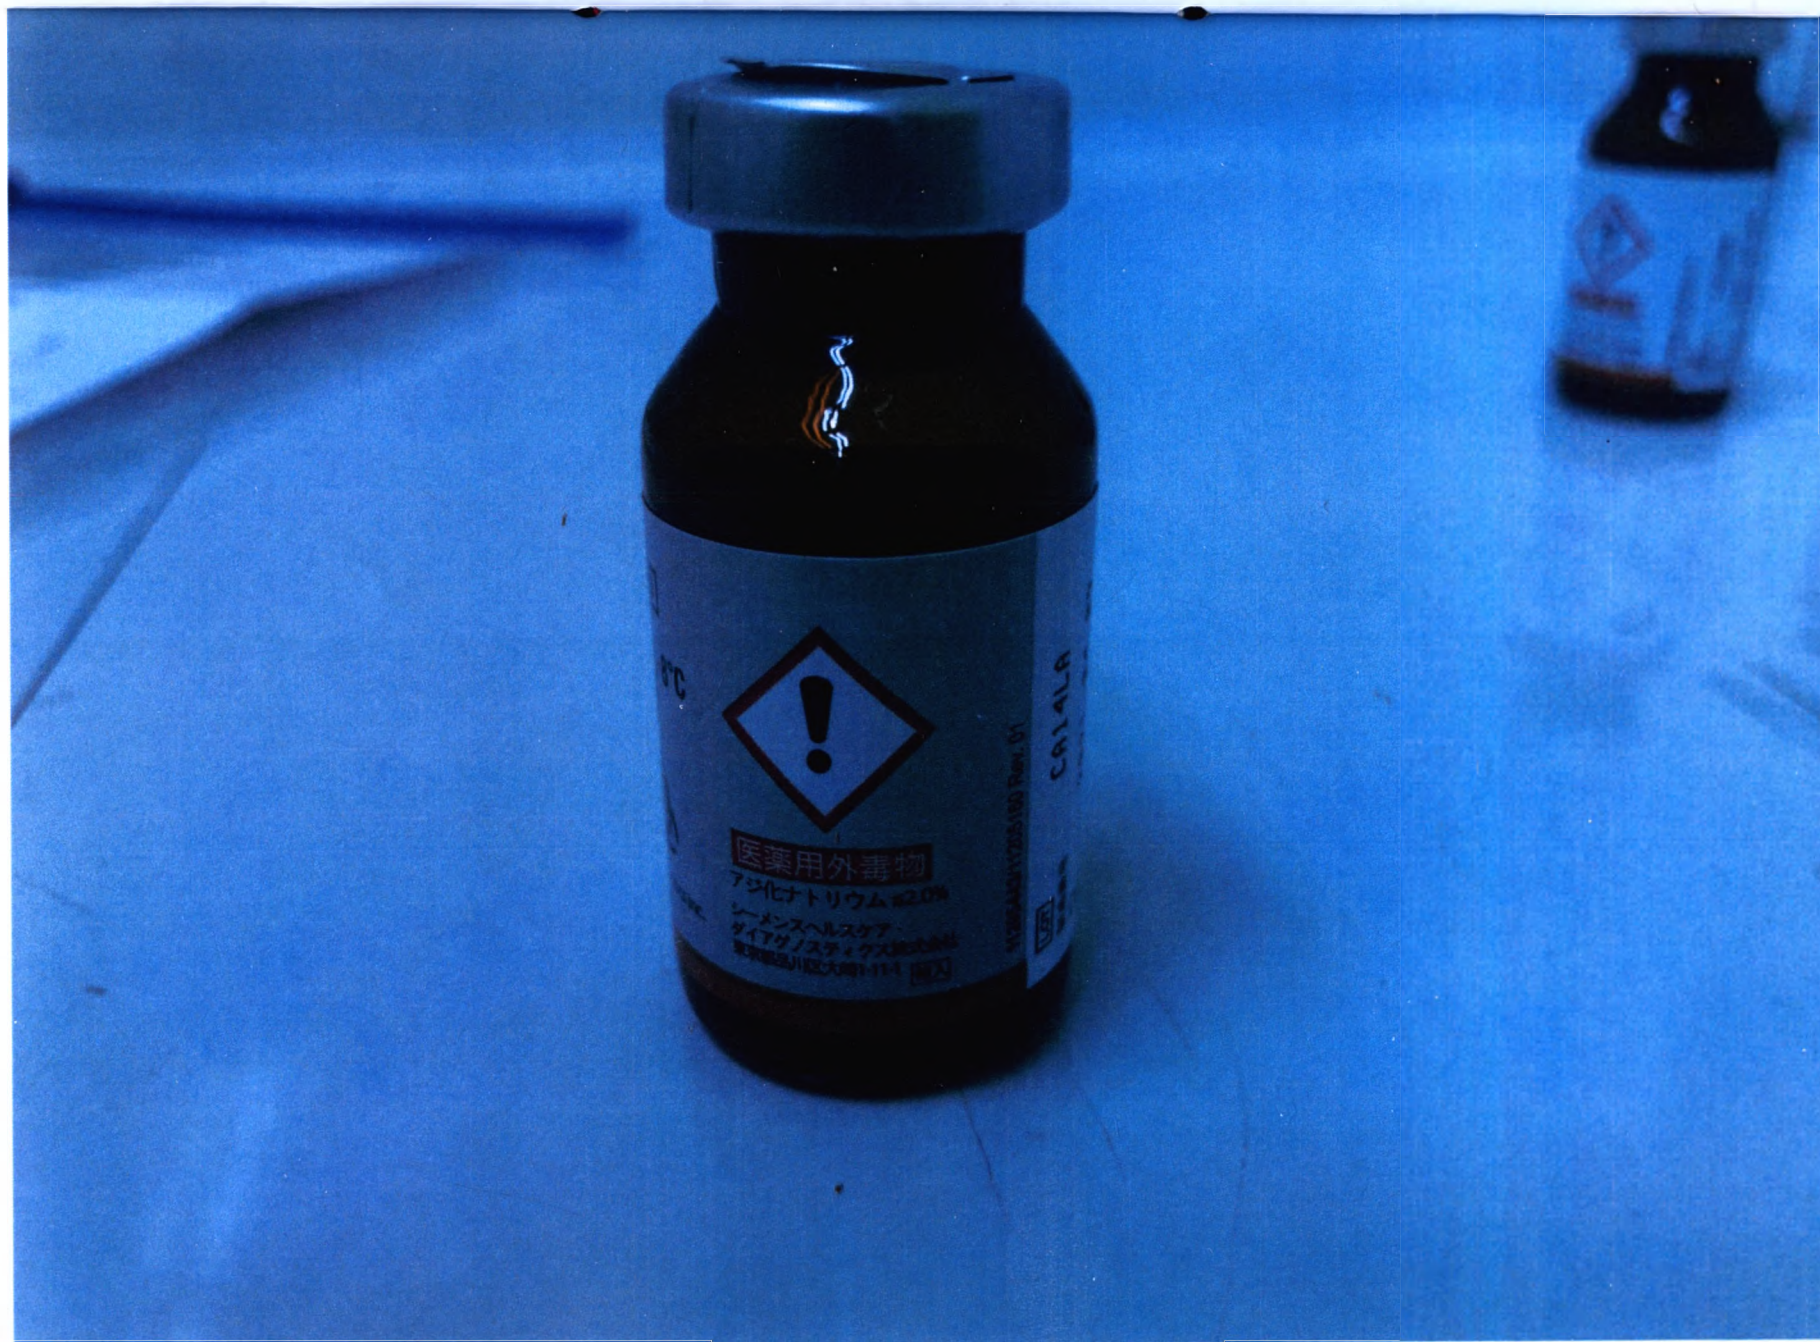


Рисунок 5. Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator A (Atellica IM CAL A)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CAL A L, 5,0 мл

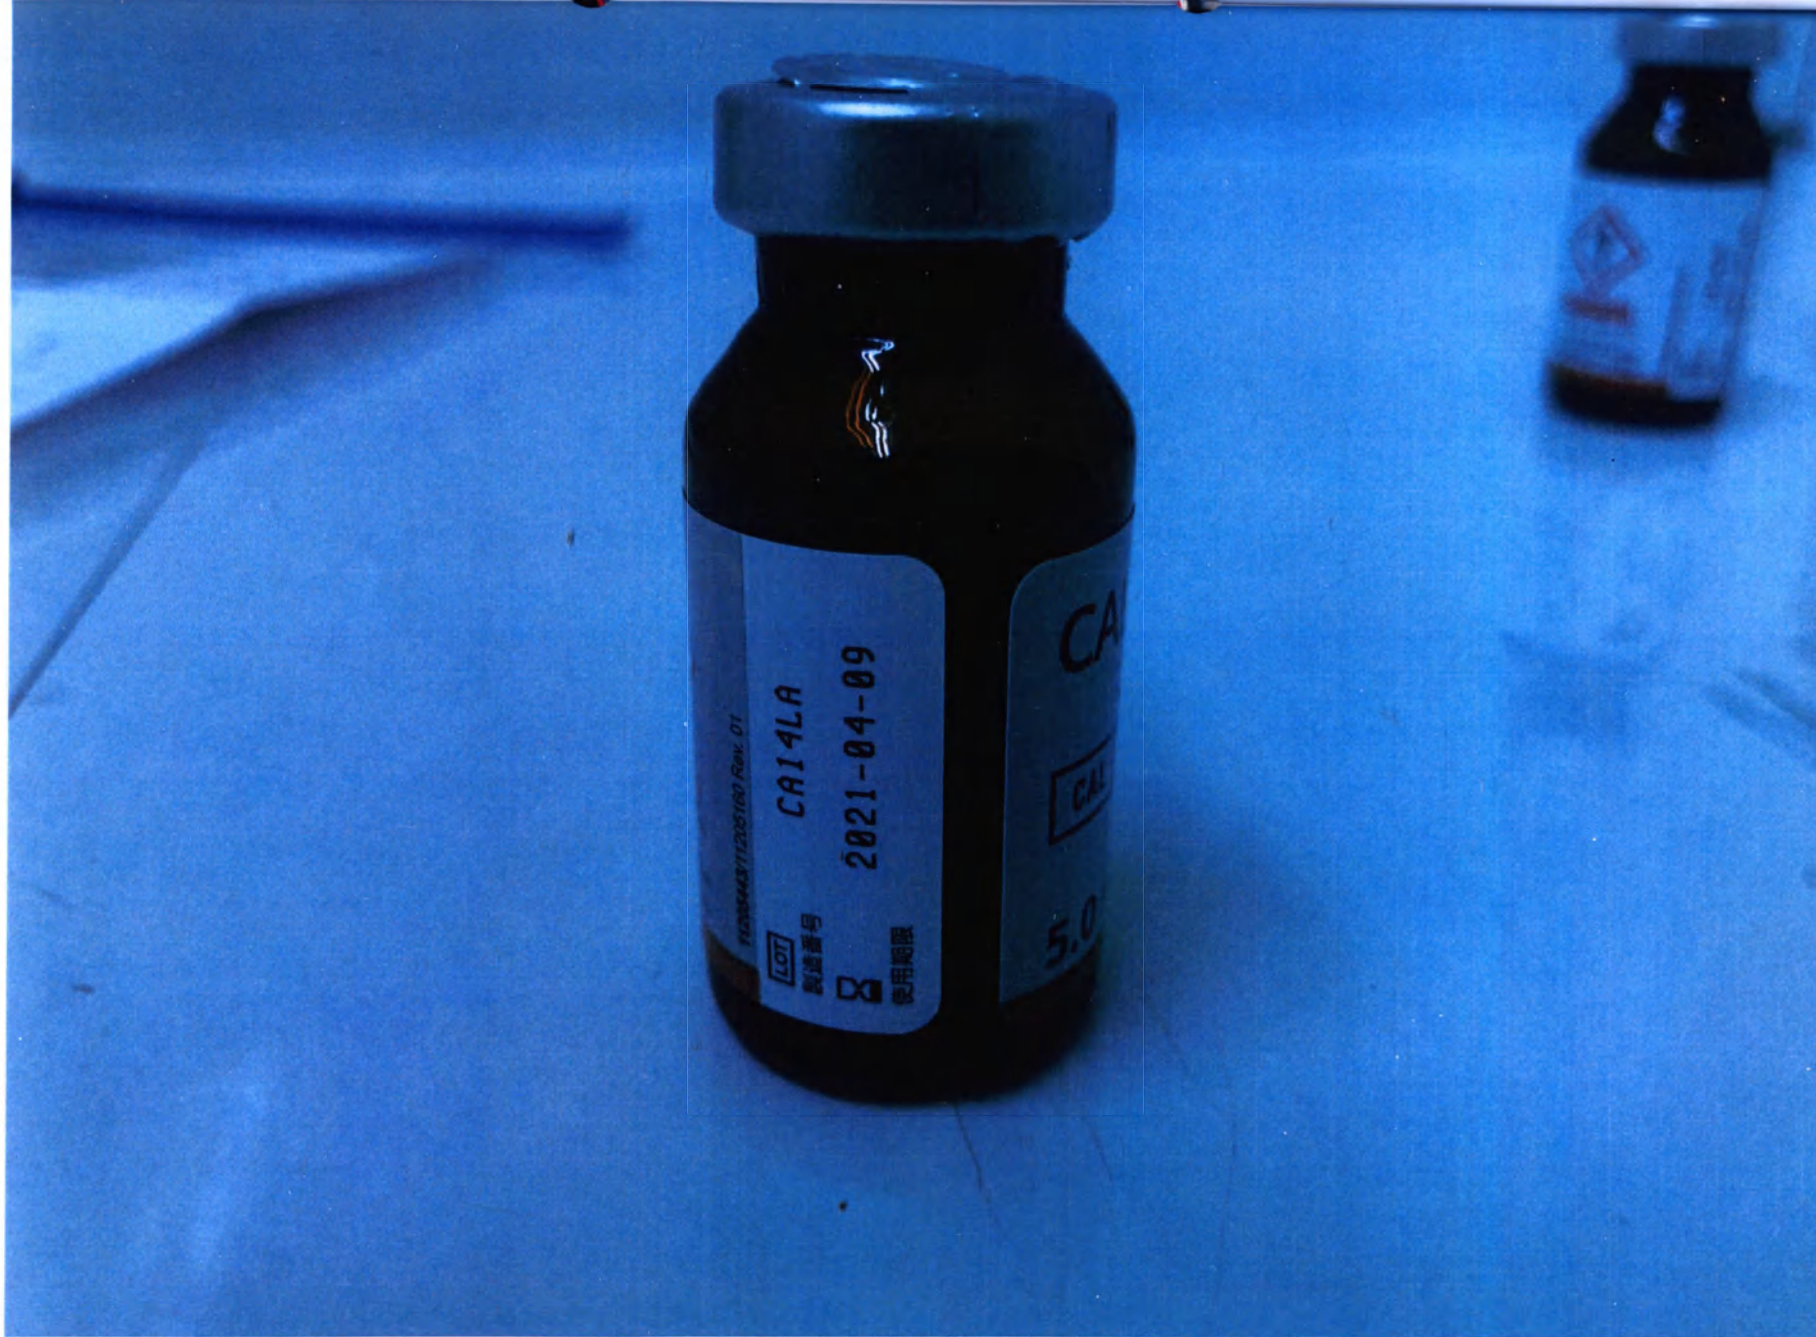


Рисунок 6. Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator A (Atellica IM CAL A)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CAL A L, 5,0 мл

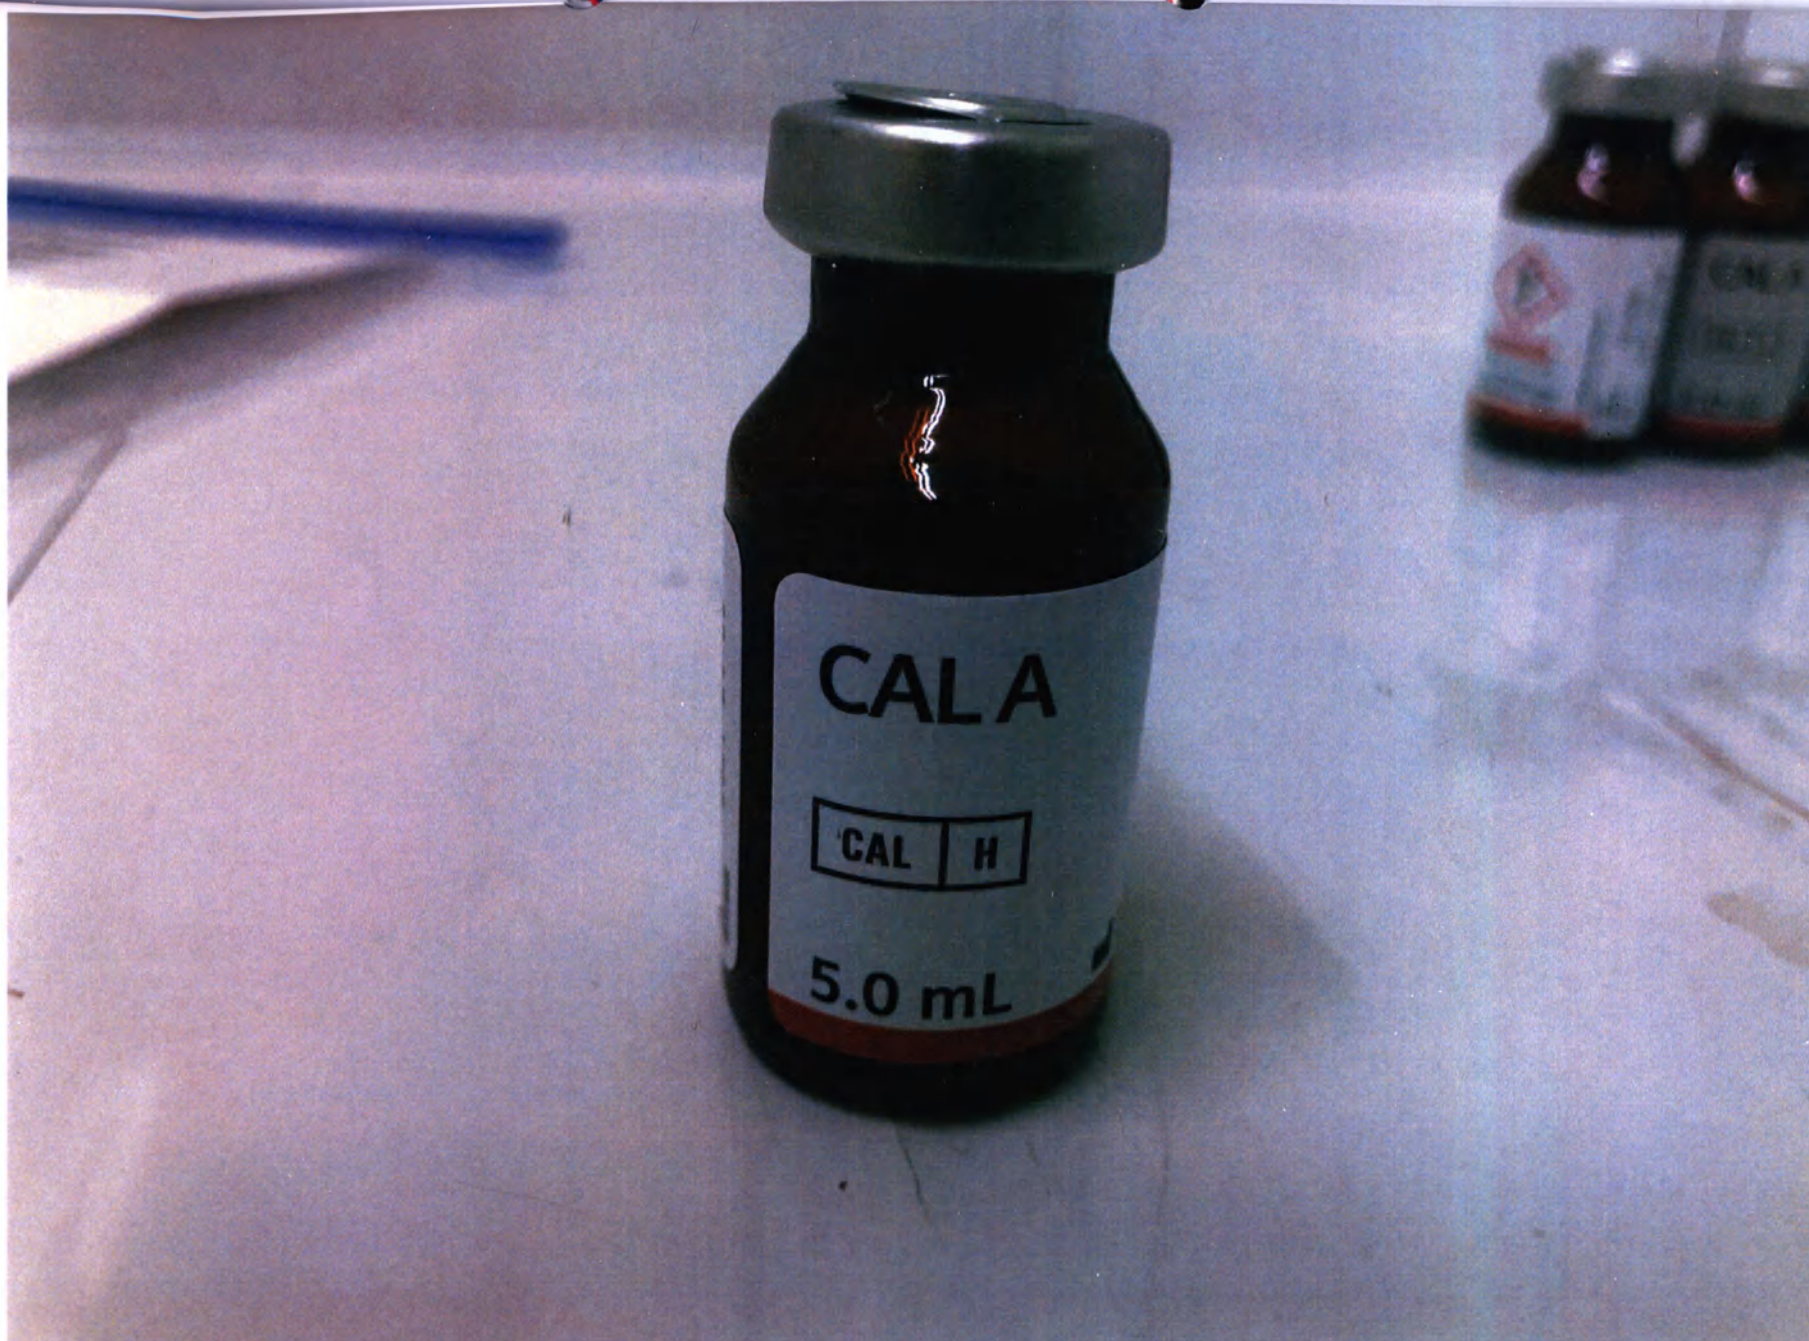


Рисунок 7. Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator A (Atellica IM CAL A)): Калибратор с высокой концентрацией

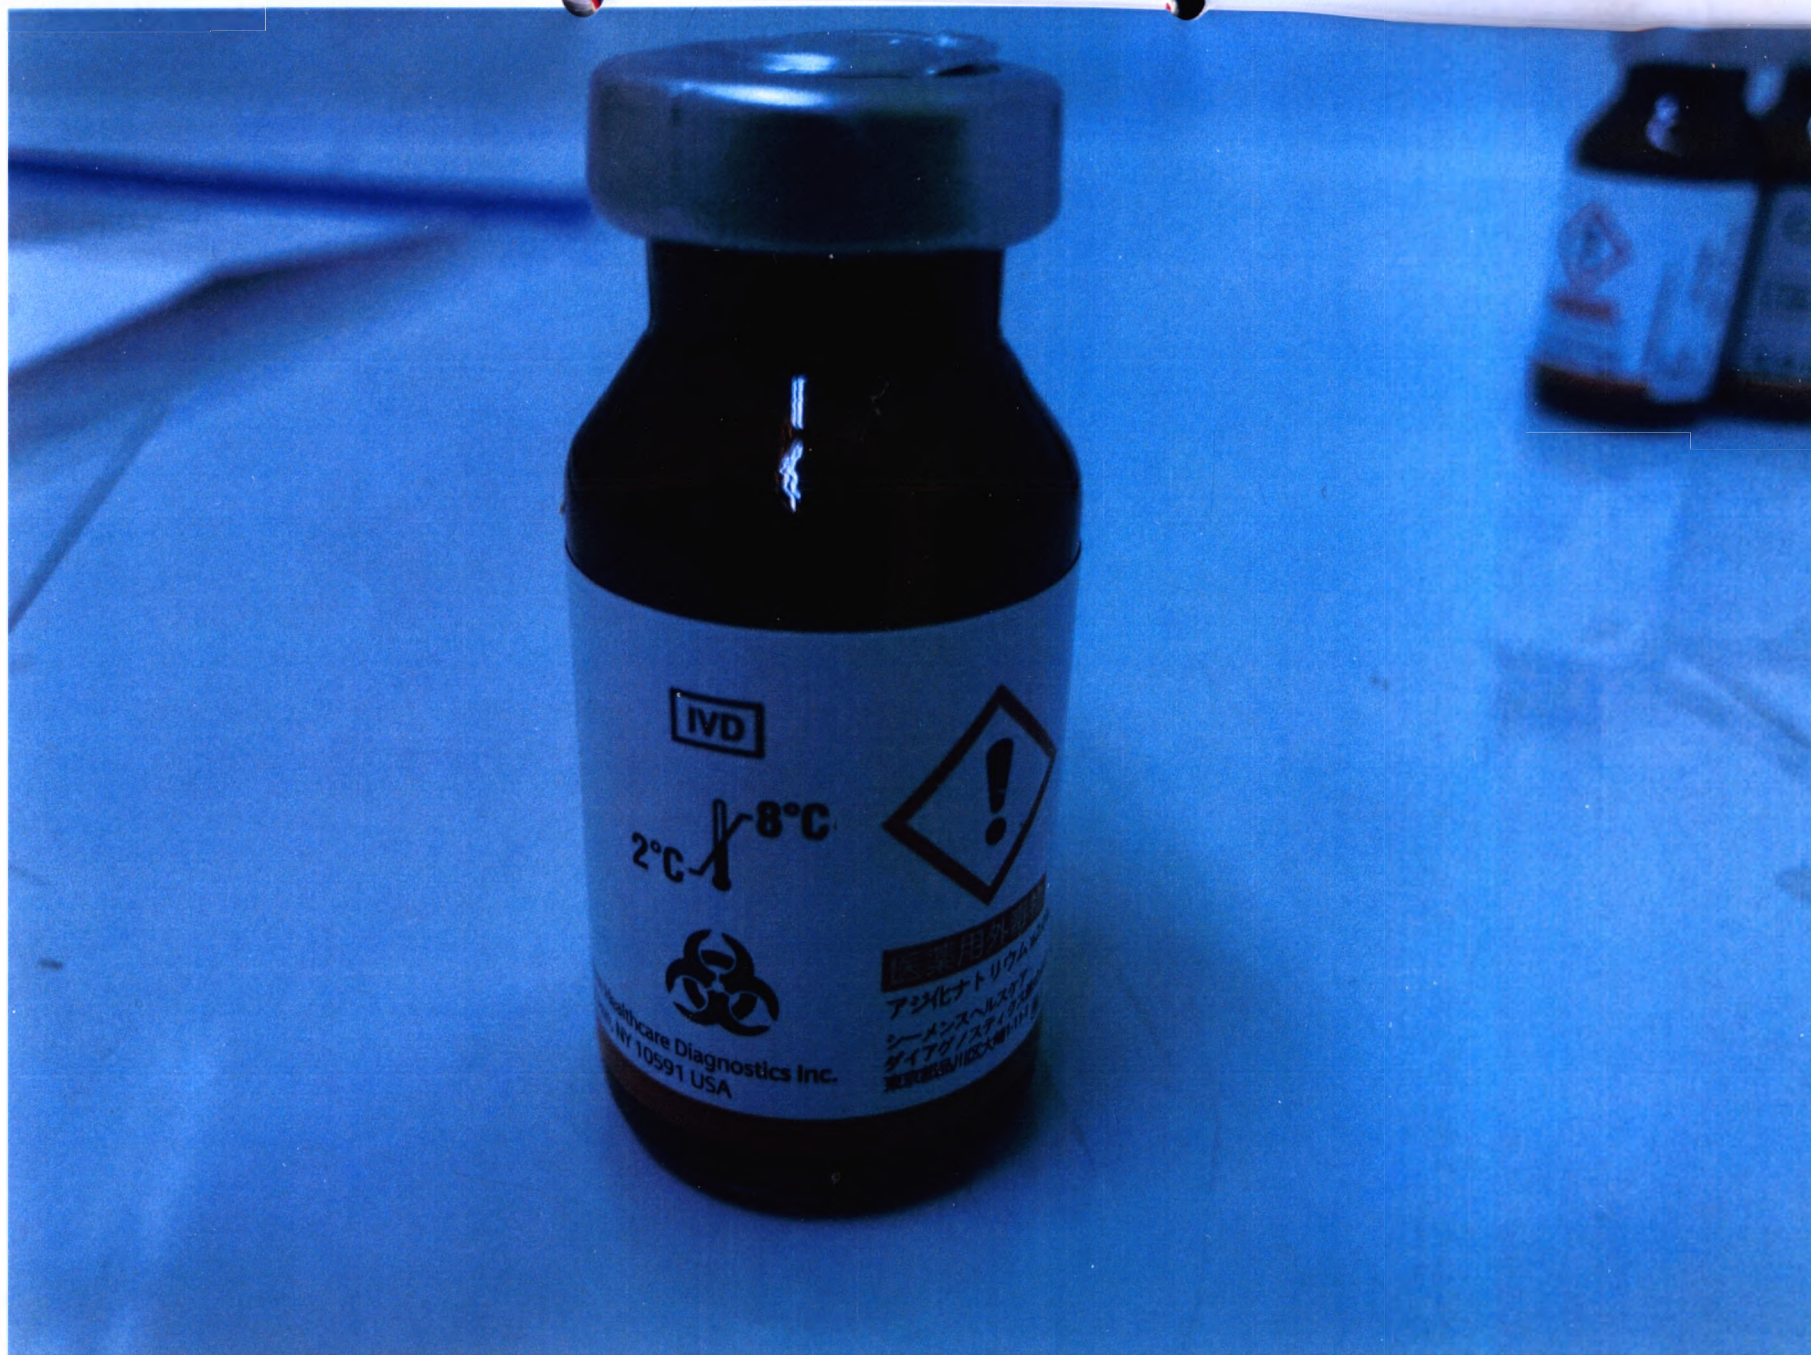


Рисунок 8. Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator А (Atellica IM CAL А)): Калибратор с высокой концентрацией

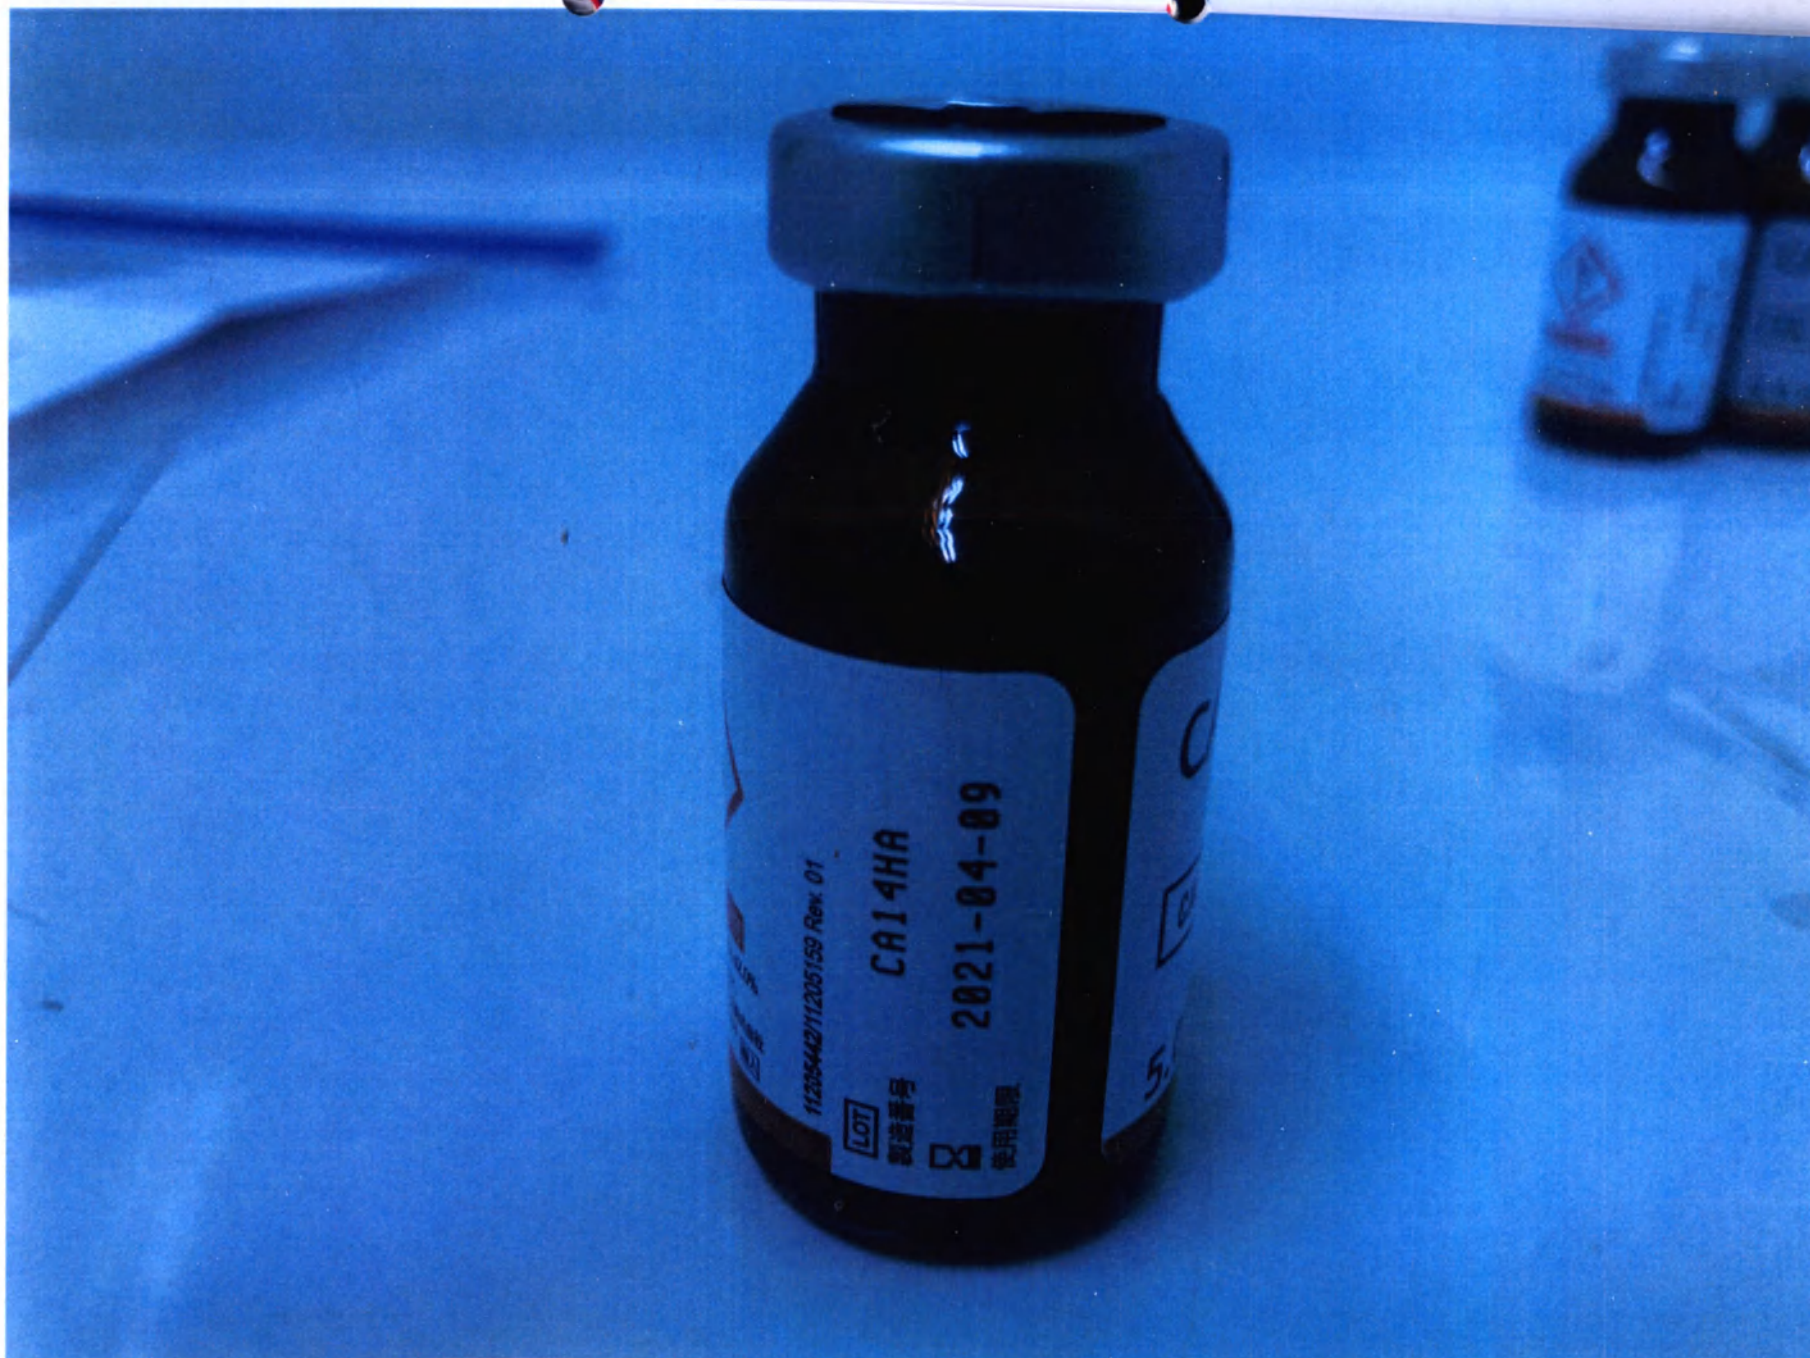


Рисунок 9. Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator A (Atellica IM CAL A)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CAL A H 5.0 мл

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CAL

A

CAL LOT VAL

LOT

CA14

製造番号



2021-04-09

使用期限



siemens.com/document-library



4332a185

CHECKSUM

CAL L

CAL H

UNITS C

UNITS SI

UNITS C

UNITS SI

FT3



2.56 PG/ML 3.94 PMOL/L 13 PG/ML 20 PMOL/L

FT4



0.835 NG/DL 10.8 PMOL/L 4.81 NG/DL 62 PMOL/L

T3



0.854 NG/ML 1.32 MMOL/L 4.44 NG/ML 6.84 MMOL/L

T4



3.75 UG/DL 48.4 MMOL/L 19.7 UG/DL 254 MMOL/L

TUp



1.27 REF/.

10997540 Rev. 02

Рисунок 10. Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Calibrator A (Atellica IM CAL A)): Лист значений параметров лота калибратора

10995500 Набор калибраторов А для анализаторов иммунохимических серии
Atellica (Atellica IM Calibrator A (Atellica IM CAL A))

Информация о производителе и стране происхождения

см. на упаковке

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/12144 от 02.10.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 02

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель изготовителя на территории Российской Федерации

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 12. Фотографическое изображение макета маркировки медицинского изделия, содержащего информацию на русском языке

Всего прошито и пронумеровано
13 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

