

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Дрегер»,

Харитонов А.А.



М.П.

« 15 »

мая

2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат для искусственной вентиляции легких «Oxylog 3000 plus» с принадлежностями

ООО «Дрегер»

Юридический адрес:
Электrozаводская ул., д.33,
стр. 4.
Москва, Россия, 107076

Тел.: + 7 495 775-15-20(22)
Факс: + 7 495 775-15-21
www.draeger.ru

Фактический адрес:

Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕОБ, блок «Б»,
12 этаж
Москва, Россия, 107061

Сервисный центр:
Электrozаводская ул., д.33, стр.4
Москва, Россия, 107076

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
Почтовый адрес:
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

info@draeger.com
www.draeger.com

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany

Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

info@draeger.com
www.draeger.com





Основной прибор.

Accu Lithium Ion
Accu Lithium Ion

Dräger


REF 2M86733 R 18




EM160618L2EK2
7800mAh


Dräger 2M86733-18

Use until:
2019-07

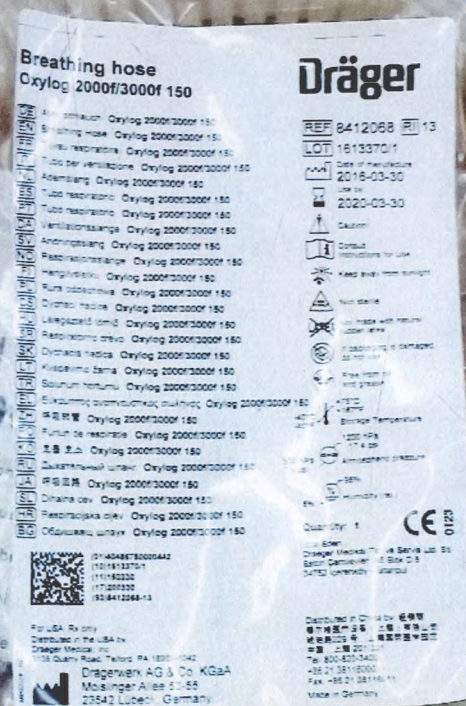



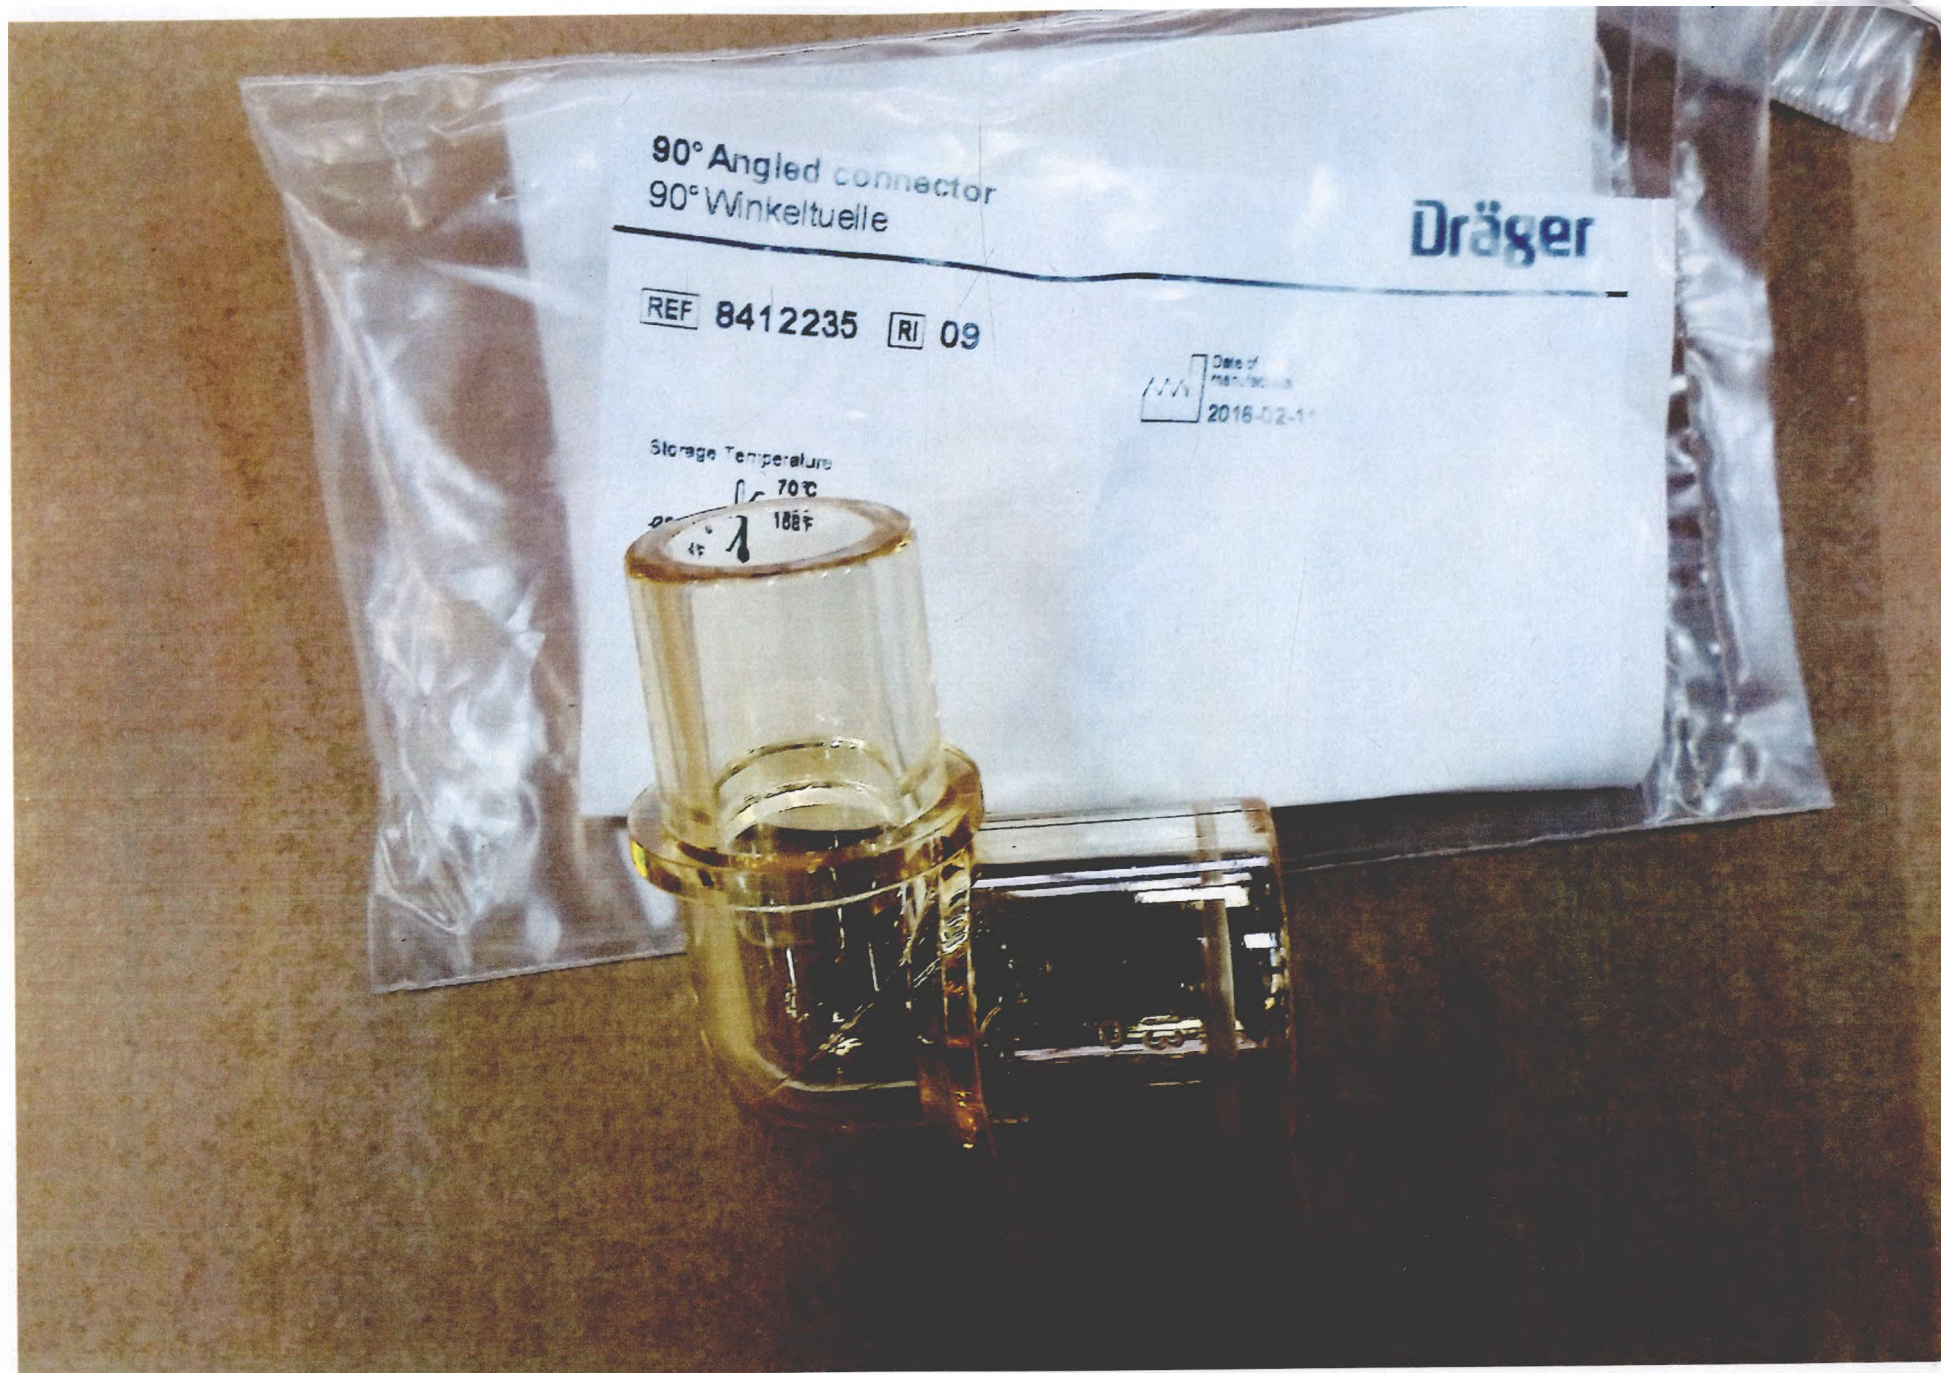

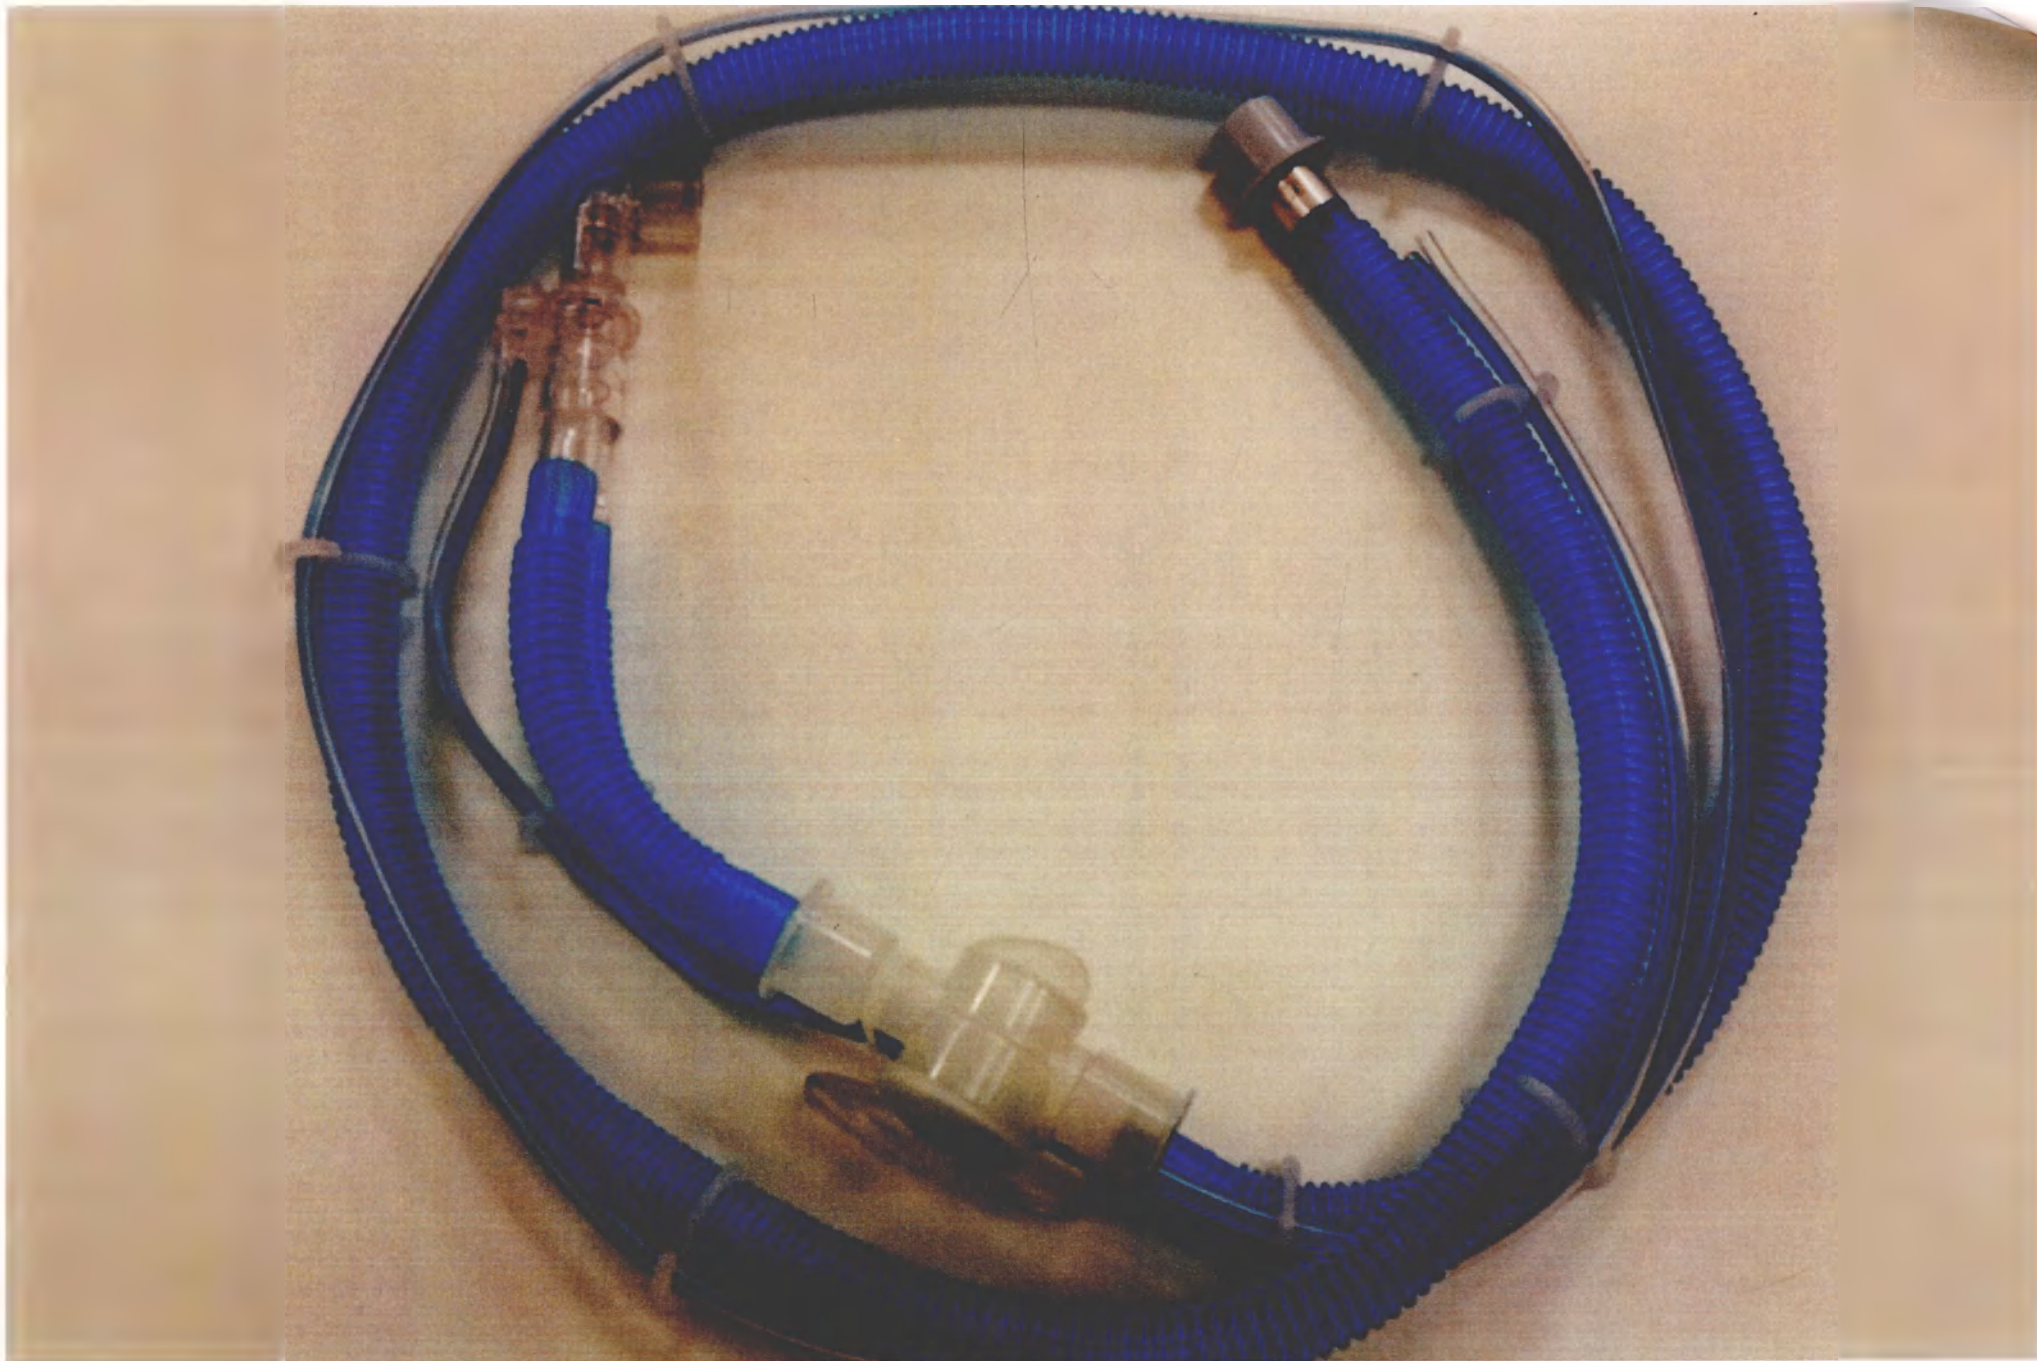


Система дыхательная для взрослых (контур пациента, одноразовый) – комплект 5 шт., состав: - силиконовый шланг – 1.5 м или 3 м.




nl van de drukverschil-flow- Gebruiksaanwijzing
sensor 8412034
da af differensdruk-flowser Brugvejledning
sor 8412034
no differensdruk-flowsen- Bruksanvisning
sor 8412034




Use the in differential mode and comply with
the instructions for use

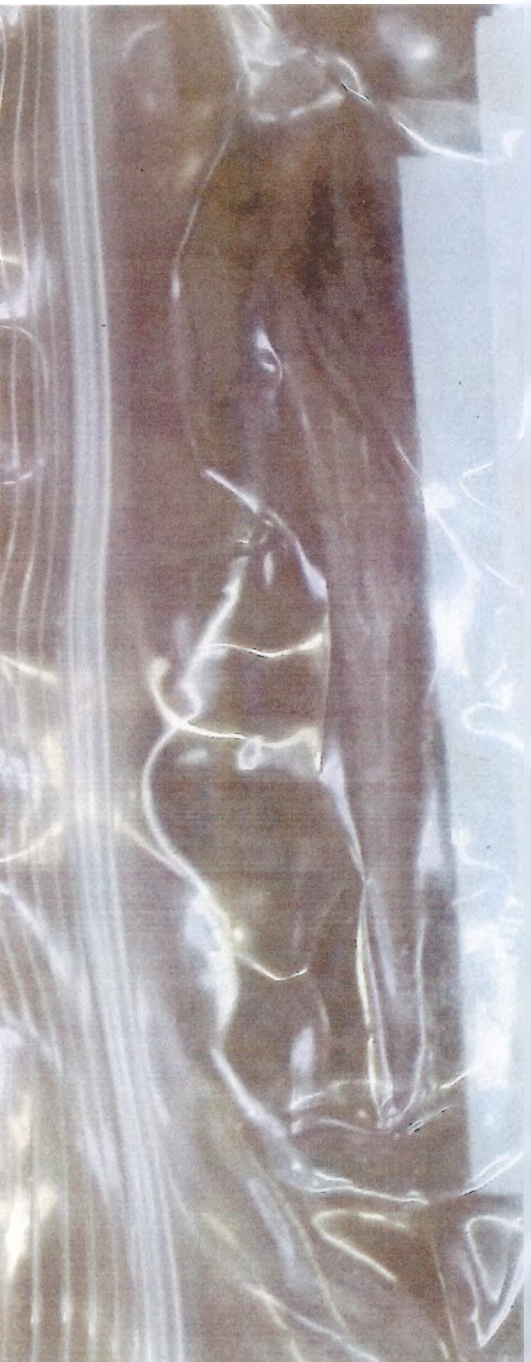

Система дыхательная для взрослых (контур пациента, одноразовый) – комплект 5 шт., состав: - датчик расхода (потока).

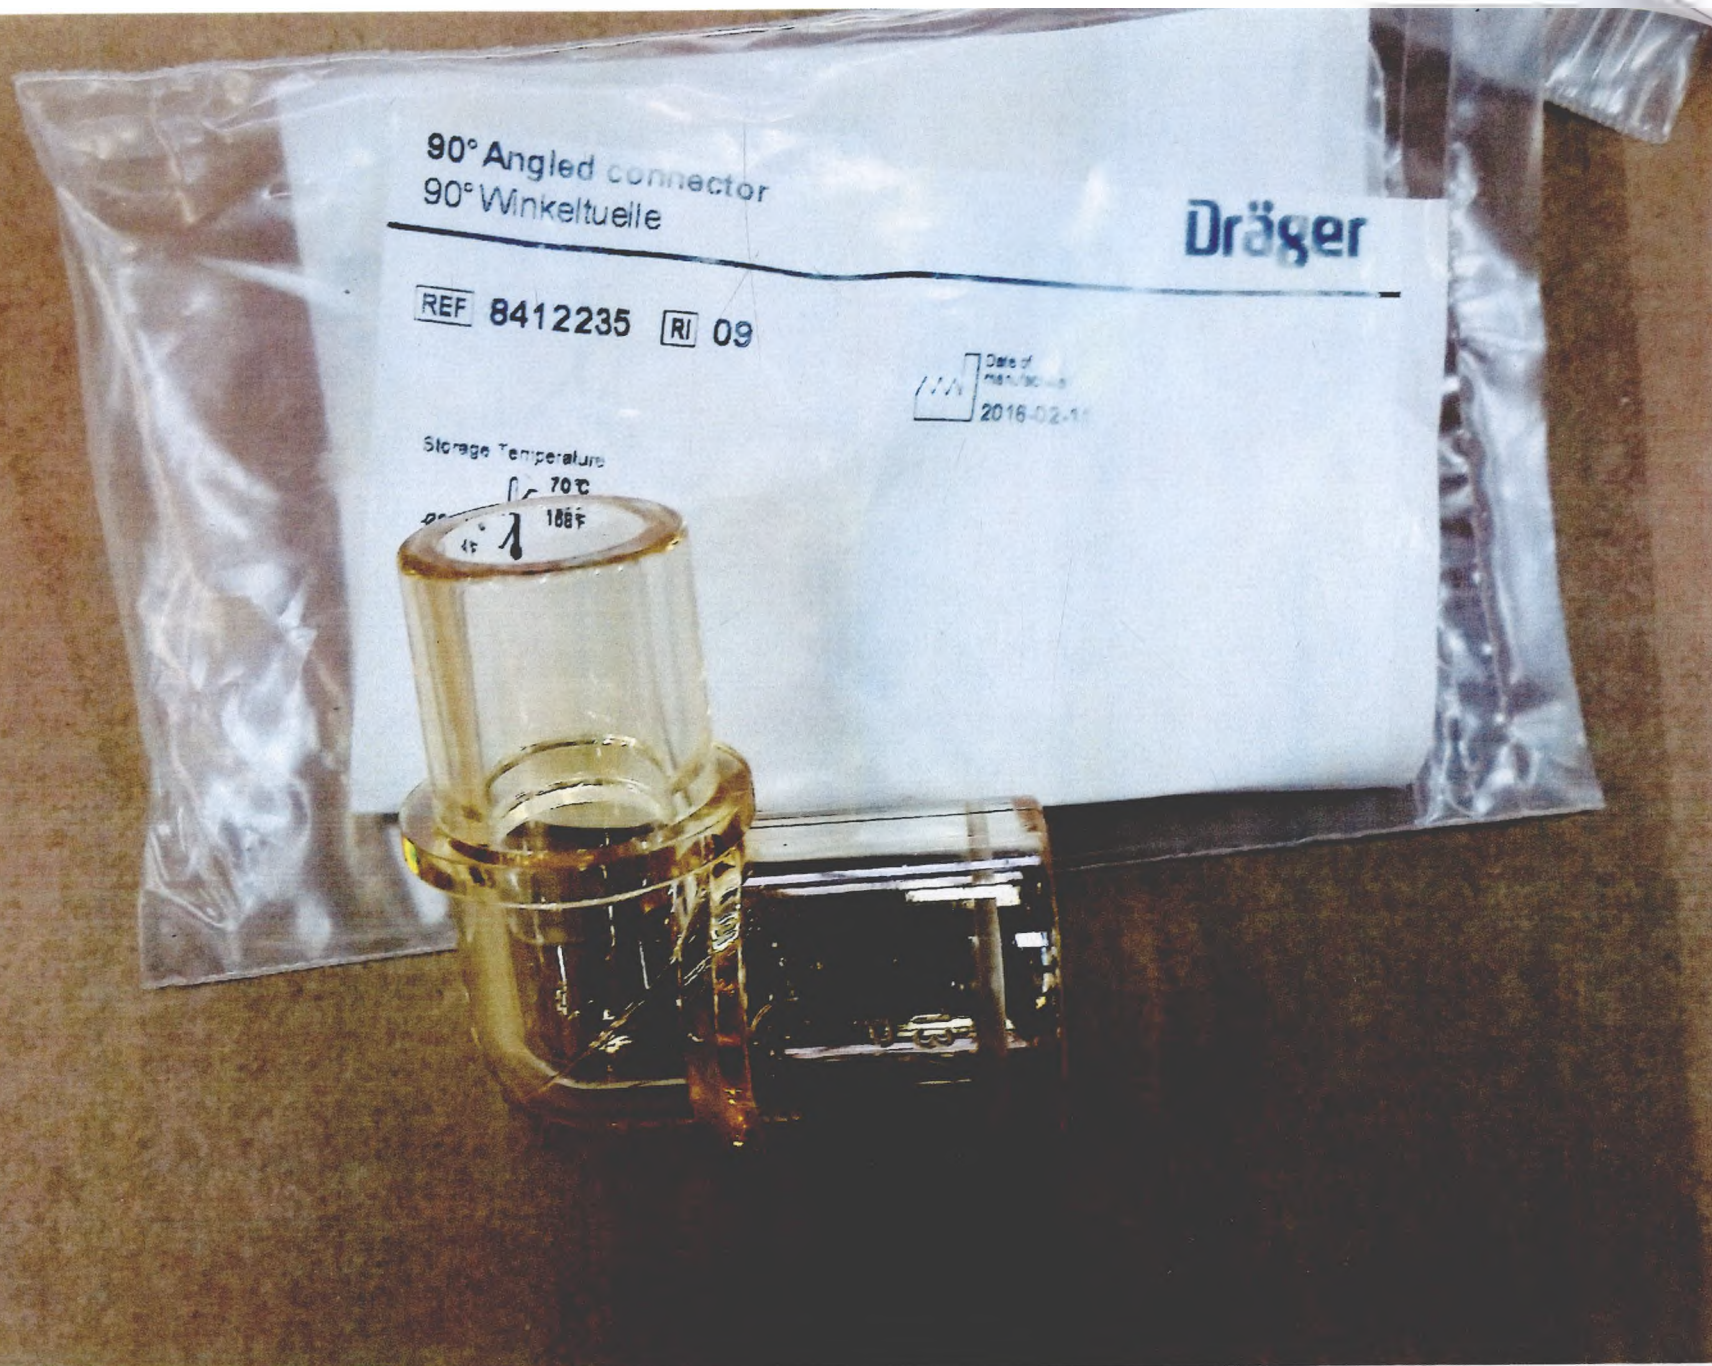

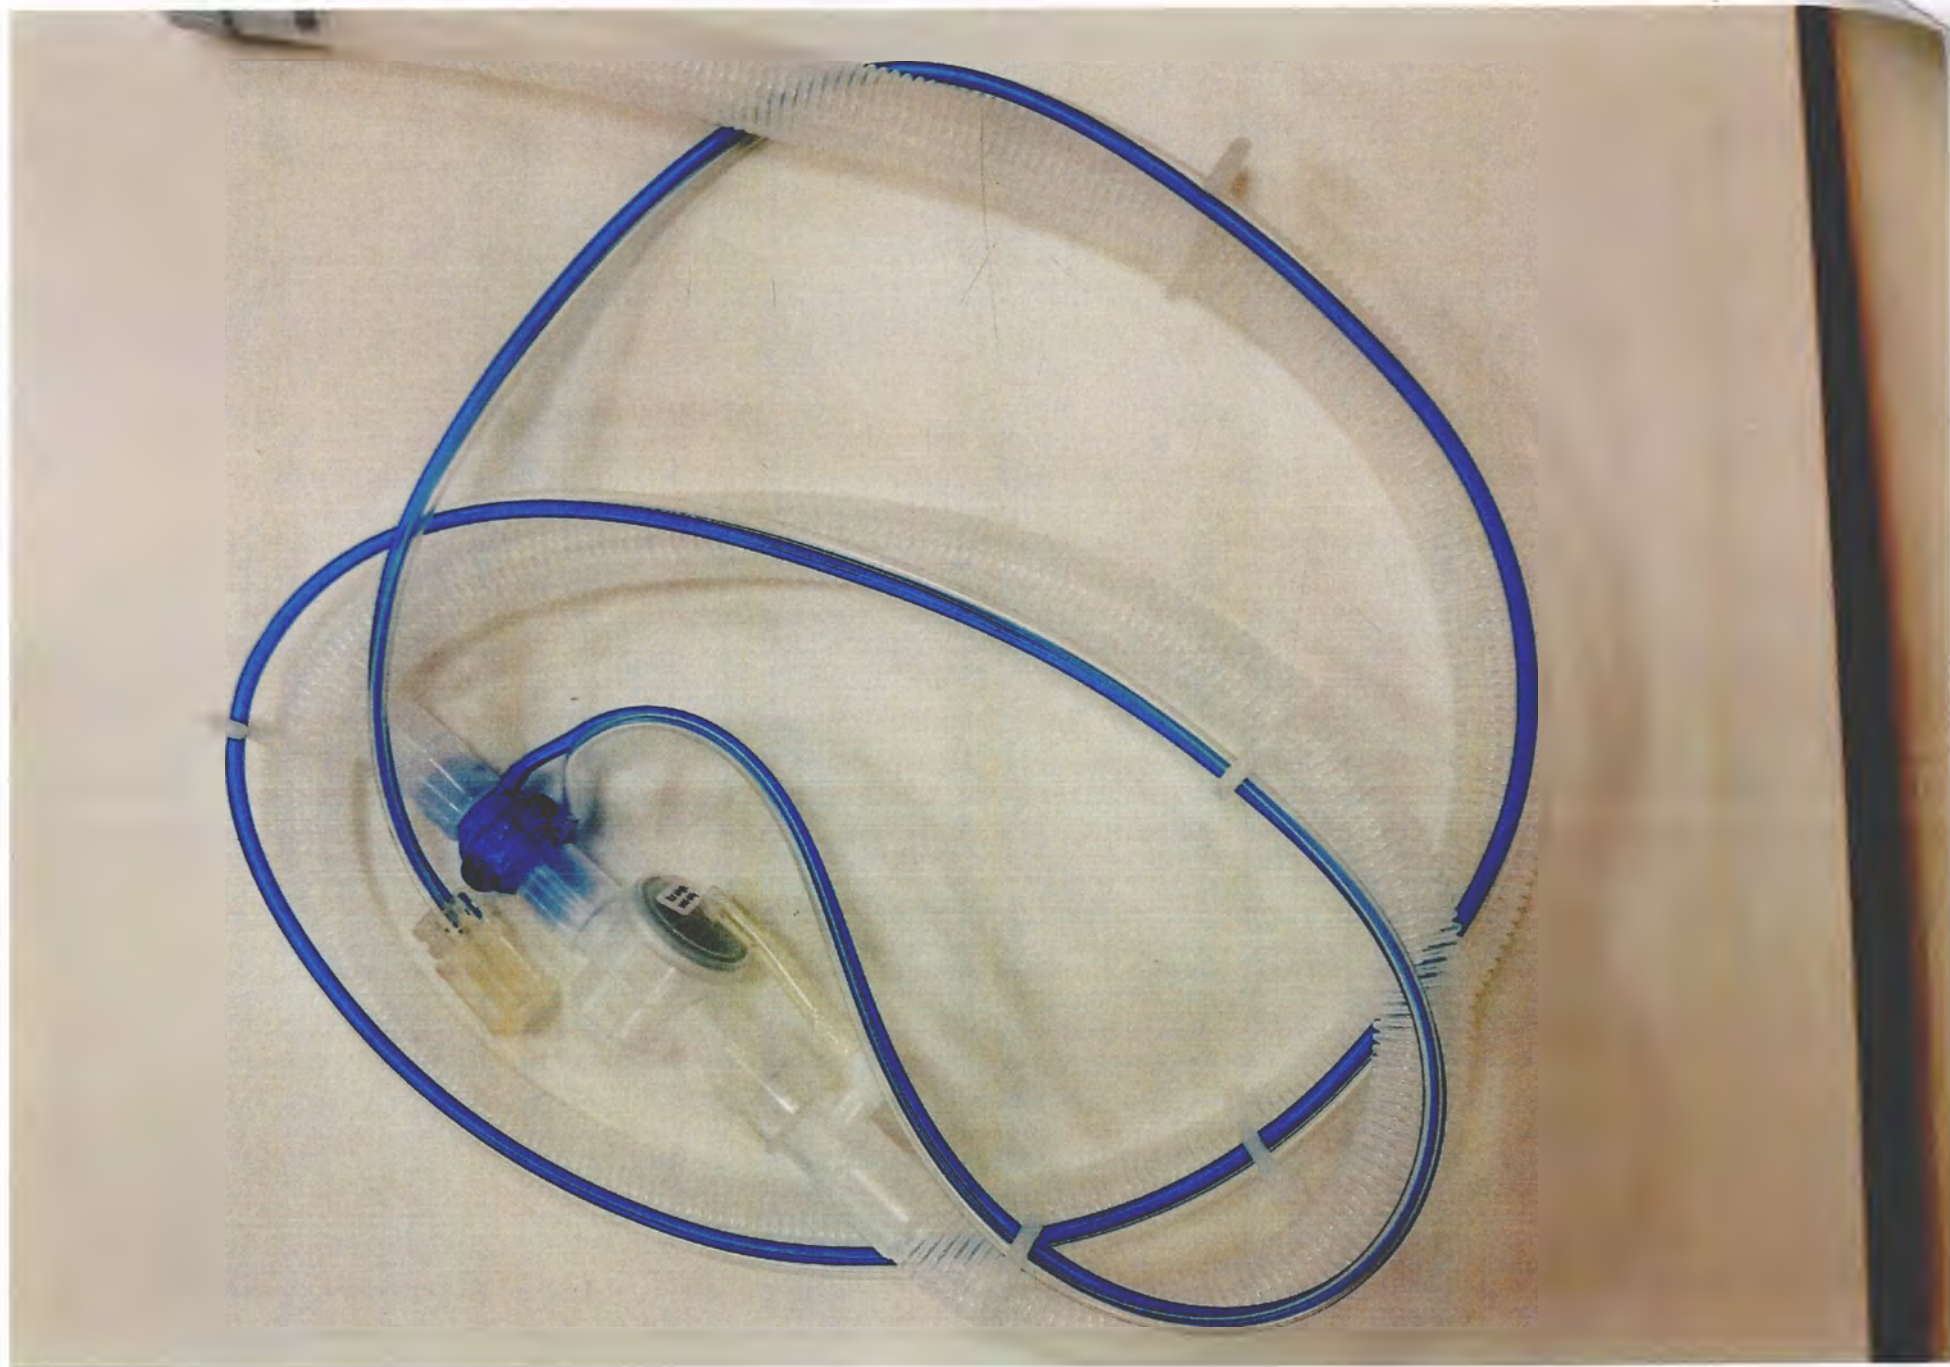




nl van de drukverschil-flow- Gebruiksaanwijzing
sensor 8412034
da af differentdruk-flowser Brugervejledning
sor 8412034
no differensialtrykk-flowsen- Bruksanvisning
sor 8412034



Do not use this medical device for any other purpose than intended.

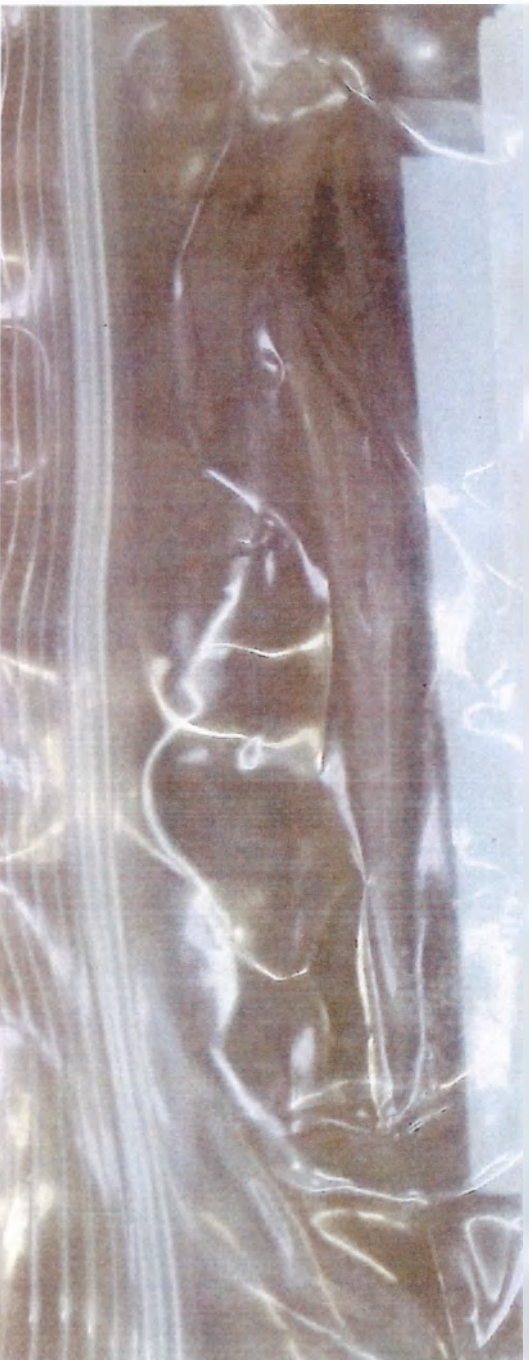

90° Angled connector
90° Winkeltuelle

Dräger

REF 8412235 RI 09


Date of
manufacture
2016-02-11

Storage Temperature

70°C
188°F






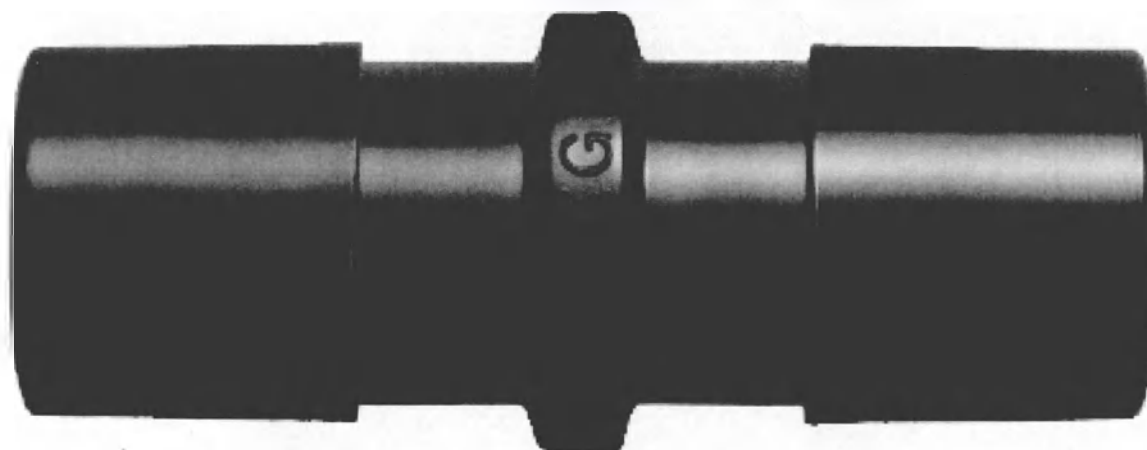

Переходник многоразовый для шлангов.



Переходник одноразовый для шлангов.

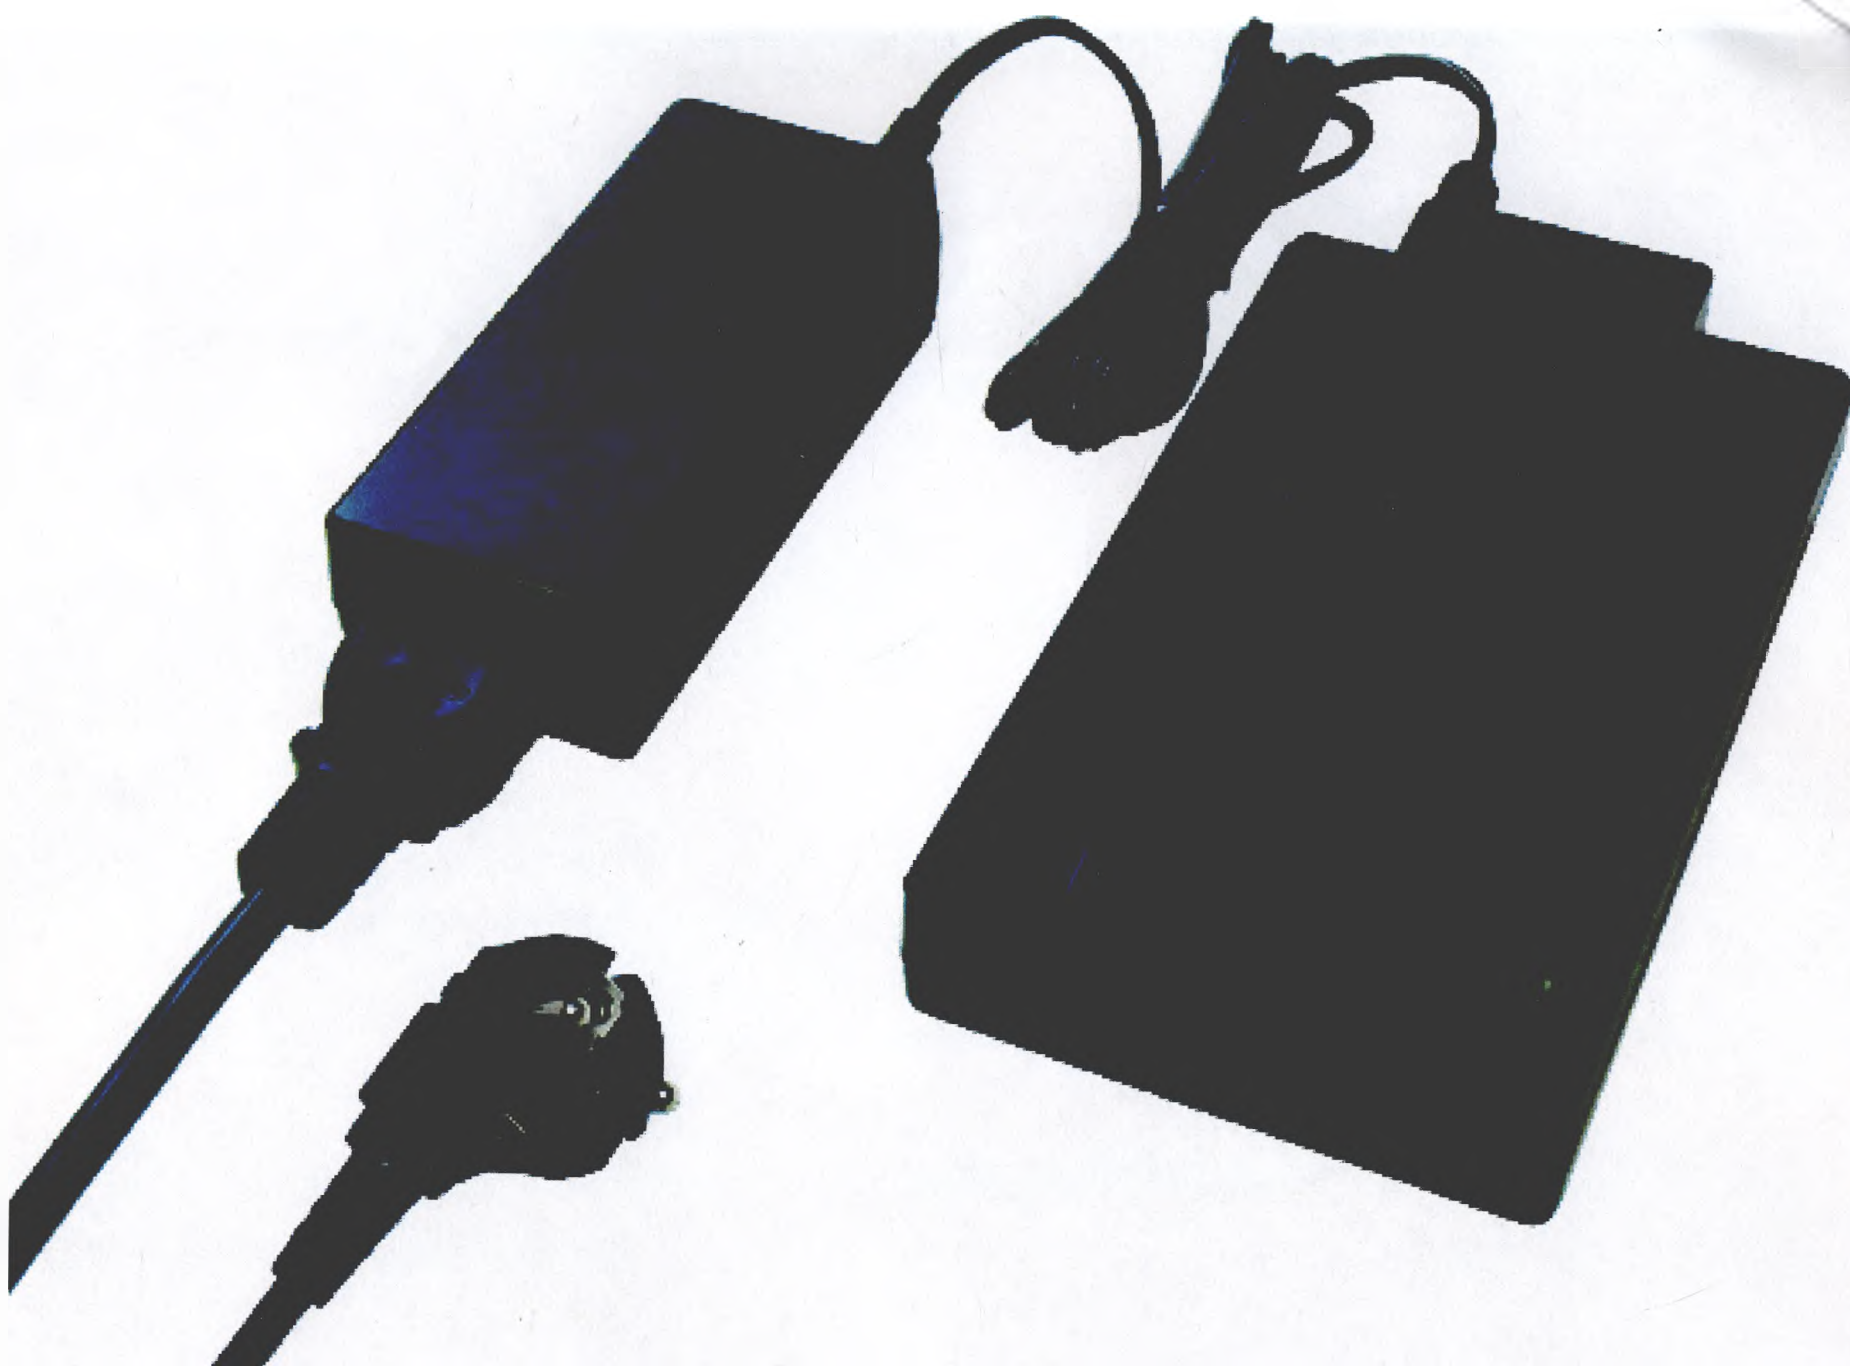



Зарядное устройство для батареи.






Редуктор давления «Alduk IV».

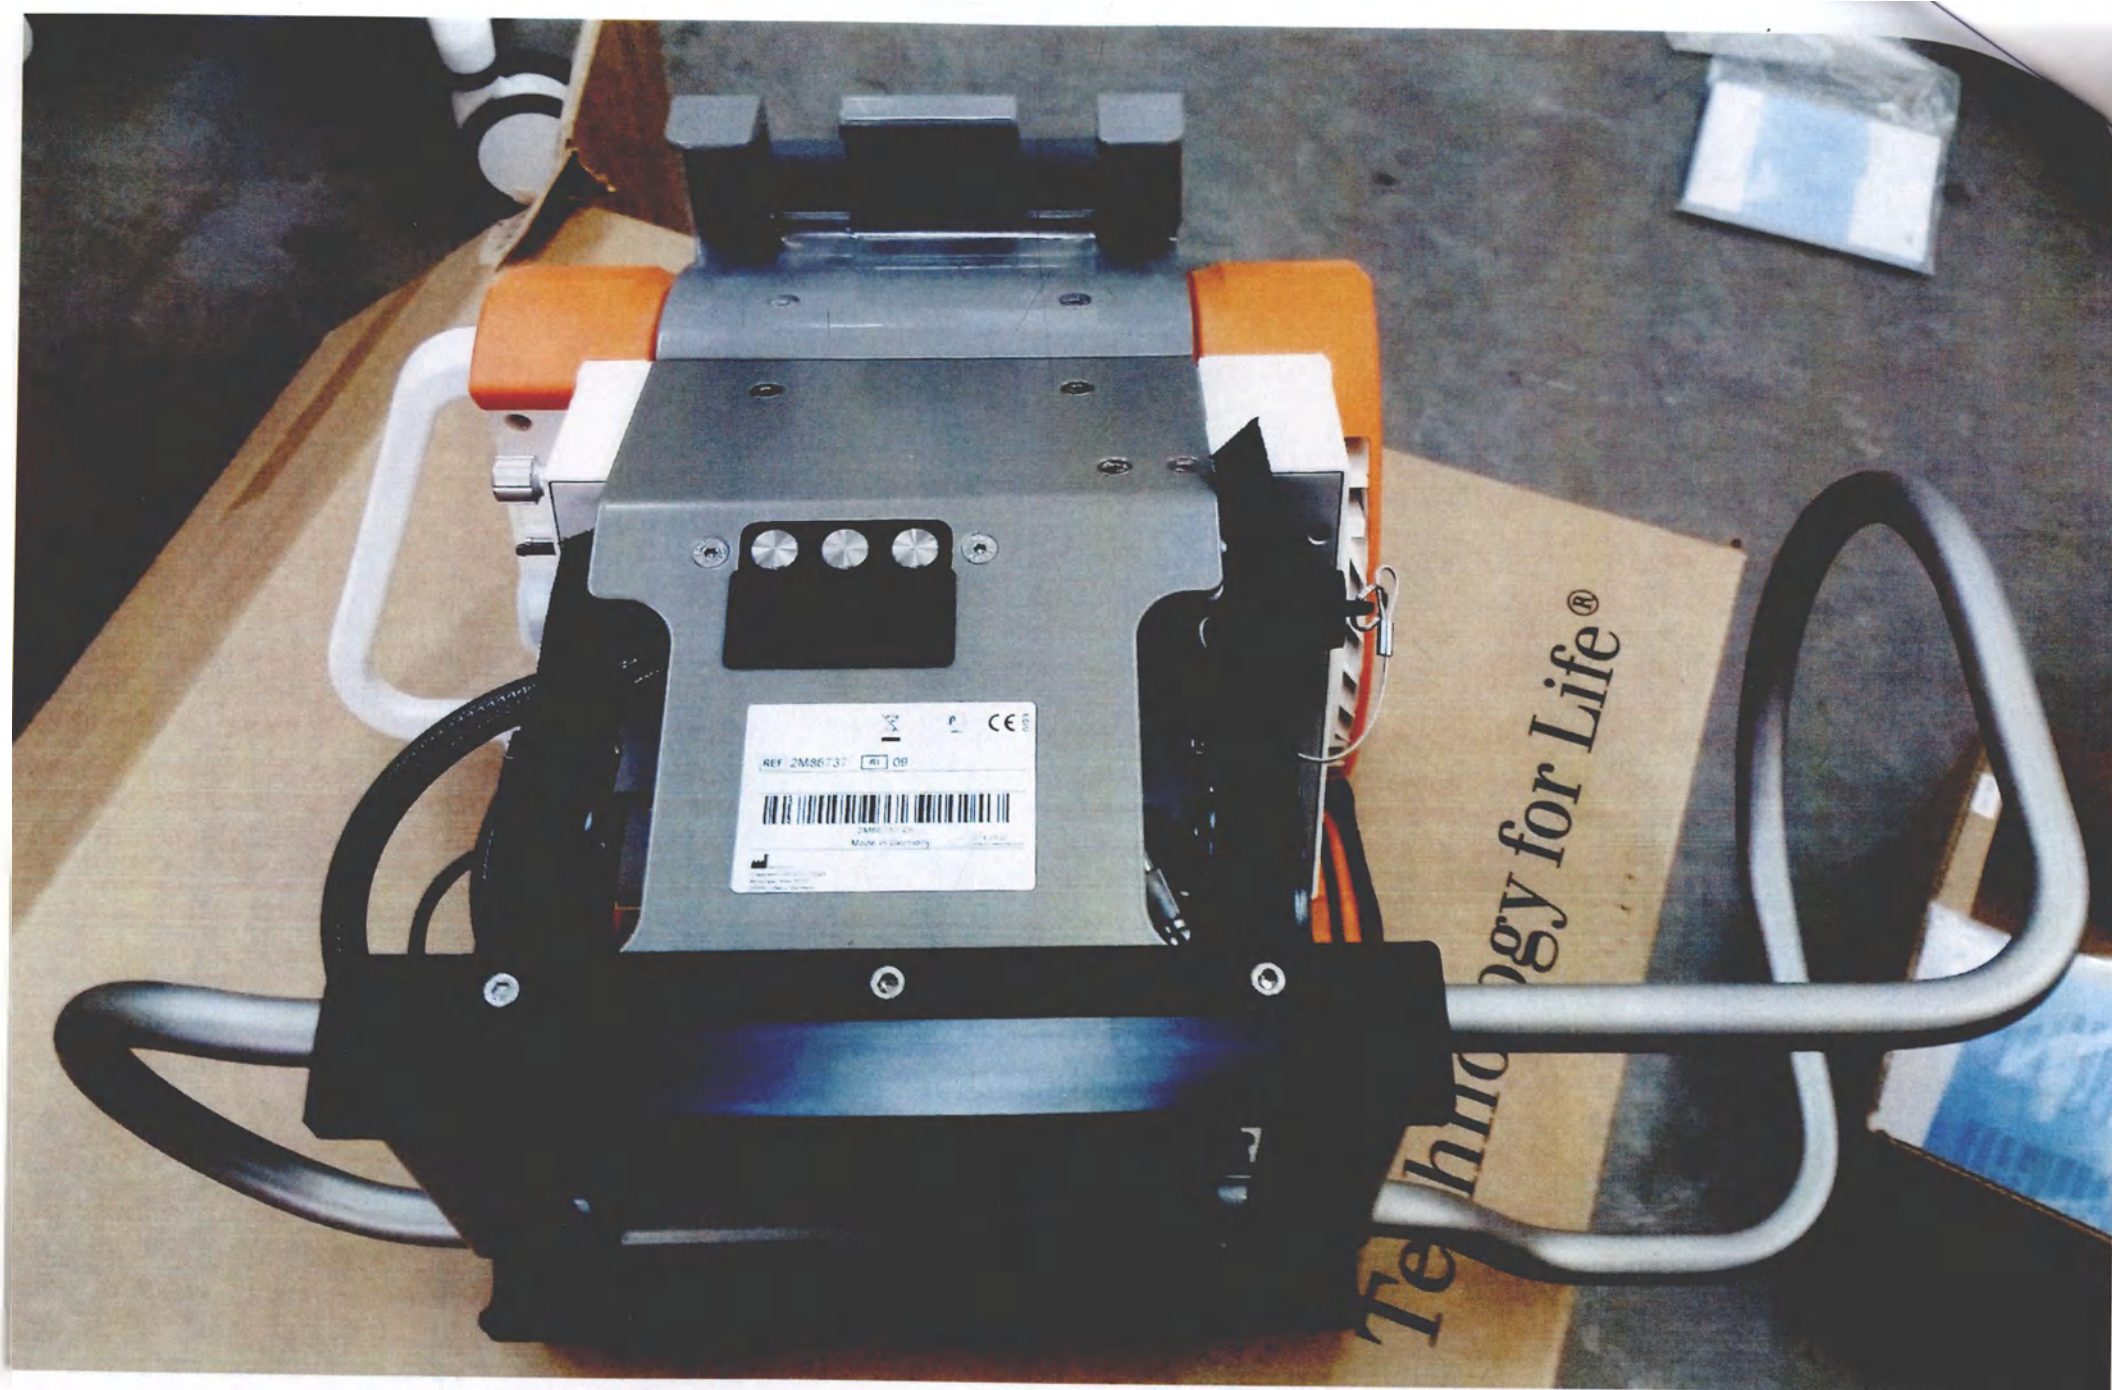

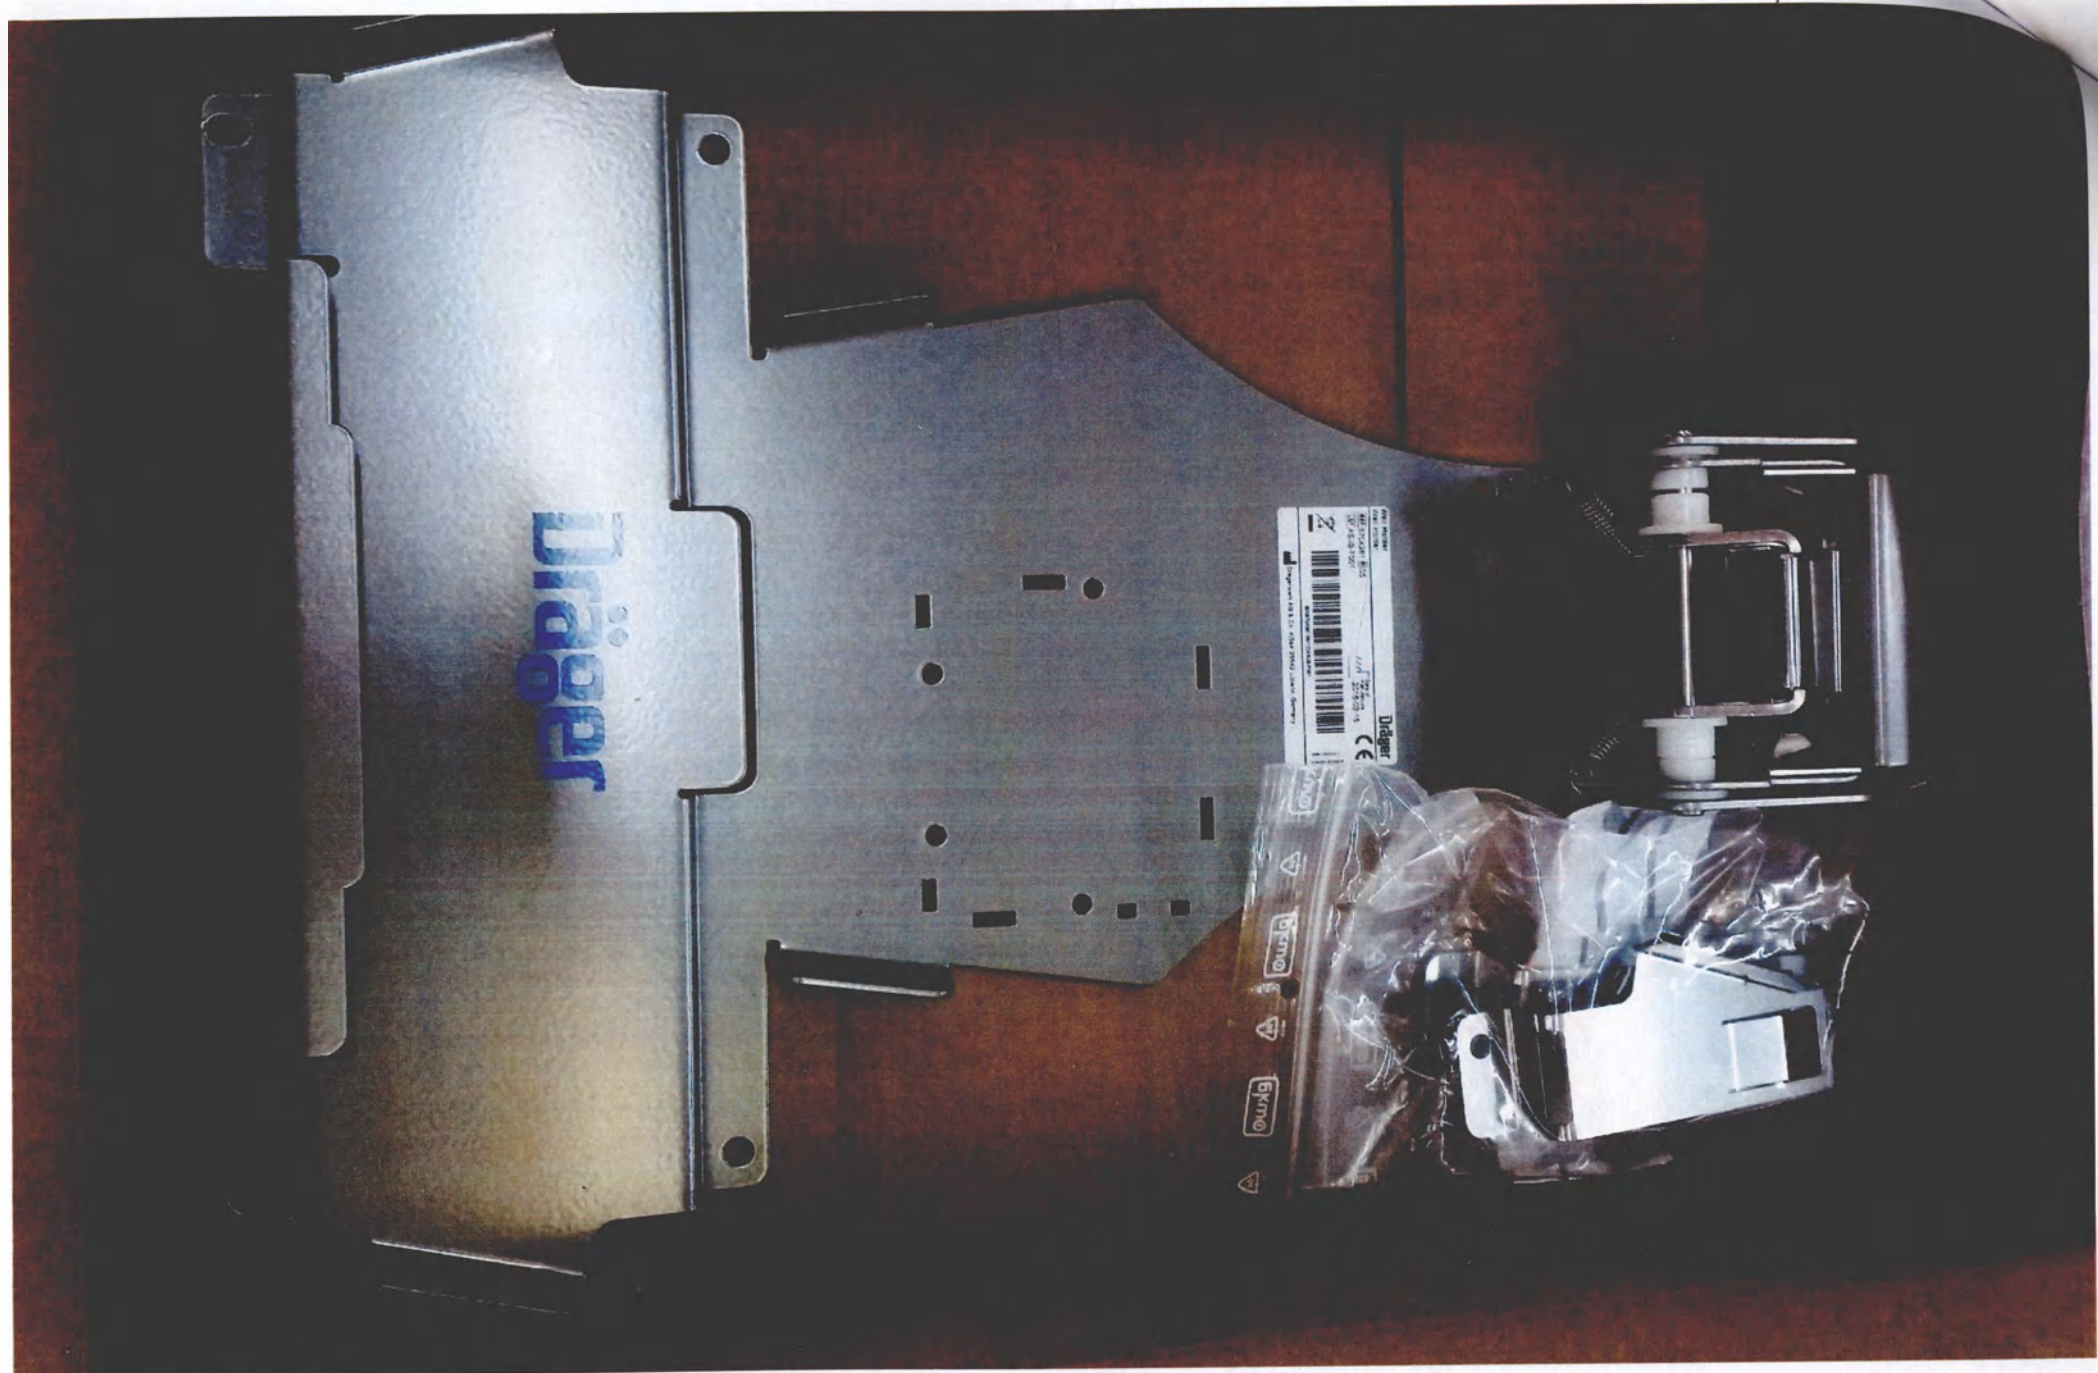



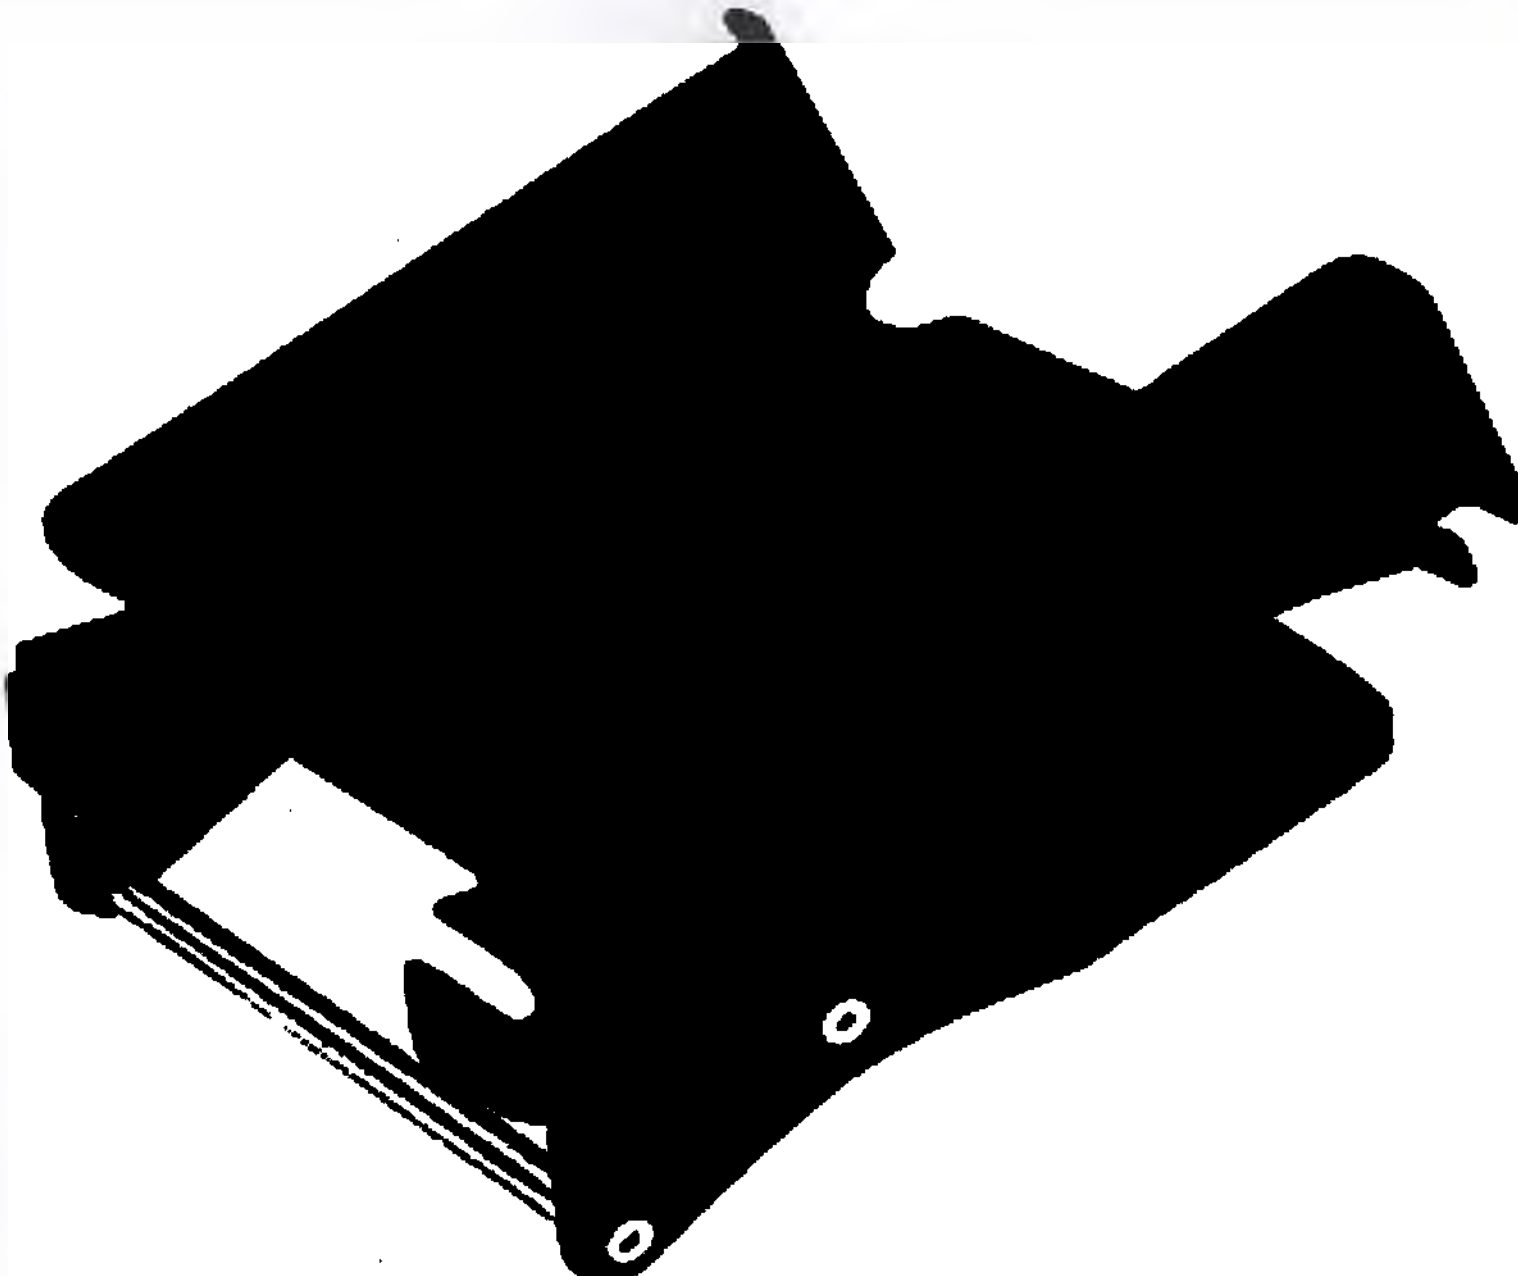








Тестовый мешок для настройки аппарата (Тест - легкие).


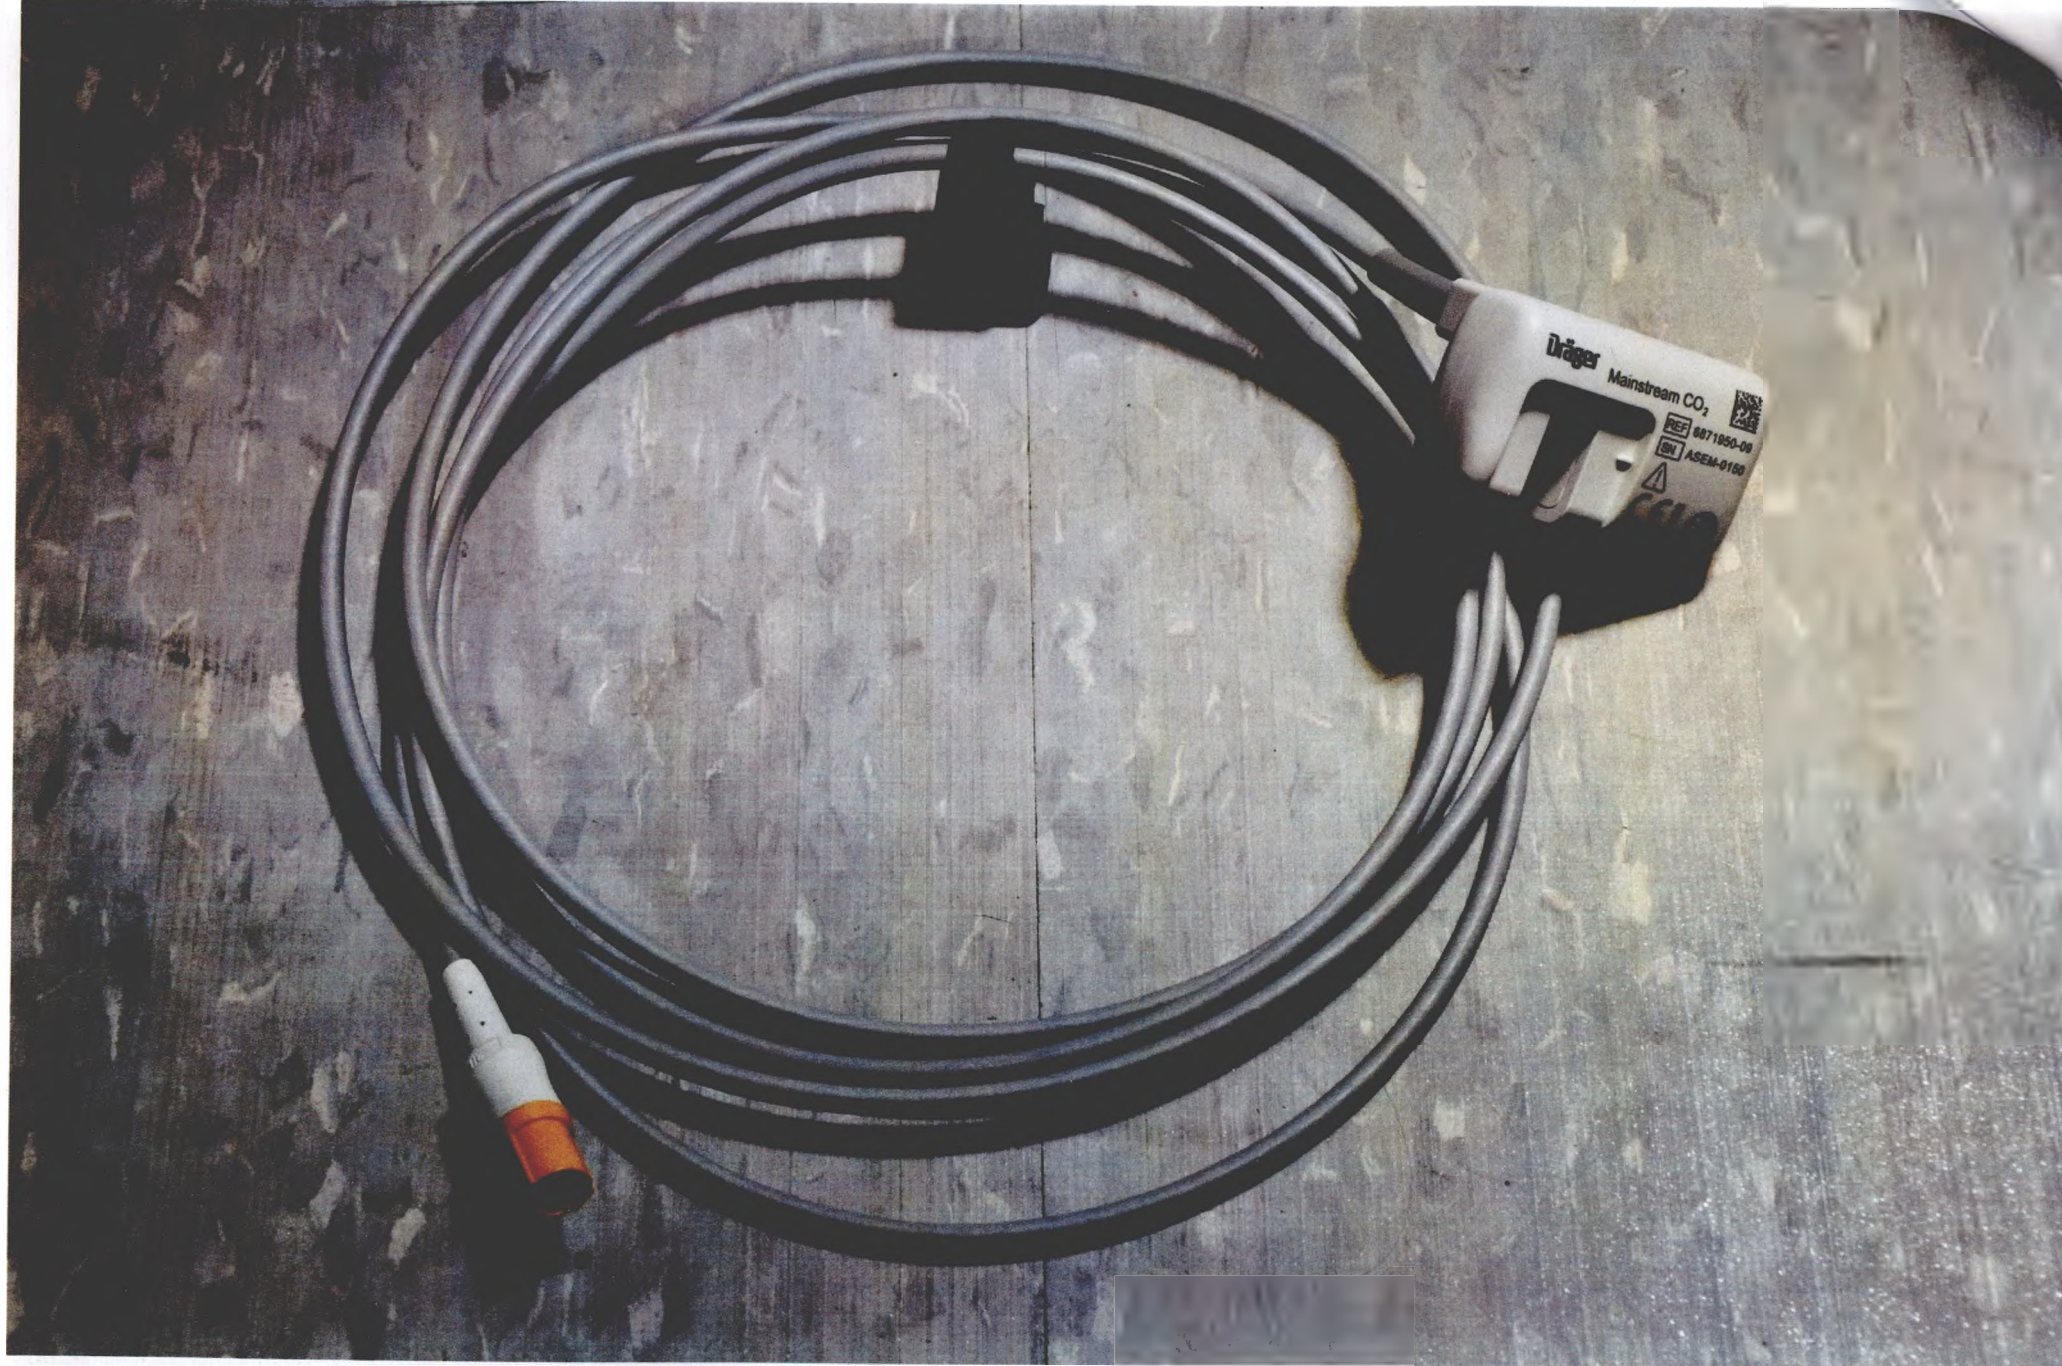



Dräger Infinity MC3 Mainstream CO2


de	CO2-Hauptstromsensor
en	CO2 Mainstream Sensor
enUS	CO2 Mainstream Sensor
fr	Capteur de CO2 de mesure directe
es	Sensor de flujo principal de CO2
it	Sensore mainstream CO2





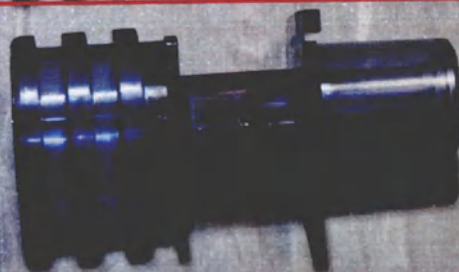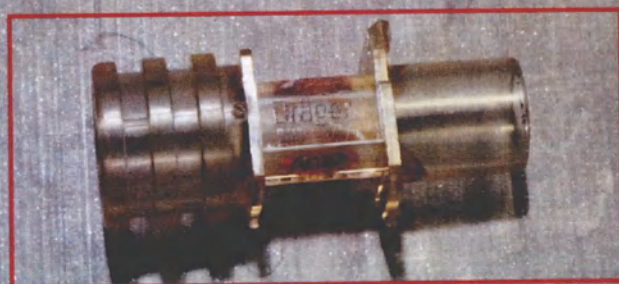

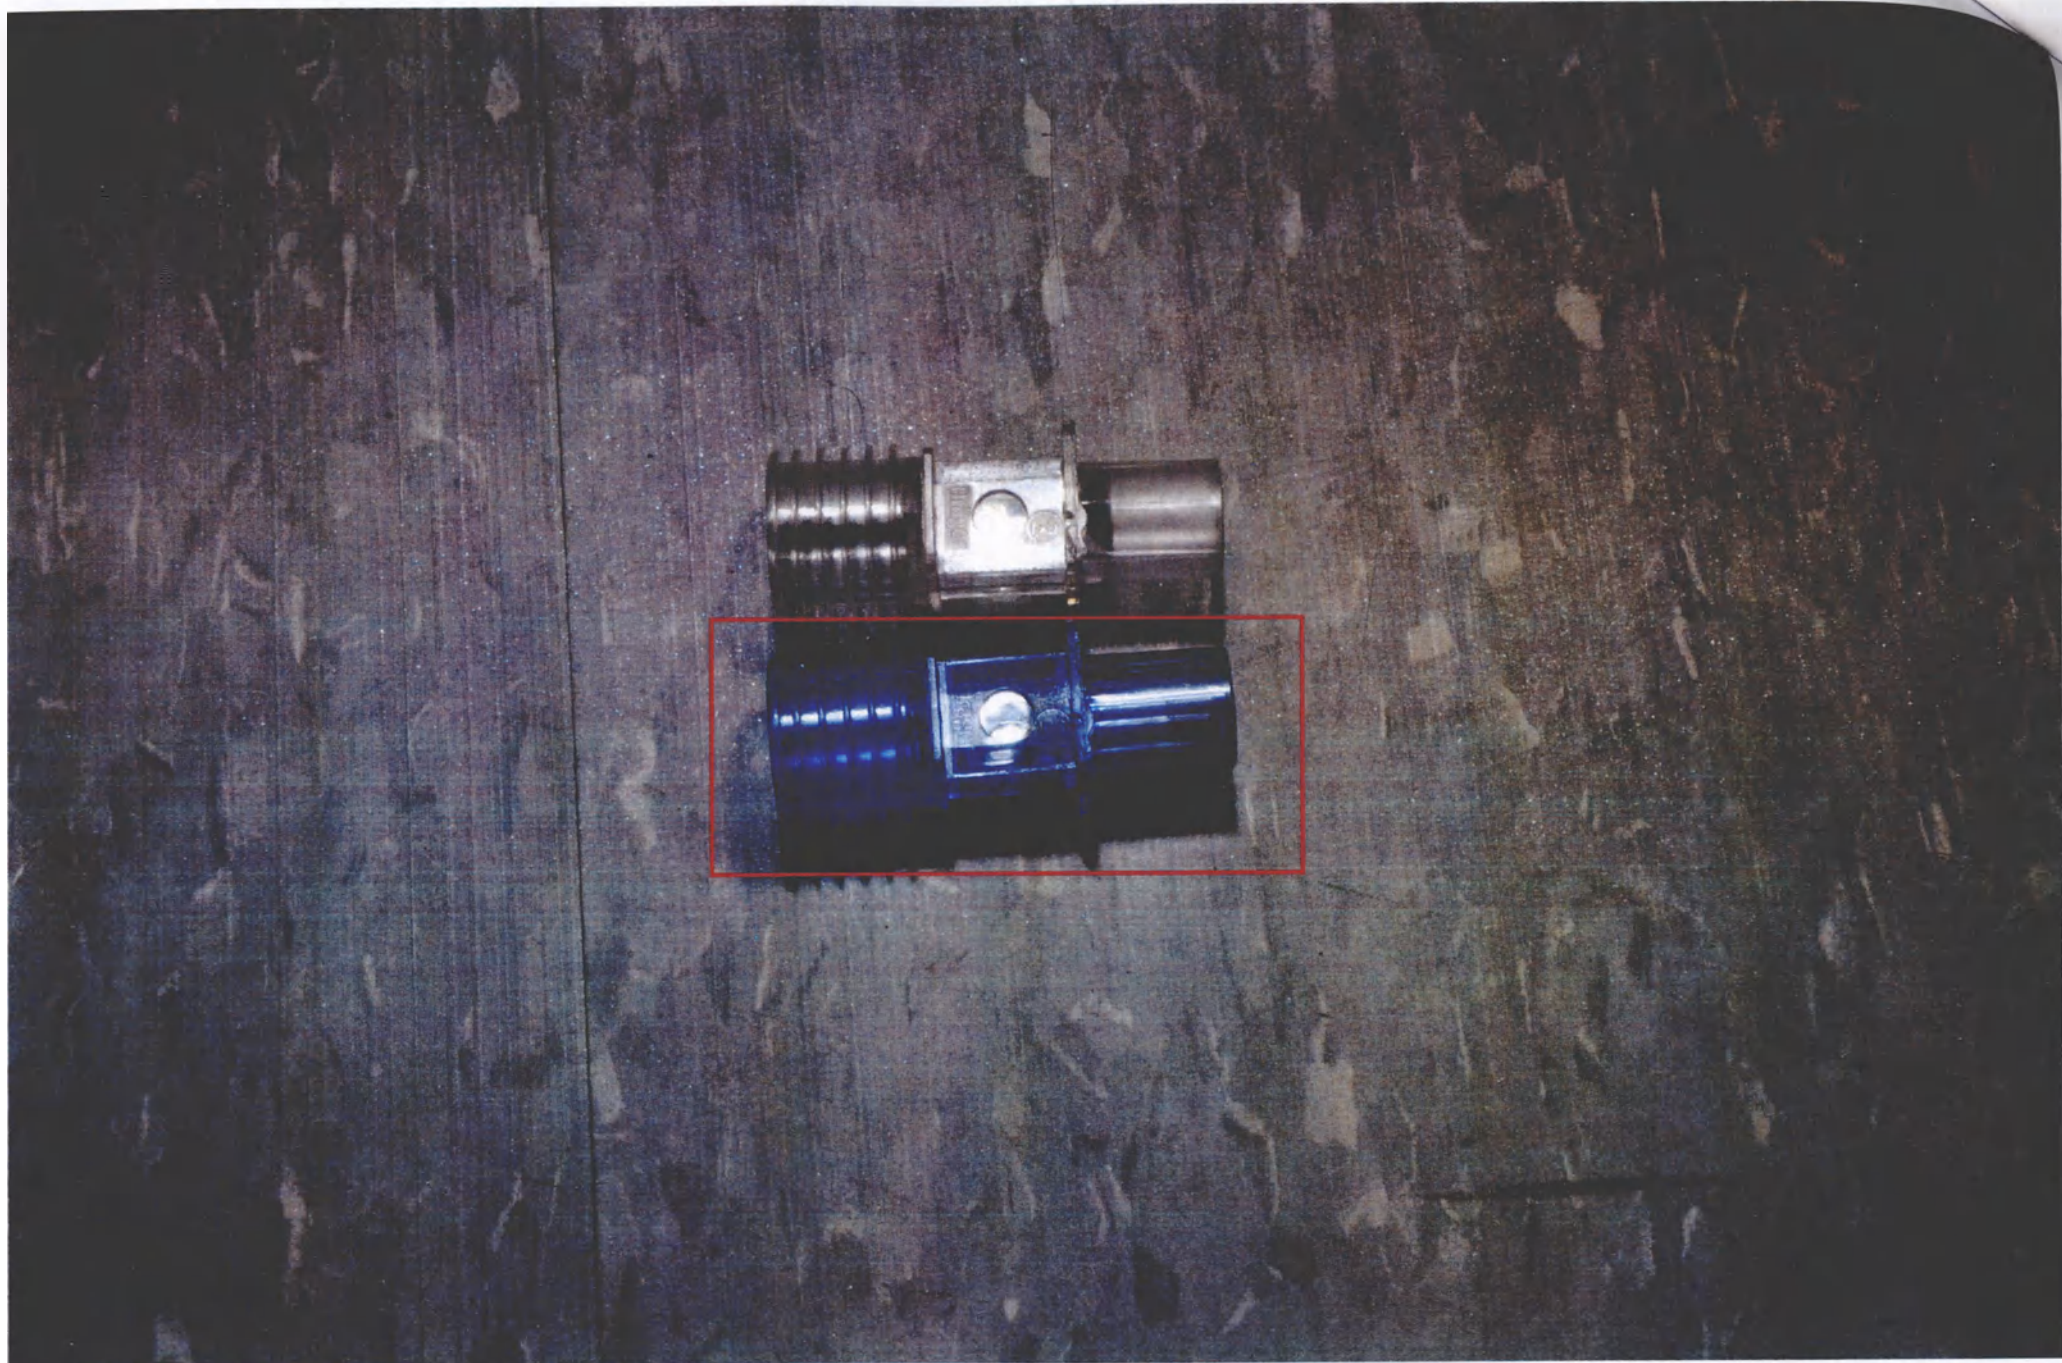

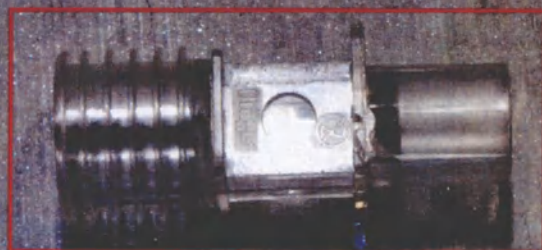






Калибровочный набор для CO₂ (с баллоном для калибровочного газа): 1. Баллон с тестовым газом. 2. Тестовая кювета для датчика CO₂.
3. Соединительный шланг.






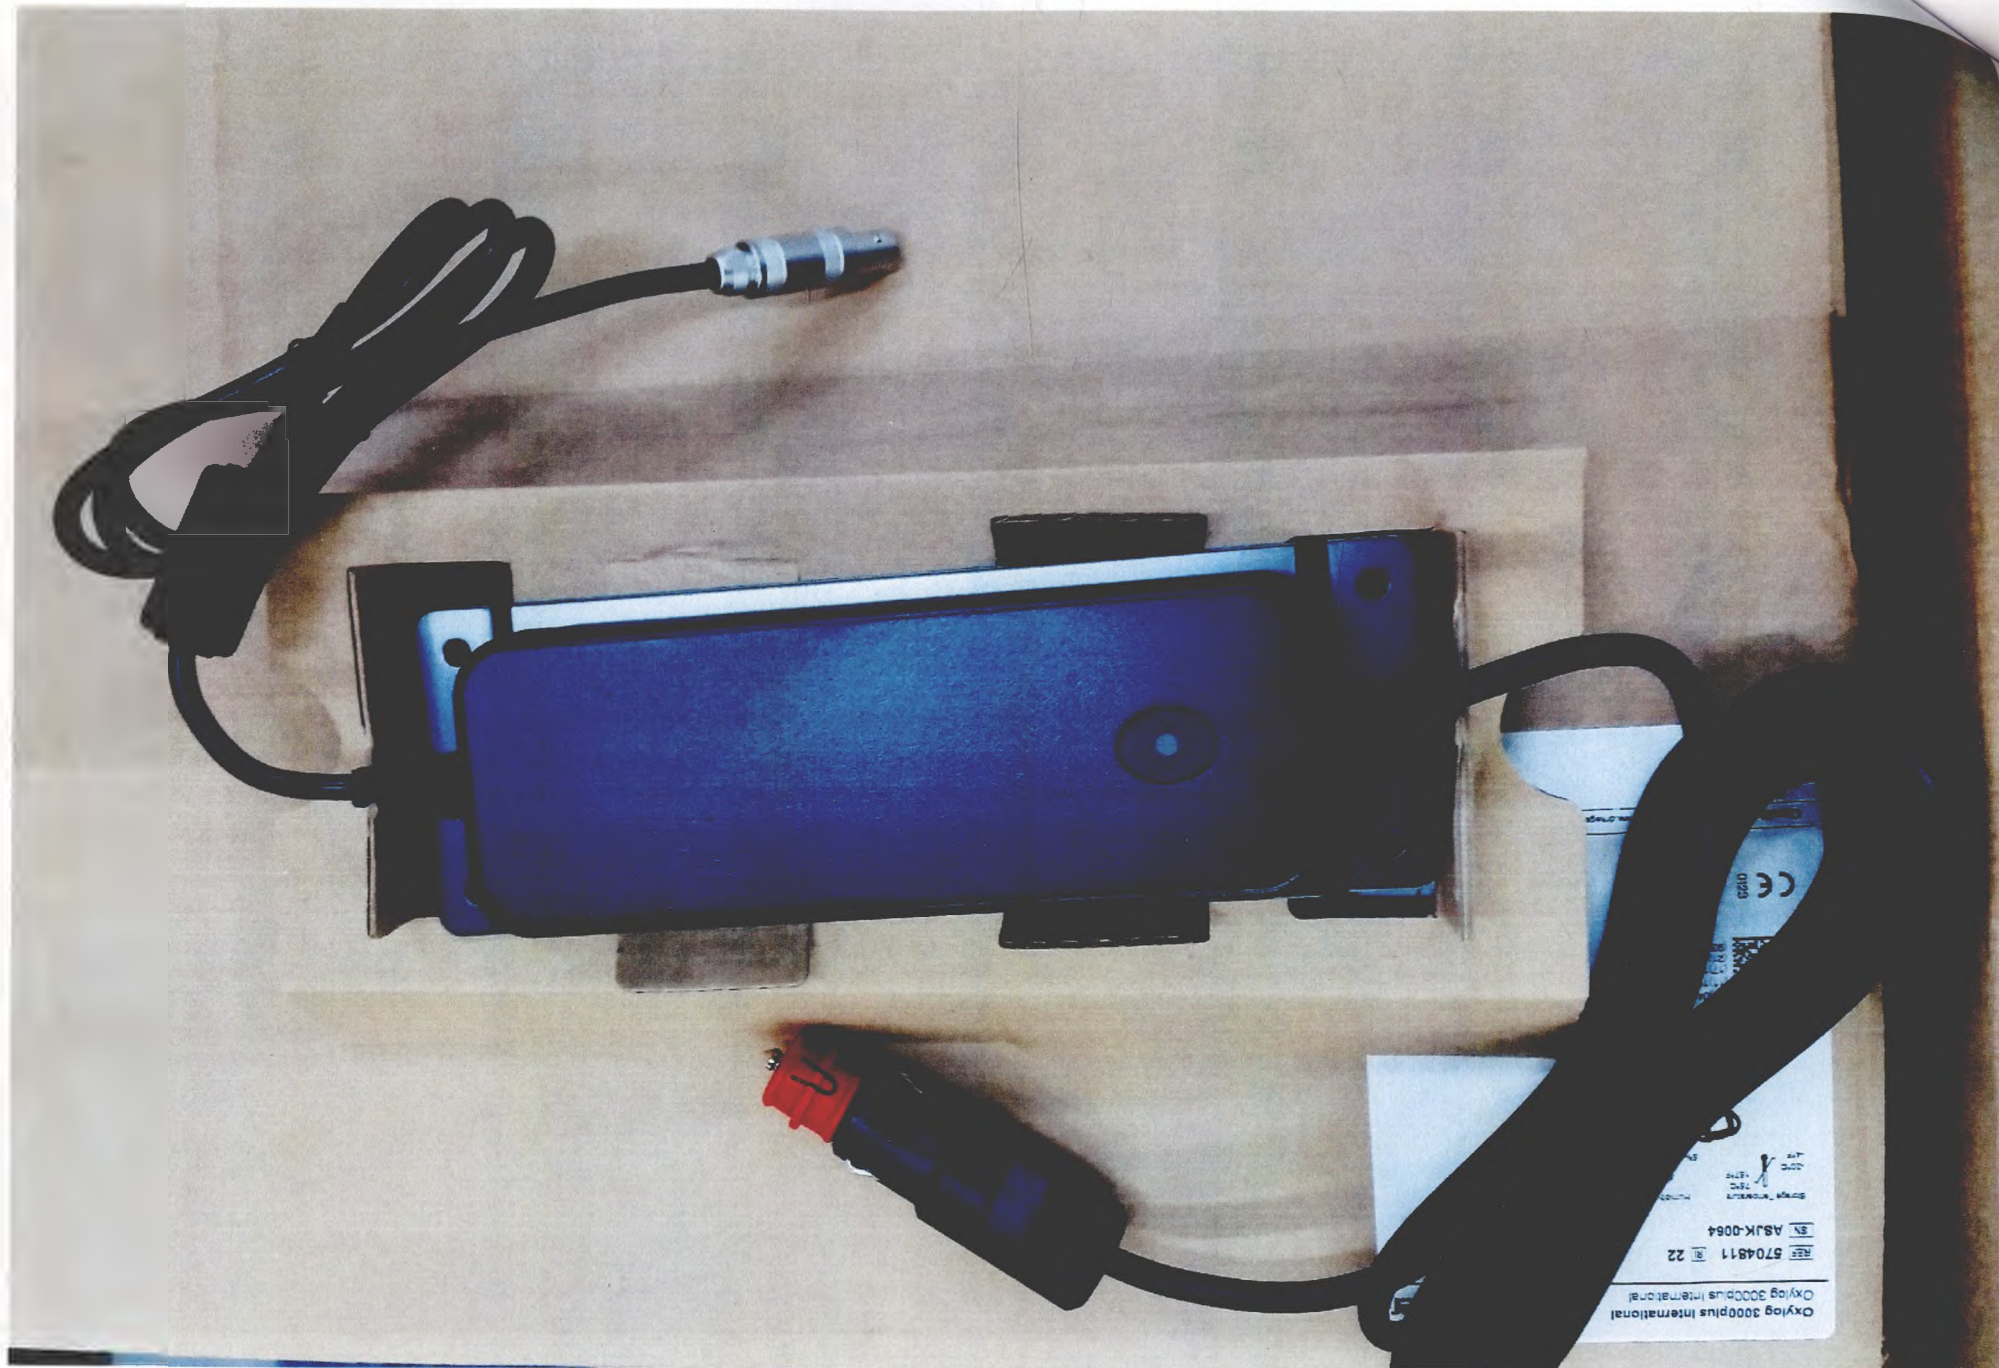

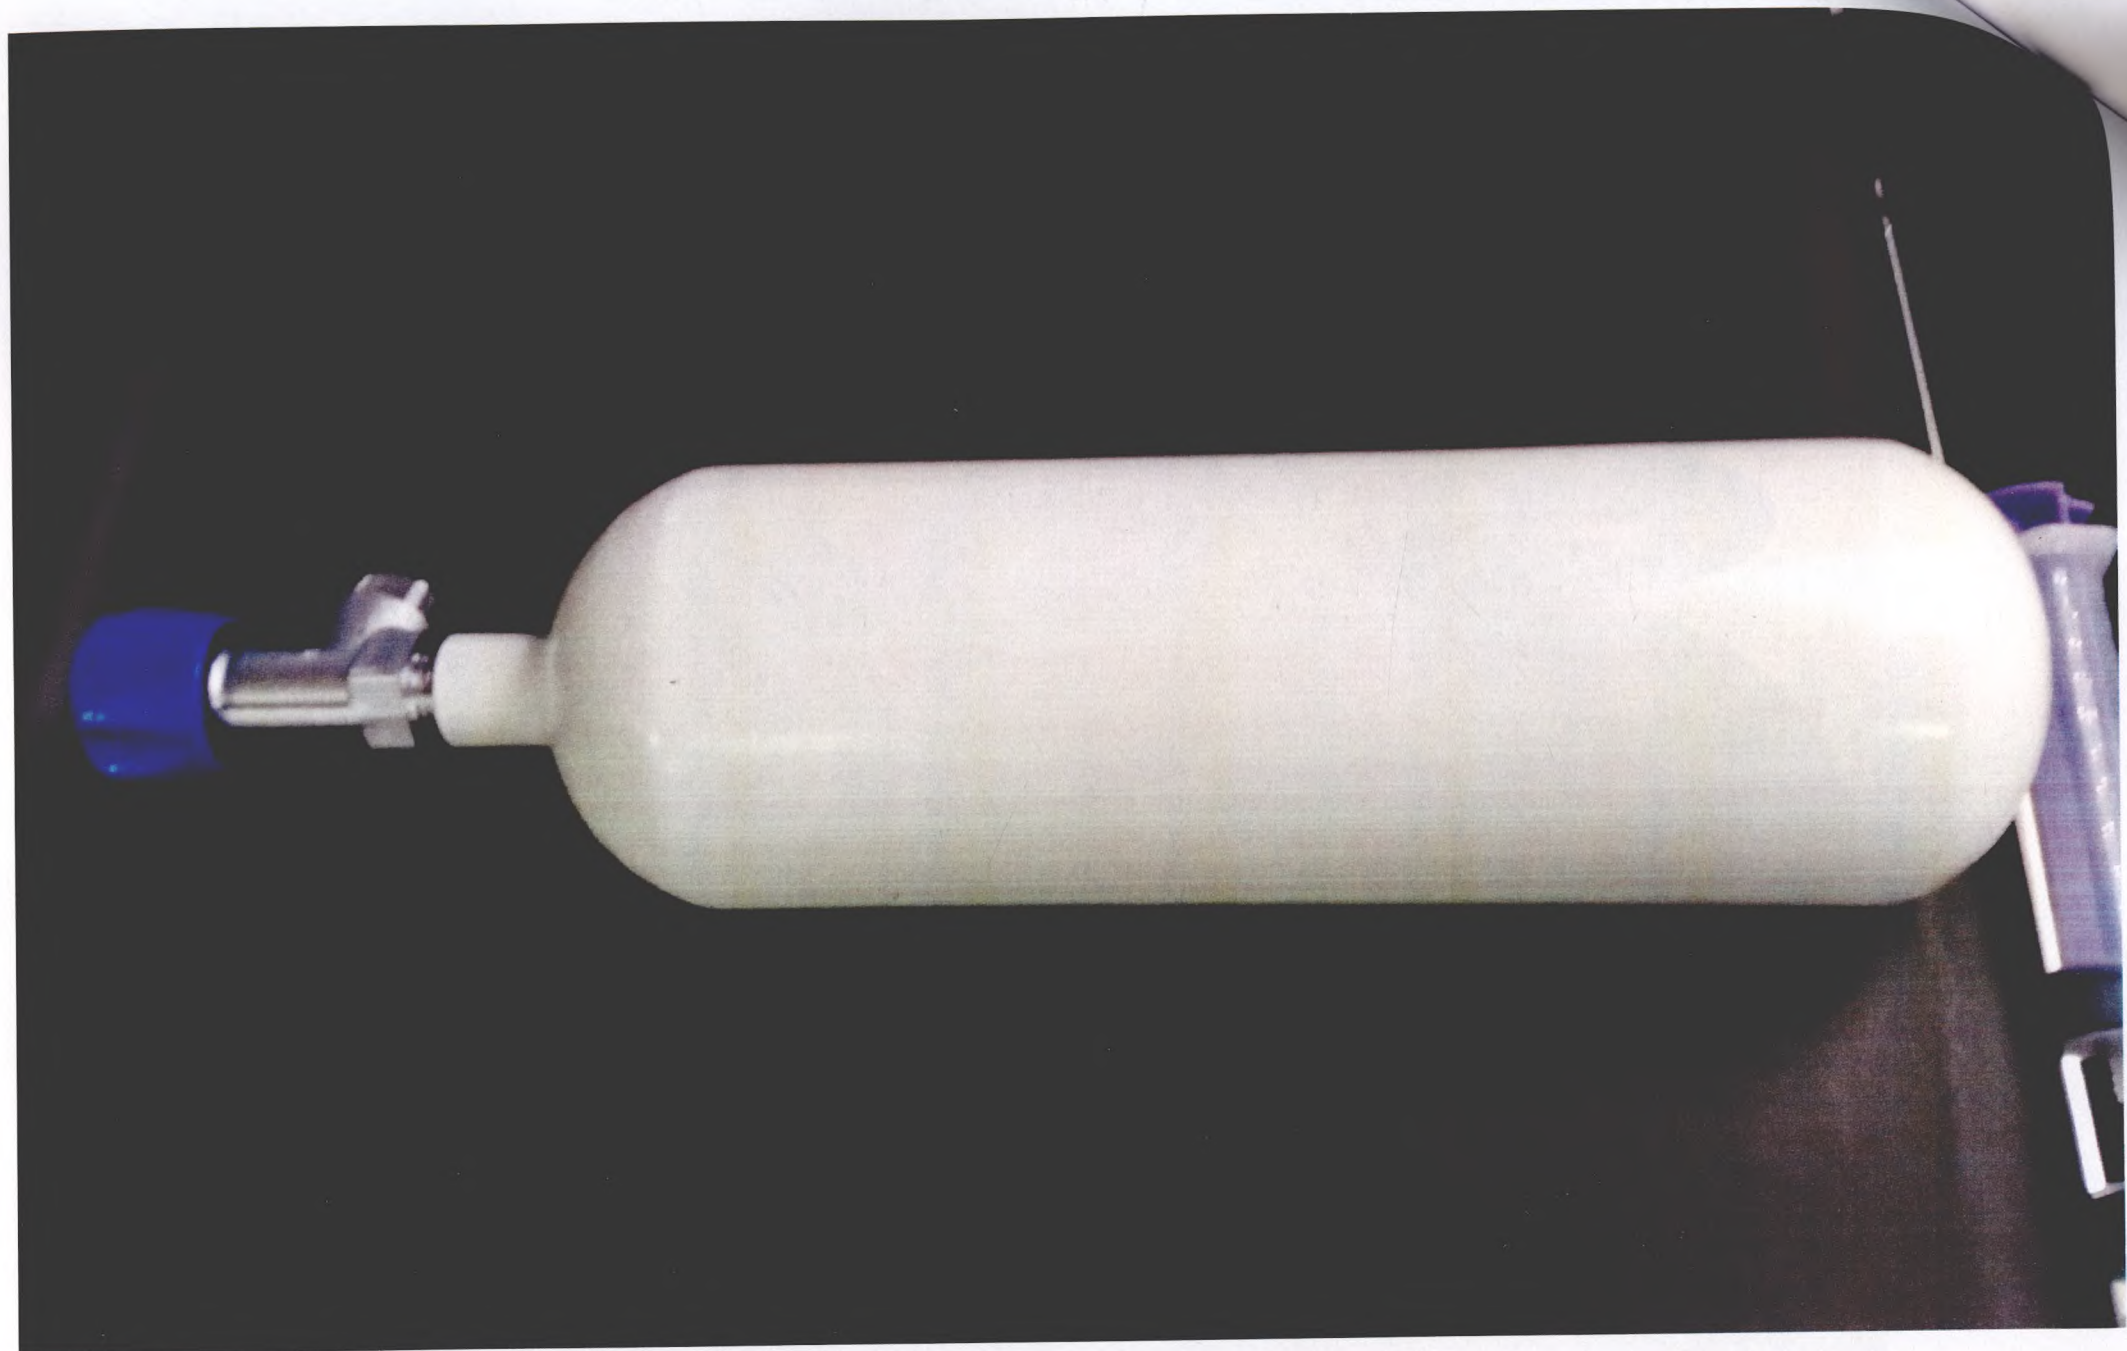

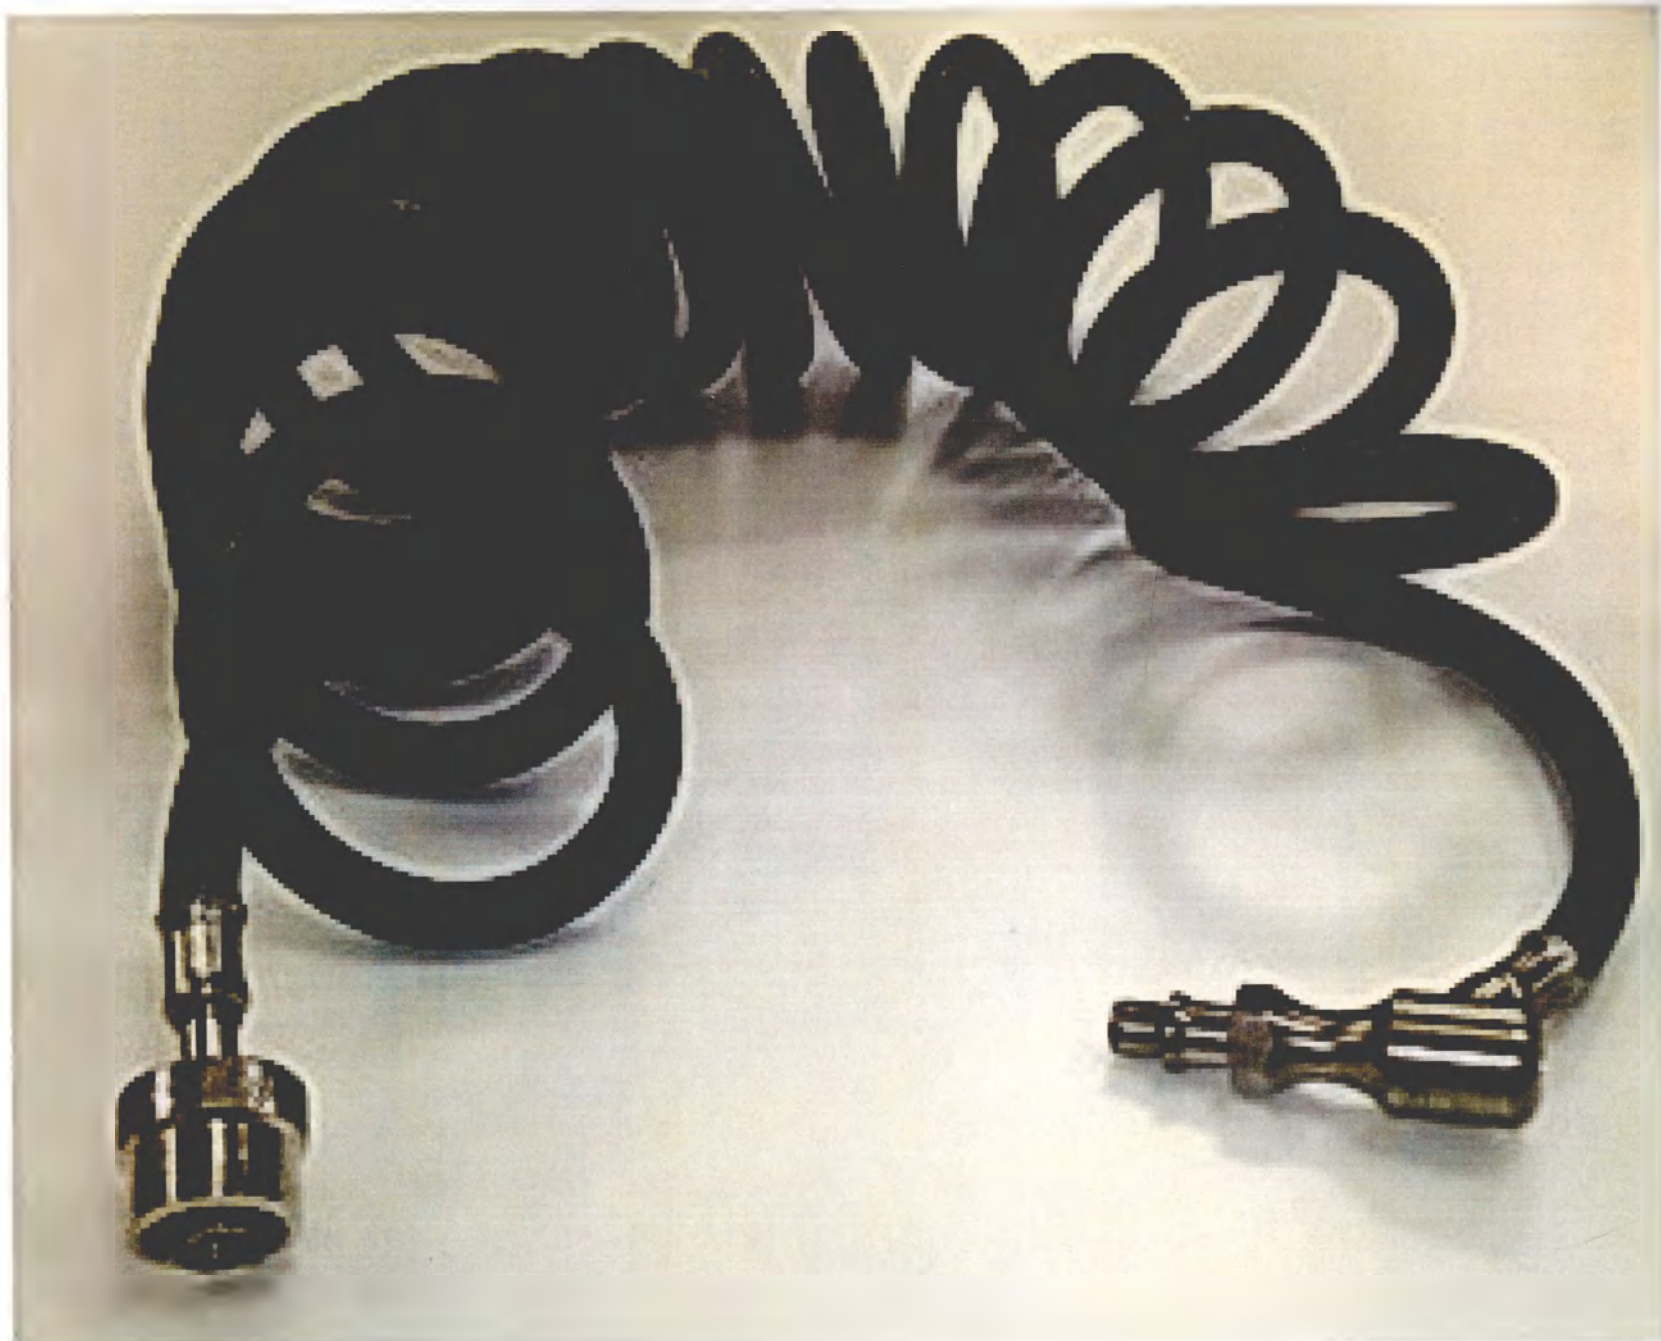

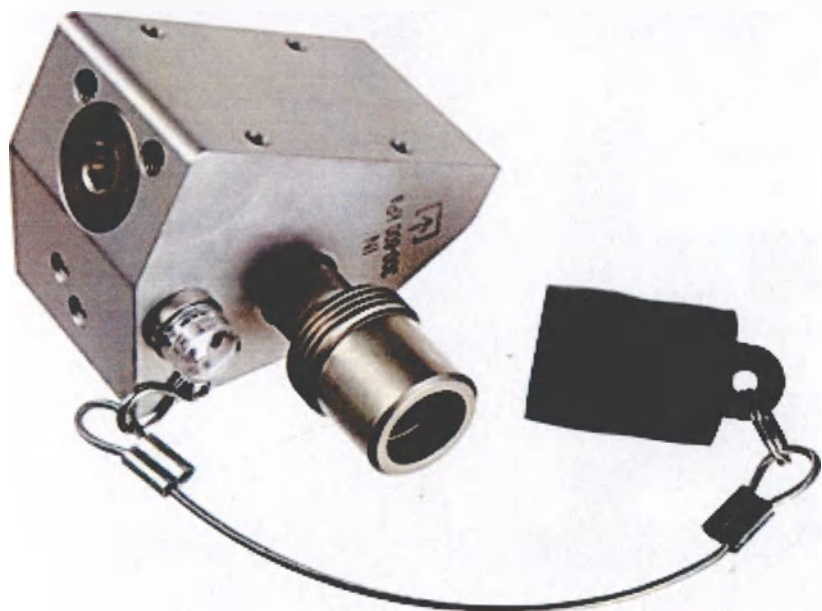

Комплект автоматического переключения O2: 1. переключатель O2. 2. шланги - 2 шт.



Dräger

Use by

2017-08-07

Dräger

Certificate of Software License

Kit Capnography (including park
holder, CO2 sensor, CO2 cuvette
adult)

OPC Number

OPC6598

Part number

8420766

Serial number of device:

ID of device: 8414060

Dräger

Certificate of Software License

Kit AutoFlow

OPC Number

OPC6798

Part number

8420767

Serial number of device:

ID of device: 8414060

Dräger

Certificate of Software License

Kit PS

OPC Number

OPC6636

Part number

8421316

Serial number of device:

ID of device: 8414060



Certificate of Software License

Kit Special Maneuvers

OPC Number

OPC6631

Part number

8421315

Serial number of device:

ID of device: 8414060



Oxylog 3000 plus

Dräger

IPX4



CE 0123



REF 5704811 RI 22

 2017-03-01

SN XXXX-1234



(01)04048675249221

(11)160996

(21)XXXX-1234

(93)5704811-22

www.draeger.com

Made in Germany



Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, Germany


Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

Аппарат для ИВЛ Oxylog 3000 plus

Dräger

REF 5704811 RI 22

SN XXXX-1234



(01)04048675249221
(11)160996

(21)XXXX-1234
(93)5704811-22



Quantity: 1

For USA: Rx only

Quality by Dräger

www.draeger.com



Drägerwerk AG & Co. KGaA
Morslinger Allee 53-55
23542 Lubeck, Germany

Система дыхательная для взрослых
1,5 м многоразовая

Dräger

REF MP01390 RI 00

LOT XXXX-1234



2017-03-15



2999-12-31



LATEX

NON
STERILE



-40°C 75°C

5% 95%

570 гПа 1200 гПа



1



101104048675541103
(11)170315
(17)991231
(10)XXXX-1234
(93)MP01390-00

CE 0123

Quality by Dräger

www.draeger.com

Made in Germany



Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moisinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

MP02314-20170315

Система дыхательная для детей
1,5 м одноразовая

Dräger

REF 5702871 RI 23

LOT XXXX

 2017-08-28

 2020-08-28



(01)04048675425670

(11)170828

(10)XXXX


(93)5702871-23

-20°C  50°C

5%  95%

570 гПа  1200 гПа

CE 0123



1

Quality by Dräger

www.draeger.com

Made in Germany



Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, Germany

Макет маркировки для систем дыхательных одноразовых

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
52 листа (ов)

