

ВНЕШНИЙ ВИД МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к микобактериям туберкулеза в образцах сыворотки (плазмы) человека»
«БиоТрейсер Туберкулёз»**

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к микобактериям туберкулеза в образцах сыворотки (плазмы) человека

Био Трейсер Туберкулёз

Хранить при температуре 2-30°С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием


Состав:
- тест-кассета: 30 шт
- одноразовая пипетка для образцов: 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 01
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021


TU 21.20.23-005-15580960-2019

РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов




Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к микобактериям туберкулеза в образцах сыворотки (плазмы) человека

Био Трейсер Туберкулёз

Состав:
- тест-кассета: 30 шт
- одноразовая пипетка для образцов: 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Состав:

- тест-кассета: 30 шт
- одноразовая пипетка для образцов: 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт

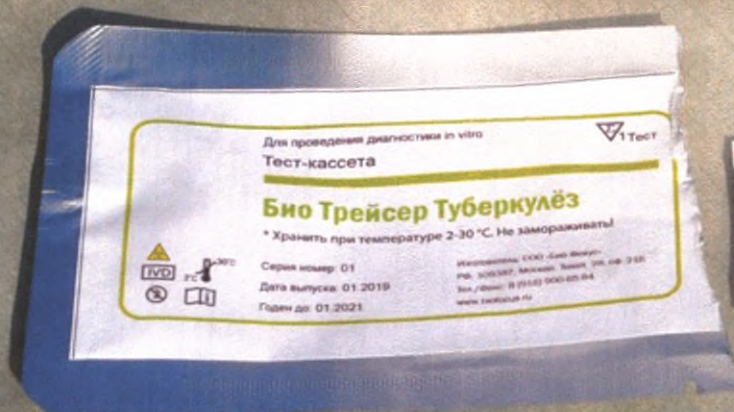

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Туберкулёз

* Хранить при температуре 2-30°С. Не замораживать!

Серия номер: 01
Дата выпуска: 01.2019
Годен до: 01.2021


Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



Туберкулёз

С

Т

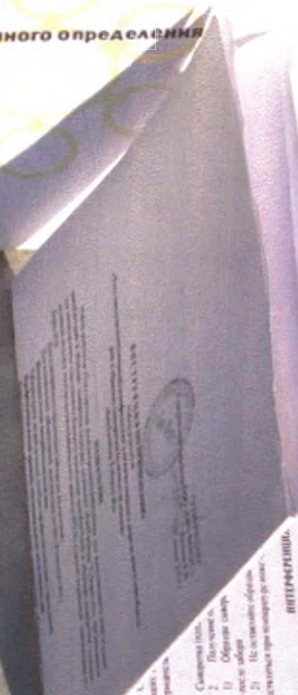

Инструкция по применению

1. Назначение

2. Состав

3. Порядок использования

4. Результаты

5. Срок годности

6. Условия хранения

7. Контактная информация

8. Выходные данные

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов
Генеральный директор
«БИО-ФОКУС» Козлов К.В.

